

Фотографические изображения медицинского изделия

Денситометр рентгеновский костный полноформатный Lunar iDXA с принадлежностями

УТВЕРЖДАЮ


Специалист по регистрации

ООО «ДжиИ Хэлскеа»


Ю.Н.Дорофеева


« 21 » апреля 2020 г.

Денситометр рентгеновский костный полноформатный Lunar iDXA с принадлежностями:

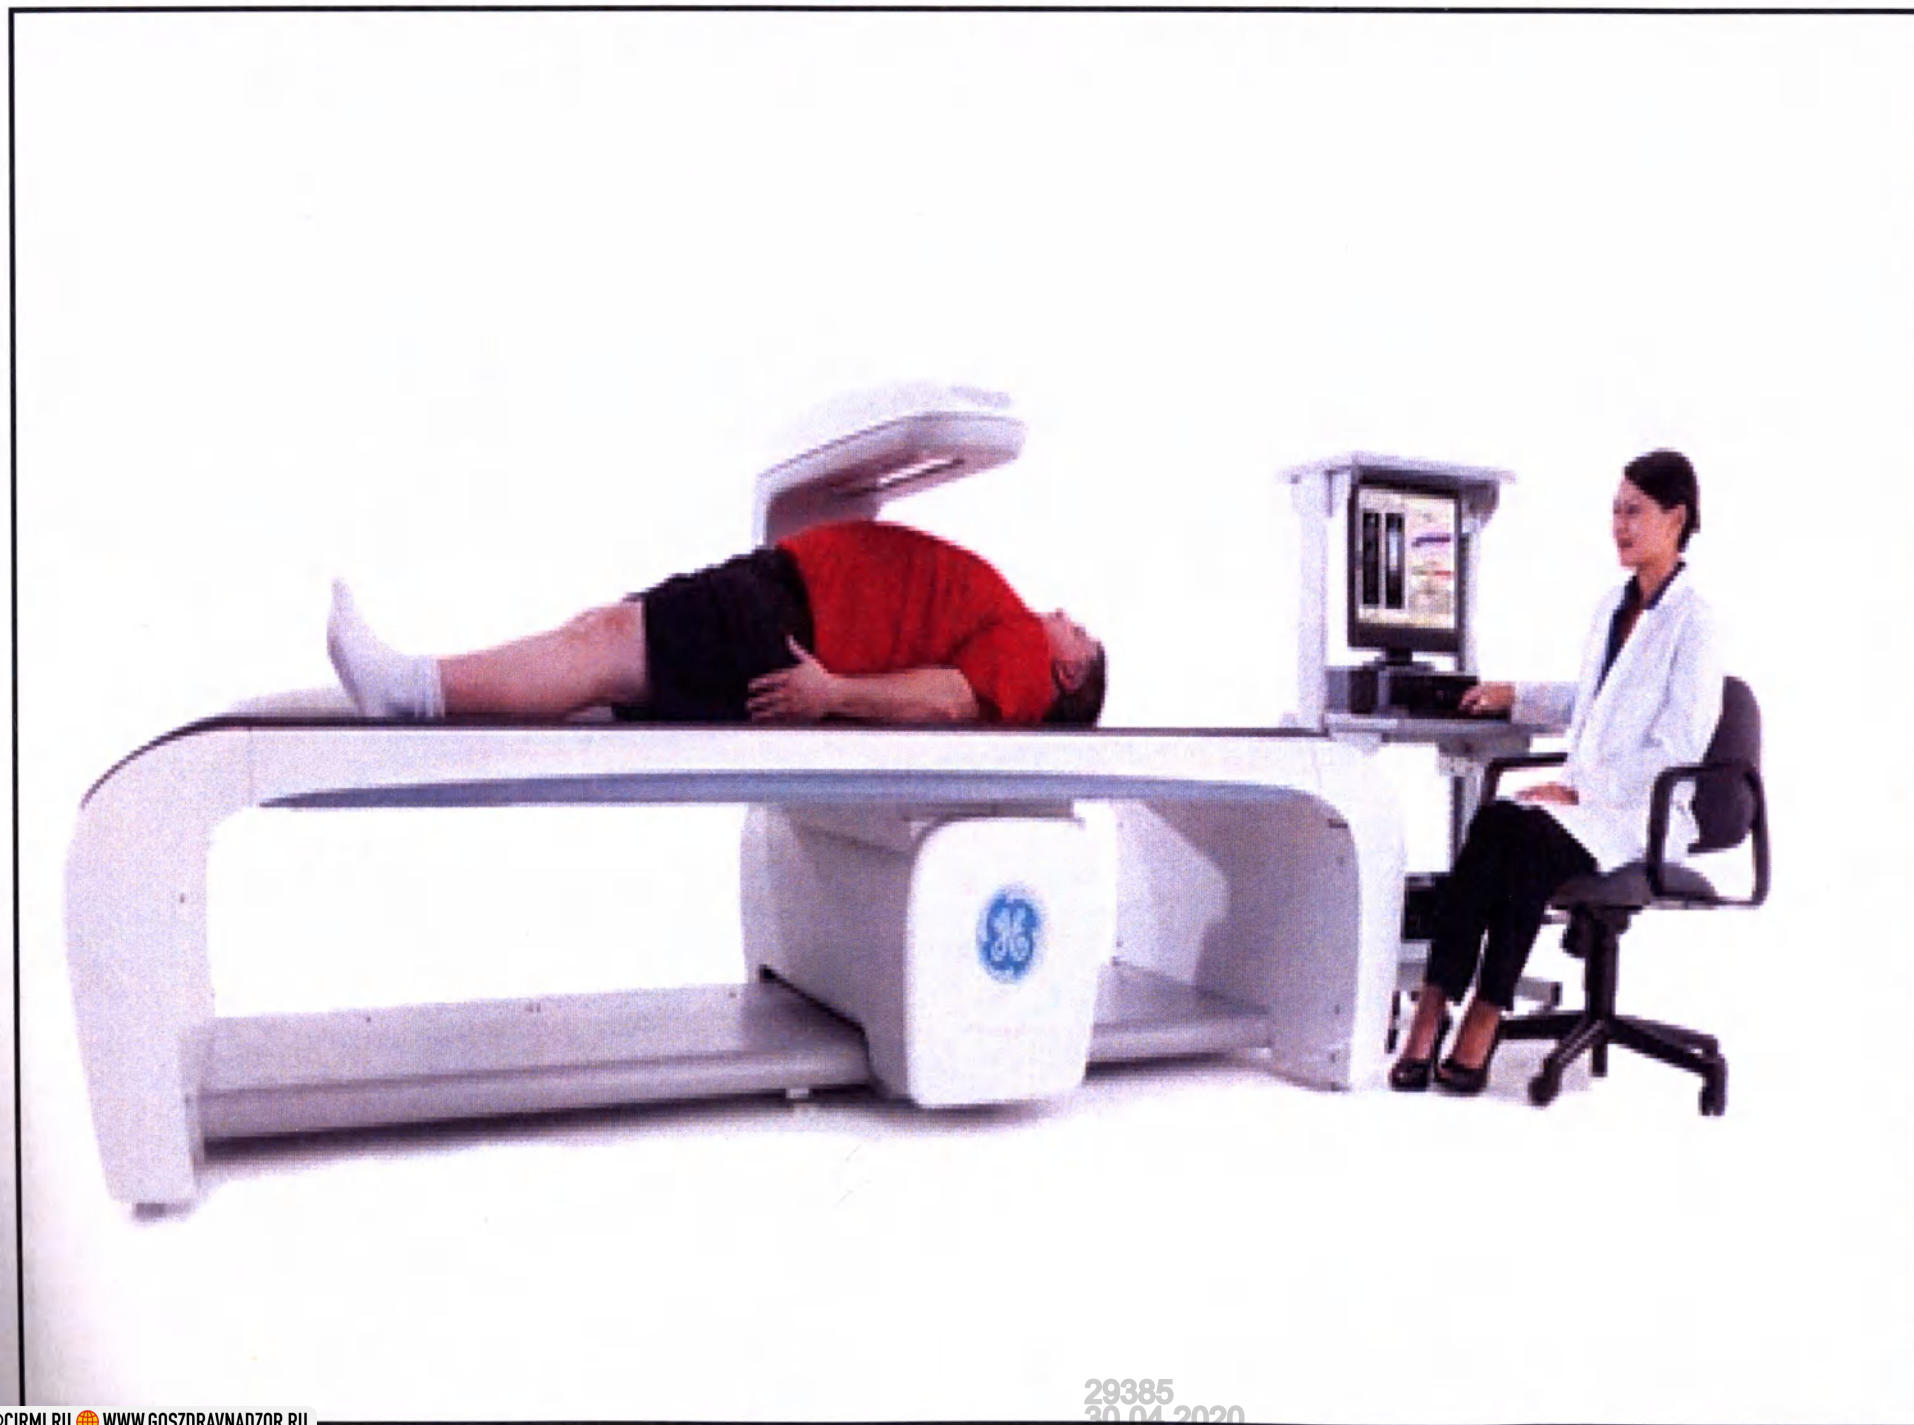

Денситометр рентгеновский костный полноформатный Lunar iDXA с принадлежностями:

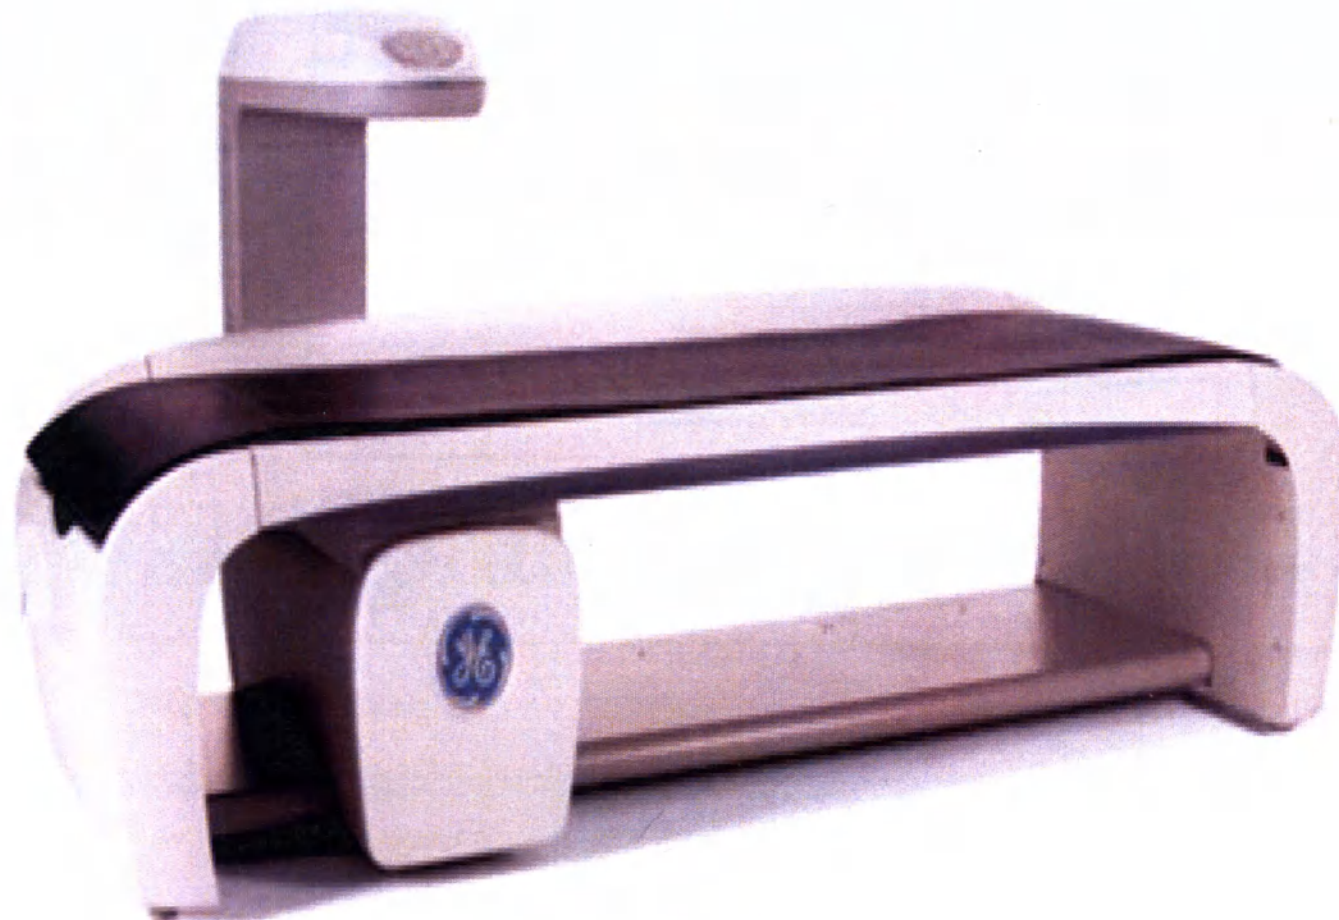


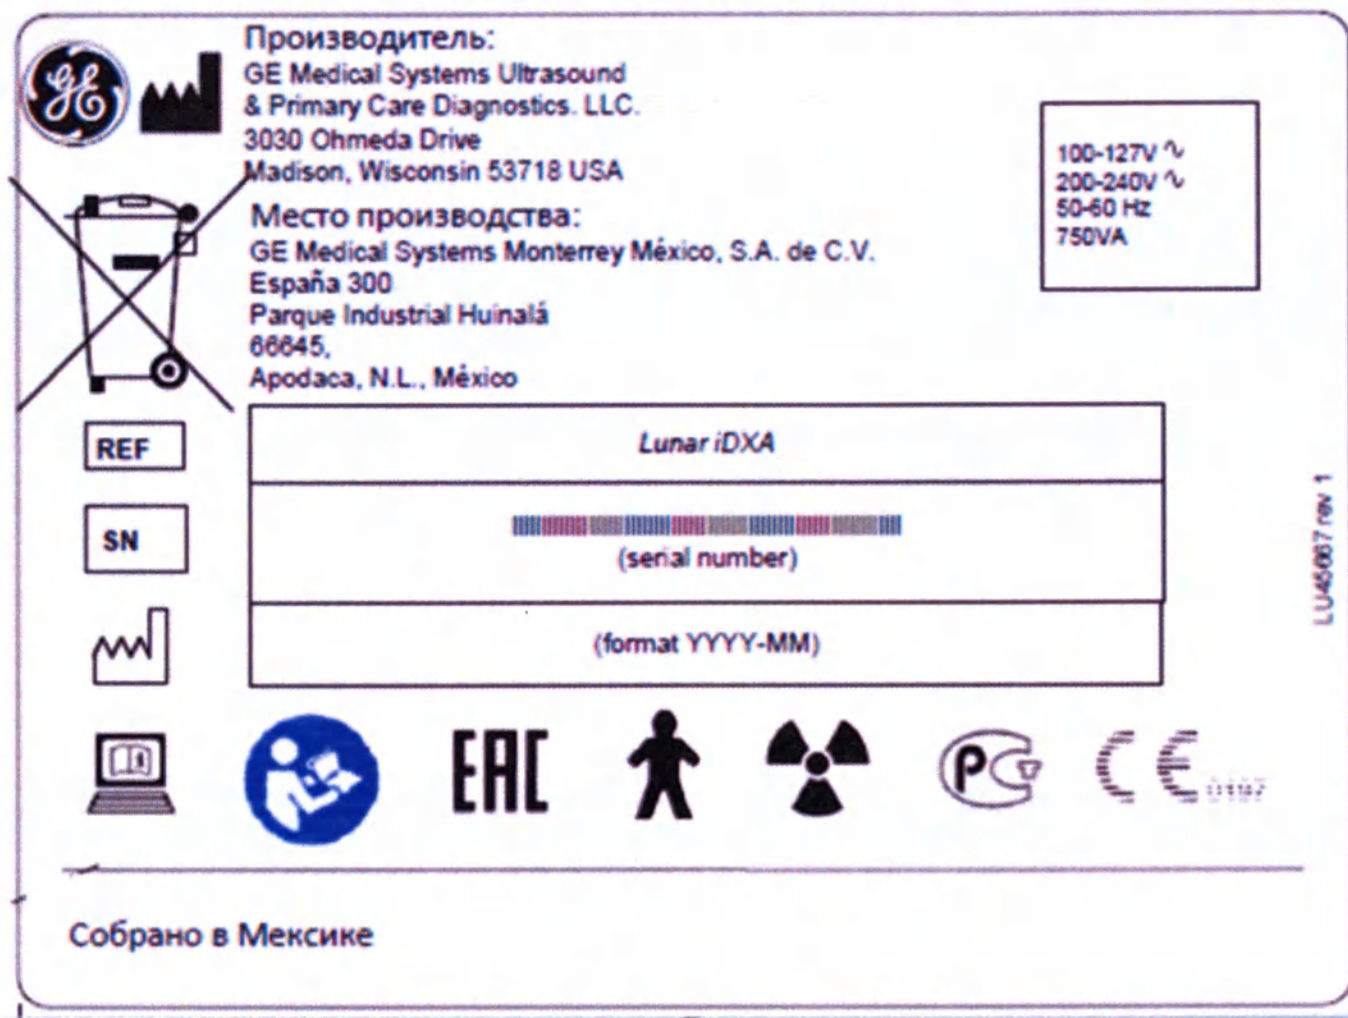


I.Основной состав: 1.Стол для пациента полноразмерный.




2.Трубка рентгеновская.

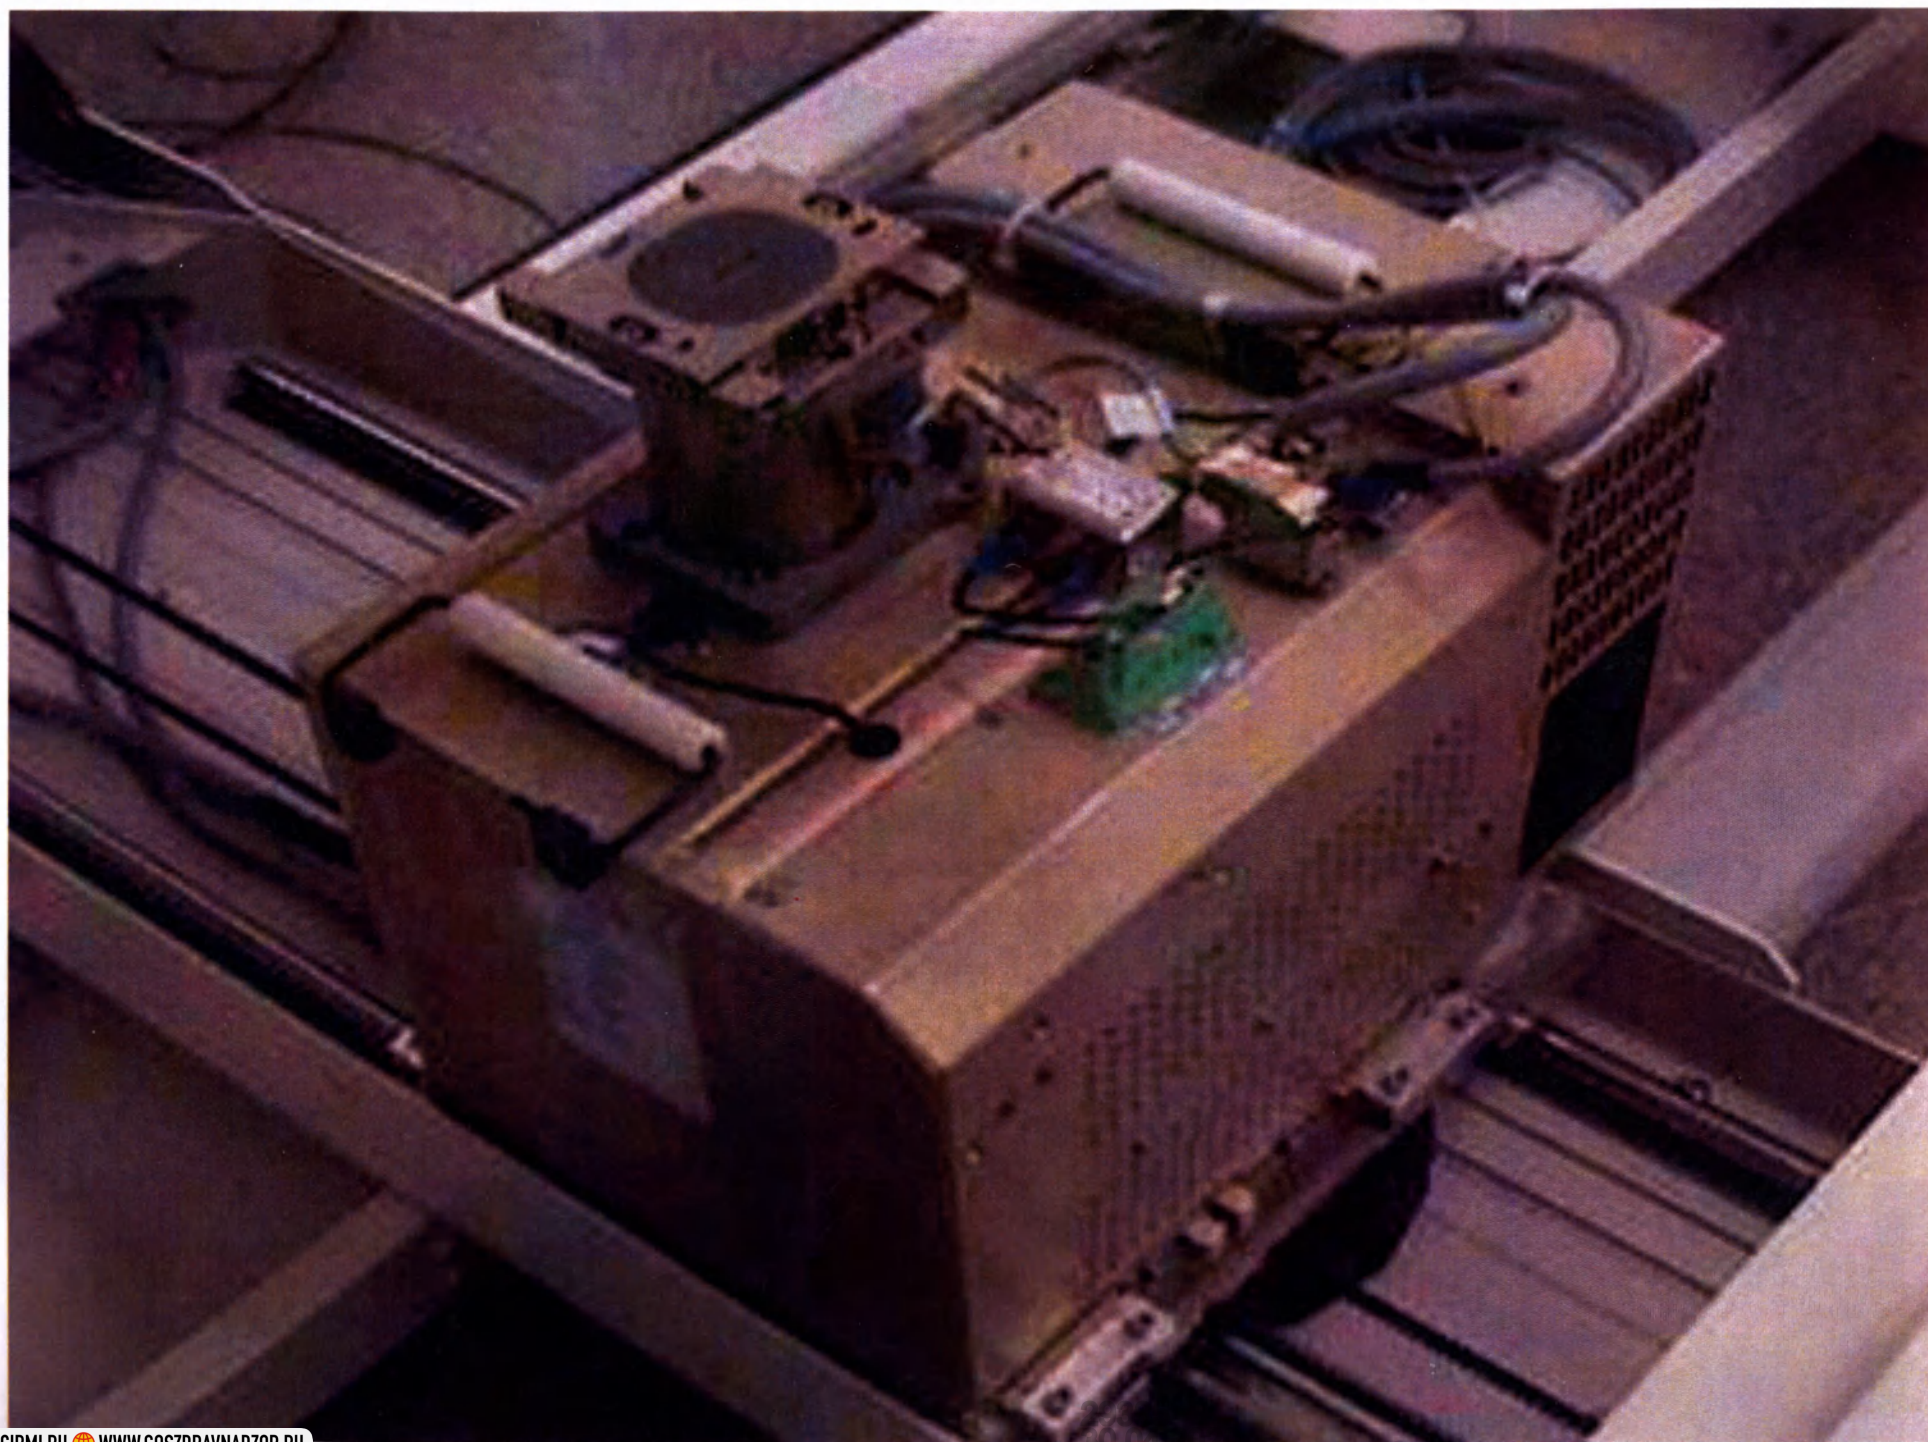


3.К-контурный фильтр.

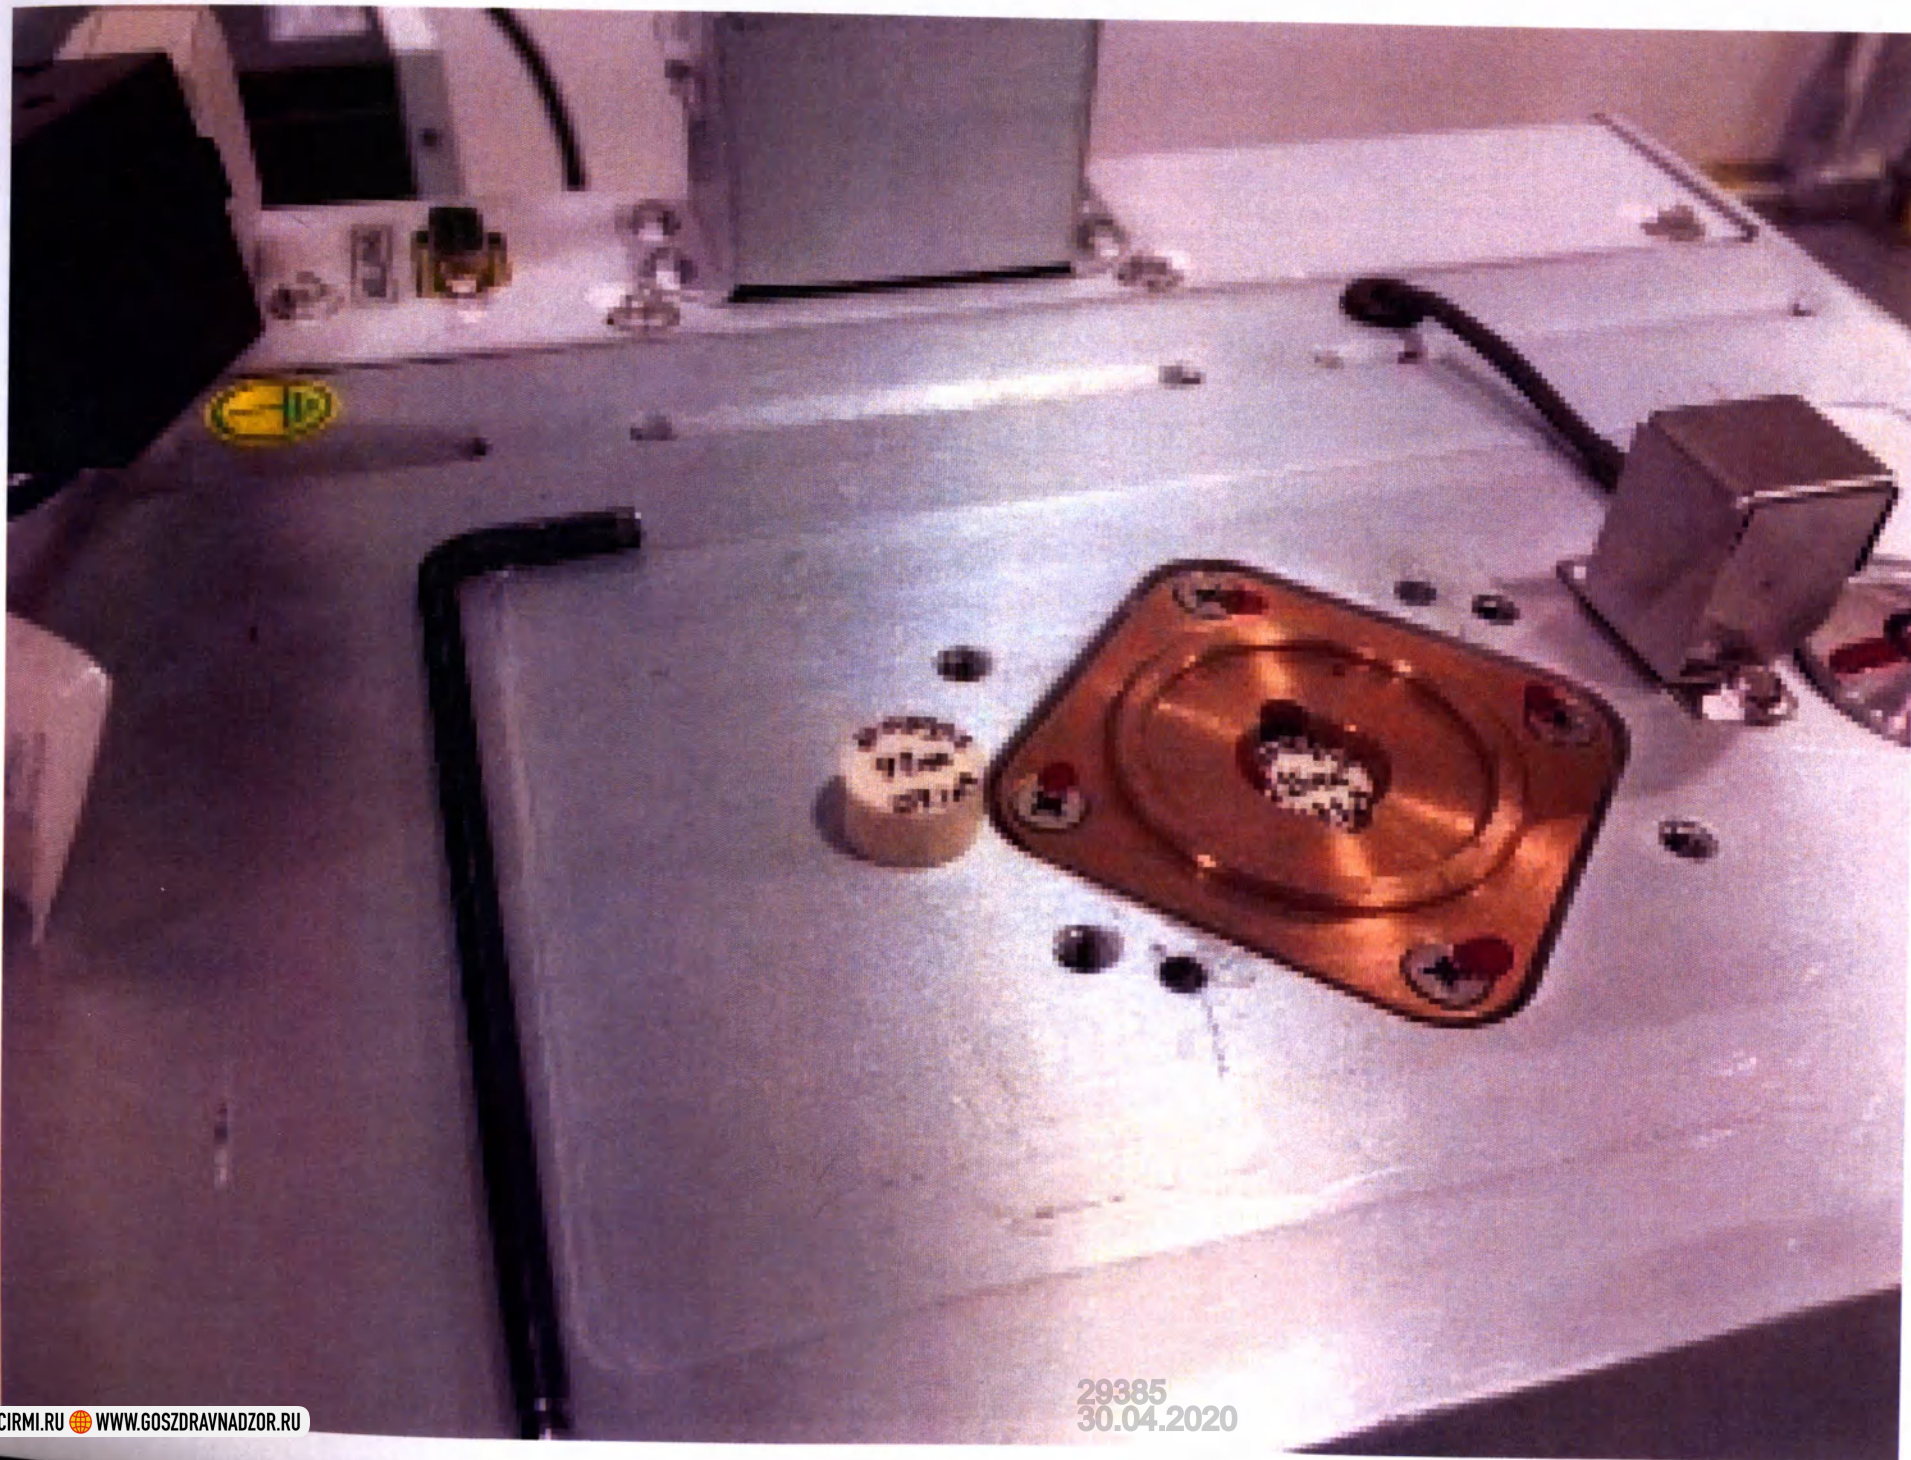


4. Детектор цифровой.

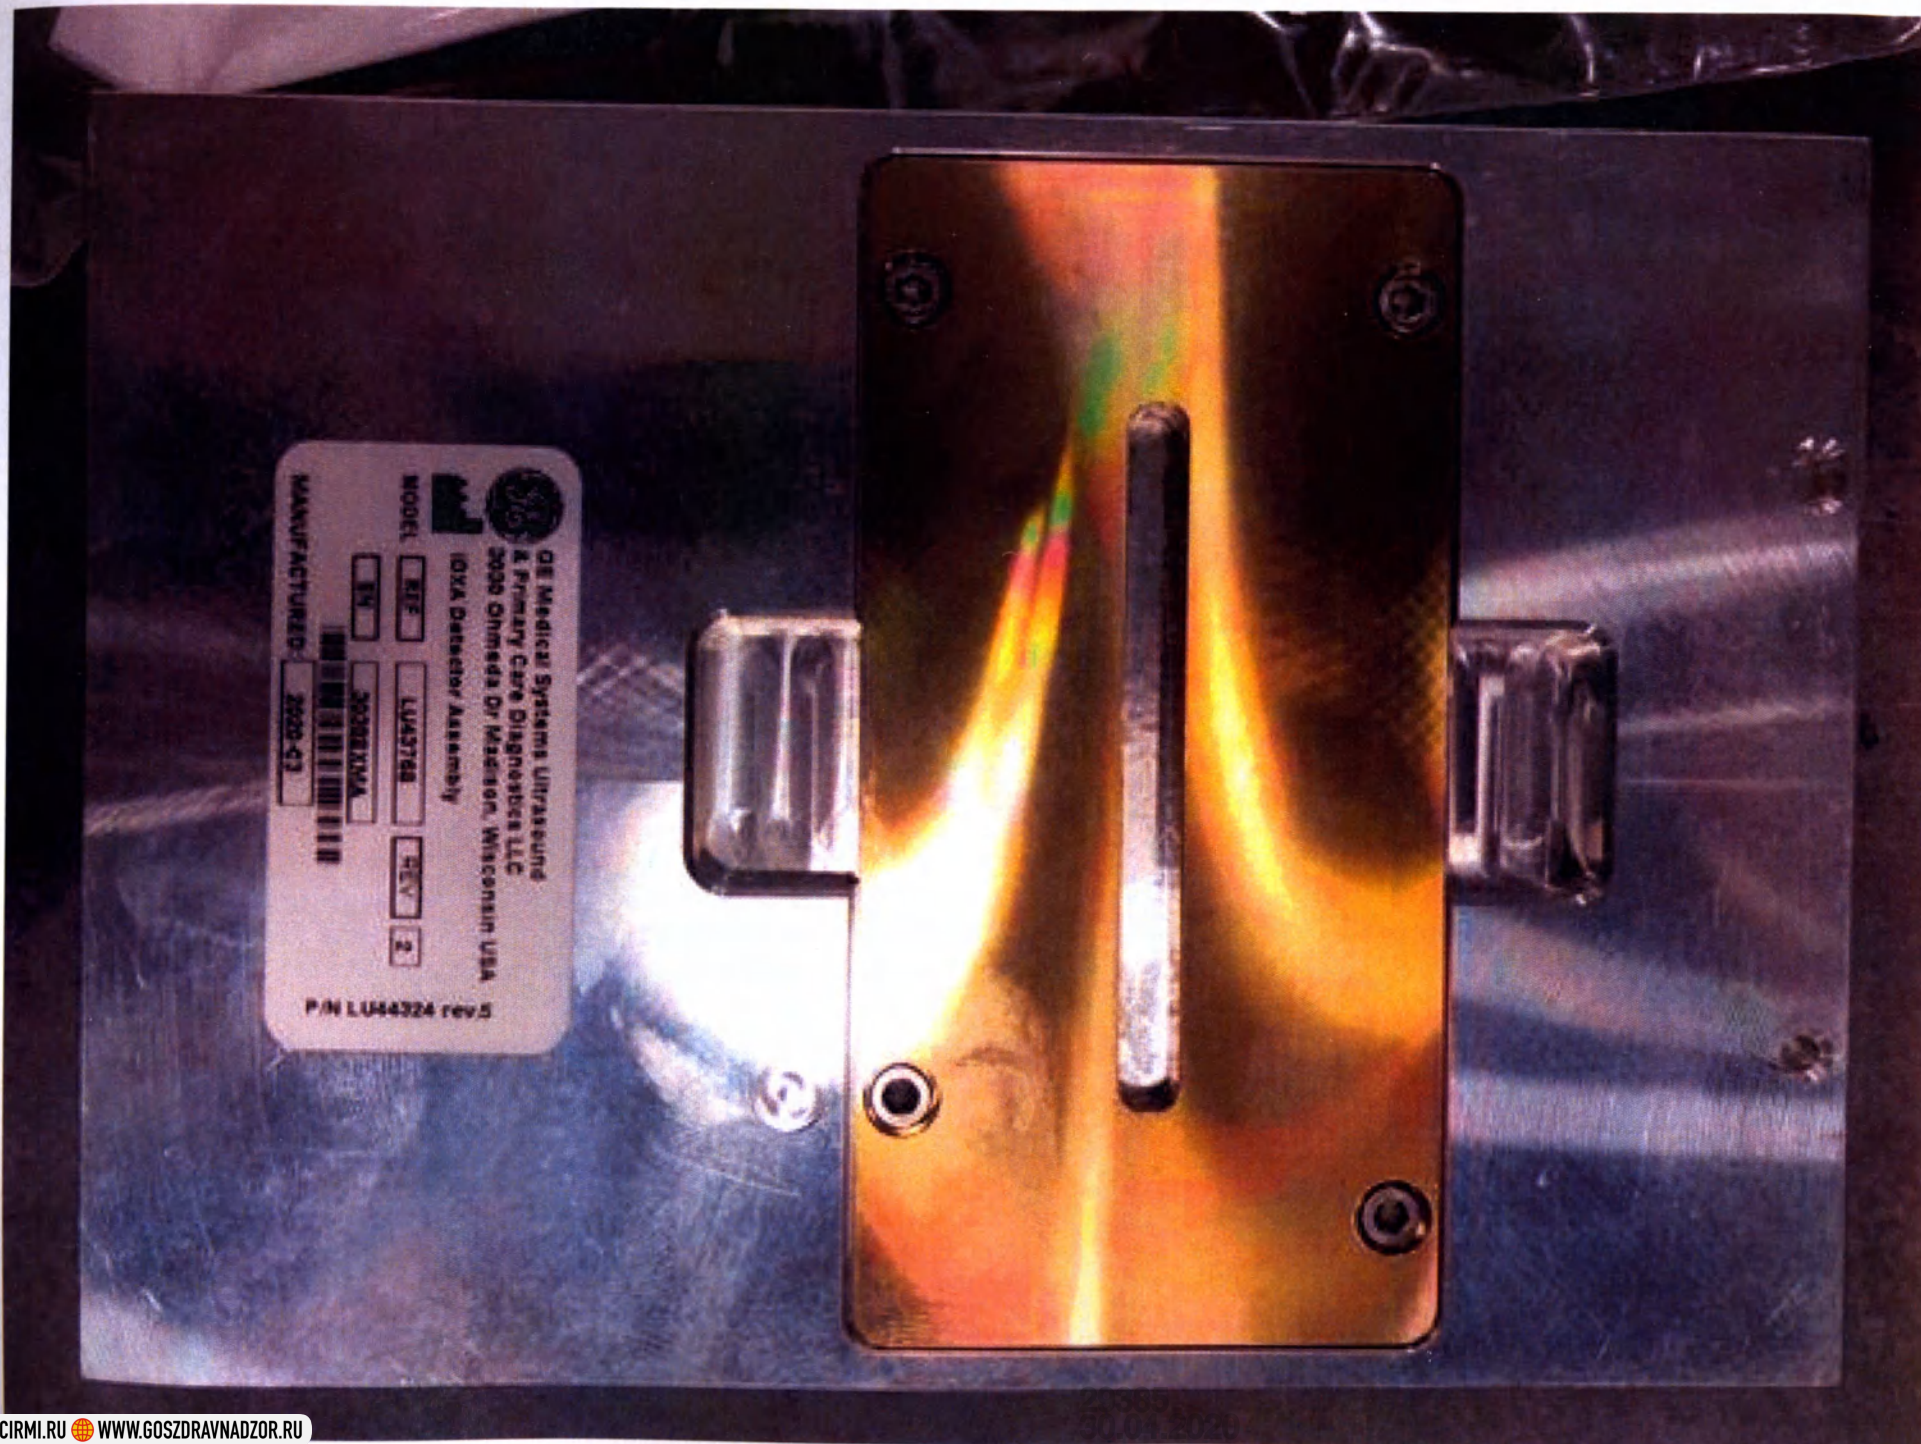


5. Устройство питающее.

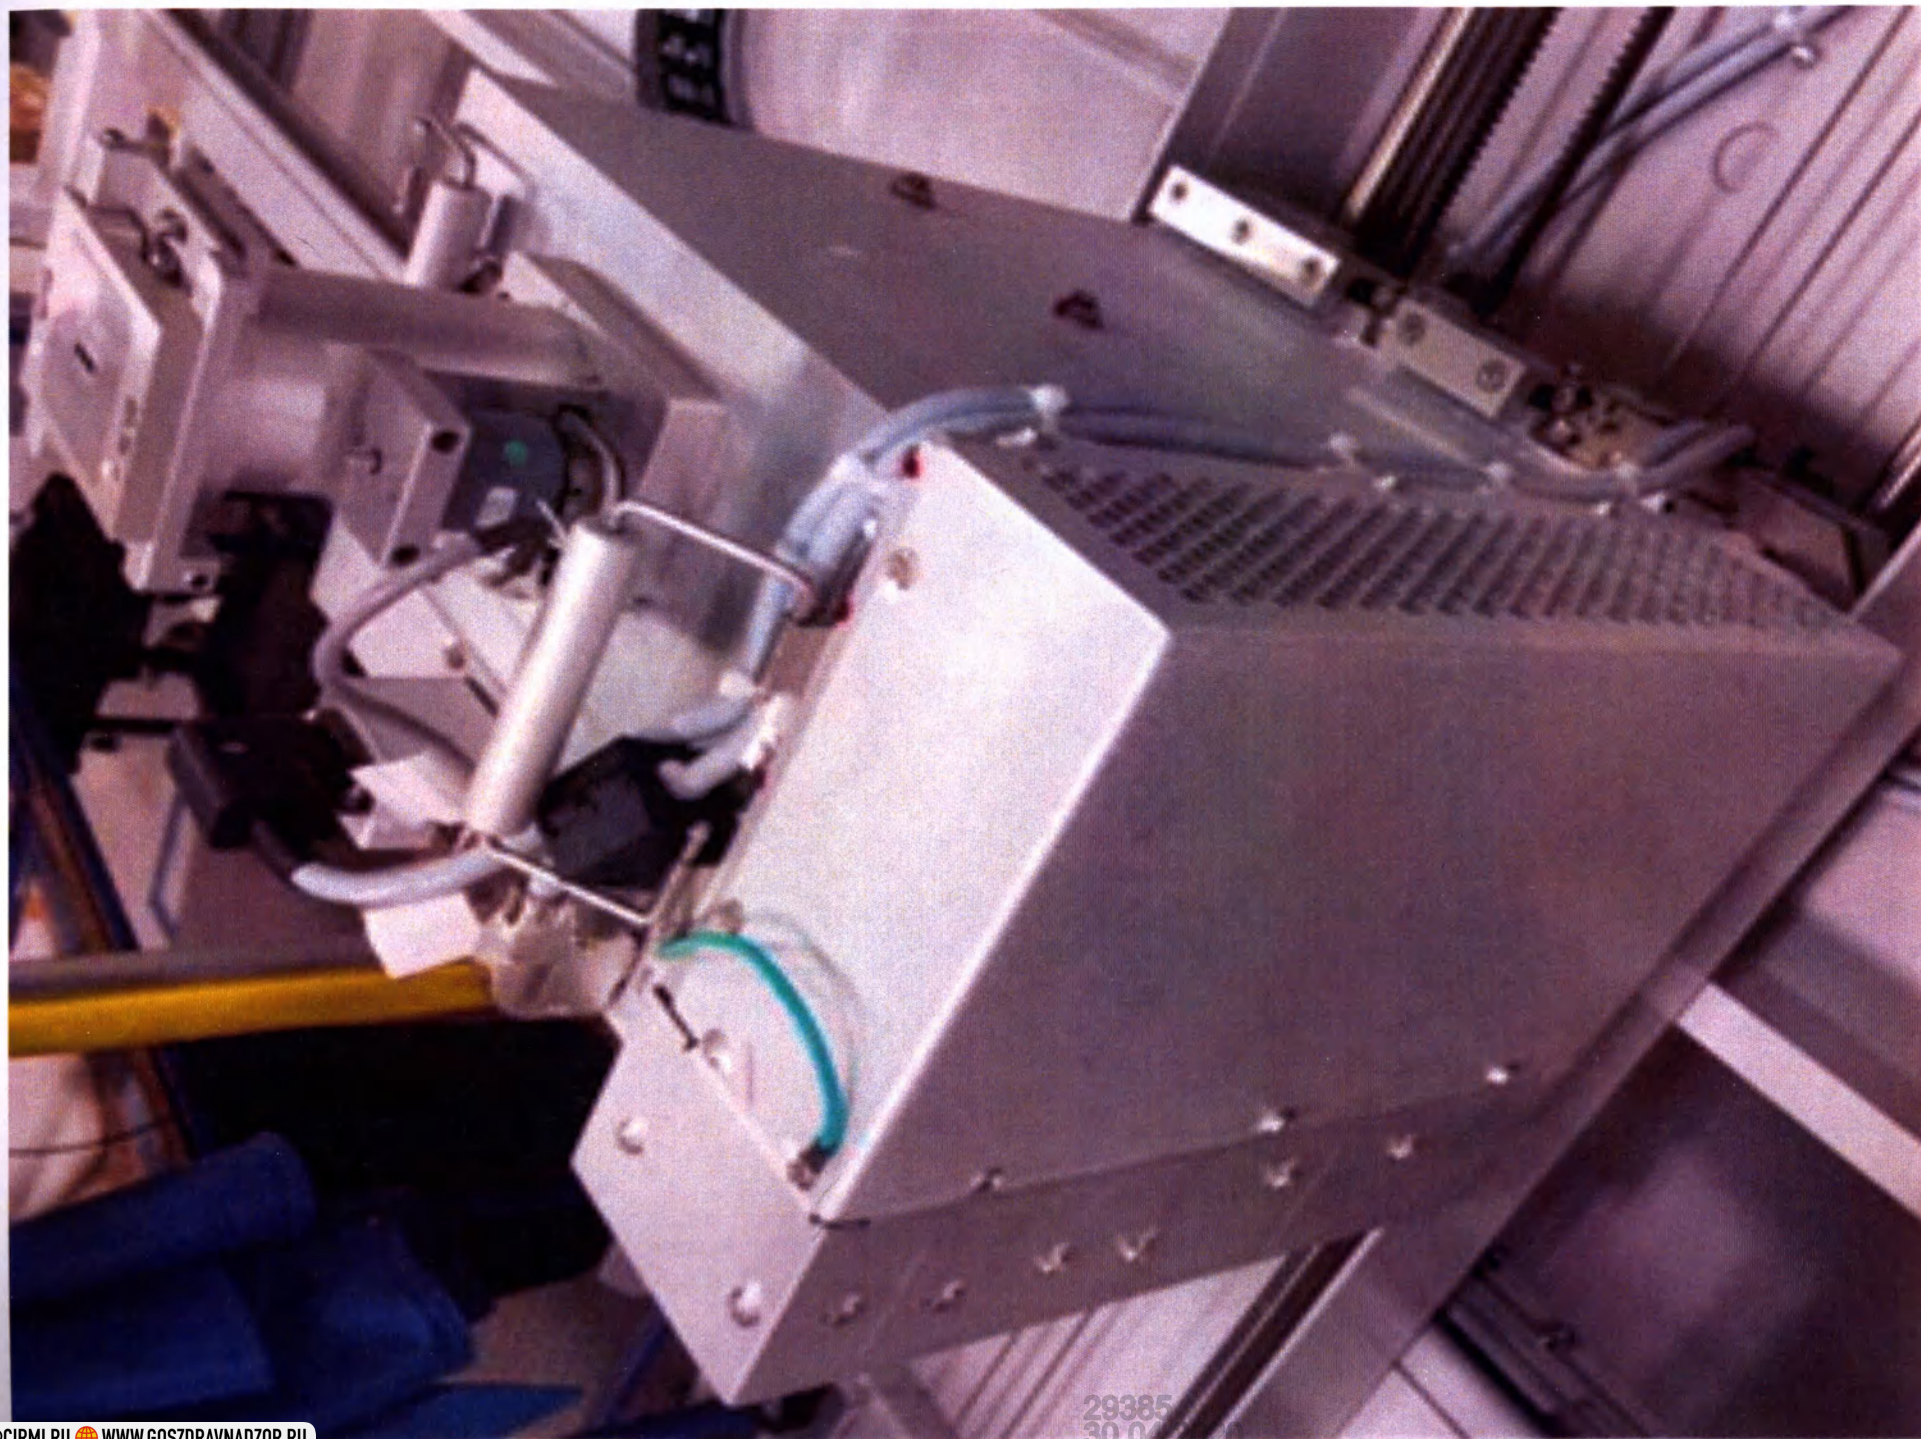

6. Программное обеспечение для денситометрии.

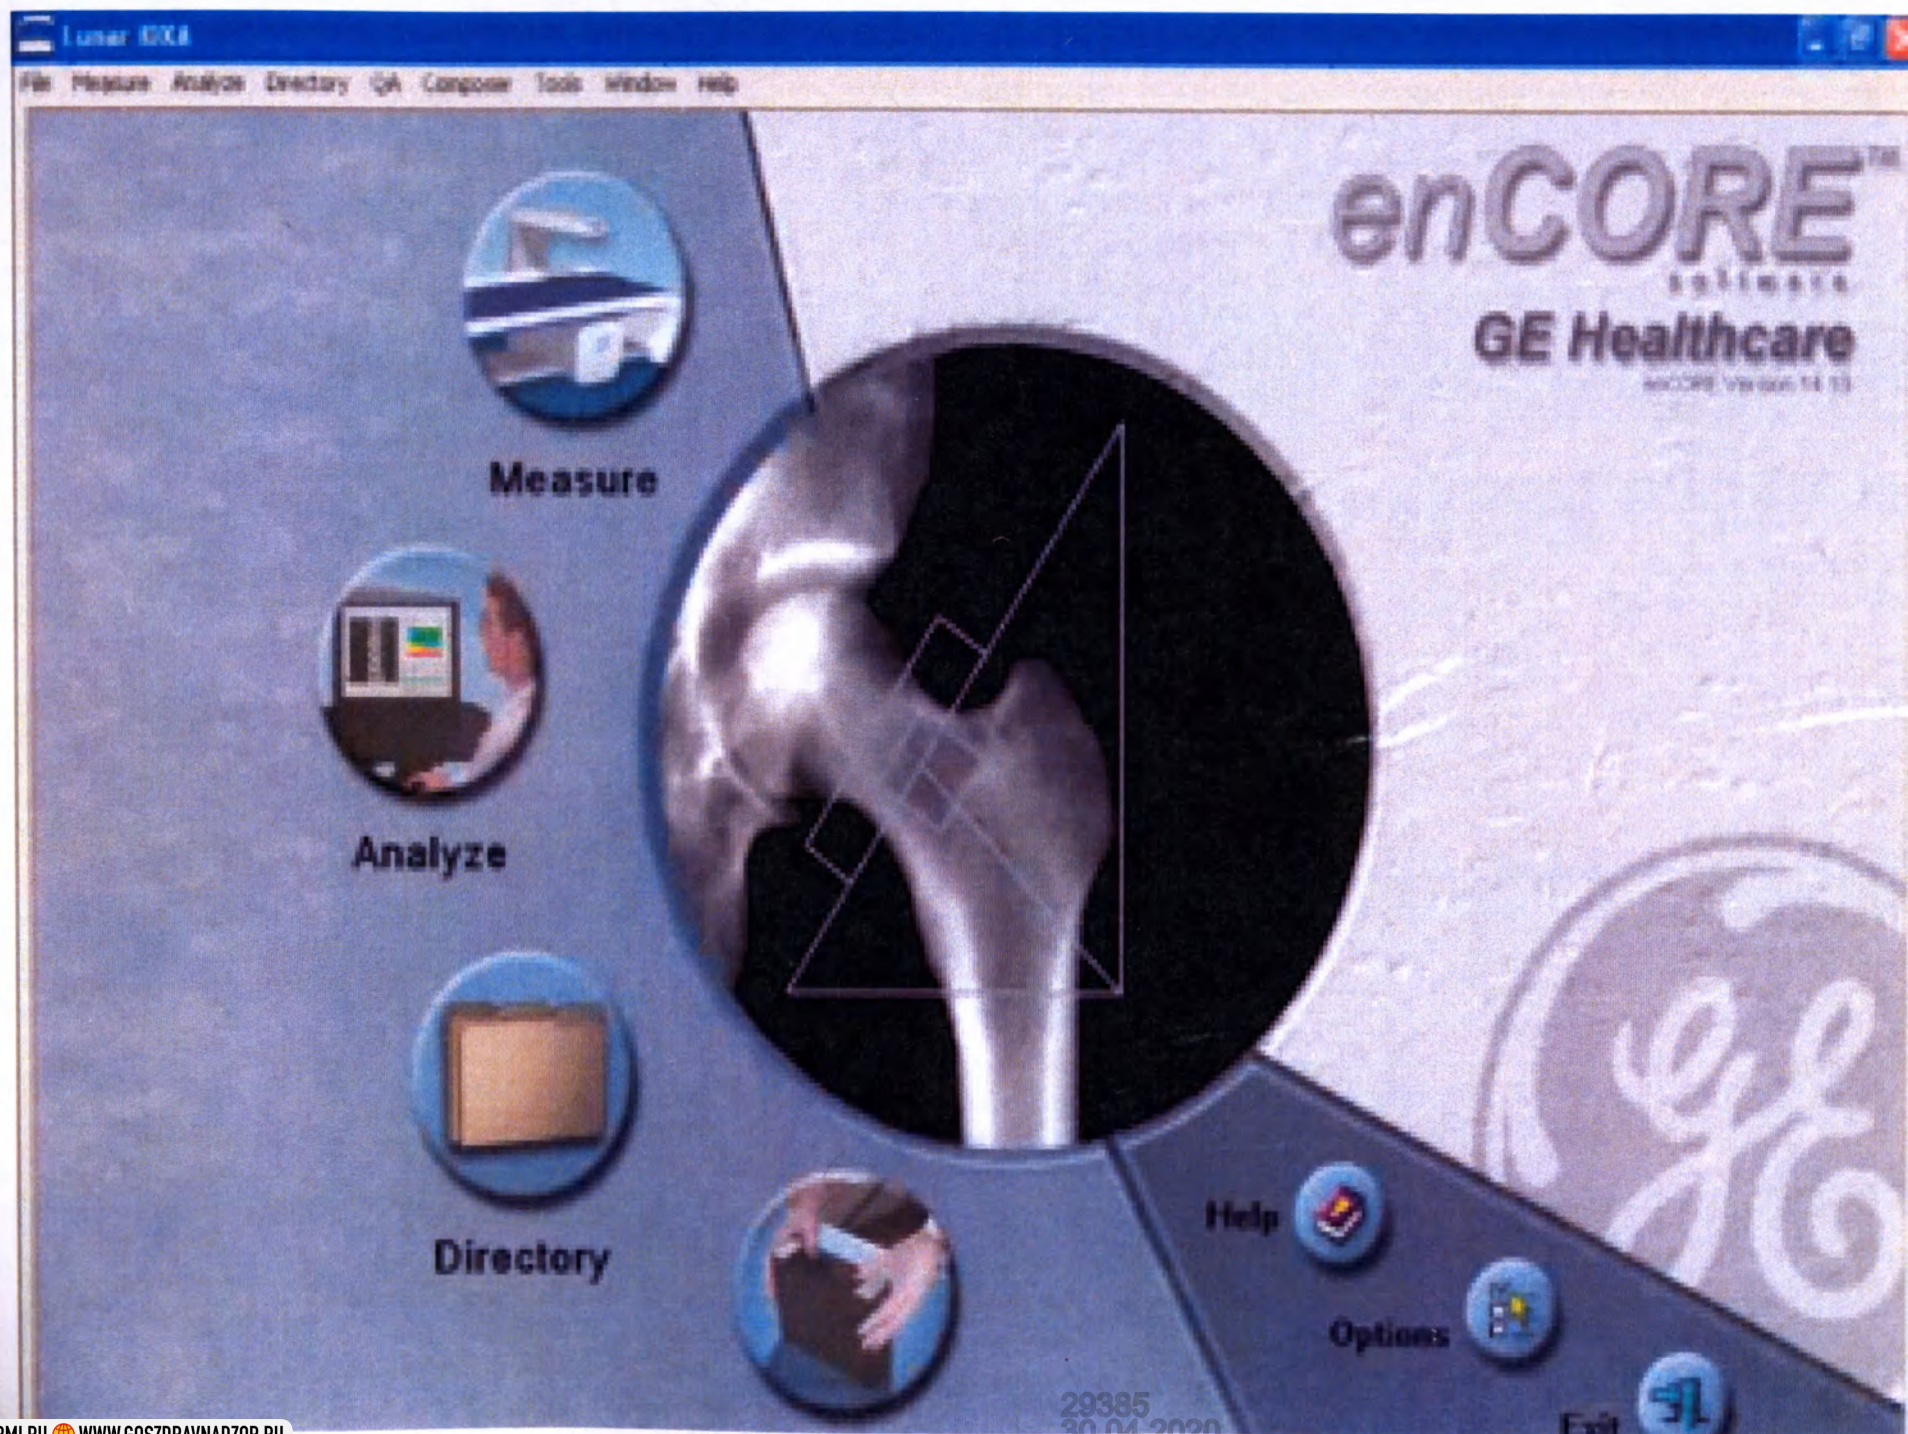

7.Фантом для калибровки.

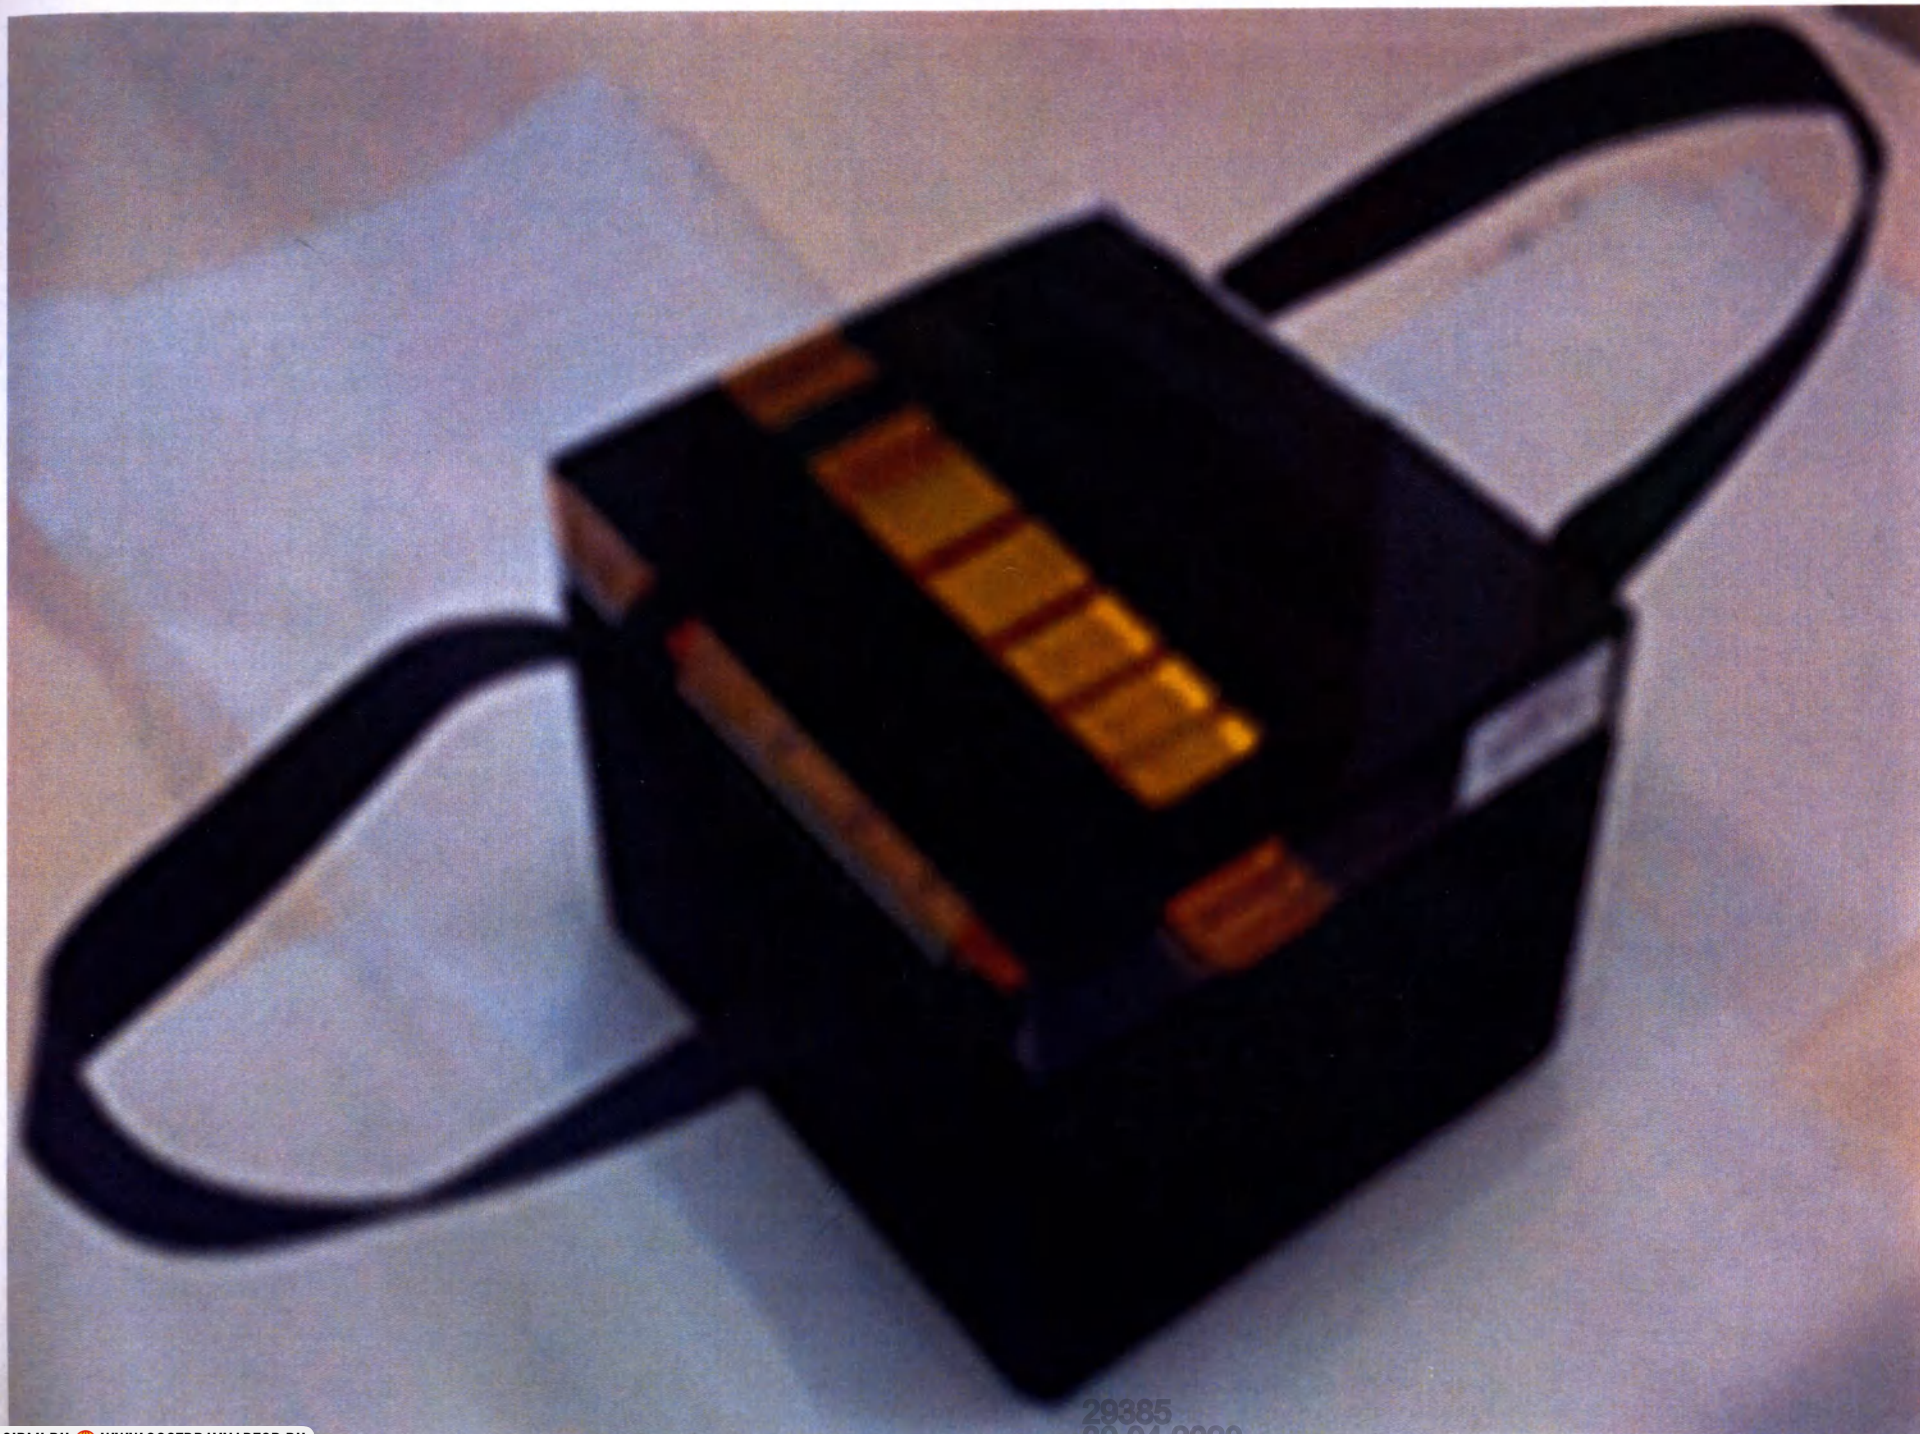

II. Принадлежности: 1. Станция компьютерная рабочая.



1. Станция компьютерная рабочая.



2. Принтер настольный.



2. Принтер настольный.



3. Мониторы жидкокристаллические (не более 4 штук).



4. Стол компьютерный.



GE Healthcare

Рентгеновскому костному денситометру с
программным обеспечением enCORE версии
18 - Руководство пользователя

Это руководство относится к следующим системам:
Lunar iDXA Series, Lunar Prodigy Series



Рентгеновскому костному денситометру с
программным обеспечением enCORE версии
18 - Руководство пользователя

LU46000RU-2RU, редакция 1 (январь
2019 г.)

© 2019 GE Healthcare

5. Инструкции по эксплуатации на электронном носителе (не более 4 шт.).

6. Кабели (не более 10 штук).




7. Устройства для позиционирования пациента (от 1 до 5 шт.).




7. Устройства для позиционирования пациента (от 1 до 5 шт.).



7. Устройства для позиционирования пациента (от 1 до 5 шт.).

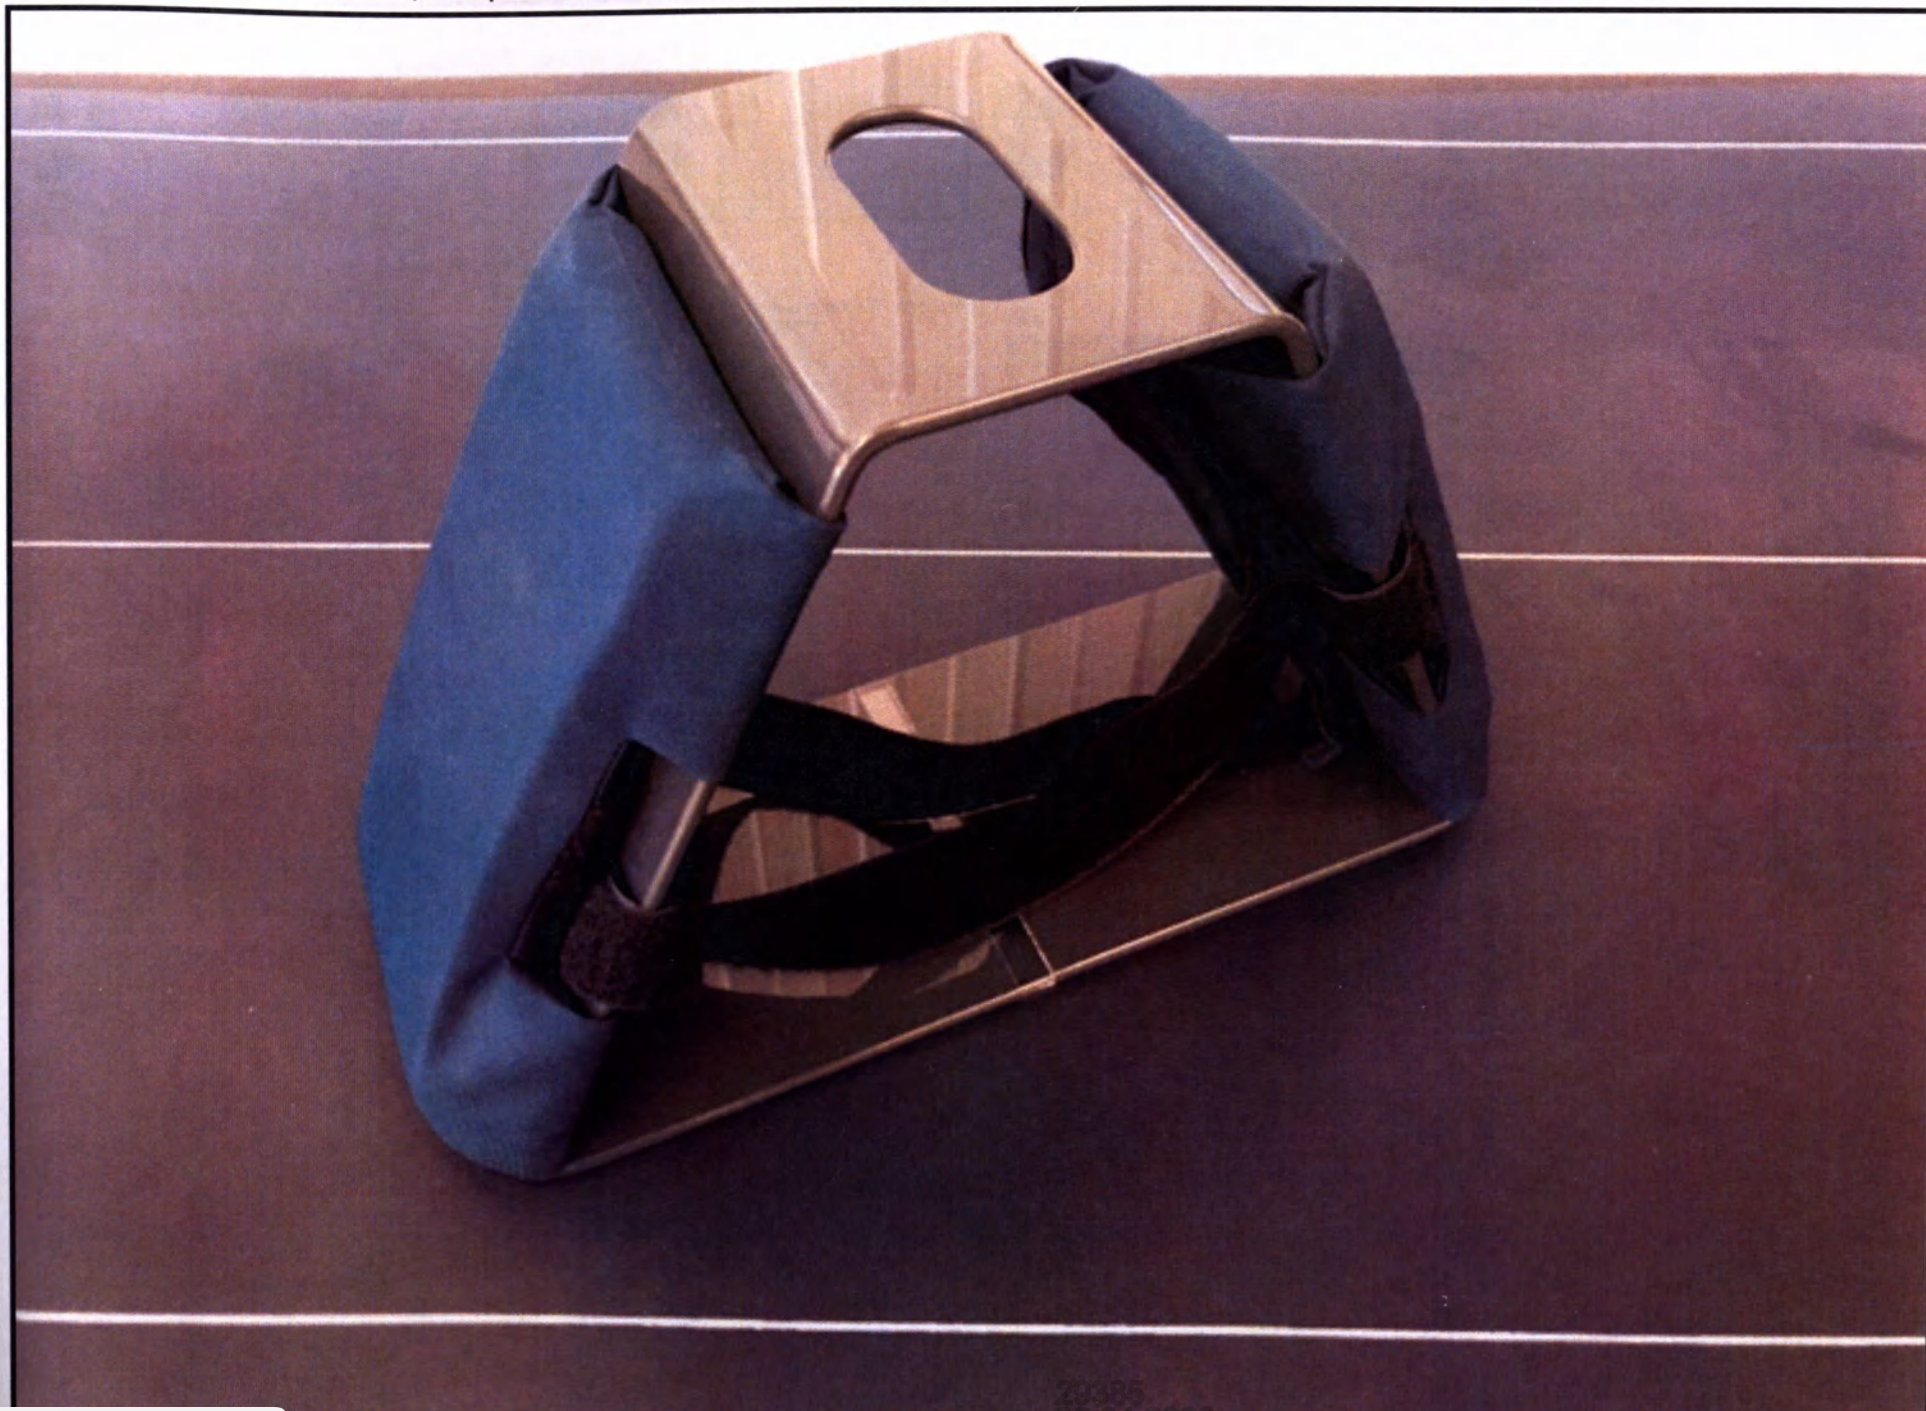

8. Дополнительные программные обеспечения для денситометрии (не более 15 шт.).

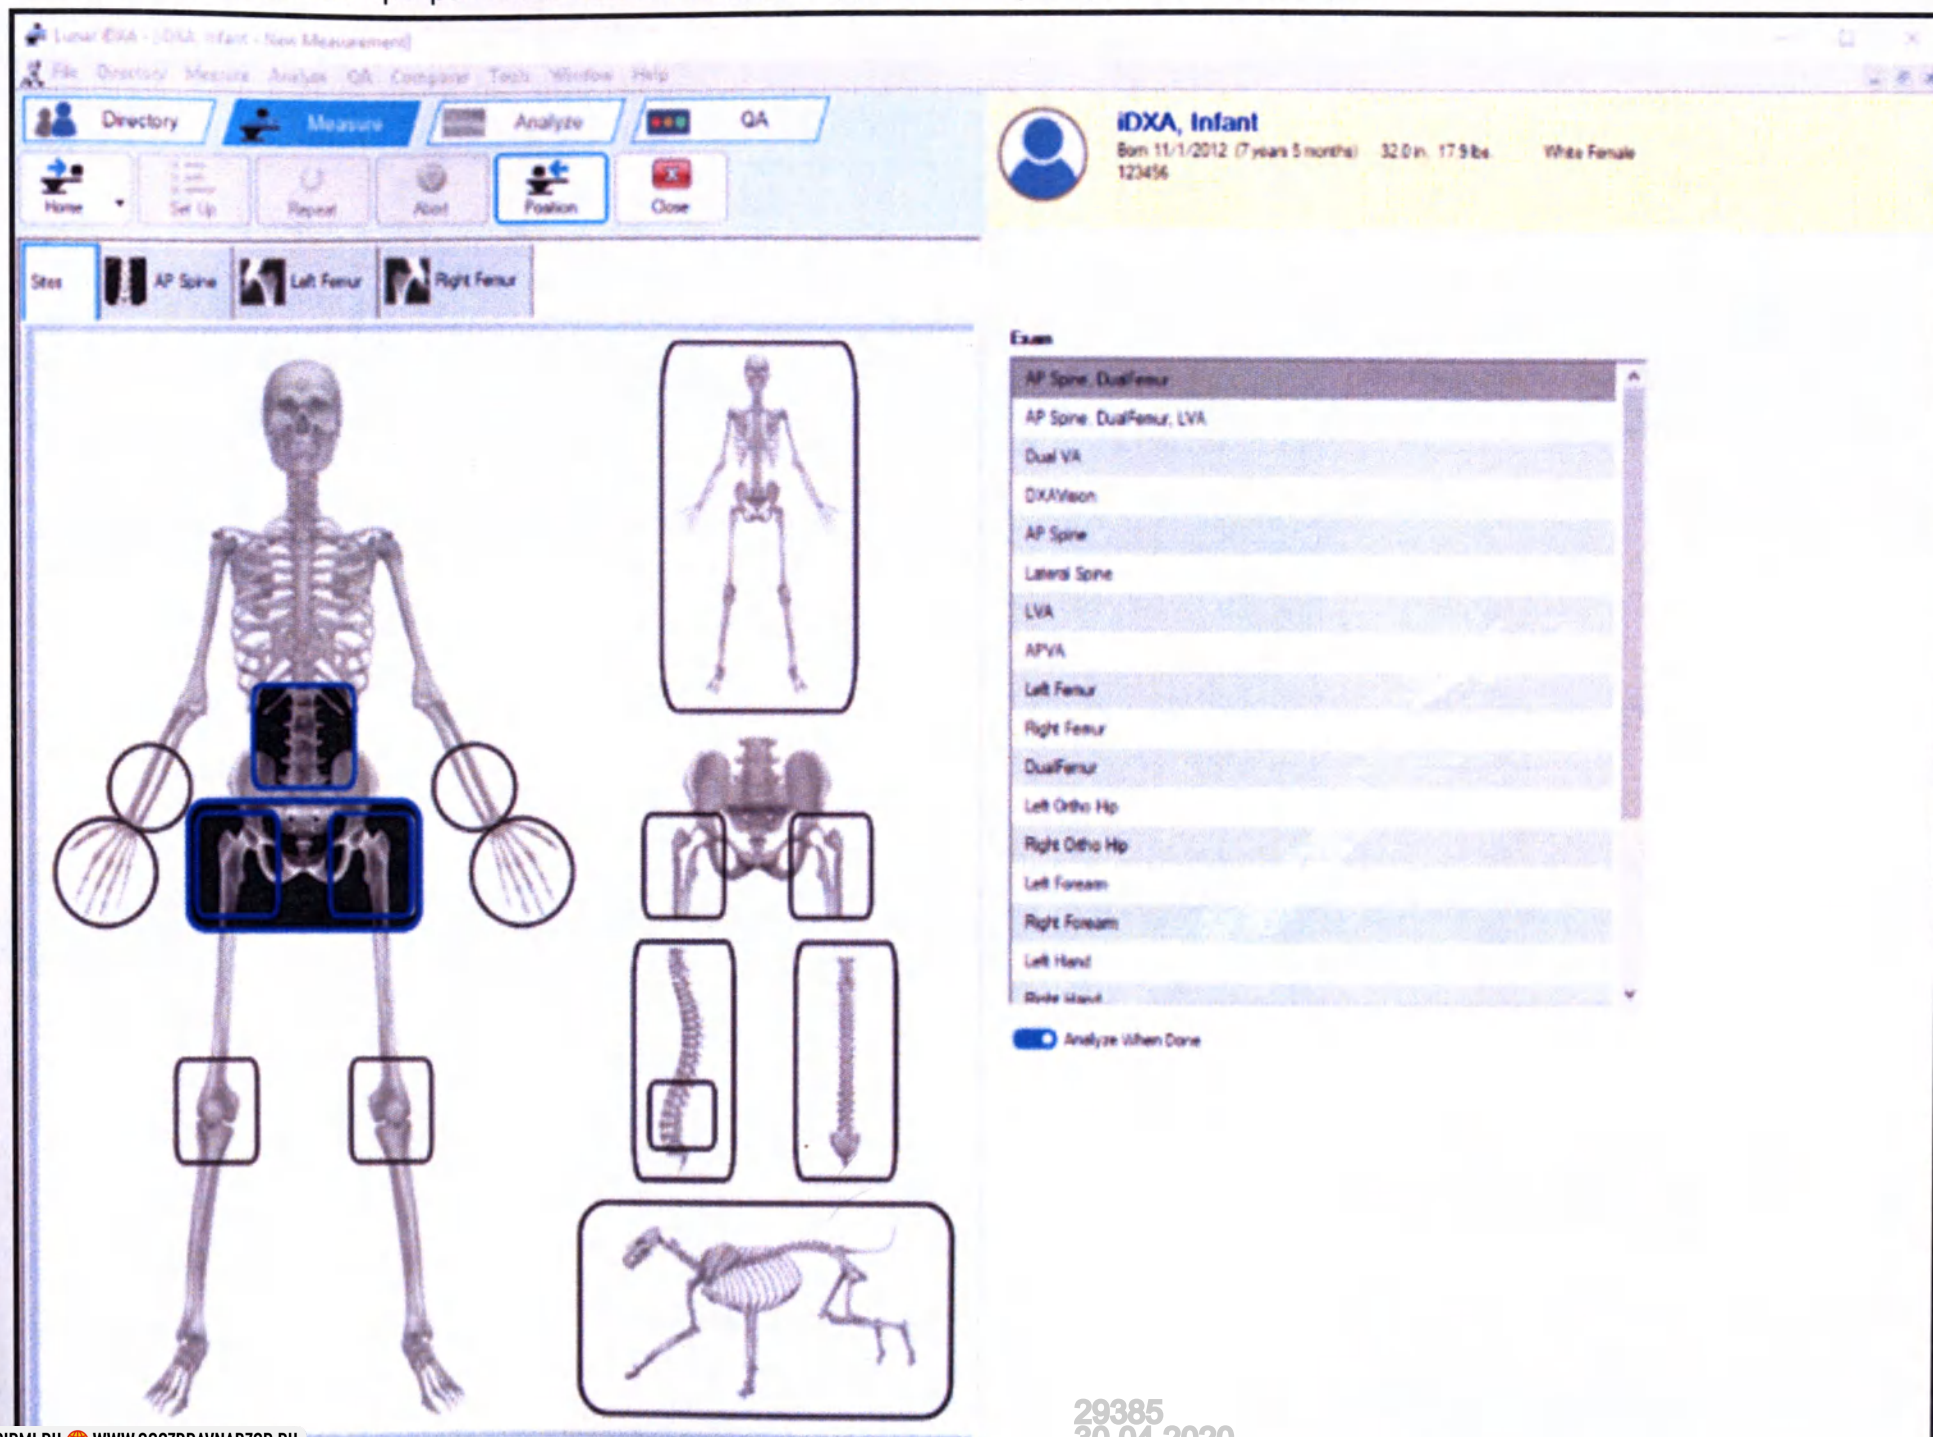

29385
30.04.2020

8. Дополнительные программные обеспечения для денситометрии (не более 15 шт.).

Lonar iDXA [iDXA, Infant - 4/3/2012 4:56 PM]

File Directory Measure Analyze QA Composer Tools Window Help

Directory Measure Analyze QA

Imaging ROIs Points Copy Refresh Reports Save Close

AP Spine DualFemur

iDXA, Infant
Born 11/1/2012 (7 years 5 months) 65.0 in. 17.9 lbs White Female
123456

Reference Chart: No reference data for Pediatric DualFemur [Total] region.
Pediatric DualFemur support disabled.

Region: Total Mean
Display: Current Results

Region	BMD (g/cm ³)	AM Z-score
Shaft Right	1.164	
Shaft Mean	1.152	
Shaft Diff	0.025	
Total Left	0.940	
Total Right	0.900	
Total Mean	0.960	


Image for demonstration only

SPINE TBS REPORT


TBS reference graph

Reference population: USA (NHANES I Mediam)

TBS L1-L4: 1.415

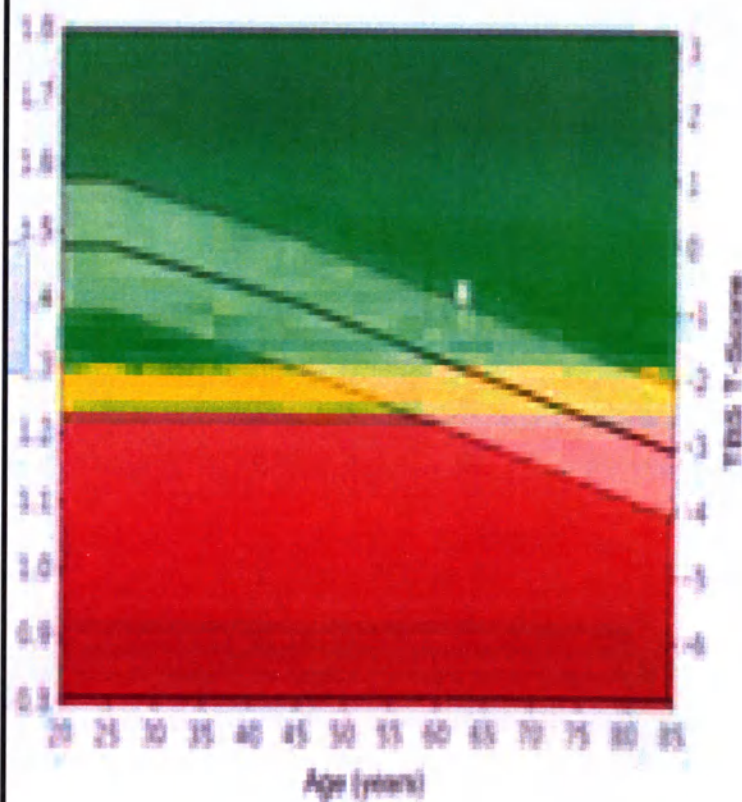


TBS Mapping

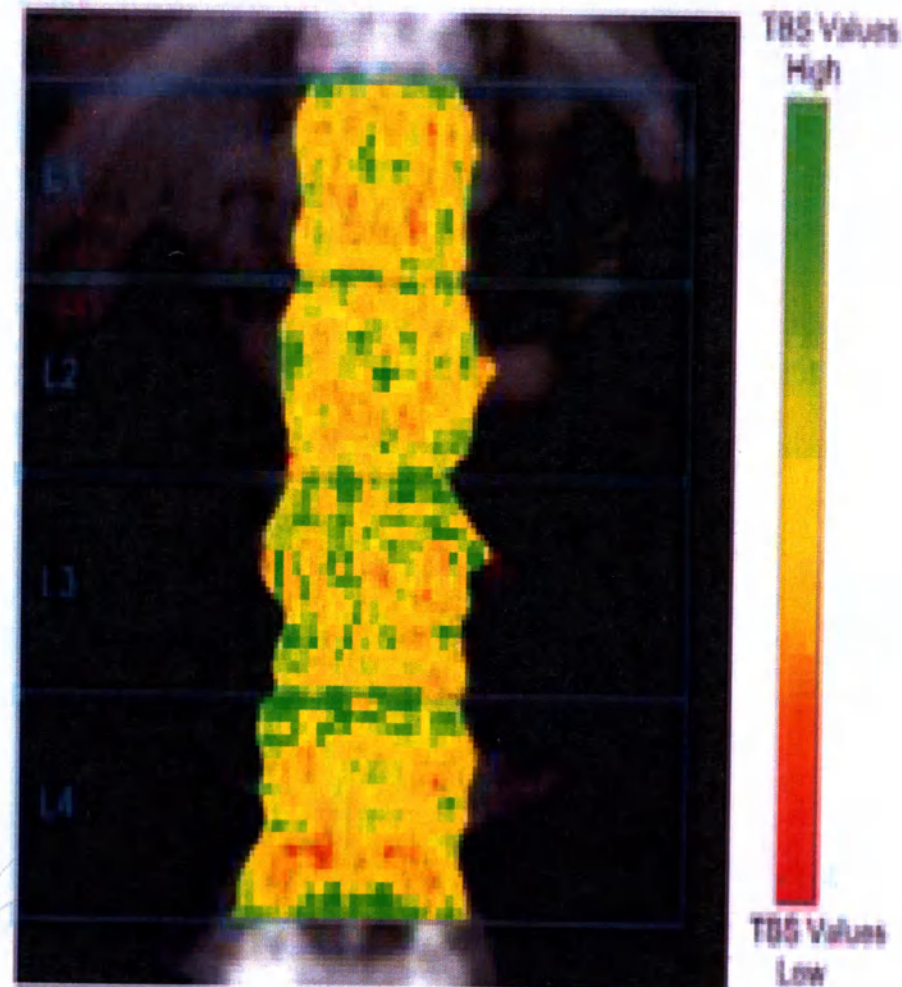

Non diagnostic image

10. Дополнительные фантомы (не более 2 шт.).

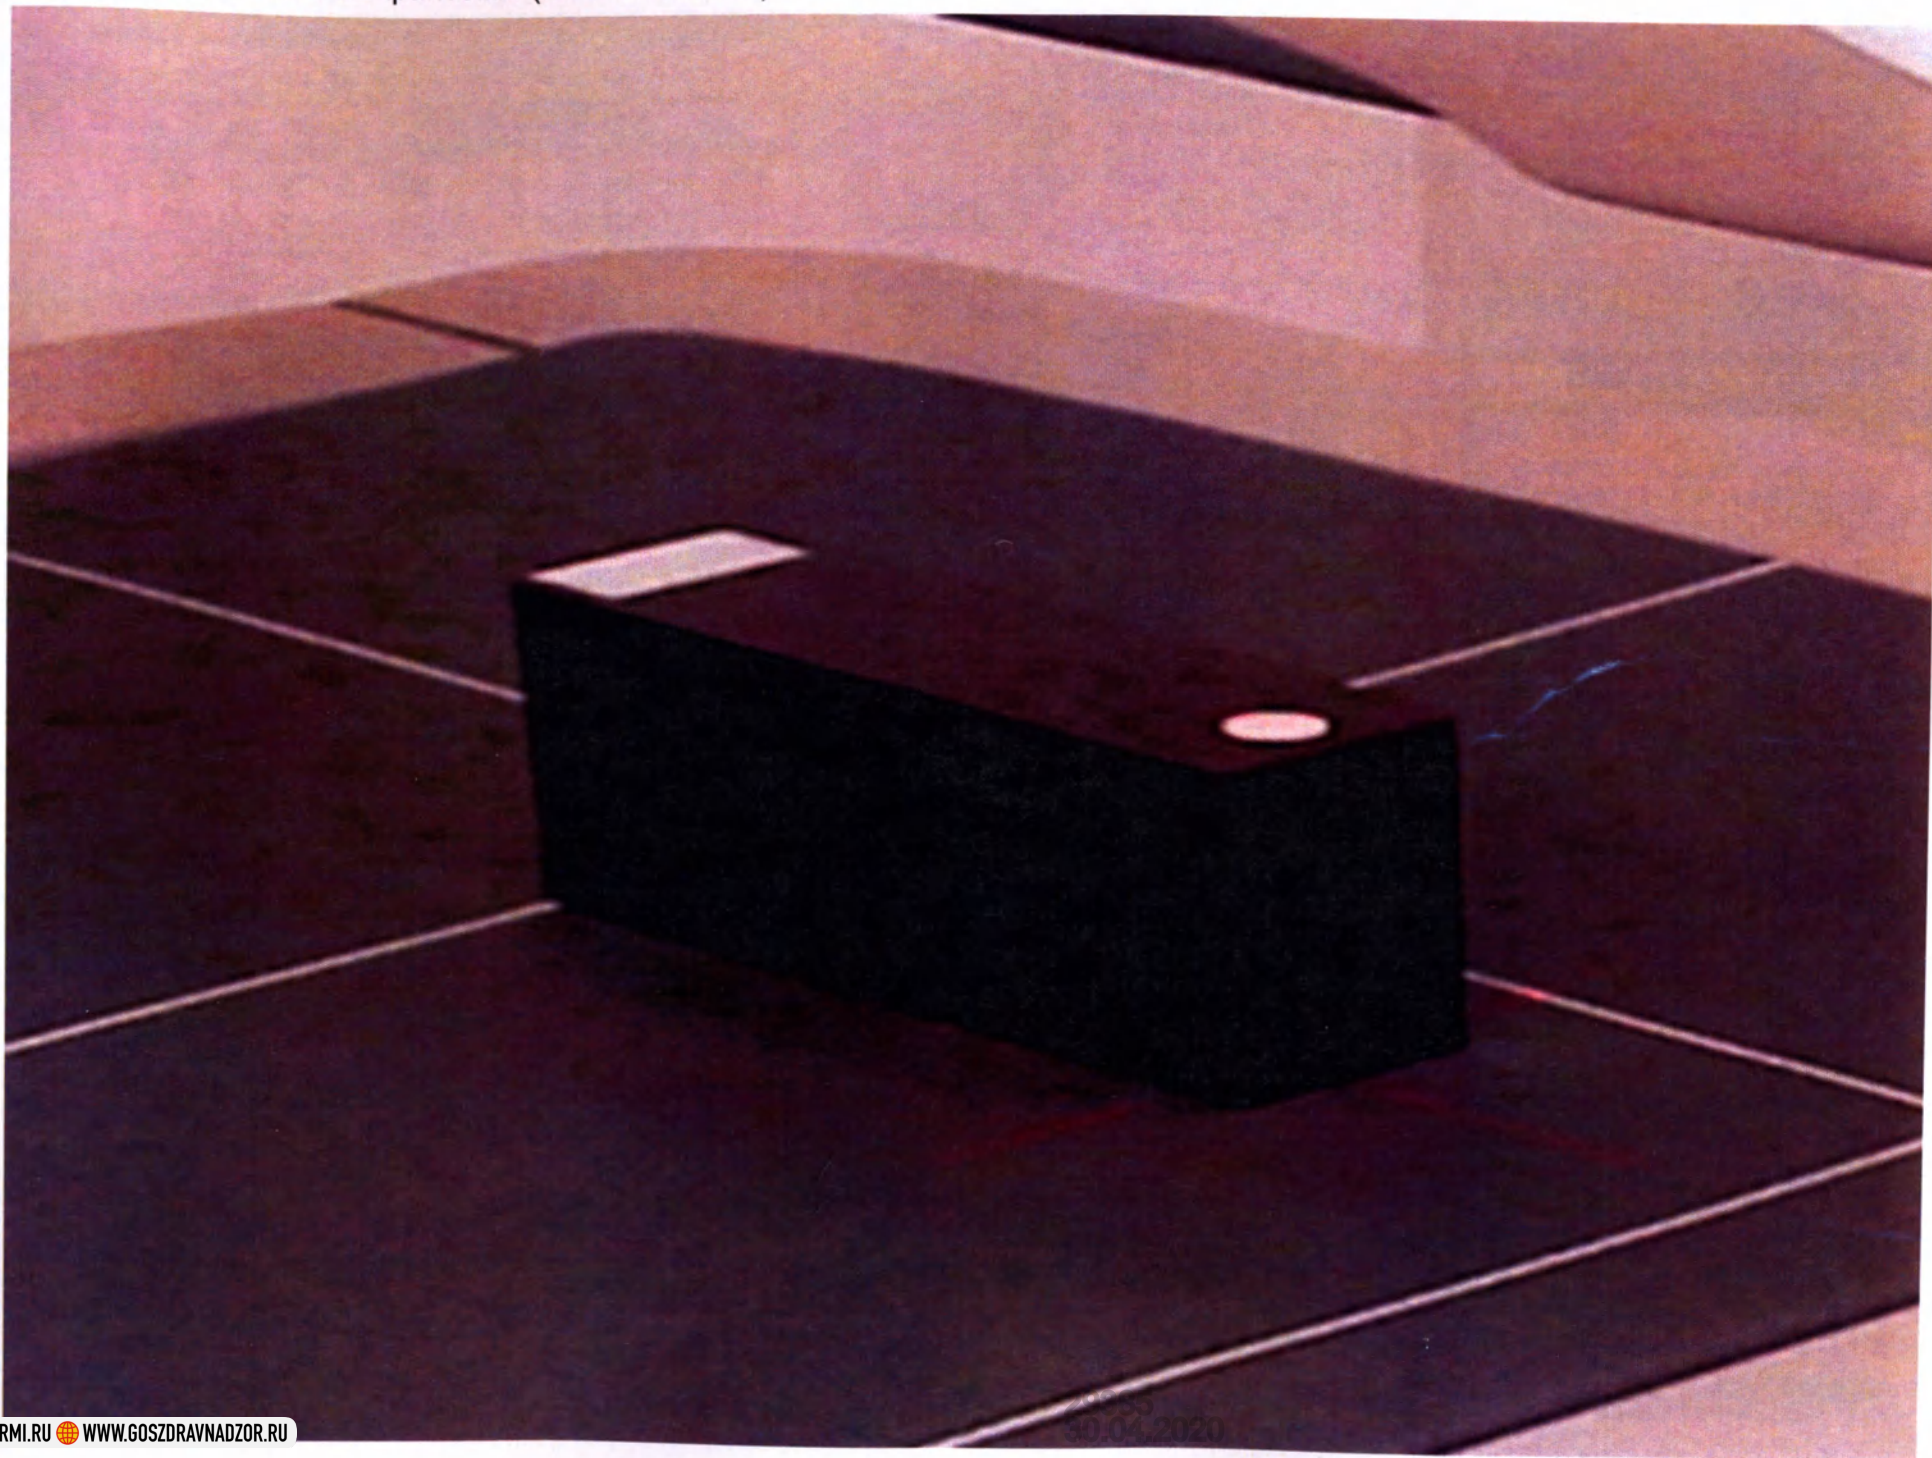

11.Интерфейс HL7.

Examen iDXA - [iDXA, Infant 4/3/2020 4:16 PM]

File Directory Measure Analyze QA Compare Tools Window Help

Directory Measure Analyze QA

Imaging POIs Points Copy Finish Reports Save Close

iDXA, Infant
Born 11/1/2012 0 years 5 months 65.0 in 17.9 lbs White Female
123456

Chart No reference data for Pediatric DualFemur [Total] region.
Pediatric DualFemur support disabled.

Connectivity Options

Report Delivery
Fax
Email
DICOM
HL7
Support

Stop Start

☐ Display Errors
☐ Directory in Worklist Mode
Worklist Settings...

☒ Use JCP/IP
Local Receiving Port: 3773
Local Sending Port: 3774

Message Header Settings
Reporting

Zoom 100%

Image for demonstration only

Deviation	BMD (g/cm ³)	AM Z score
Shift Mean	1.164	
Shift Off	1.152	
Total Left	0.940	
Total Right	0.960	
Total Mean	1.360	

12. Интерфейс DICOM

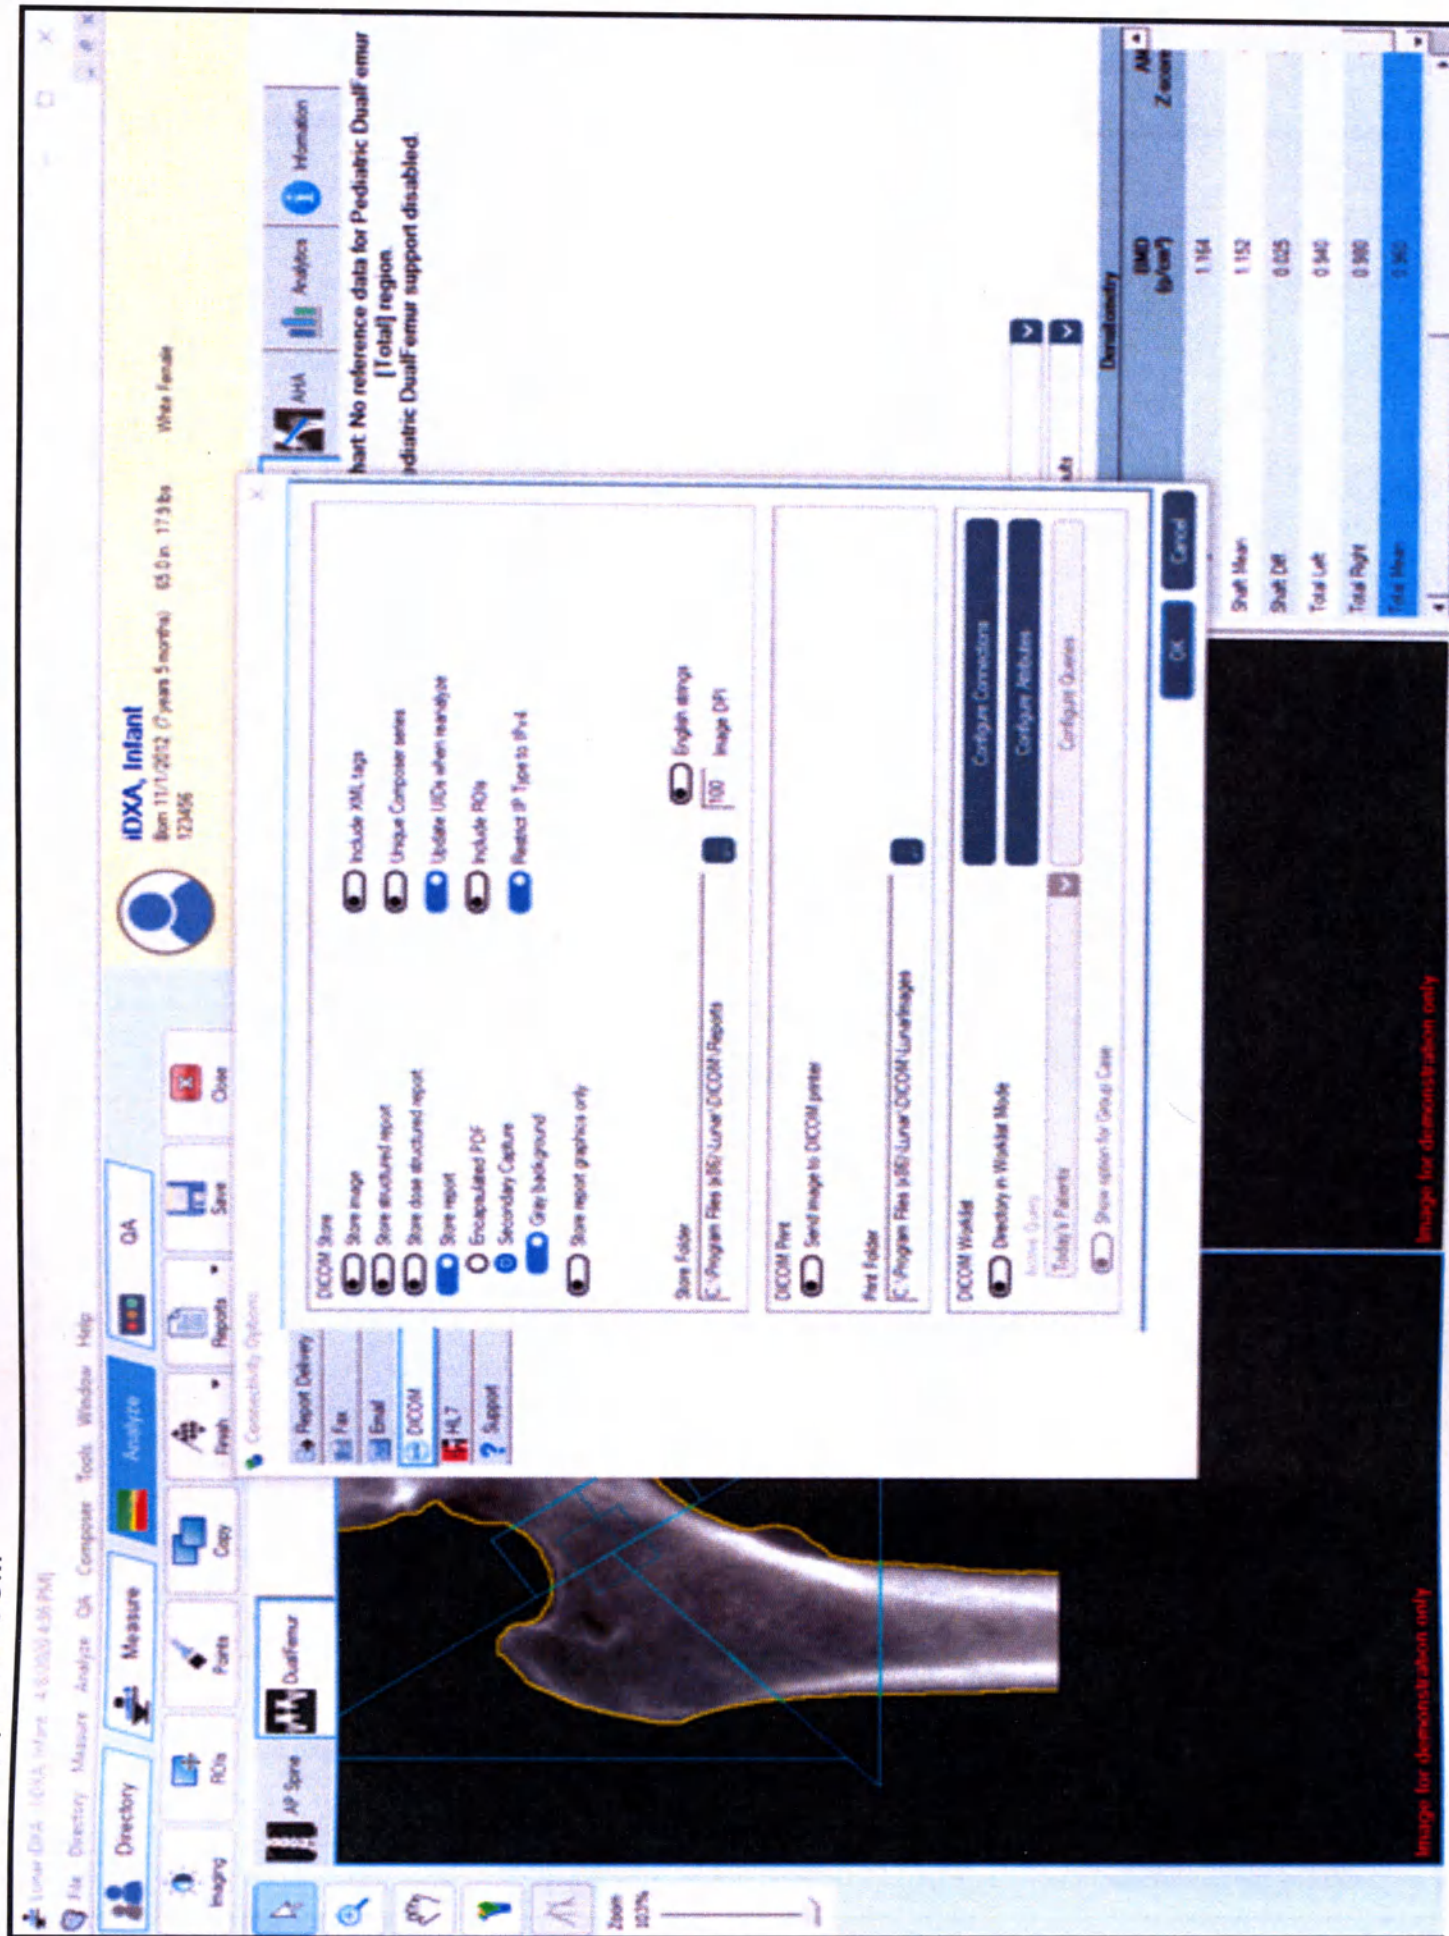



Image for demonstration only

Image for demonstration only



GE Healthcare

iDXA Service Manual

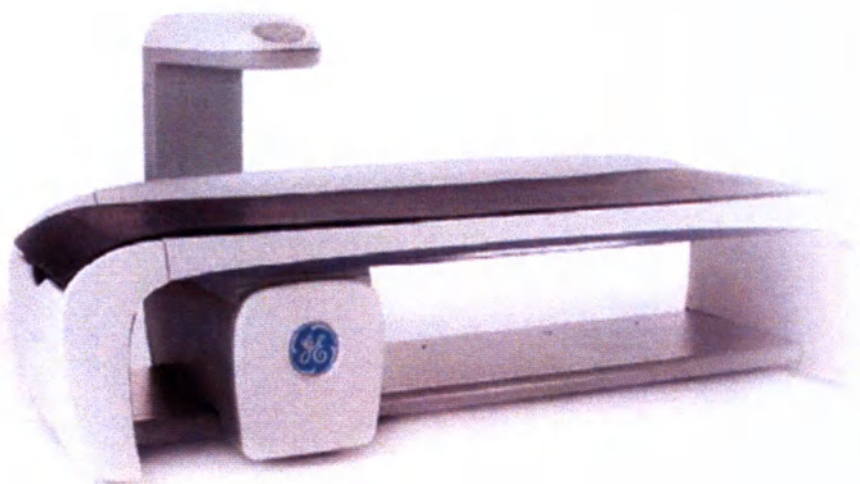

© GE Healthcare

14. Источник бесперебойного питания.




15. Клавиатура.




16. Компьютерная «мышь».



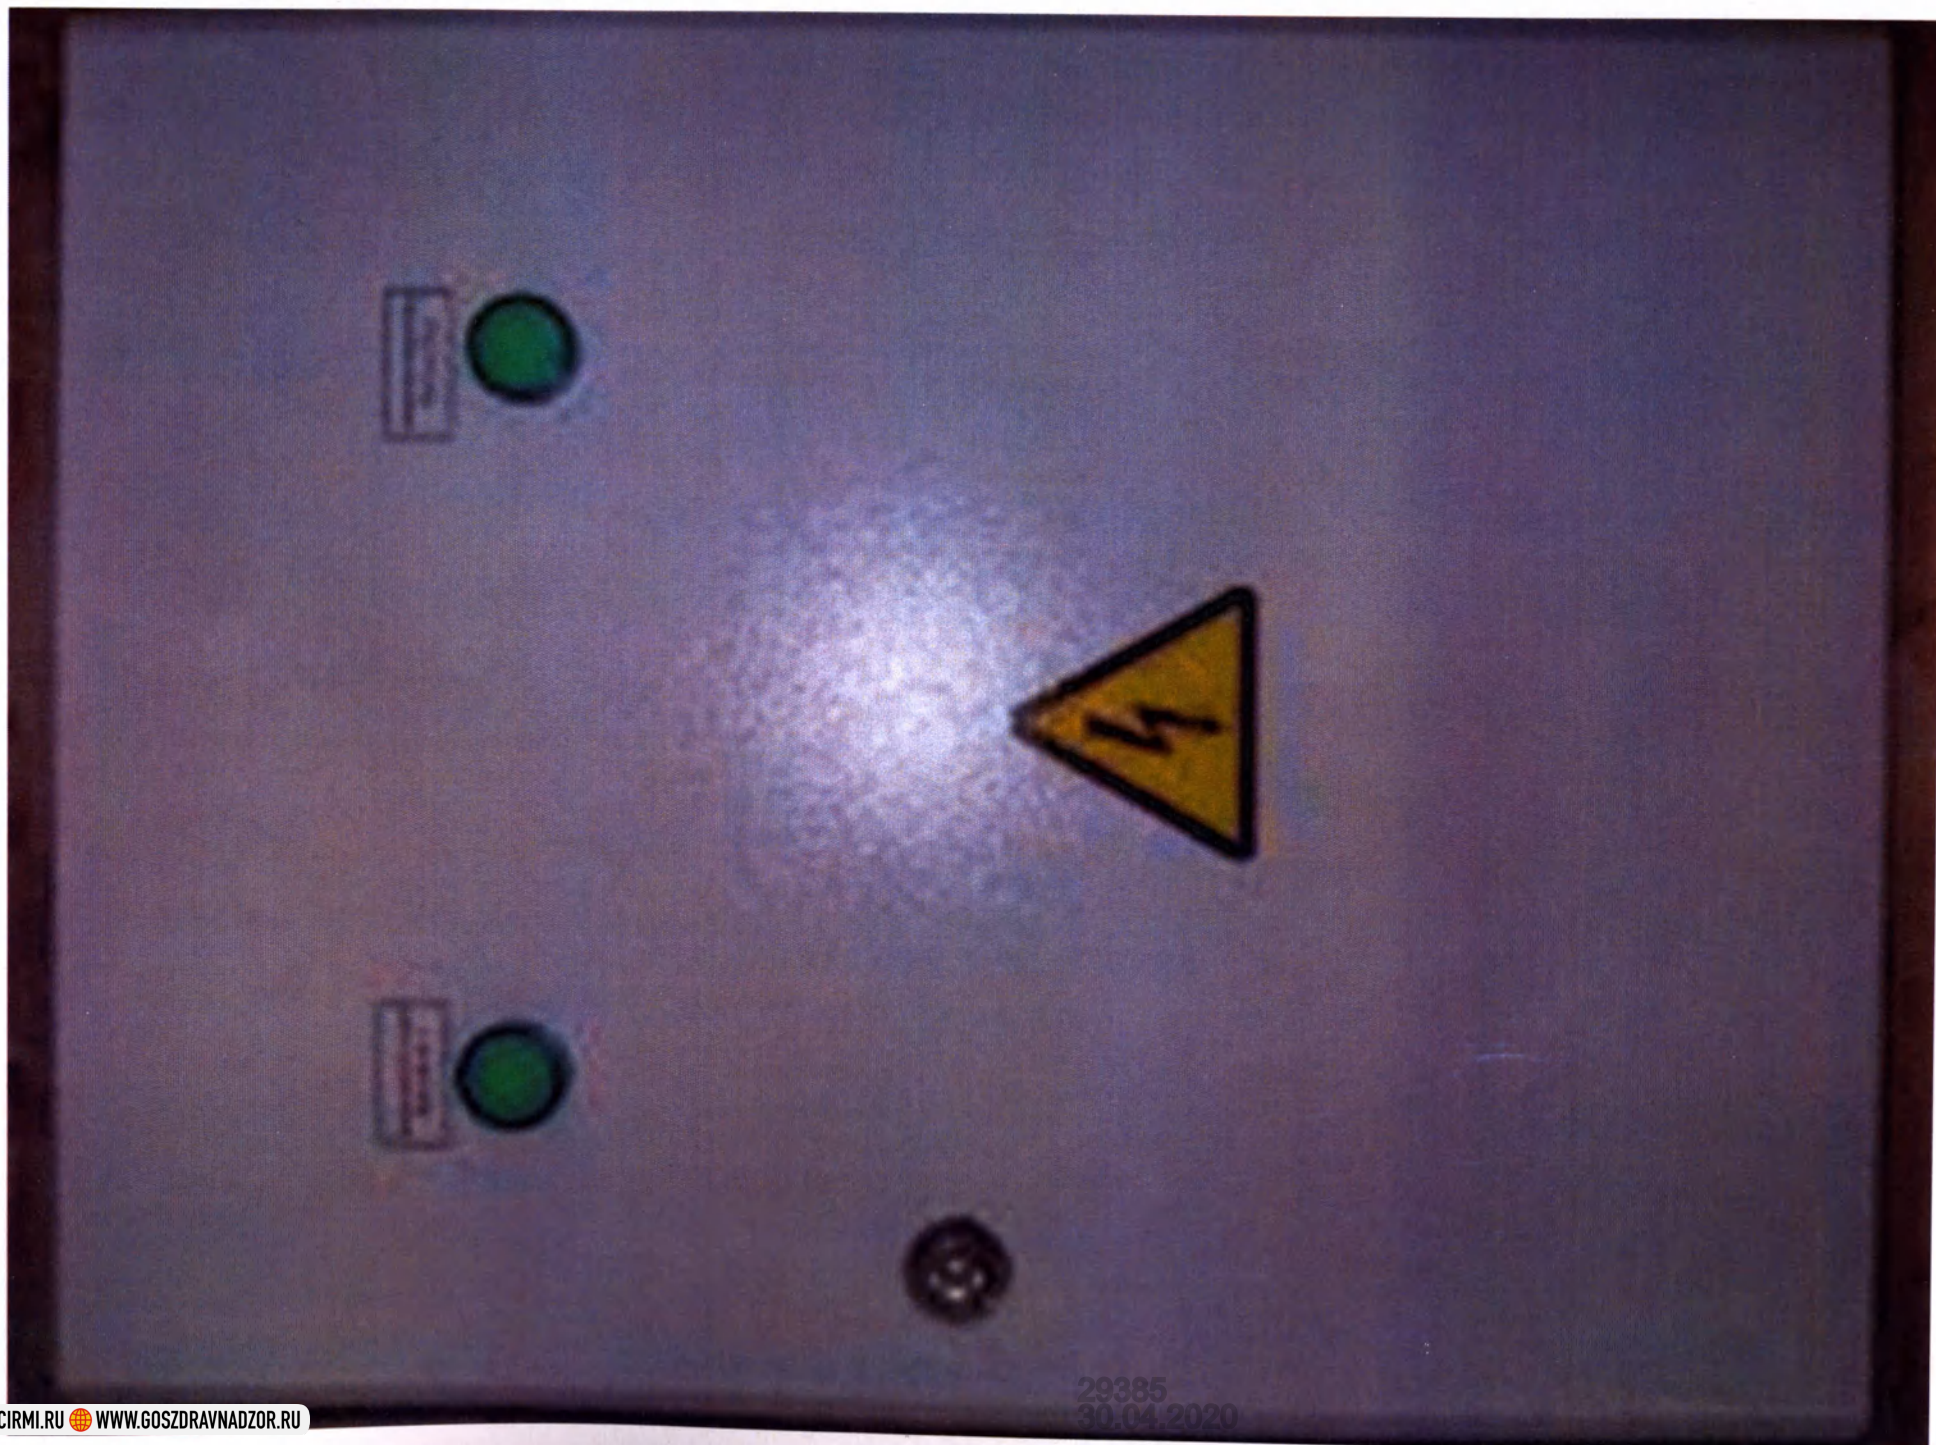

18.Рентгенозащитная ширма.

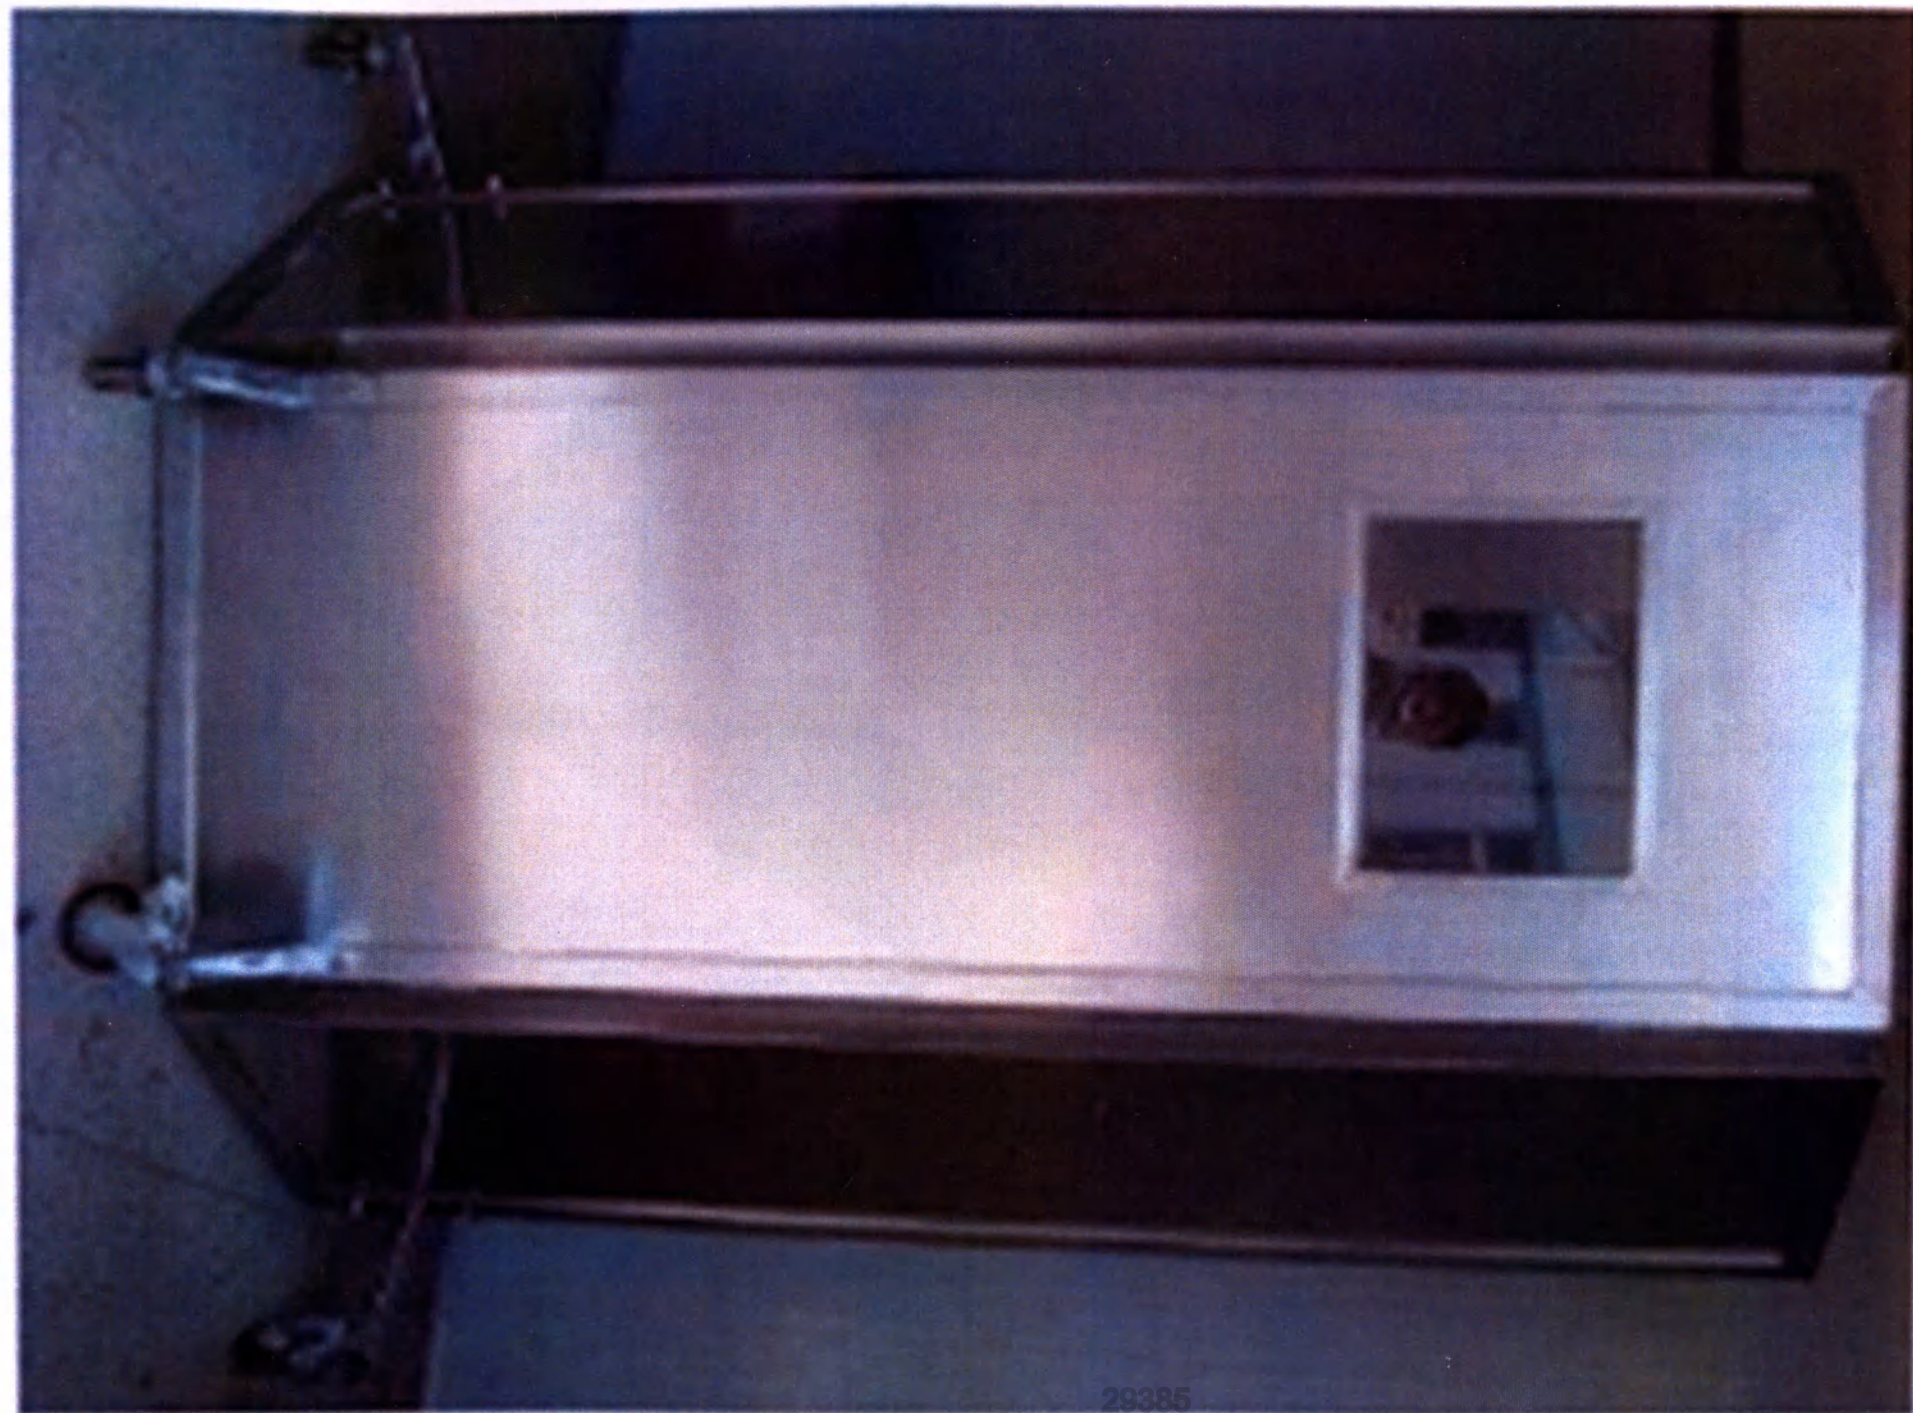


19. Внешний жесткий диск.



20. Реле для подключения световой индикации.



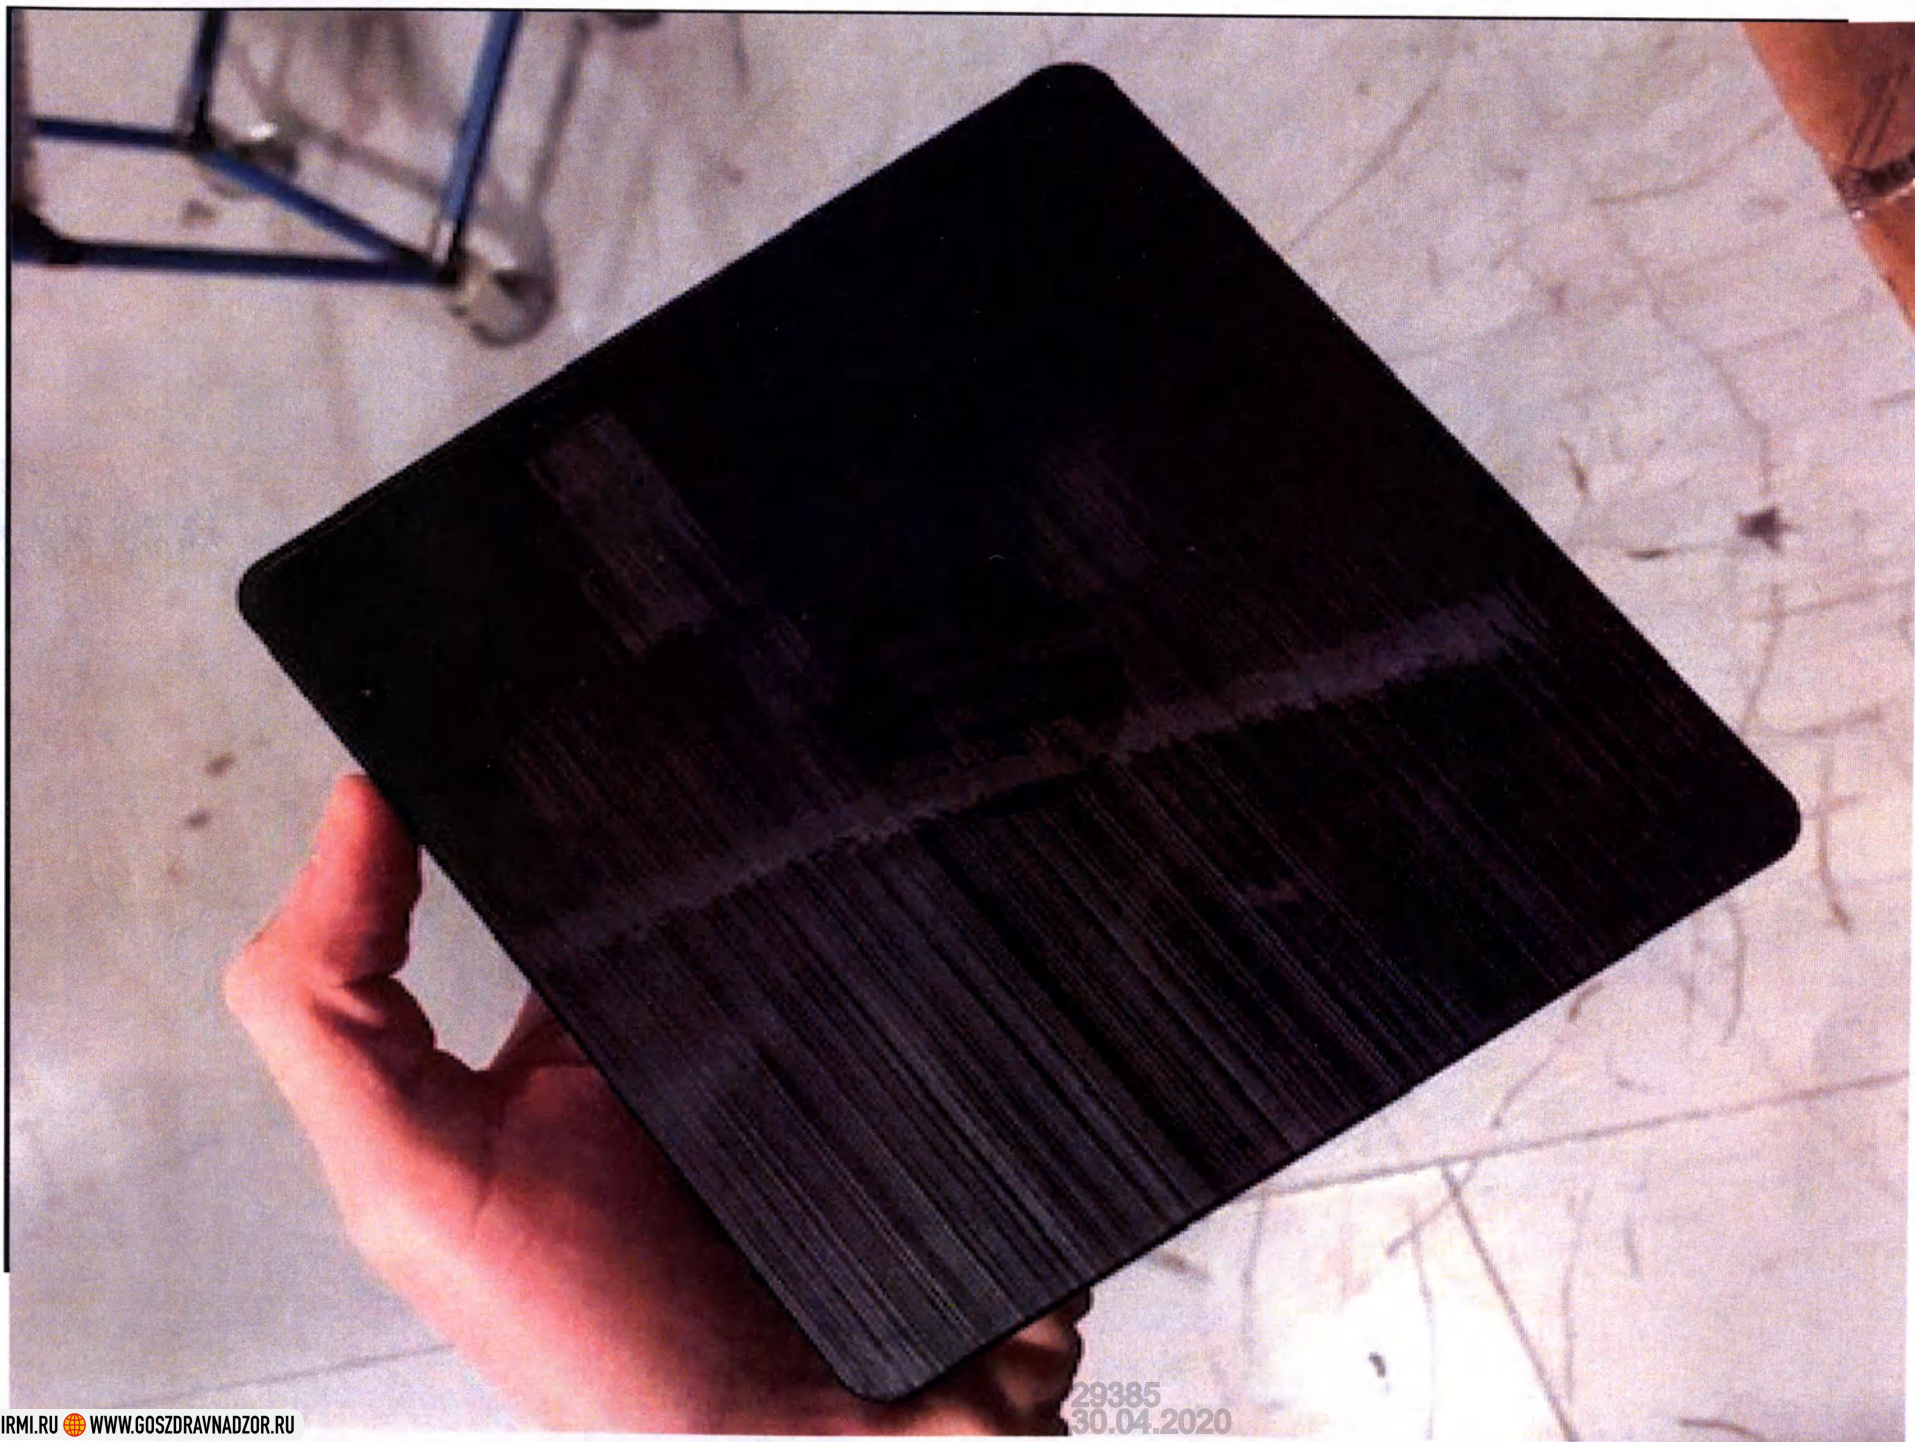

Всего страниц 37
(включая титульный лист)
Специальность по специальности
радиационной физики

