

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Катетер баллонный дилатационный PERSEUS-q для ЧТА

**«КвалиМед Инноватив Медицинпродукт ГмбХ» (QualiMed Innovative
Medizinprodukte GmbH), Германия**

Compliance Table Q2 0,014"

Pressure [bar]	Balloon Diameter [mm]								
	1.25	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00
5 bar	1.21	1.46	1.94	2.43	2.92	3.40	3.88	4.36	4.84
6 bar	1.22	1.47	1.96	2.45	2.94	3.43	3.91	4.40	4.88
7 bar	1.23	1.48	1.97	2.47	2.96	3.45	3.94	4.43	4.92
8 bar	1.24	1.49	1.99	2.48	2.98	3.48	3.97	4.47	4.96
9 bar (NP)	1.25	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00
10 bar	1.26	1.51	2.02	2.52	3.02	3.53	4.03	4.54	5.04
11 bar	1.27	1.52	2.03	2.54	3.04	3.55	4.06	4.57	5.08
12 bar	1.28	1.53	2.05	2.55	3.06	3.58	4.09	4.61	5.12
13 bar	1.29	1.54	2.06	2.57	3.08	3.60	4.12	4.64	5.16
14 bar	1.30	1.55	2.08	2.59	3.10	3.63	4.15	4.68	5.20
15 bar	1.31	1.56	2.09	2.61	3.12	3.65	4.18	4.71	5.24
16 bar	1.32	1.57	2.11	2.62	3.14	3.68	4.21	4.75	5.28
17 bar	1.33	1.58	2.12	2.64	3.16	3.70	4.24	4.78	5.32
18 bar (RBP)	1.34	1.59	2.14	2.66	3.18	3.73	4.27	4.82	5.36
19 bar	1.35	1.60	2.15	2.68	3.20	3.75	4.30	4.85	5.40
20 bar	1.36	1.61	2.17	2.69	3.22	3.78	4.33	4.89	5.44
21 bar	1.37	1.62	2.18	2.71	3.24	3.80	4.36	4.92	5.48
22 bar	1.38	1.63	2.20	2.73	3.26	3.83	4.39	4.96	5.52
23 bar	1.39	1.64	2.21	2.75	3.28	3.85	4.42	4.99	5.56
24 bar	1.40	1.65	2.23	2.76	3.30	3.88	4.45	5.03	5.60
25 bar	1.41	1.66	2.24	2.78	3.32	3.90	4.48	5.06	5.64
26 bar	1.42	1.67	2.26	2.80	3.34	3.93	4.51	5.10	5.68
27 bar	1.43	1.68	2.27	2.82	3.36	3.95	4.54	5.13	5.72
28 bar	1.44	1.69	2.29	2.83	3.38	3.98	4.57	5.17	5.76
29 bar	1.45	1.70	2.30	2.85	3.40	4.00	4.60	5.20	5.80
30 bar	1.46	1.71	2.32	2.87	3.42	4.03	4.63	5.24	5.84

Warning: Do Not Exceed the Rated Burst Pressure. Values are obtained „In Vitro“

Normal
Pressure

Rated
Burst
Pressure

Фото 1. Общий вид изделия, варианты исполнения отличаются размерами.

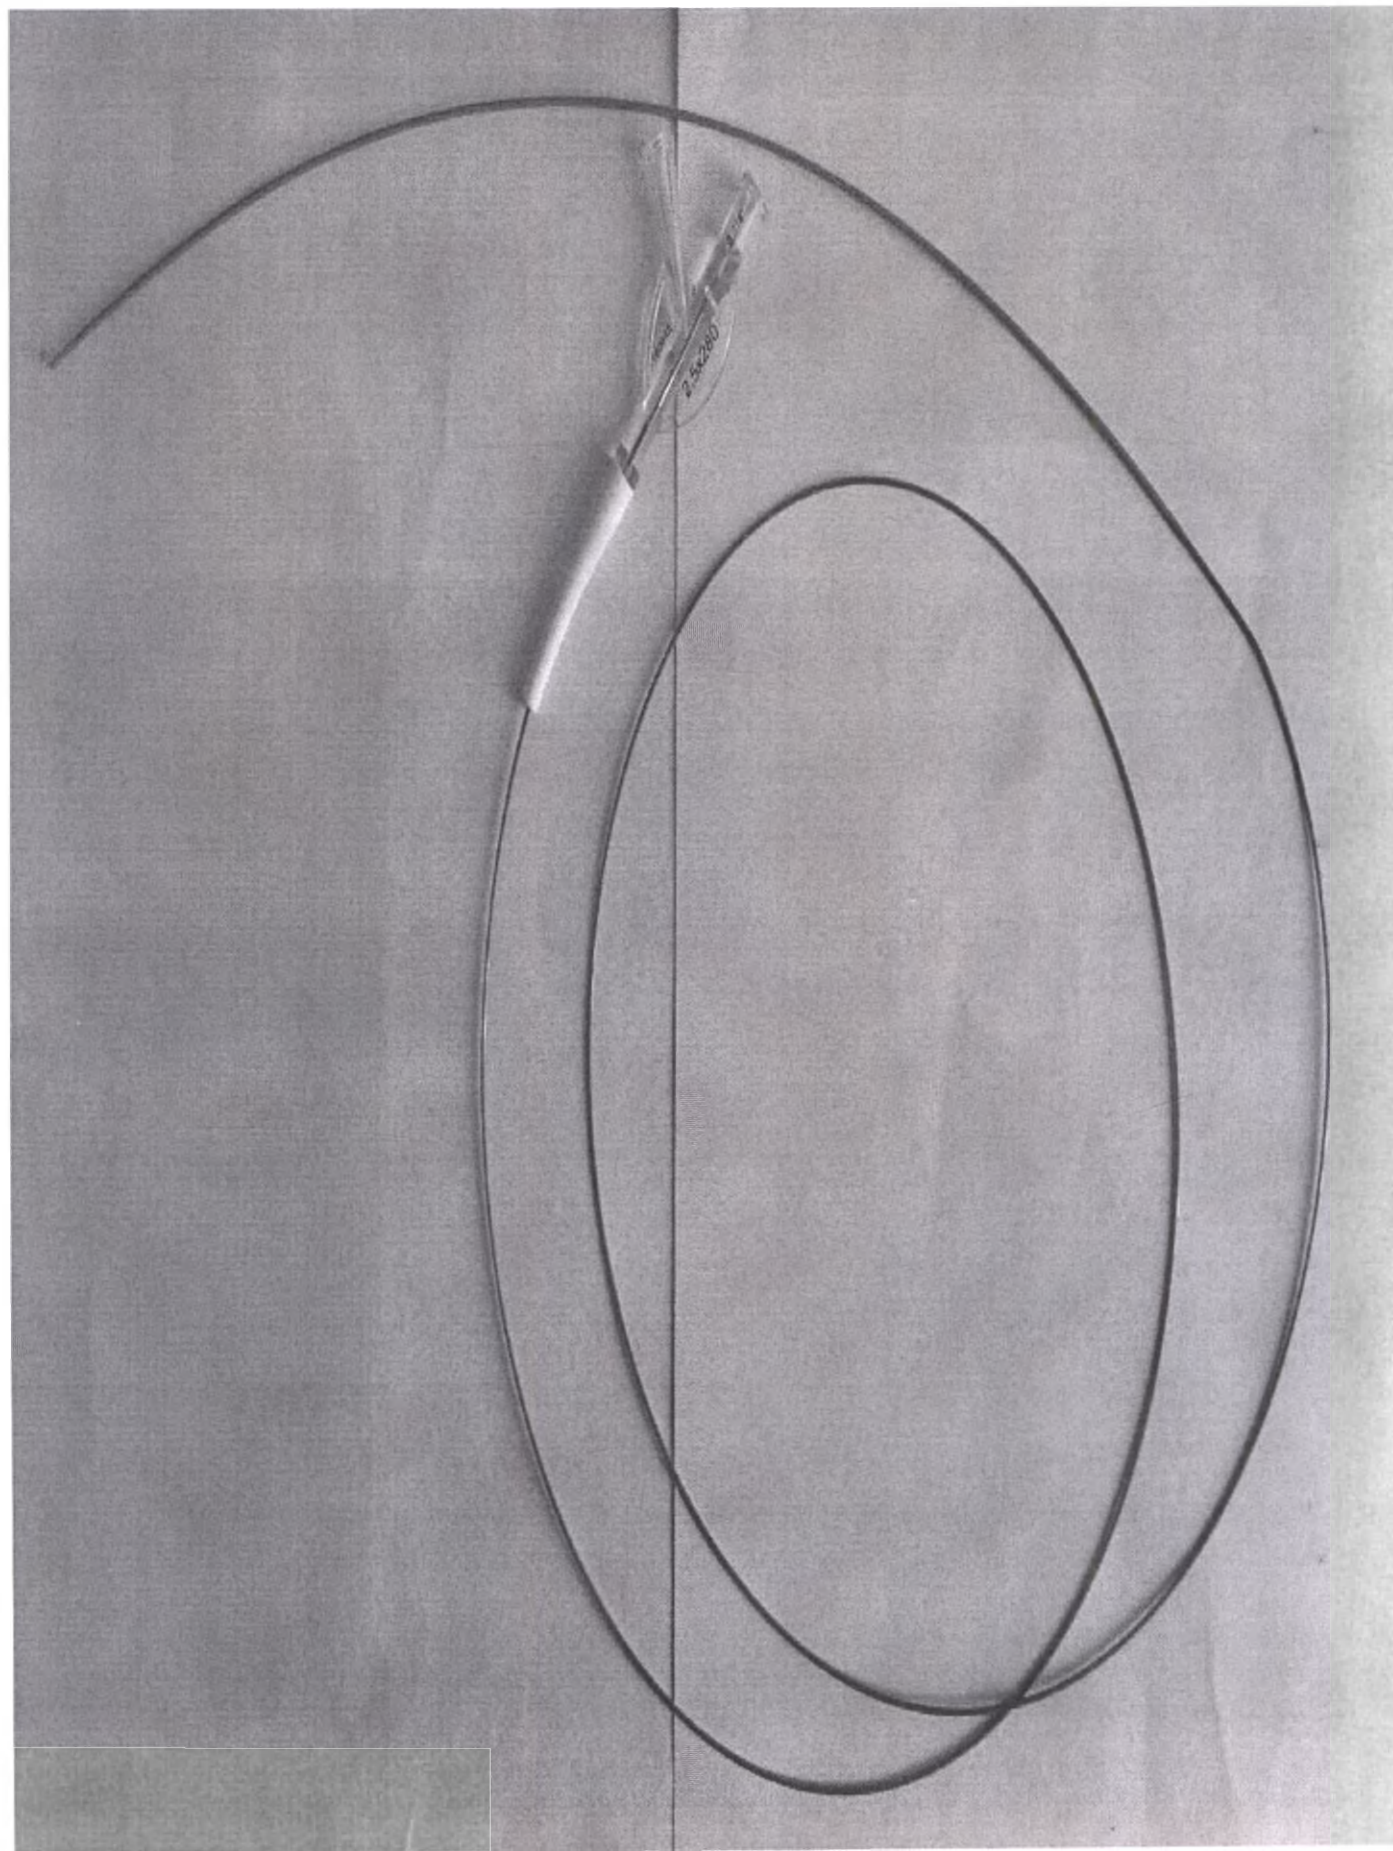


Фото 2. Общий вид изделия, варианты исполнения отличаются размерами.

PERSEUS-q PTA Balloon Catheter






CE 0124	
STERILE	EO
	2021-02
LOT	L364456A
REF	15PVQ012020CPD
Storage:	

PERSEUS-q
PTA Balloon Catheter
Over-the-wire Dilatation Catheter

0.014"

NOM 9 bar (0.9 MPa)

RBP 18 bar (1.8 MPa)



Manufacturer:
QualiMed
Innovative Medizinprodukte GmbH
Boschstraße 16
D-21423 Winsen
Germany
Phone: +49 4171 6578-0
Fax: +49 4171 6578-11
E-mail: info@qualimed.de
Website: www.qualimed.de

HYDROPHILIC

18 PERSEUS-q P, D1

PERSEUS-q PTA Balloon Catheter

Cat. No. 15PVQ012020CPD / Lot No. L364456A
Ø 1.25 mm, BL 20 mm



PERSEUS-q PTA Balloon Catheter

Cat. No. 15PVQ012020CPD / Lot No. L364456A
Ø 1.25 mm, BL 20 mm




PERSEUS-q PTA Balloon Catheter

Cat. No. 15PVQ012020CPD / Lot No. L364456A
Ø 1.25 mm, BL 20 mm



MANUFACTURED BY
QualiMed Innovative Medizinprodukte GmbH
Boschstraße 16, 21423 Winsen, Germany
Phone: +49 4171 6578 0
Fax: +49 4171 6578 11
Web: www.qualimed.de



CE 0124



BOX_PERSEUS-q REV. C

Фото 3. Маркировка вторичной упаковки (оригинальная, производителя)

PERSEUS-q PTA Balloon Catheter 0.014"



PERSEUS-q



UCL LOT L364456A

1.25mm

20mm

0.014"

150cm

2021-02



PERSEUS-q PTA Balloon Catheter



0.014"

NOM 9 bar (0.9 MPa)

RBP 18 bar (1.8 MPa)

CE 0124

STERILE EO



2021-02






L364456A



15PVQ012020CPD

Storage:



Manufacturer:
QualiMed
Innovative Medizinprodukte GmbH
Besenstraße 16
D-21423 Wismar
Germany
Phone: +49 4171 6576-0
Fax: +49 4171 6576-11
E-mail: info@qualimed.de
Website: www.qualimed.de

HYDROPHILIC

18 PERSEUS-q P. 01


PERSEUS-q
PTA Balloon Catheter
Over-the-wire Dilatation Catheter

PERSEUS-q PTA Balloon Catheter




Manufactured by
QualiMed Innovative Medizinprodukte GmbH
Besenstraße 16 - D-21423 Wismar-Germany

Cat. No. 15PVQ012020CPD / Lot No. L364456A
Ø 1.25 mm, BL 20 mm



0010 4051049 04 100 1 1771 21423000 140 L364456A

PERSEUS-q PTA Balloon Catheter




Manufactured by
QualiMed Innovative Medizinprodukte GmbH
Besenstraße 16 - D-21423 Wismar-Germany

Cat. No. 15PVQ012020CPD / Lot No. L364456A
Ø 1.25 mm, BL 20 mm



0010 4051049 04 100 1 1771 21423000 140 L364456A

PERSEUS-q PTA Balloon Catheter



Manufactured by
QualiMed Innovative Medizinprodukte GmbH
Besenstraße 16 - D-21423 Wismar-Germany

Cat. No. 15PVQ012020CPD / Lot No. L364456A
Ø 1.25 mm, BL 20 mm



0010 4051049 04 100 1 1771 21423000 140 L364456A

Фото 4. Маркировка первичной упаковки (оригинальная, производителя)

Пример макета маркировки РФ (стикер):

Регистрационное удостоверение № _____ от _____
Наименование МИ: Катетер баллонный дилатационный PERSEUS-q для ЧТА,
Вариант исполнения: проводник 0,014 дюйма (0,36 мм), эффективная длина катетера 120 см;
наружный диаметр катетера 1,067 мм, диаметр баллона 1,25 мм; длина баллона 10 мм
Производитель: «КвалиМед Инноватив Медицинпродукт ГмбХ» (QualiMed Innovative
Medizinprodukte GmbH) Бошштрассе 16, 21423 Винзен, Германия
Представитель производителя в РФ: ООО "АГРЕГАТОР МЕДИКАЛ", 115191, г. Москва, ул.
Тульская Б., д. 10, стр. 5 пом/ком/оф XII/3/5310, тел.: +7 (495) 231-12-86
Дата изготовления: ММ.ГГГГ



STERILE EO



НЕТОКСИЧНО

Прошито, пронумеровано, заверено
подписью и печатью 6 листов
Генеральный директор
ООО «Агрегатор Медикал»
Д.В. Домнышев

