

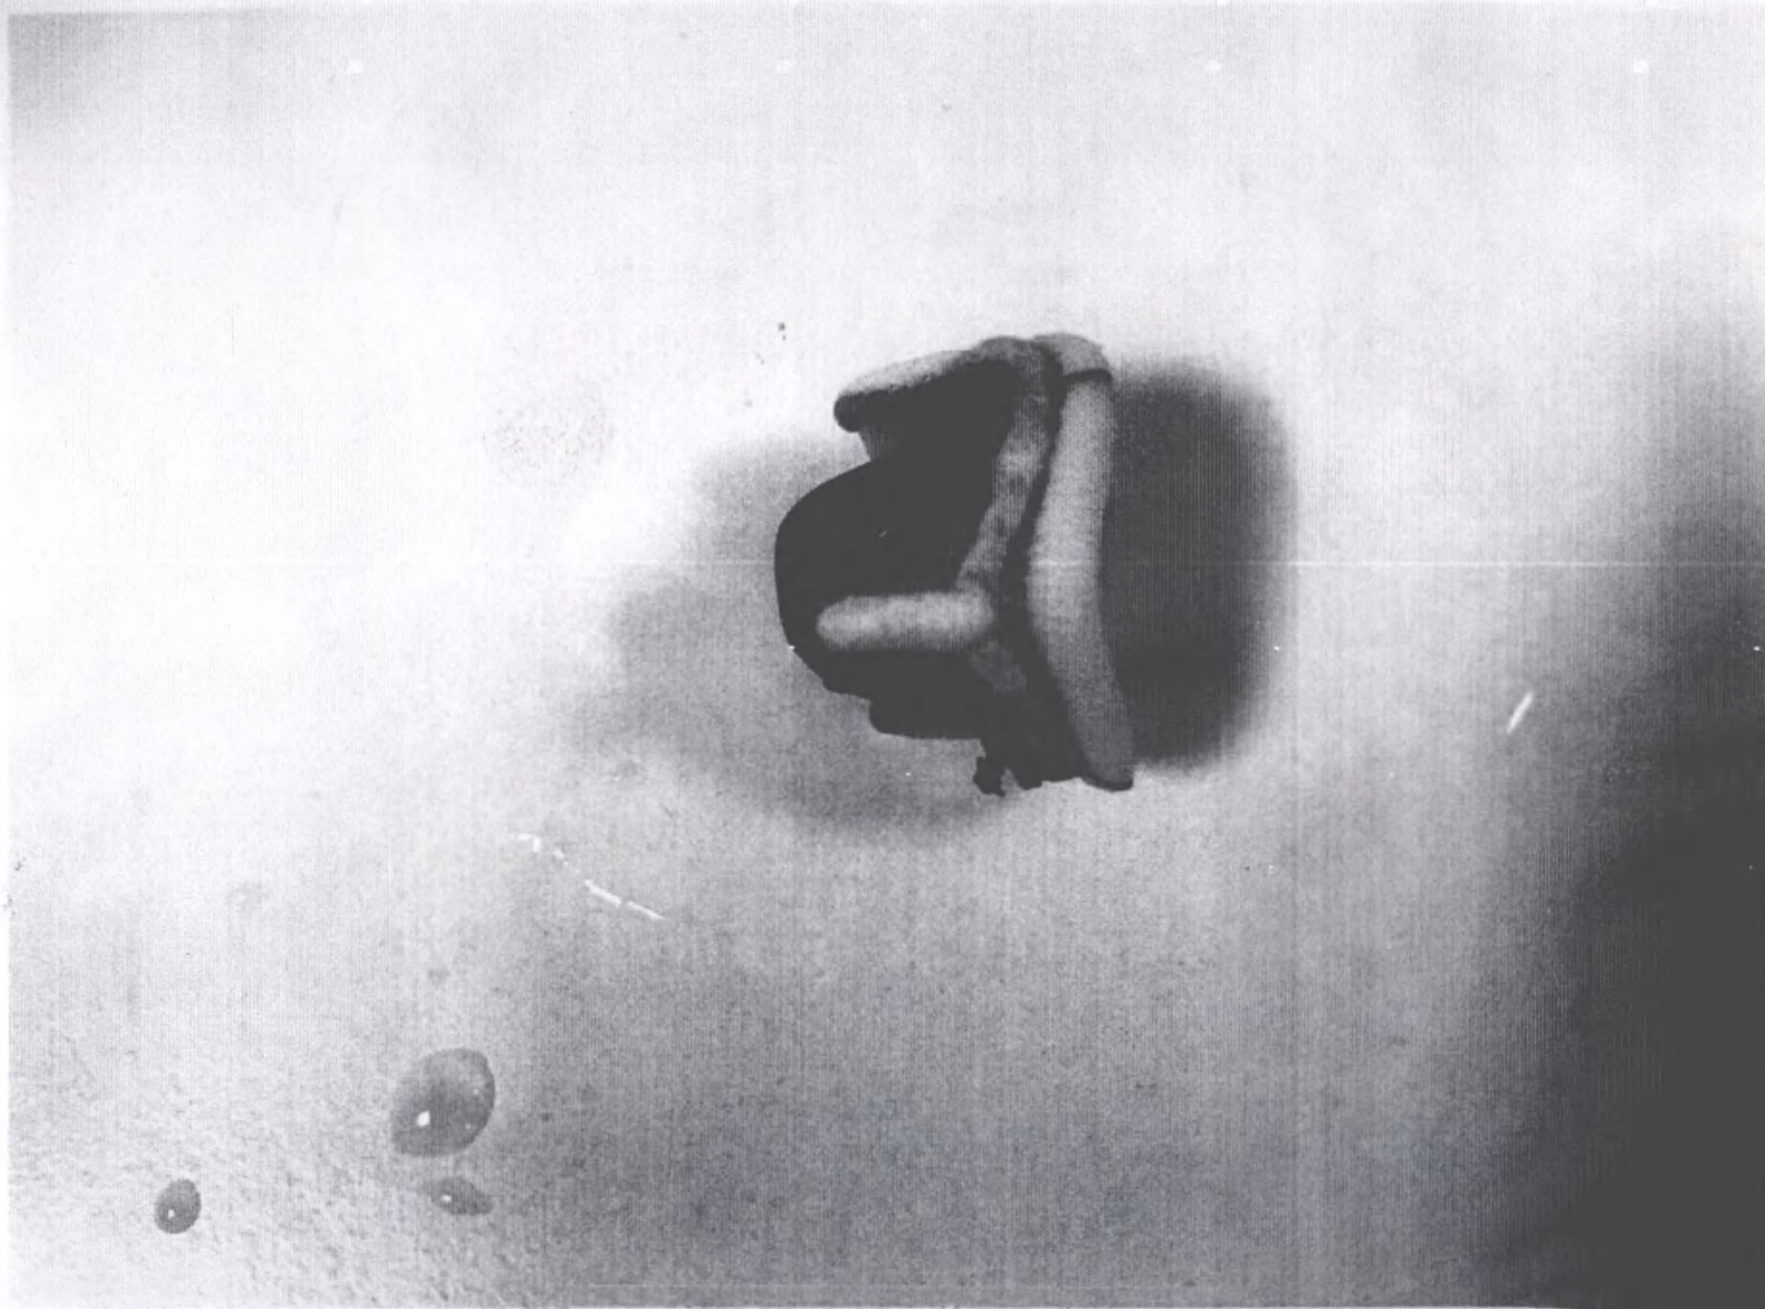


Рисунок 1. Протез клапана сердца аортальный лепестковый биологический Avalus (вид сбоку) на примере Протеза клапана сердца аортальный лепестковый биологический Avalus с посадочным диаметром 21 мм

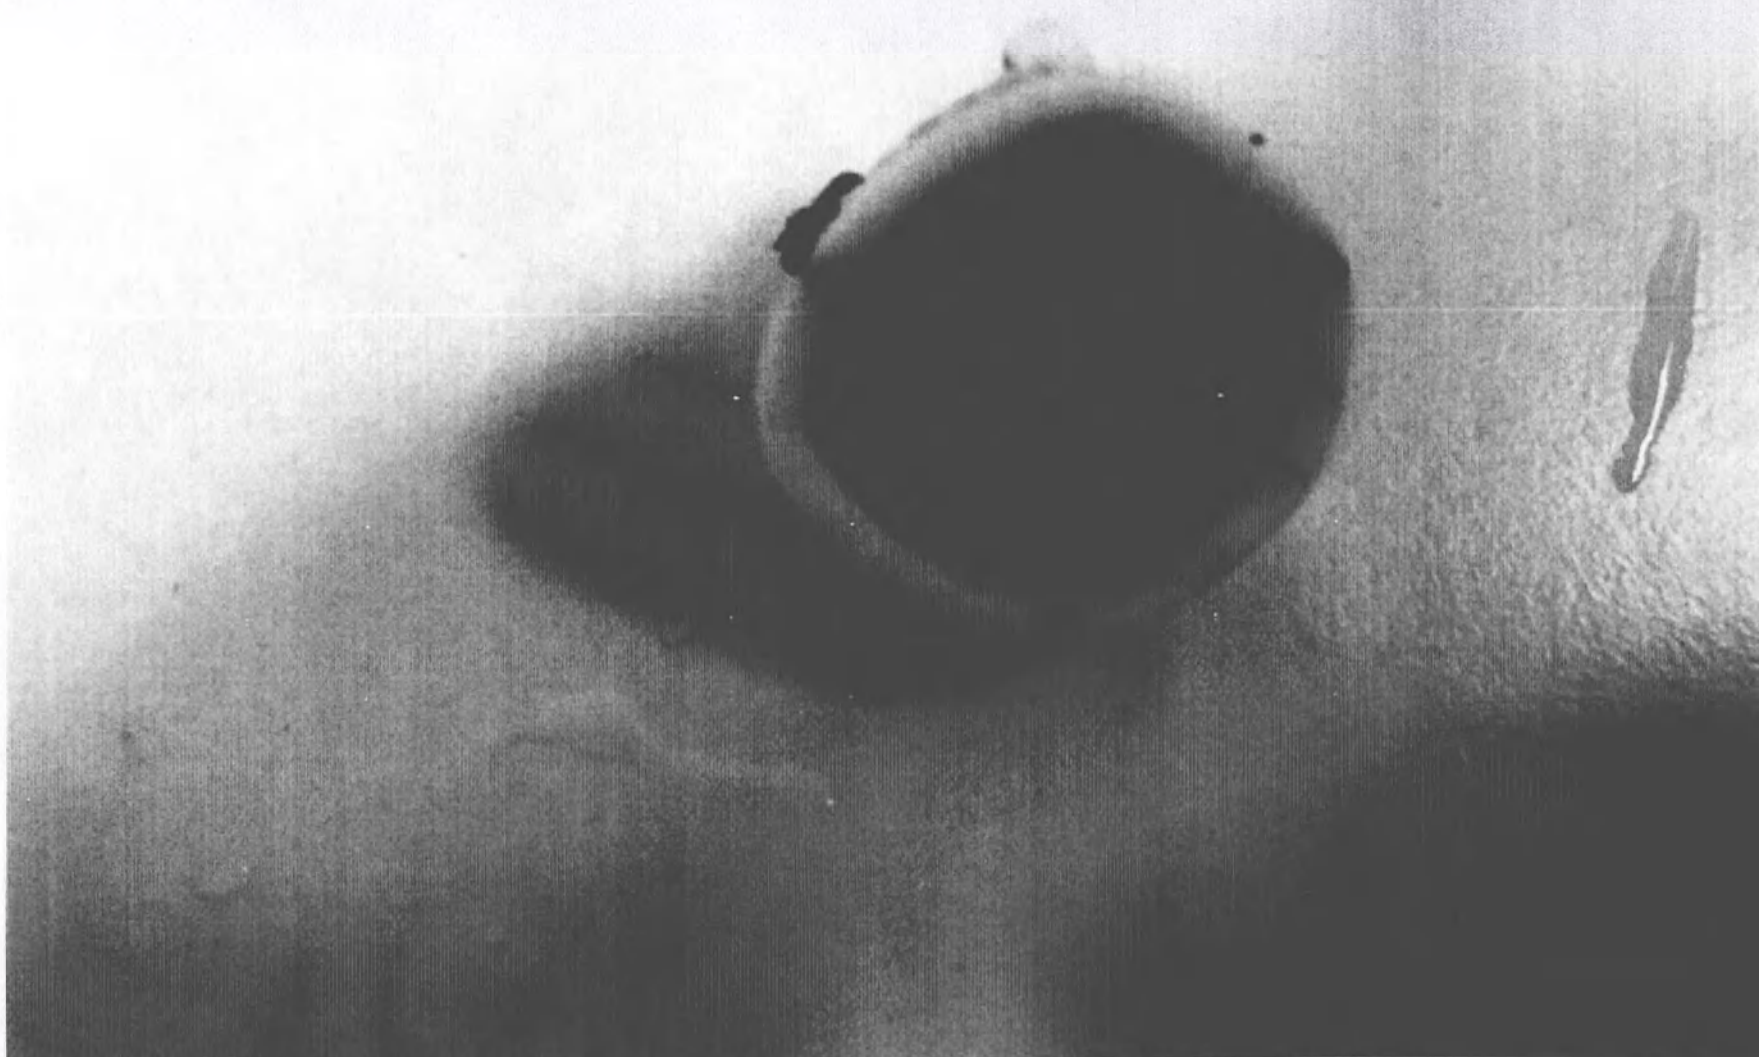


Рисунок 2. Протез клапана сердца аортальный лепестковый биологический Avalus (вид спереди) на примере Протеза клапана сердца аортальный лепестковый биологический Avalus с посадочным диаметром 21 мм



Рисунок 3. Протез клапана сердца аортальный лепестковый биологический Avalus (вид сверху) на примере Протеза клапана сердца аортальный лепестковый биологический Avalus с посадочным диаметром 21 мм

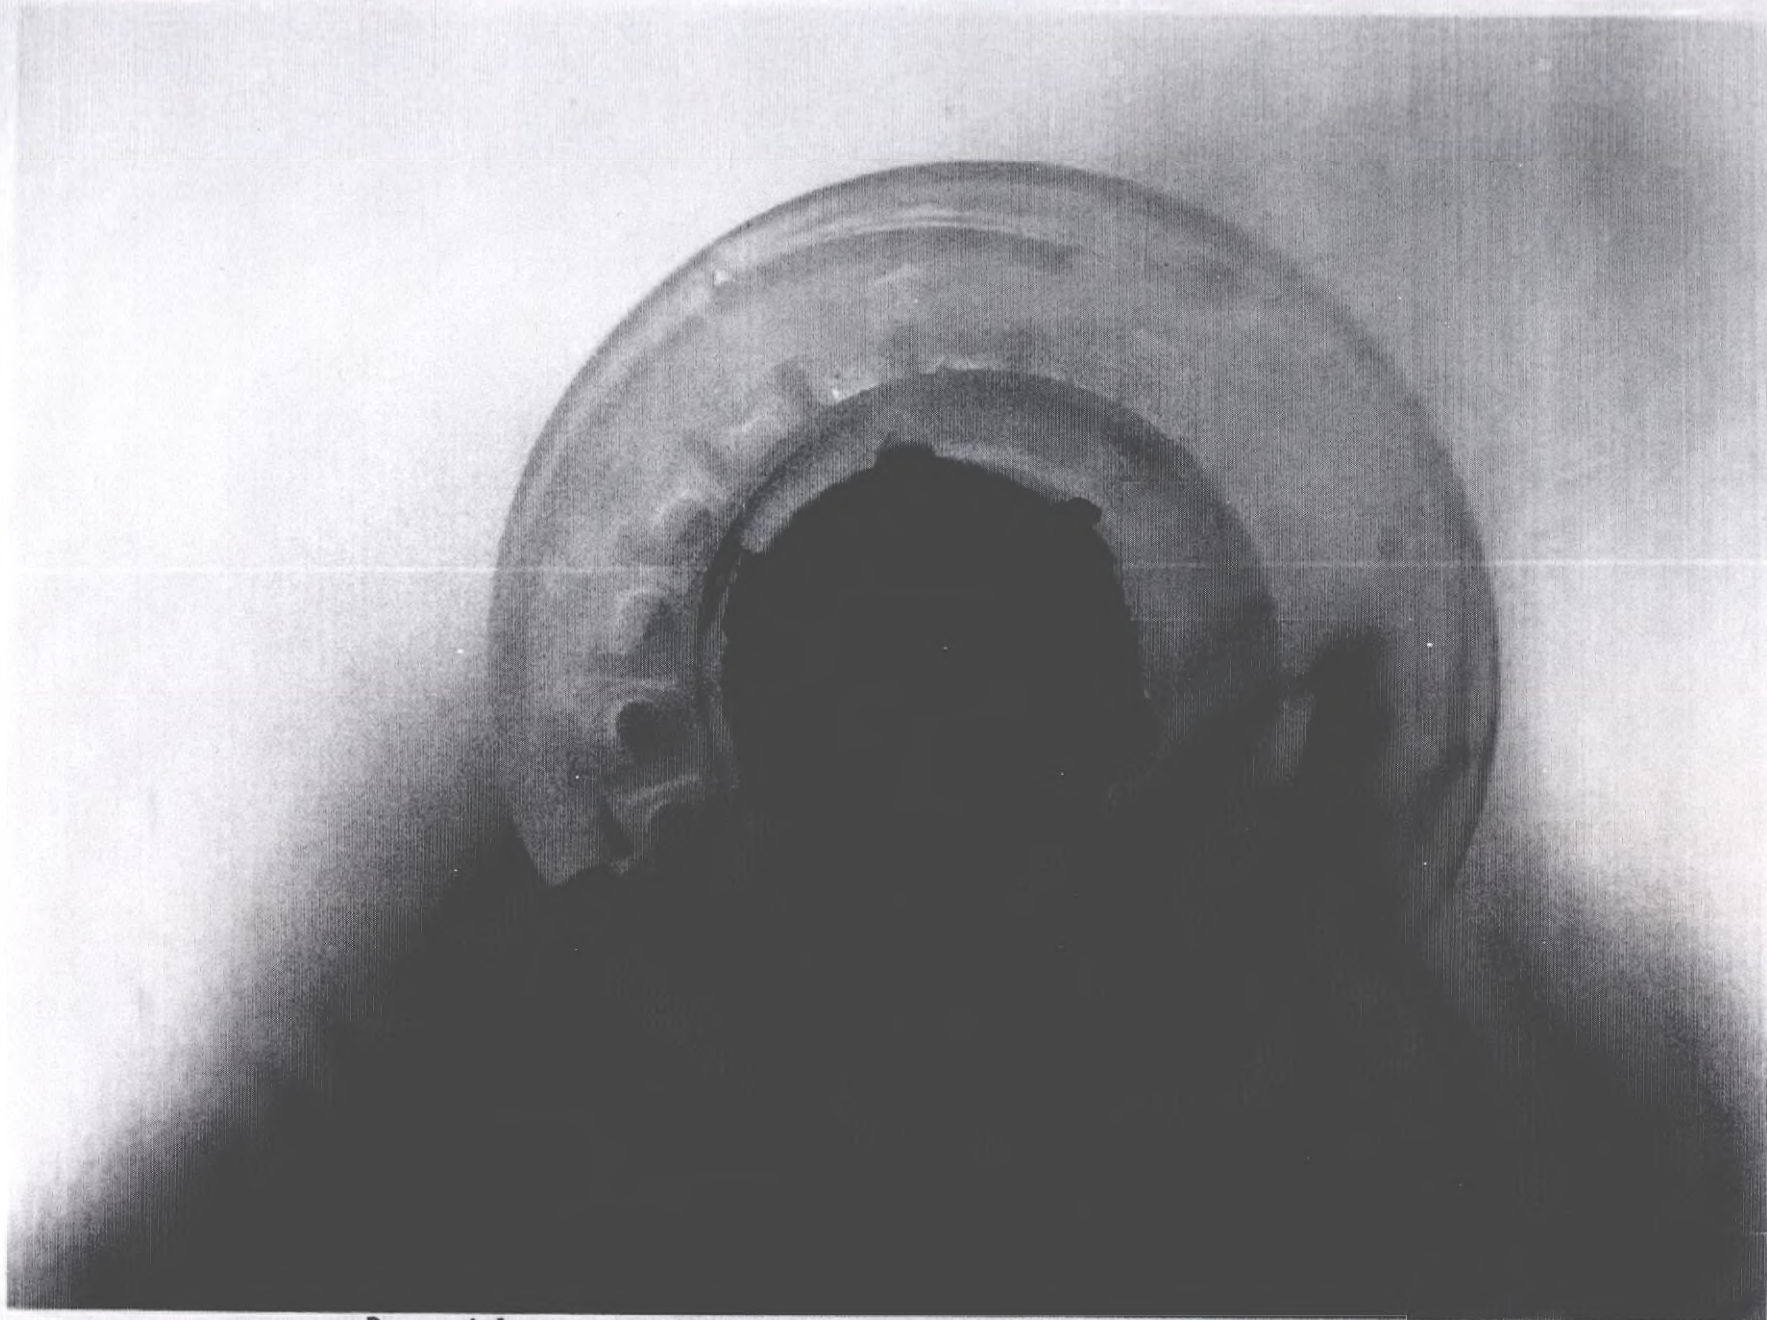


Рисунок 4. Фиксатор протеза клапана сердца аортальный лепестковый биологический Aavalus

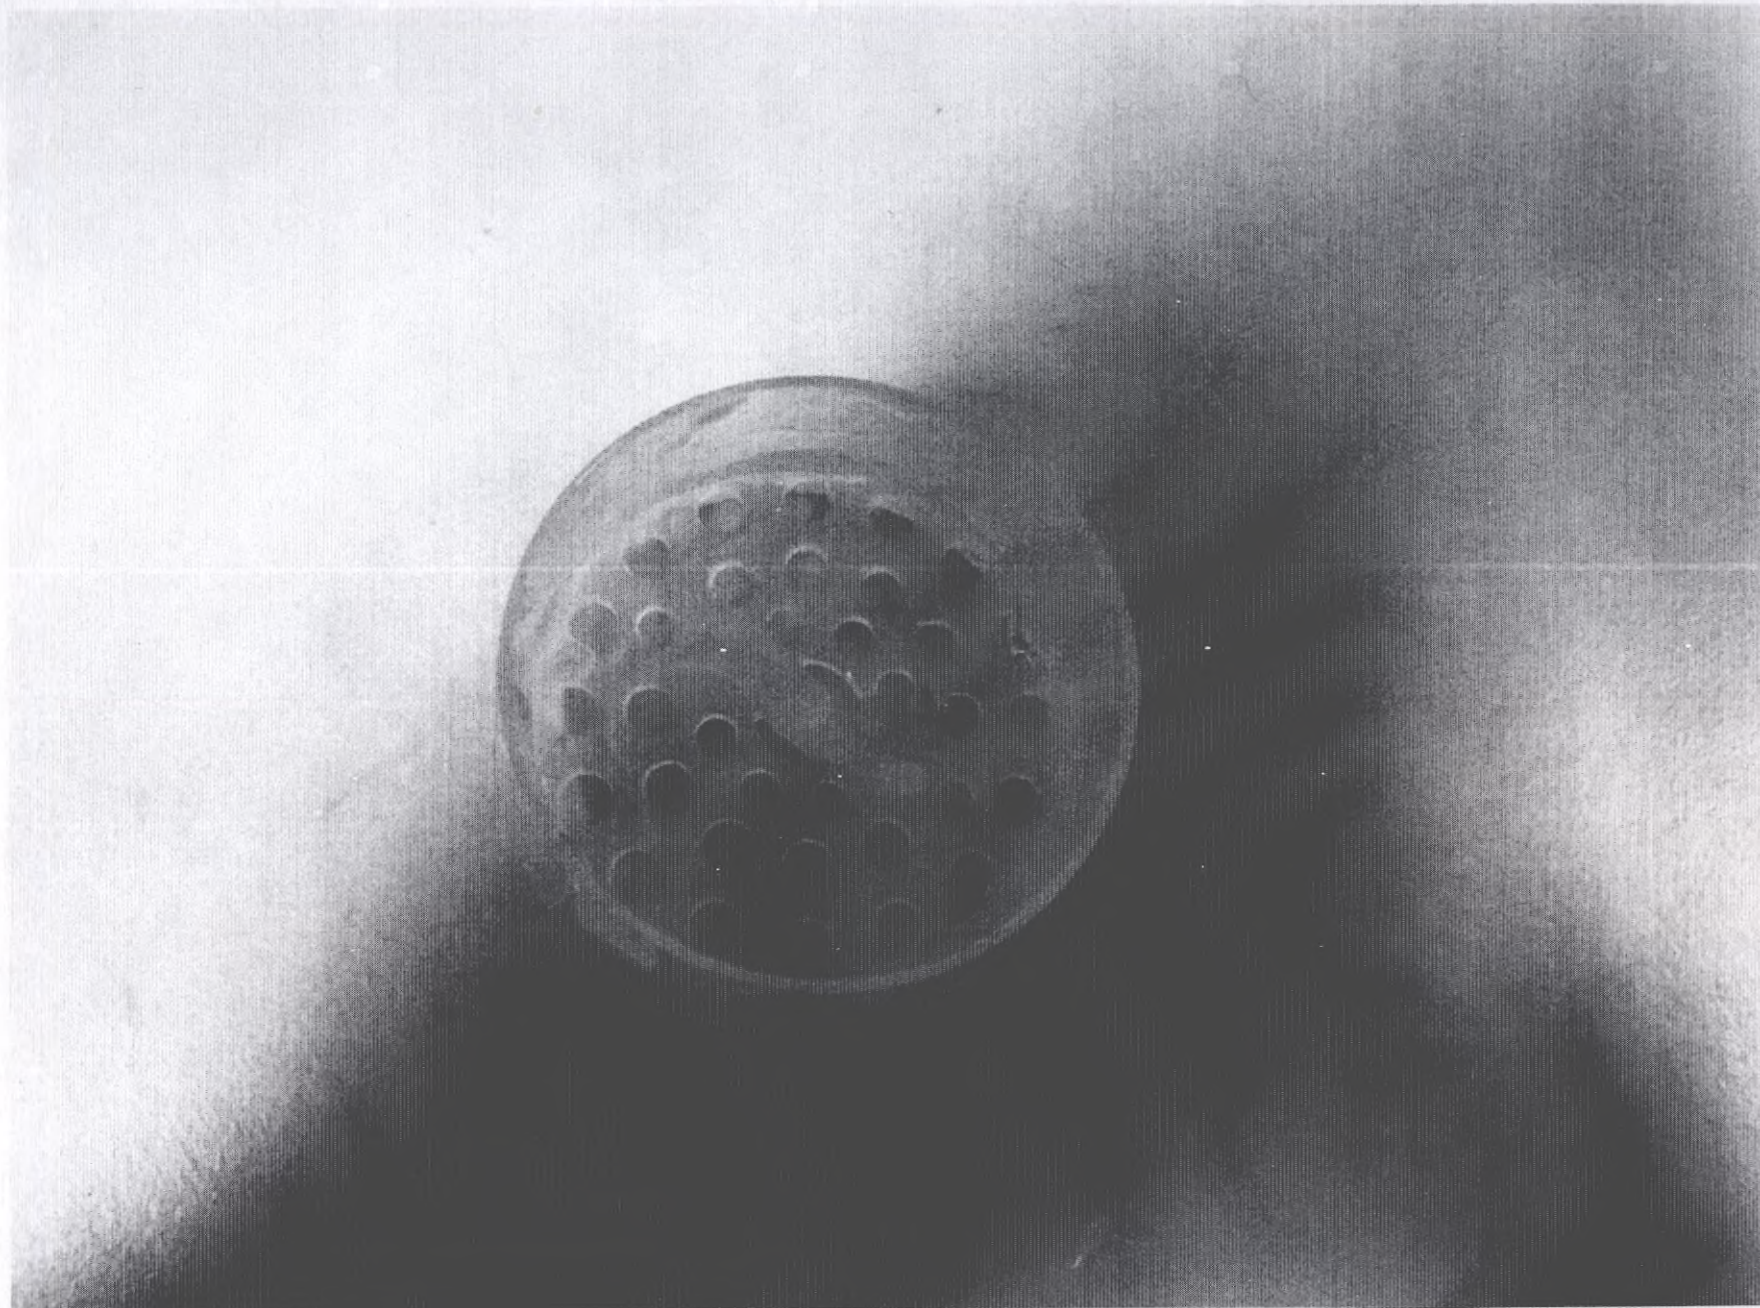


Рисунок 5. Крышка фиксатора протеза клапана сердца аортальный лепестковый биологический Avalus

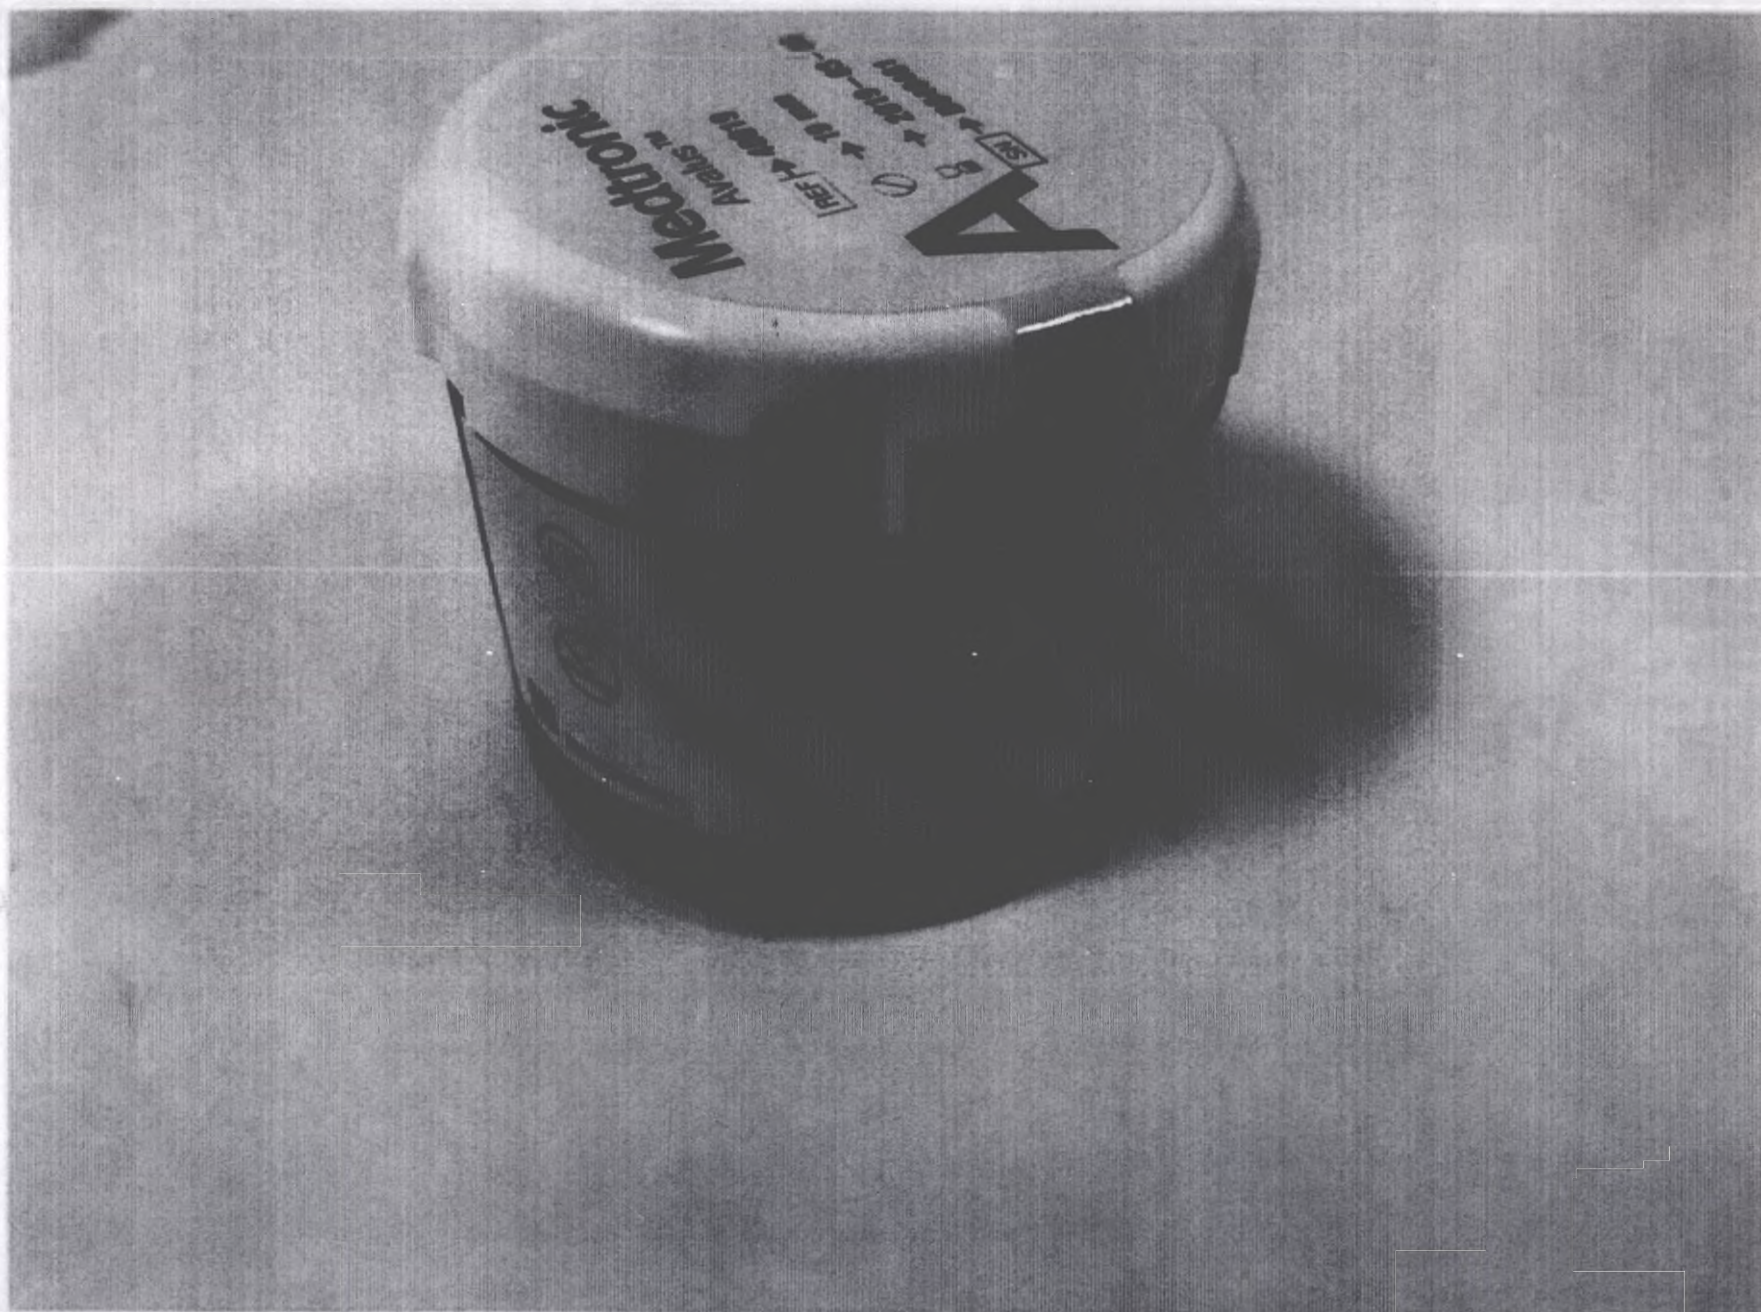


Рисунок 6. Первичная упаковка протеза клапана сердца аортальный лепестковый биологический Avalus (Стеклянный контейнер) Рисунок 6. Первичная

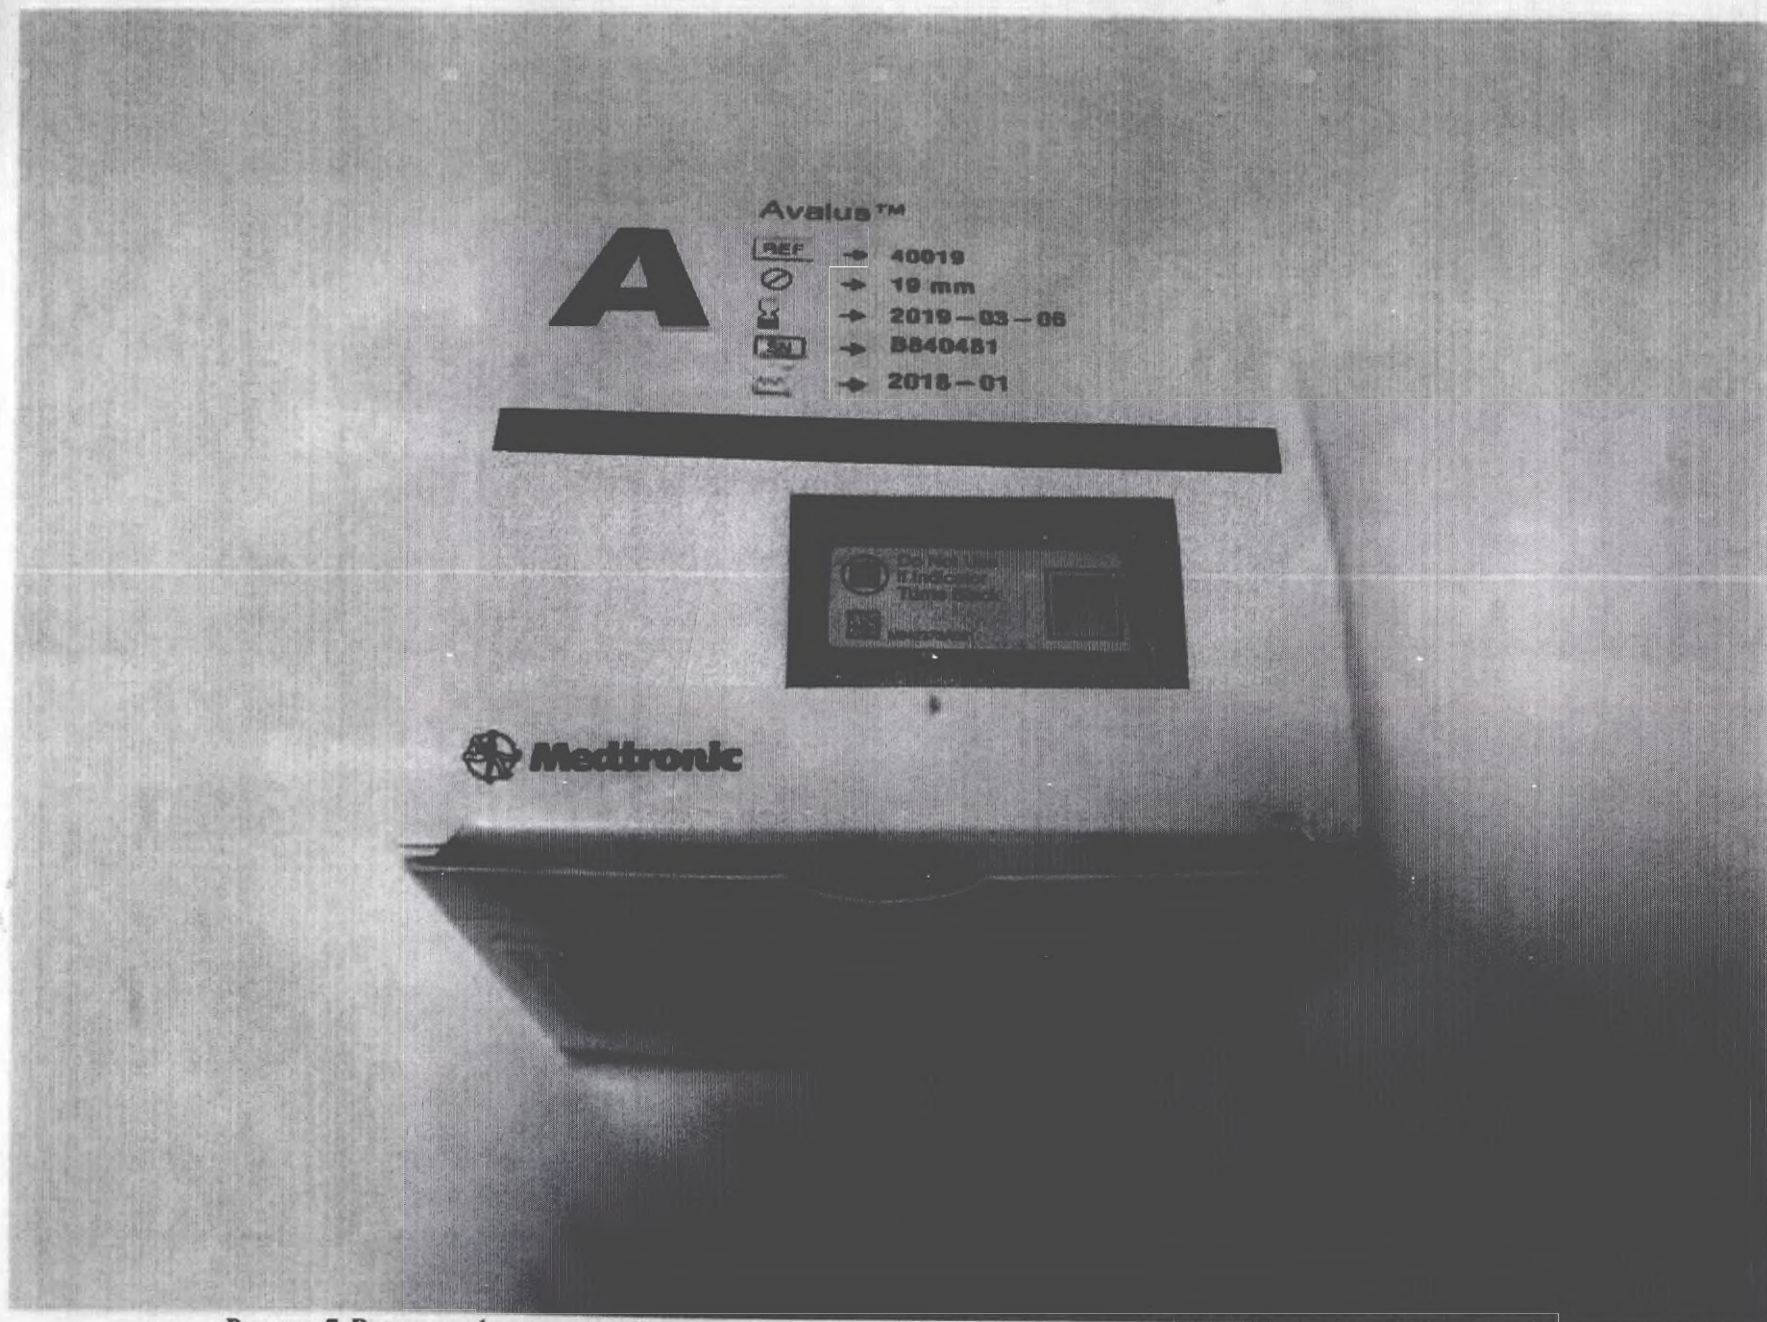


Рисунок 7. Вторичная (транспортная) упаковка протеза клапана сердца аортальный лепестковый биологический Avalus

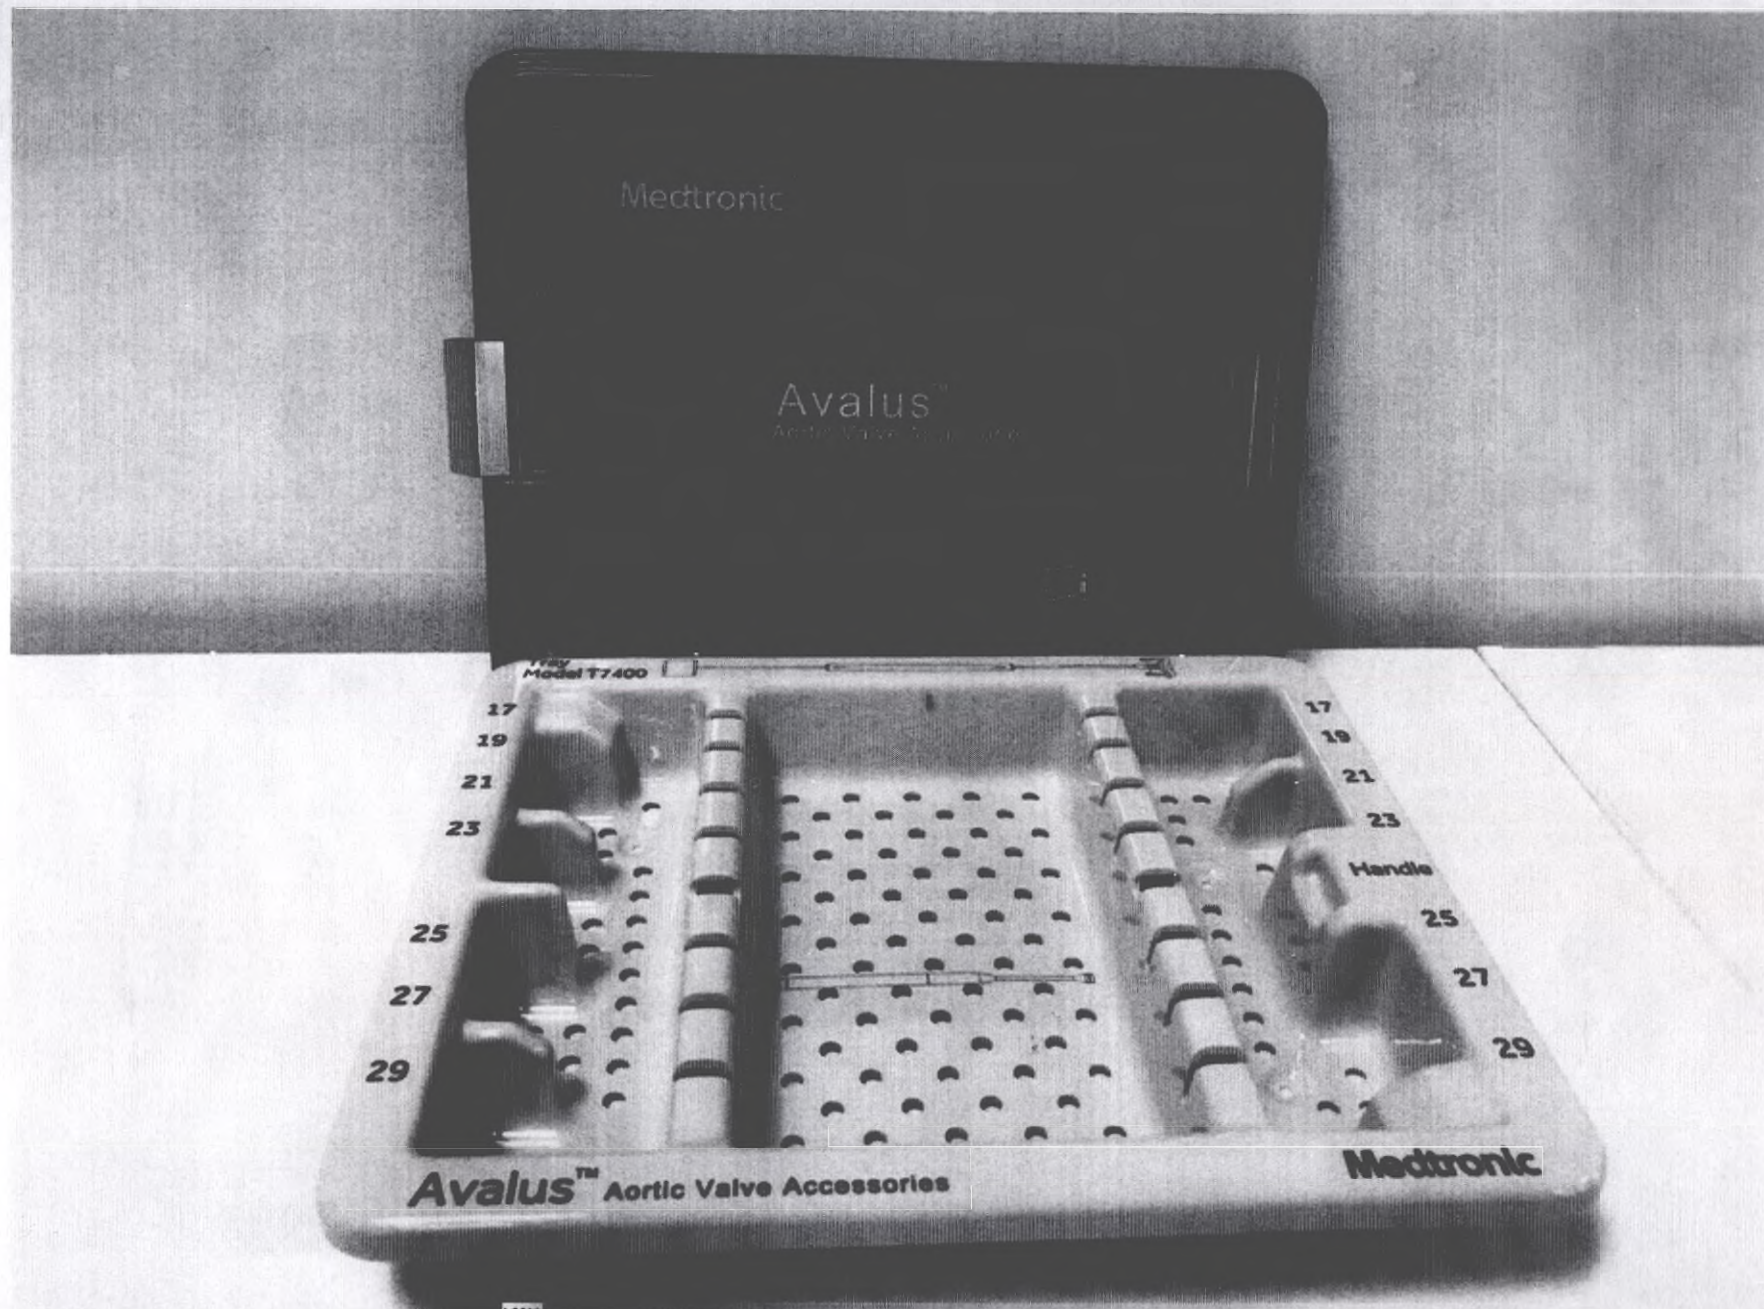


Рисунок 8. Лоток для принадлежностей (Основание и крышка)




Рисунок 11. Универсальная ручка держатель

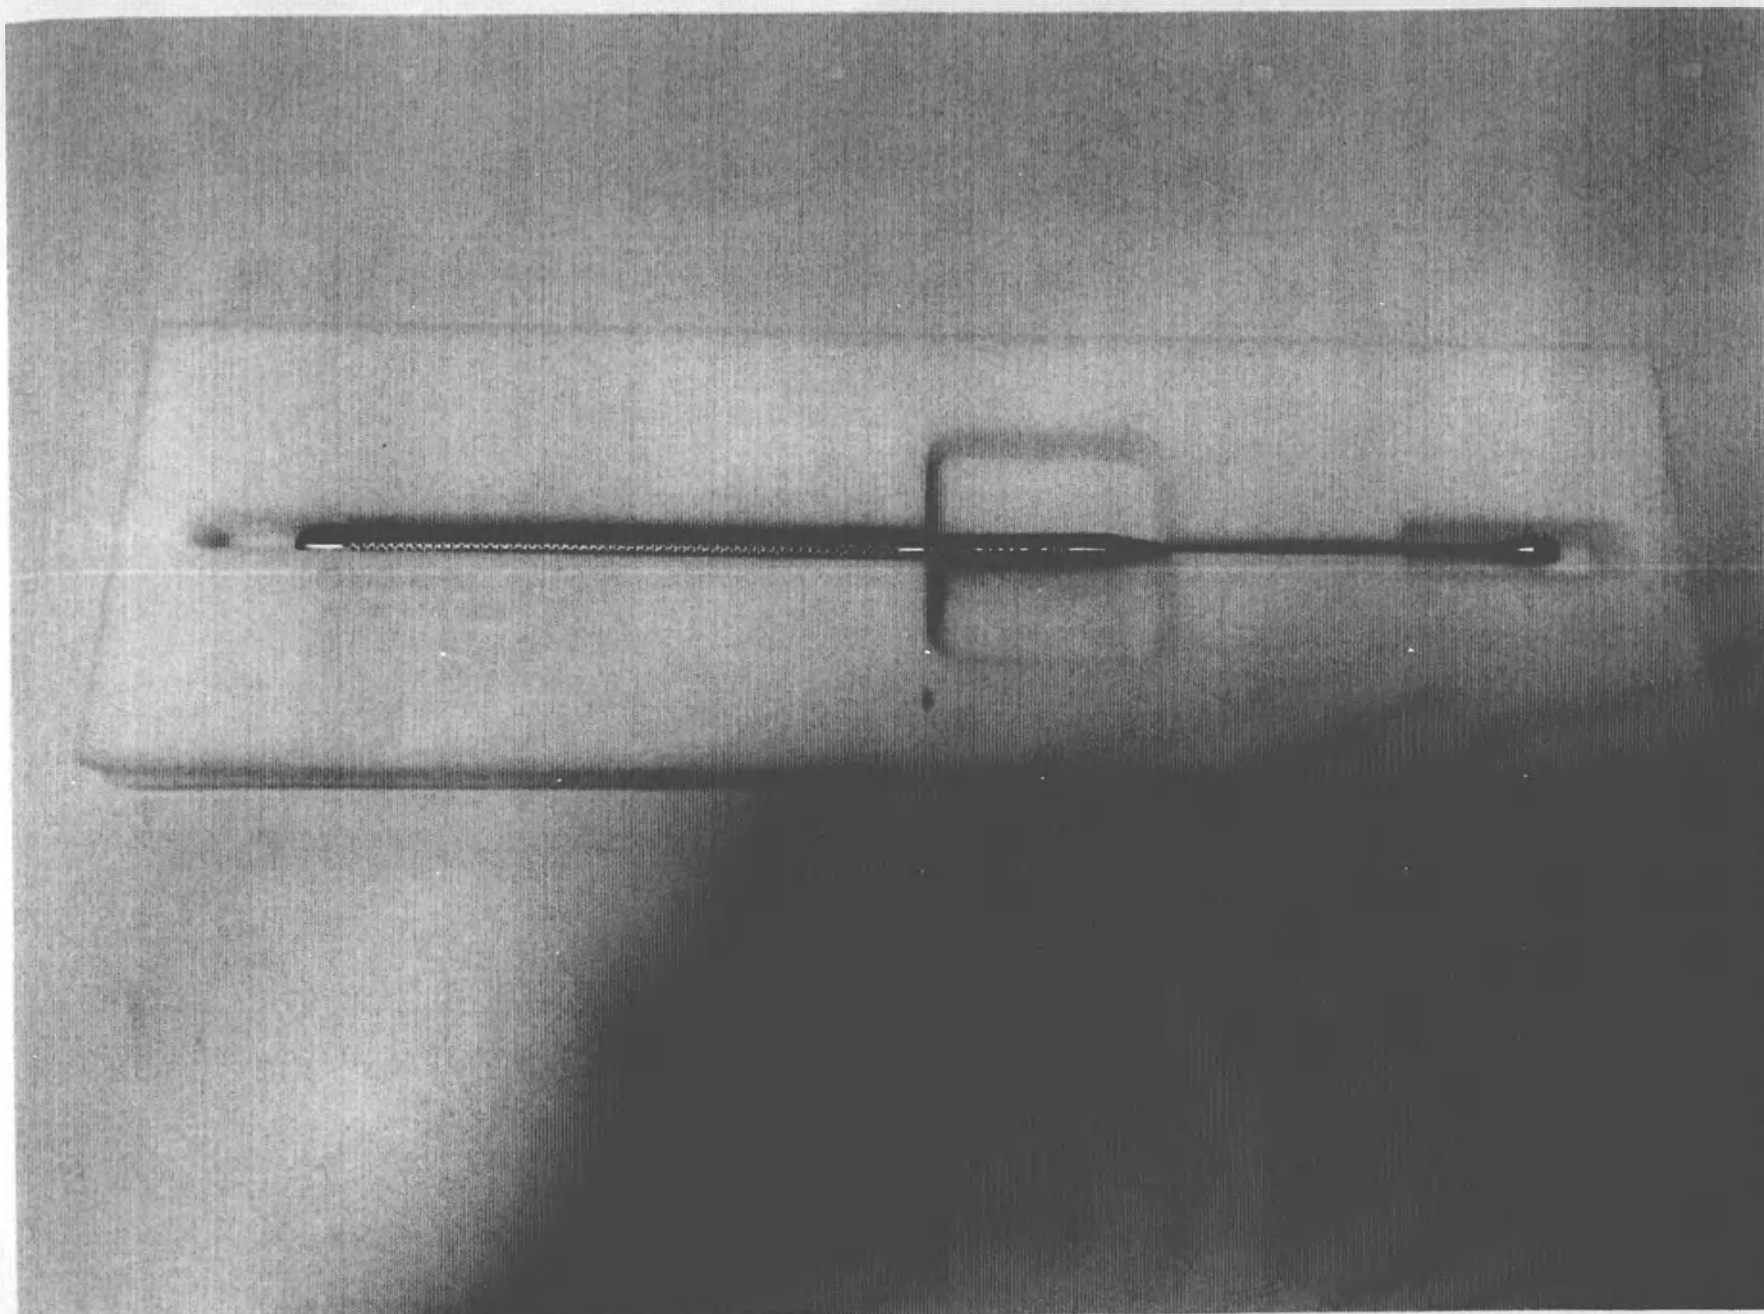


Рисунок 11. Универсальная ручка держатель

20. 1940. gada 1. oktobrī, kad Latvijas valsts bija okupēta, tika izveidota Latvijas Valsts valodas komisija, kas bija atbildīga par valodas politikas īstenošanu. Komisijas priekšsēdētājs bija Kārlis Vācietis, kas bija arī valodas komisijas sekretārs. Komisijas sastāvā bija arī citi valodas zinātnieki, kas bija atbildīgi par valodas politikas īstenošanu. Komisijas uzdevums bija nodrošināt valodas politikas īstenošanu, kas bija atbilstoši valsts interesiem. Komisijas darbs bija saistīts ar valodas politikas īstenošanu, kas bija atbilstoši valsts interesiem. Komisijas darbs bija saistīts ar valodas politikas īstenošanu, kas bija atbilstoši valsts interesiem.

Medtronic, Inc.
715 Medtronic Parkway
Minneapolis, MN 55432-1514

Medtronic Heart Valves Division
1001 E. Ocean Avenue
Irvine, CA 92714 USA

Product of USA

1072664DOC1 Rev 1A



LOT ▶ 212039005



 ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

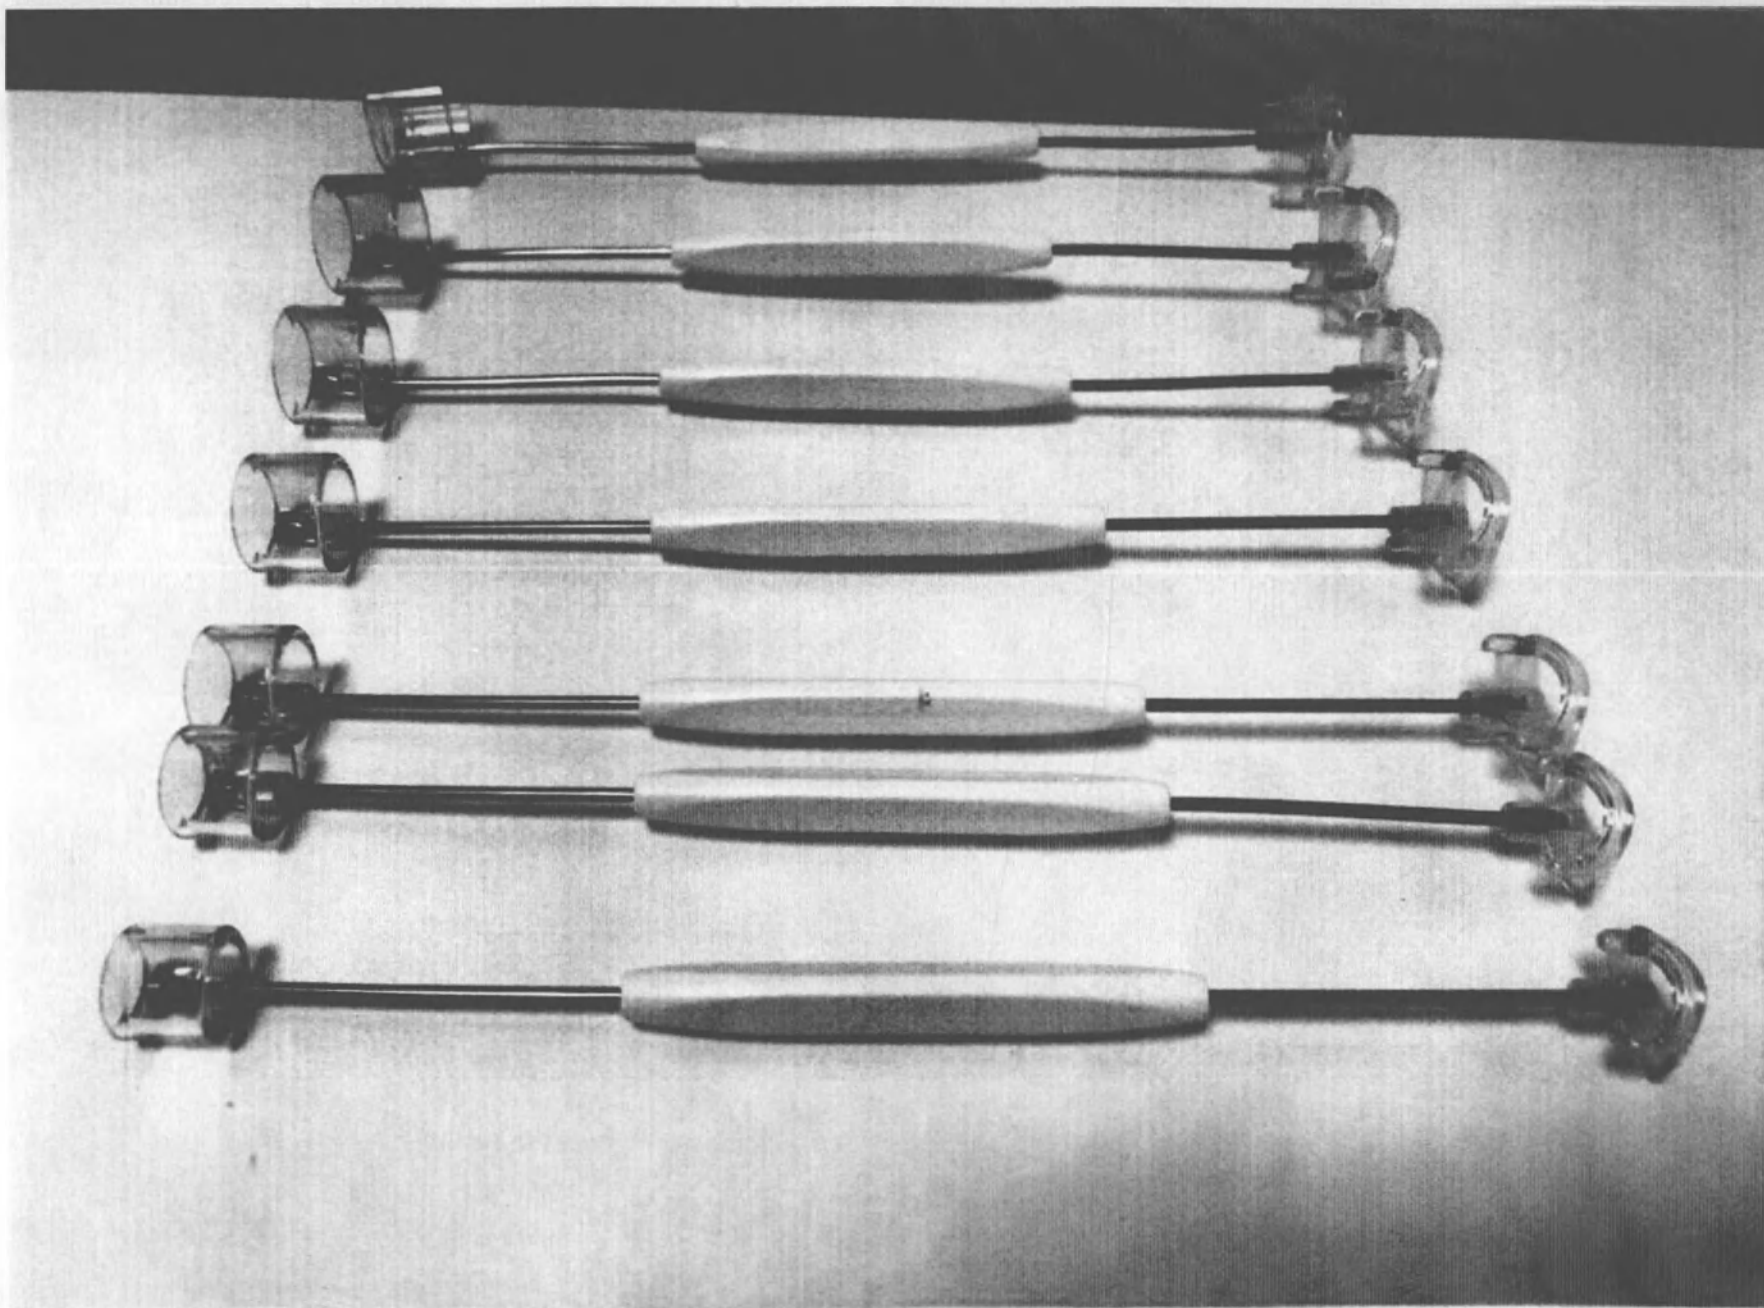


Рисунок 13. Измеритель диаметра клапана Avalus

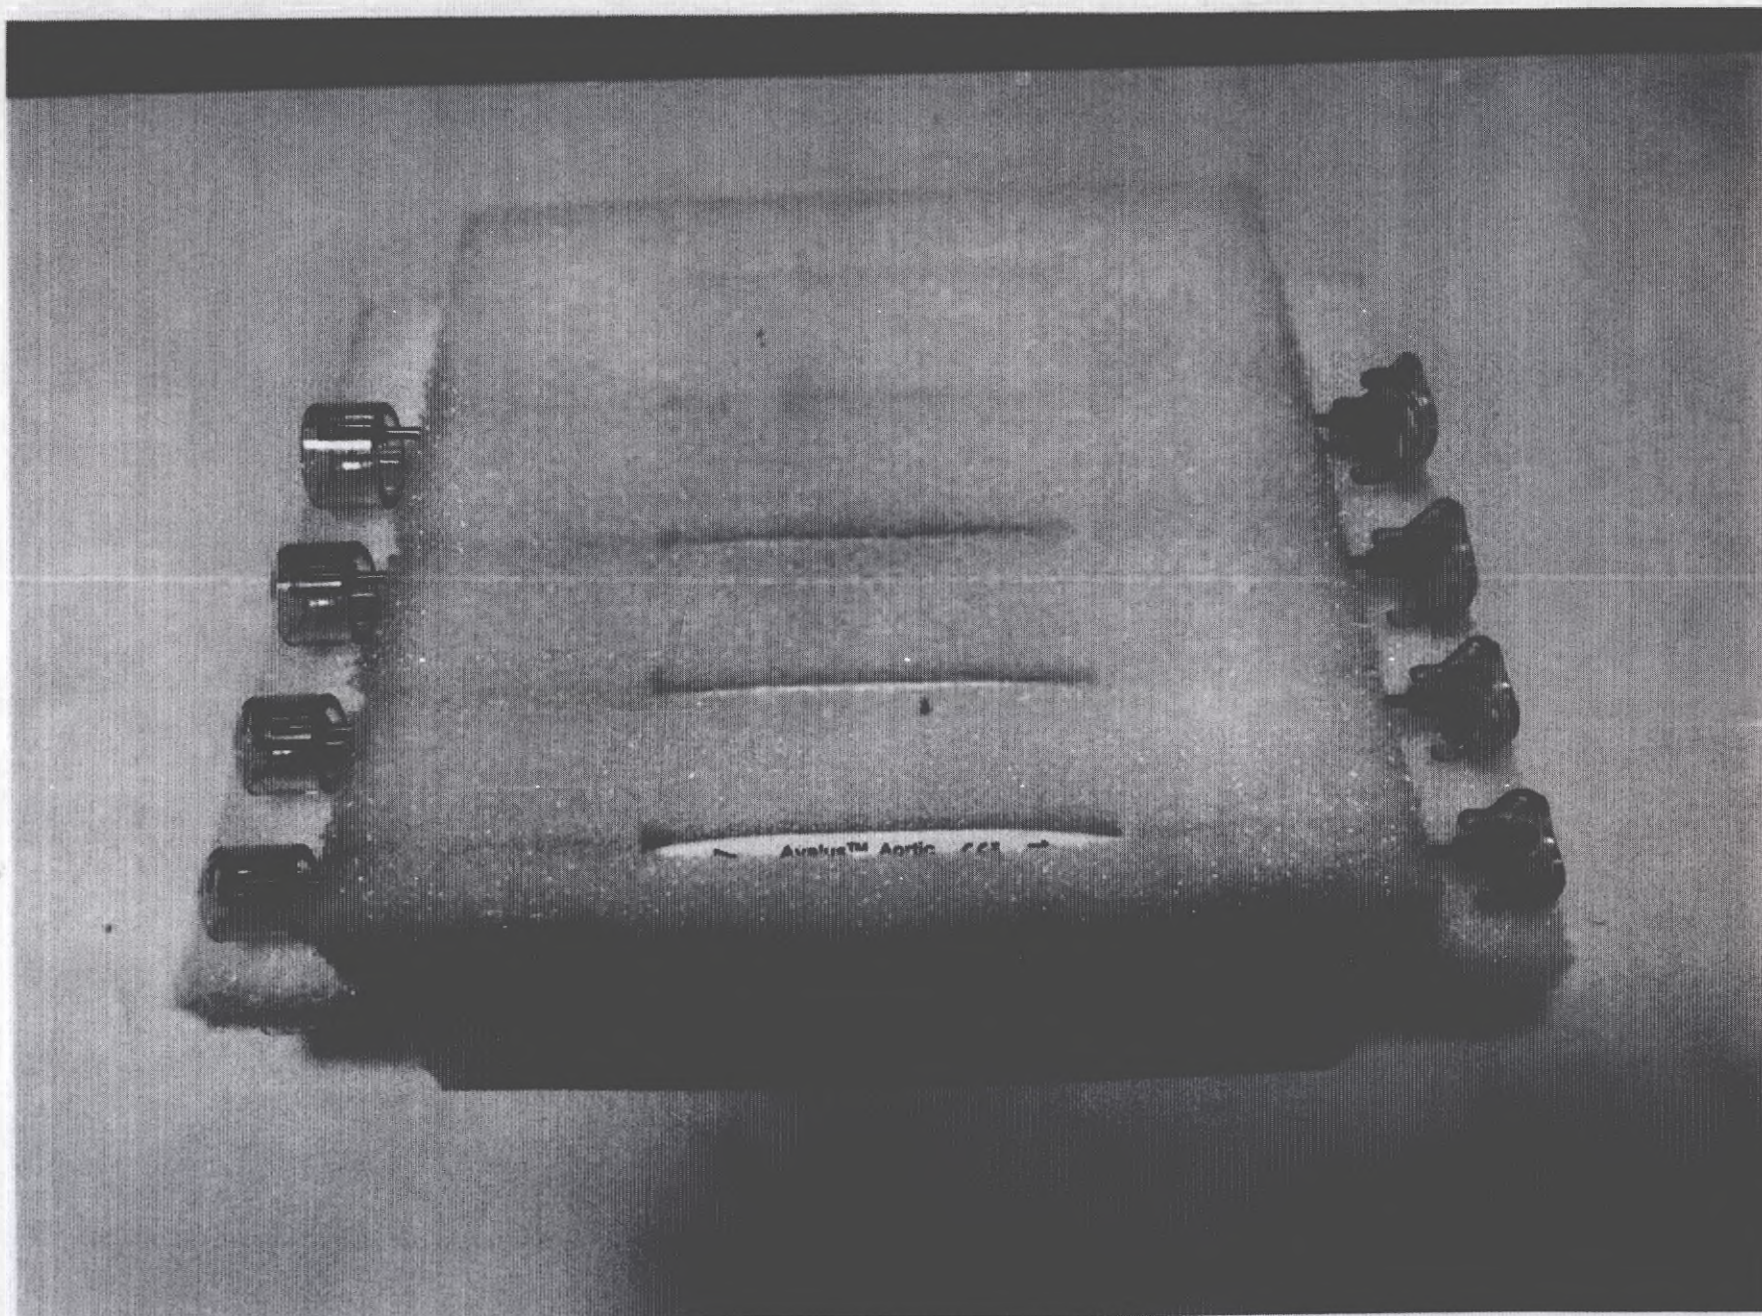


Рисунок 14. Измеритель диаметра клапана Avalus

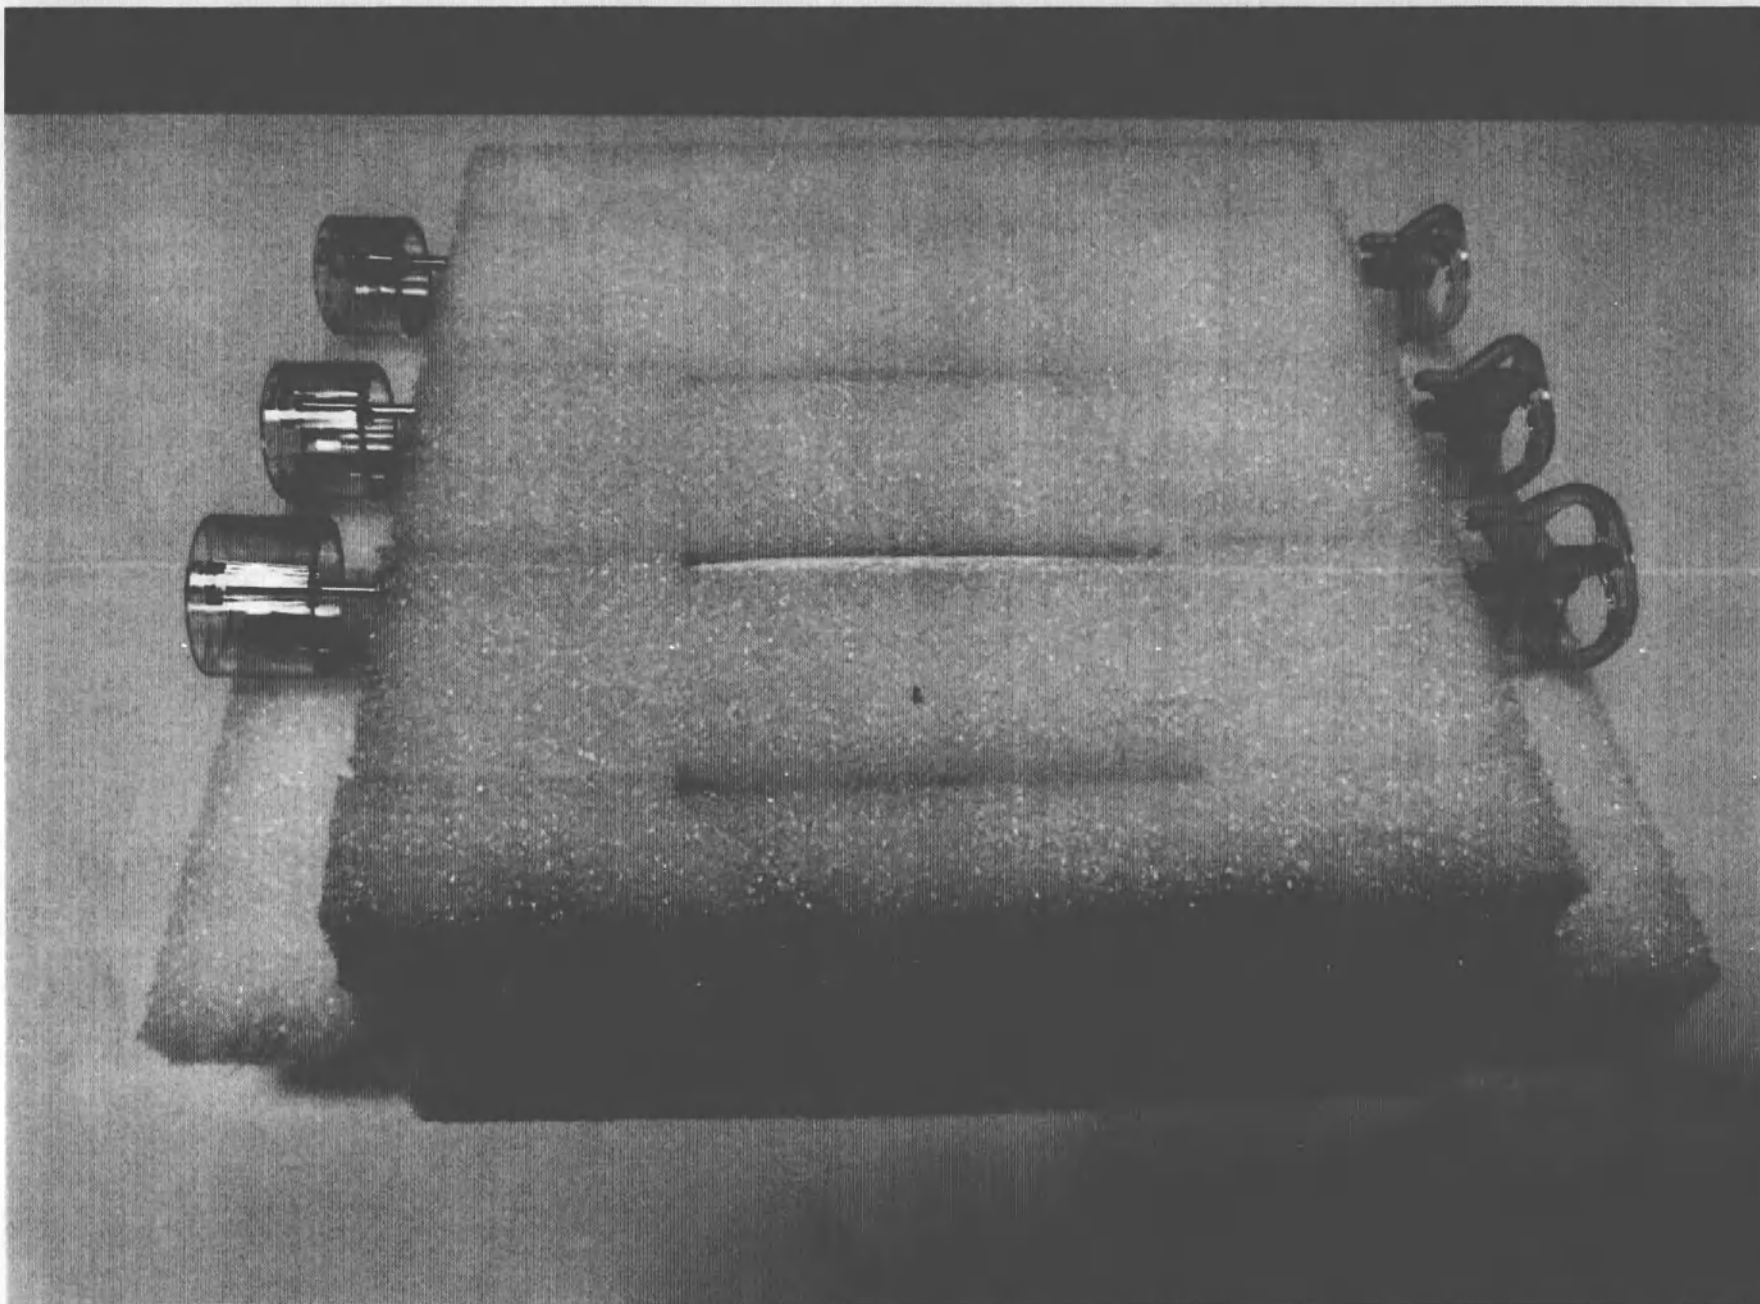


Рисунок 15. Измеритель диаметра клапана Avalus

Medtronic
Avalus™ 7400S

es Sizers / big Conspicuous / es Märtyr / die Sizers /
die Calibratoren / el Mētrónik / mētrónik / es Medidores /
es Calibradores / el Sovlānēl / fr Calibraire / fr Ajuste za
određivanje veličine / ha Mētrónik / el Mētrónik /
fr Calibratore / fr Sizers / mētrónik / mētrónik /
el Sizers / no Mētrónik / el Pozymary / pt-br Calibradores /
pt-pt Calibradores / re Calibratore / re Mētrónik
(Mētrónik dvanastre stranice Avalus) / el Mētrónik /
el Naprava za določanje velikosti / es Regulador veličine /
es Startelastmētrónik / fr Boyut bētrōnyk / uk Bētrōnyk



1000000001 Rev 1A

REF ► 7400S

LOT ► 212232841



Рисунок 16. Упаковка измерителя диаметра клапана Avalus