



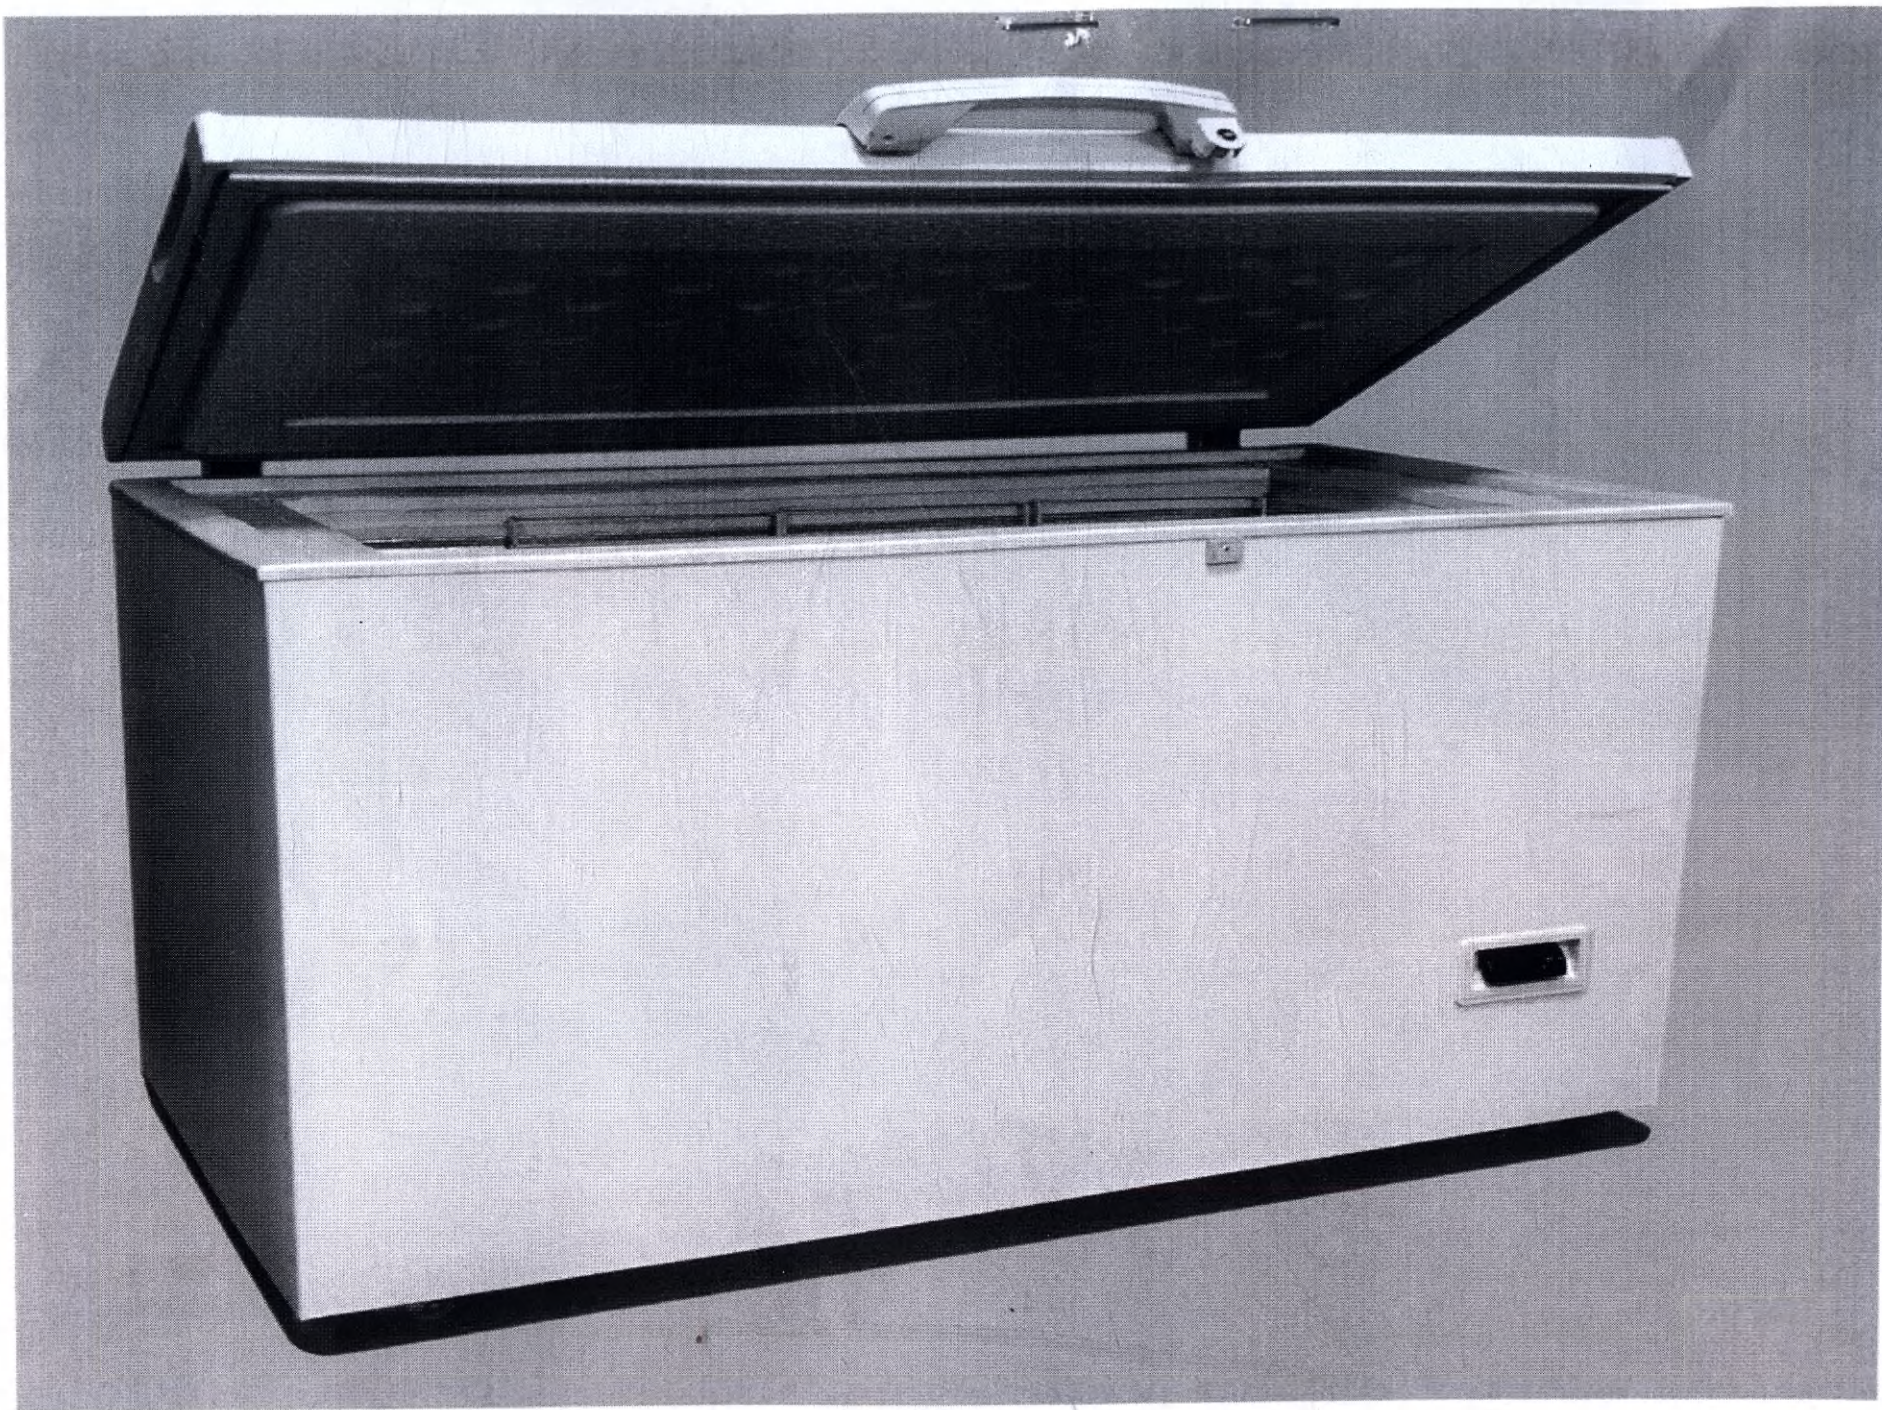

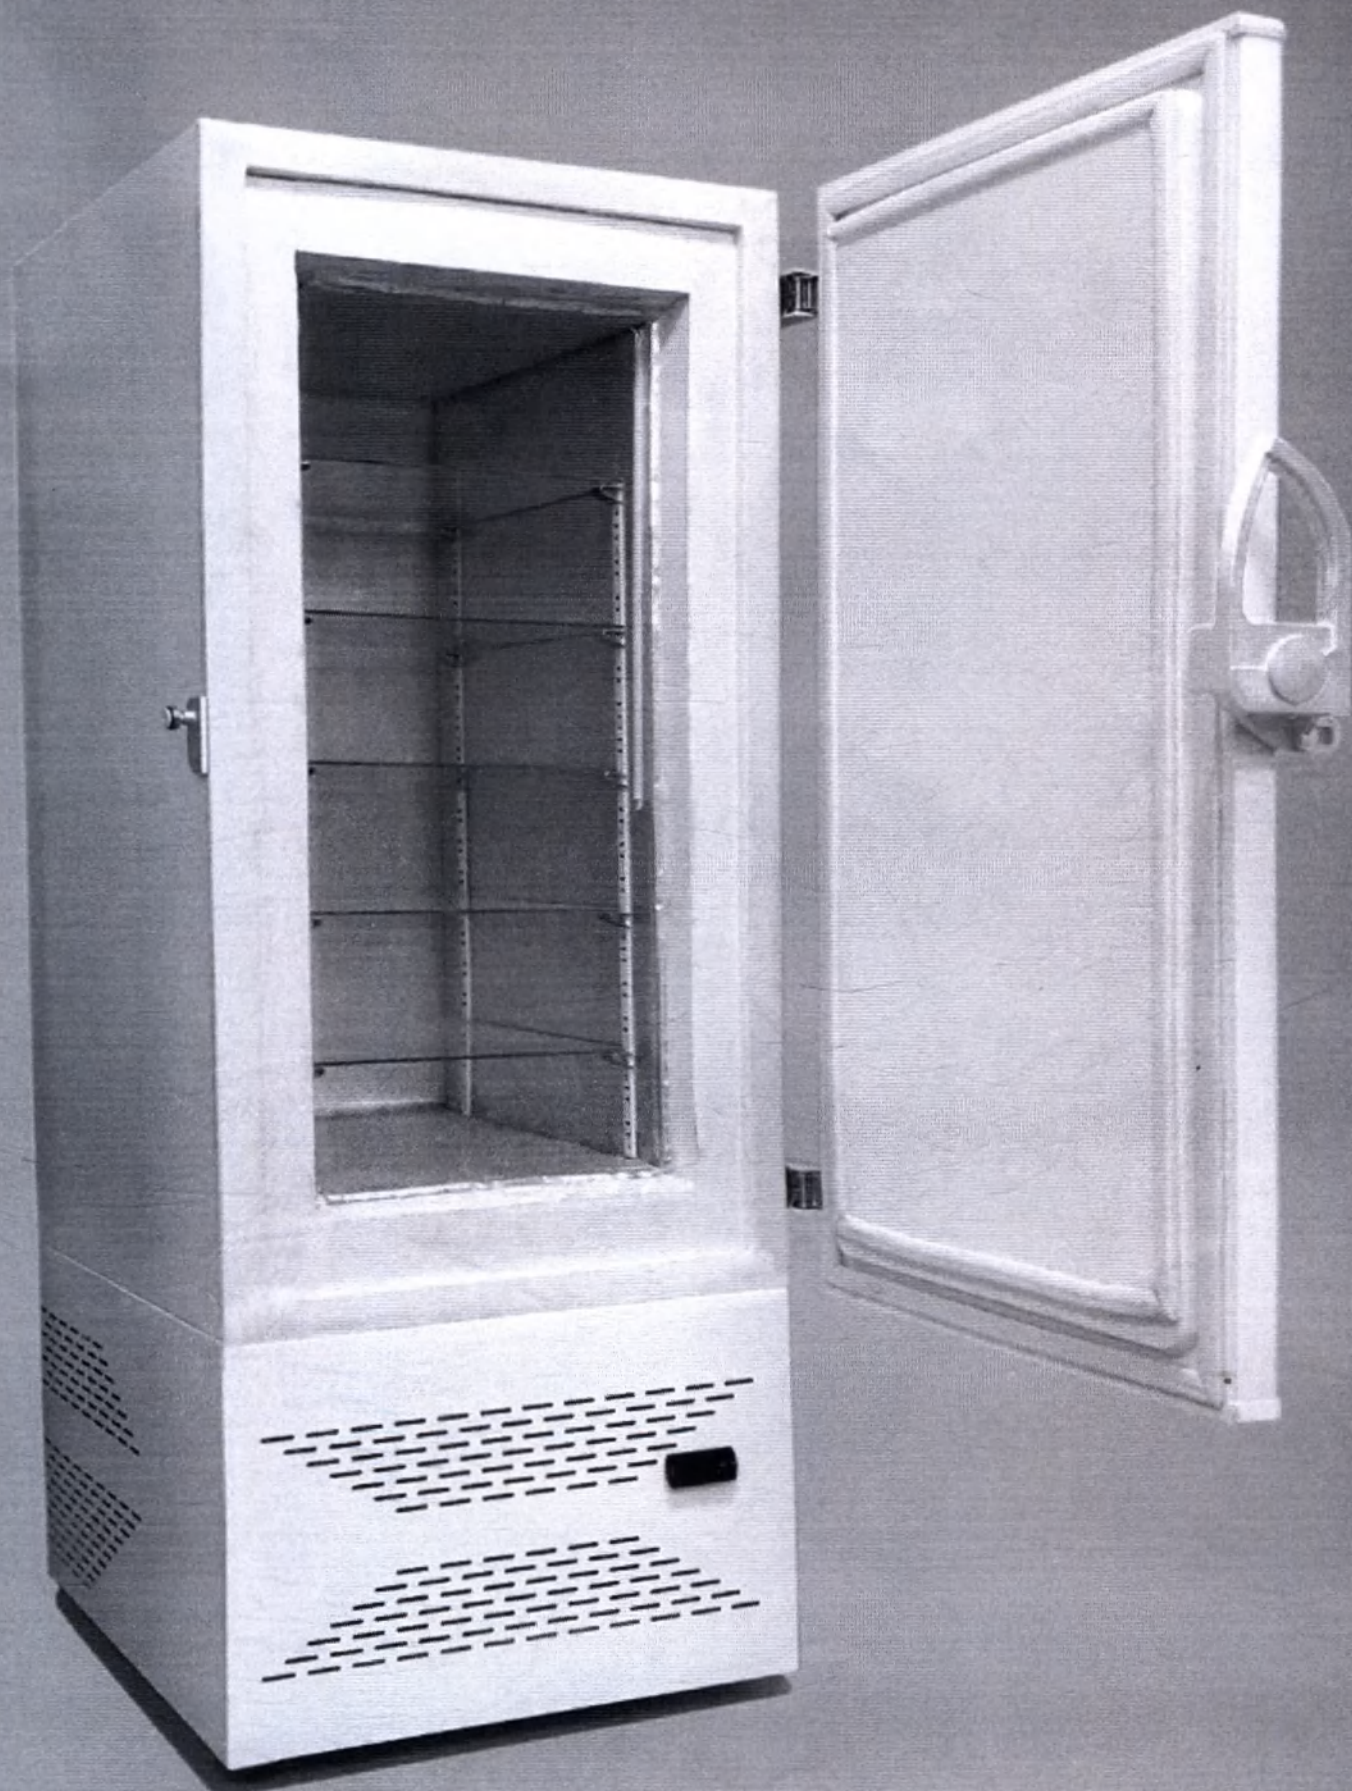

Камера морозильная медицинская «Бирюса 205К-Г», «Бирюса 205К-Р», «Бирюса 205К-ГВ», «Бирюса 205К-РВ»
Камера морозильная медицинская «Бирюса 245К-Г», «Бирюса 245К-Р», «Бирюса 245К-ГВ», «Бирюса 245К-РВ»

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 2 лист(ов)

Руководитель организации



М. В. Петров