


1.1. Система рентгеновская дентальная панорамная, цефалометрическая и томографическая MyRay Hyperion X9 pro, в составе, с принадлежностями



1.2 Пульт управления, краниостат, блок указателей лазерного позиционирования системы рентгеновской дентальной панорамной, цефалометрической и томографической MyRay Hyperion X9 pro и краниостат

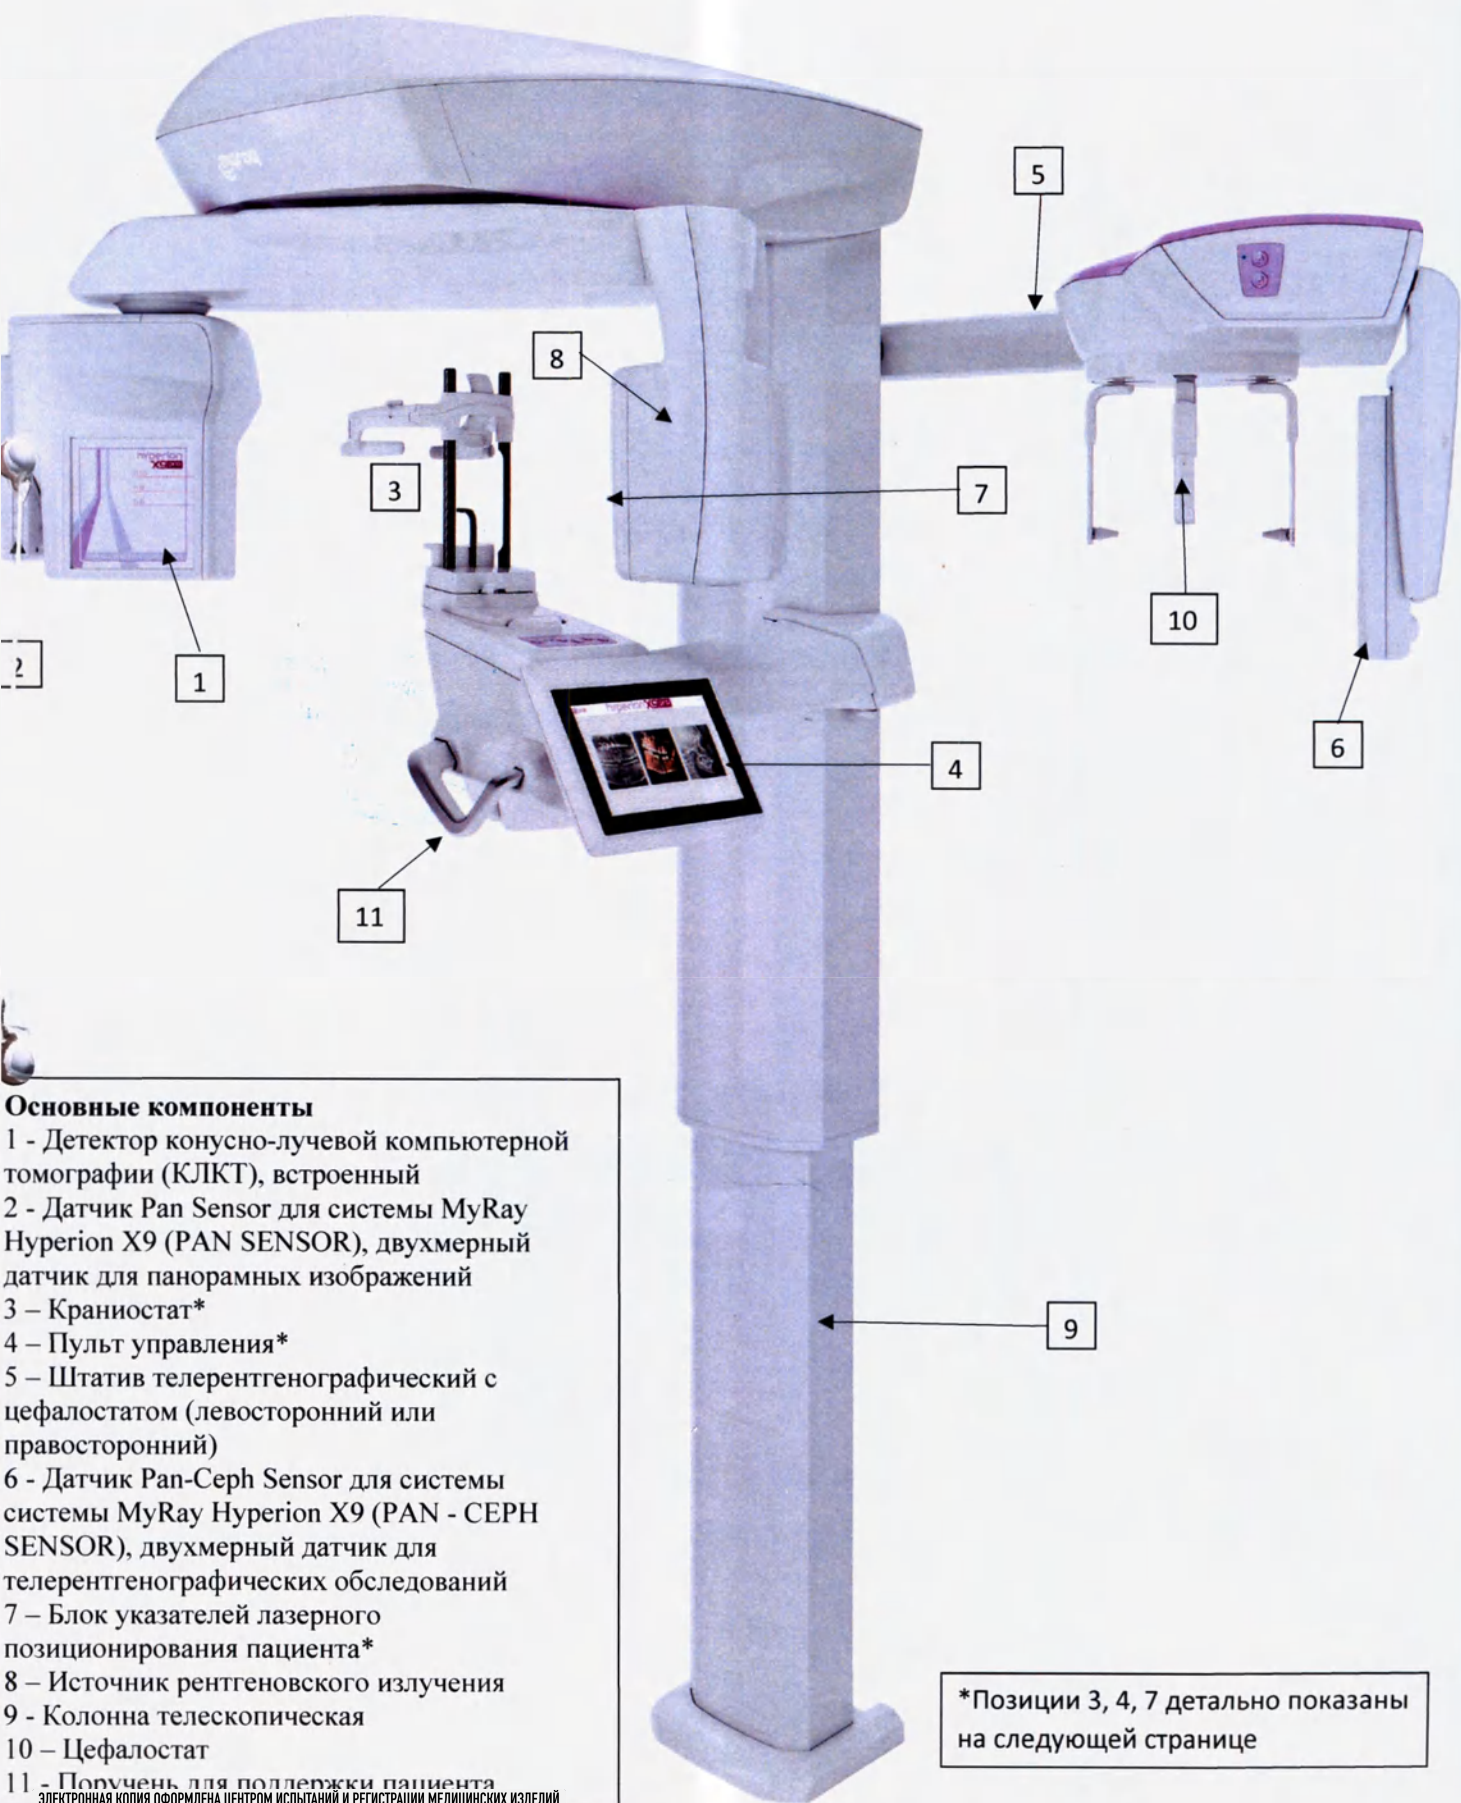

2. Датчик Pan Sensor для системы MyRay Hyperion X9 (PAN SENSOR)



3. Датчик Pan-Ceph Sensor для системы системы MyRay Hyperion X9 (PAN - CEPH SENSOR)




4. Штатив телерадиографический с цефалостатом, правосторонний (RIGHT
TELERRADIOGRAPHY ARM)




5. Штатив телерадиографический с цефалостатом, левосторонний (LEFT TELERADIOGRAPHY ARM)



6. Упор для подбородка моторизованный для модернизации (MOTORIZED UPGRADE CHINREST)

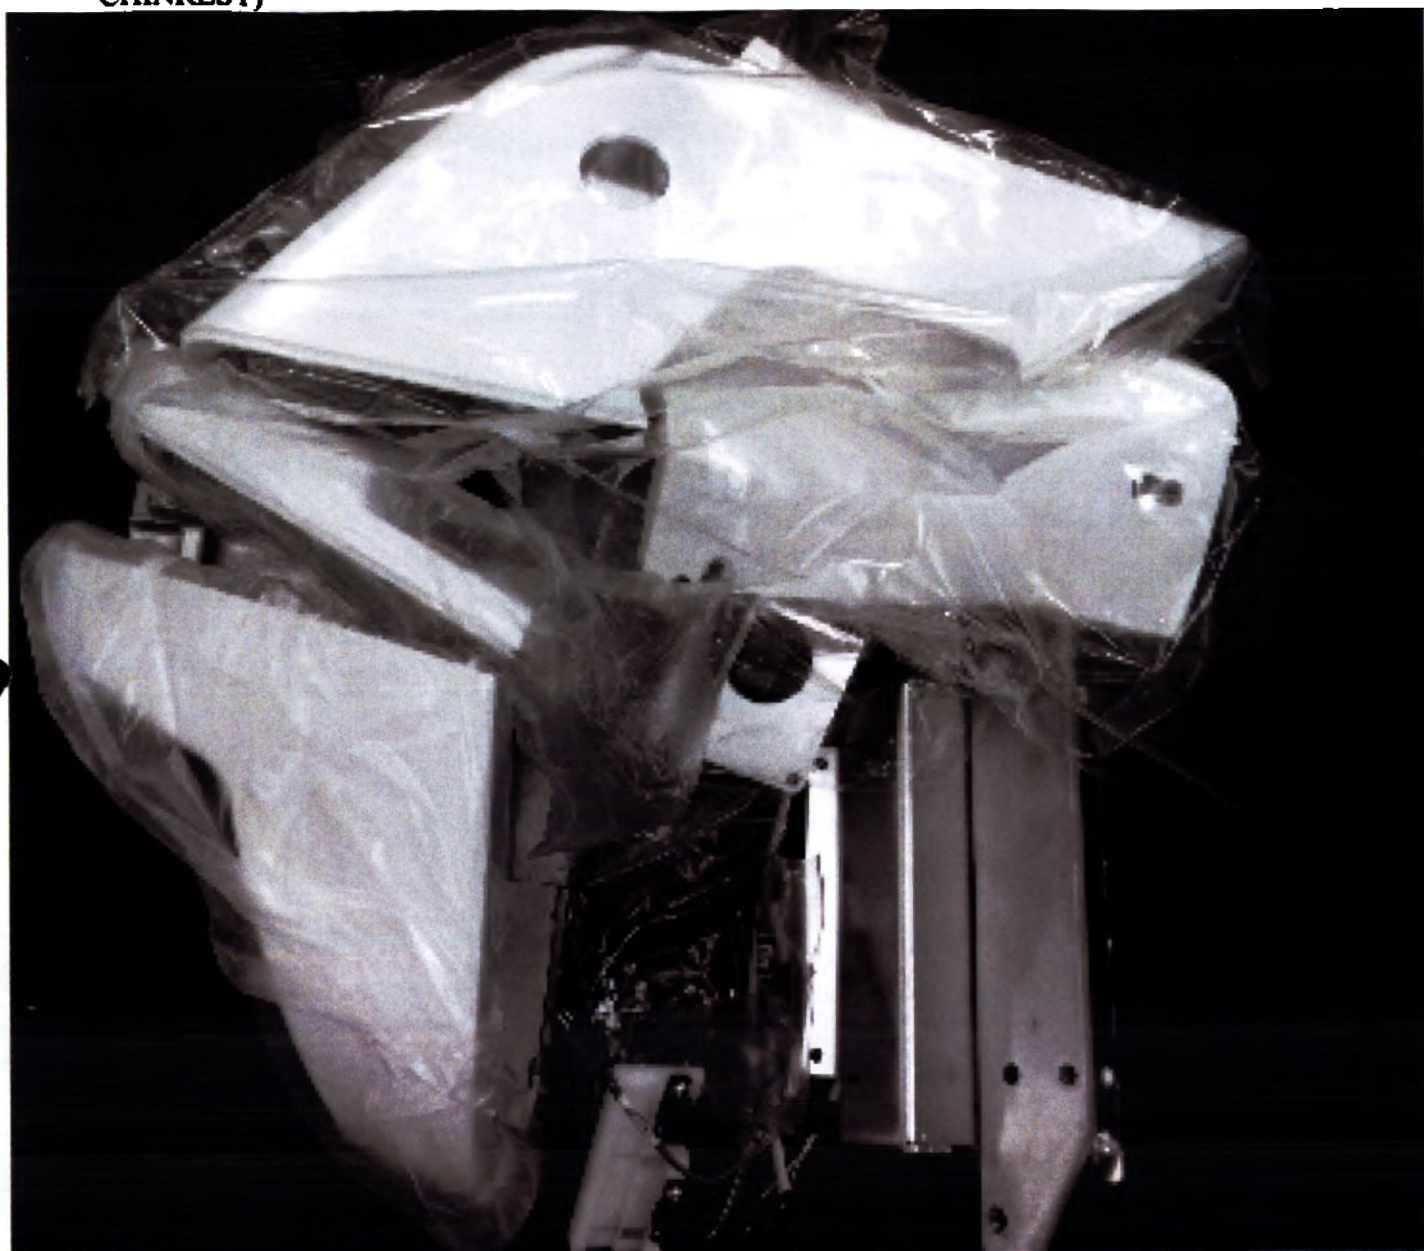

7. Основание напольное для базового блока, стандартное (STANDARD FREESTANDING BASE)

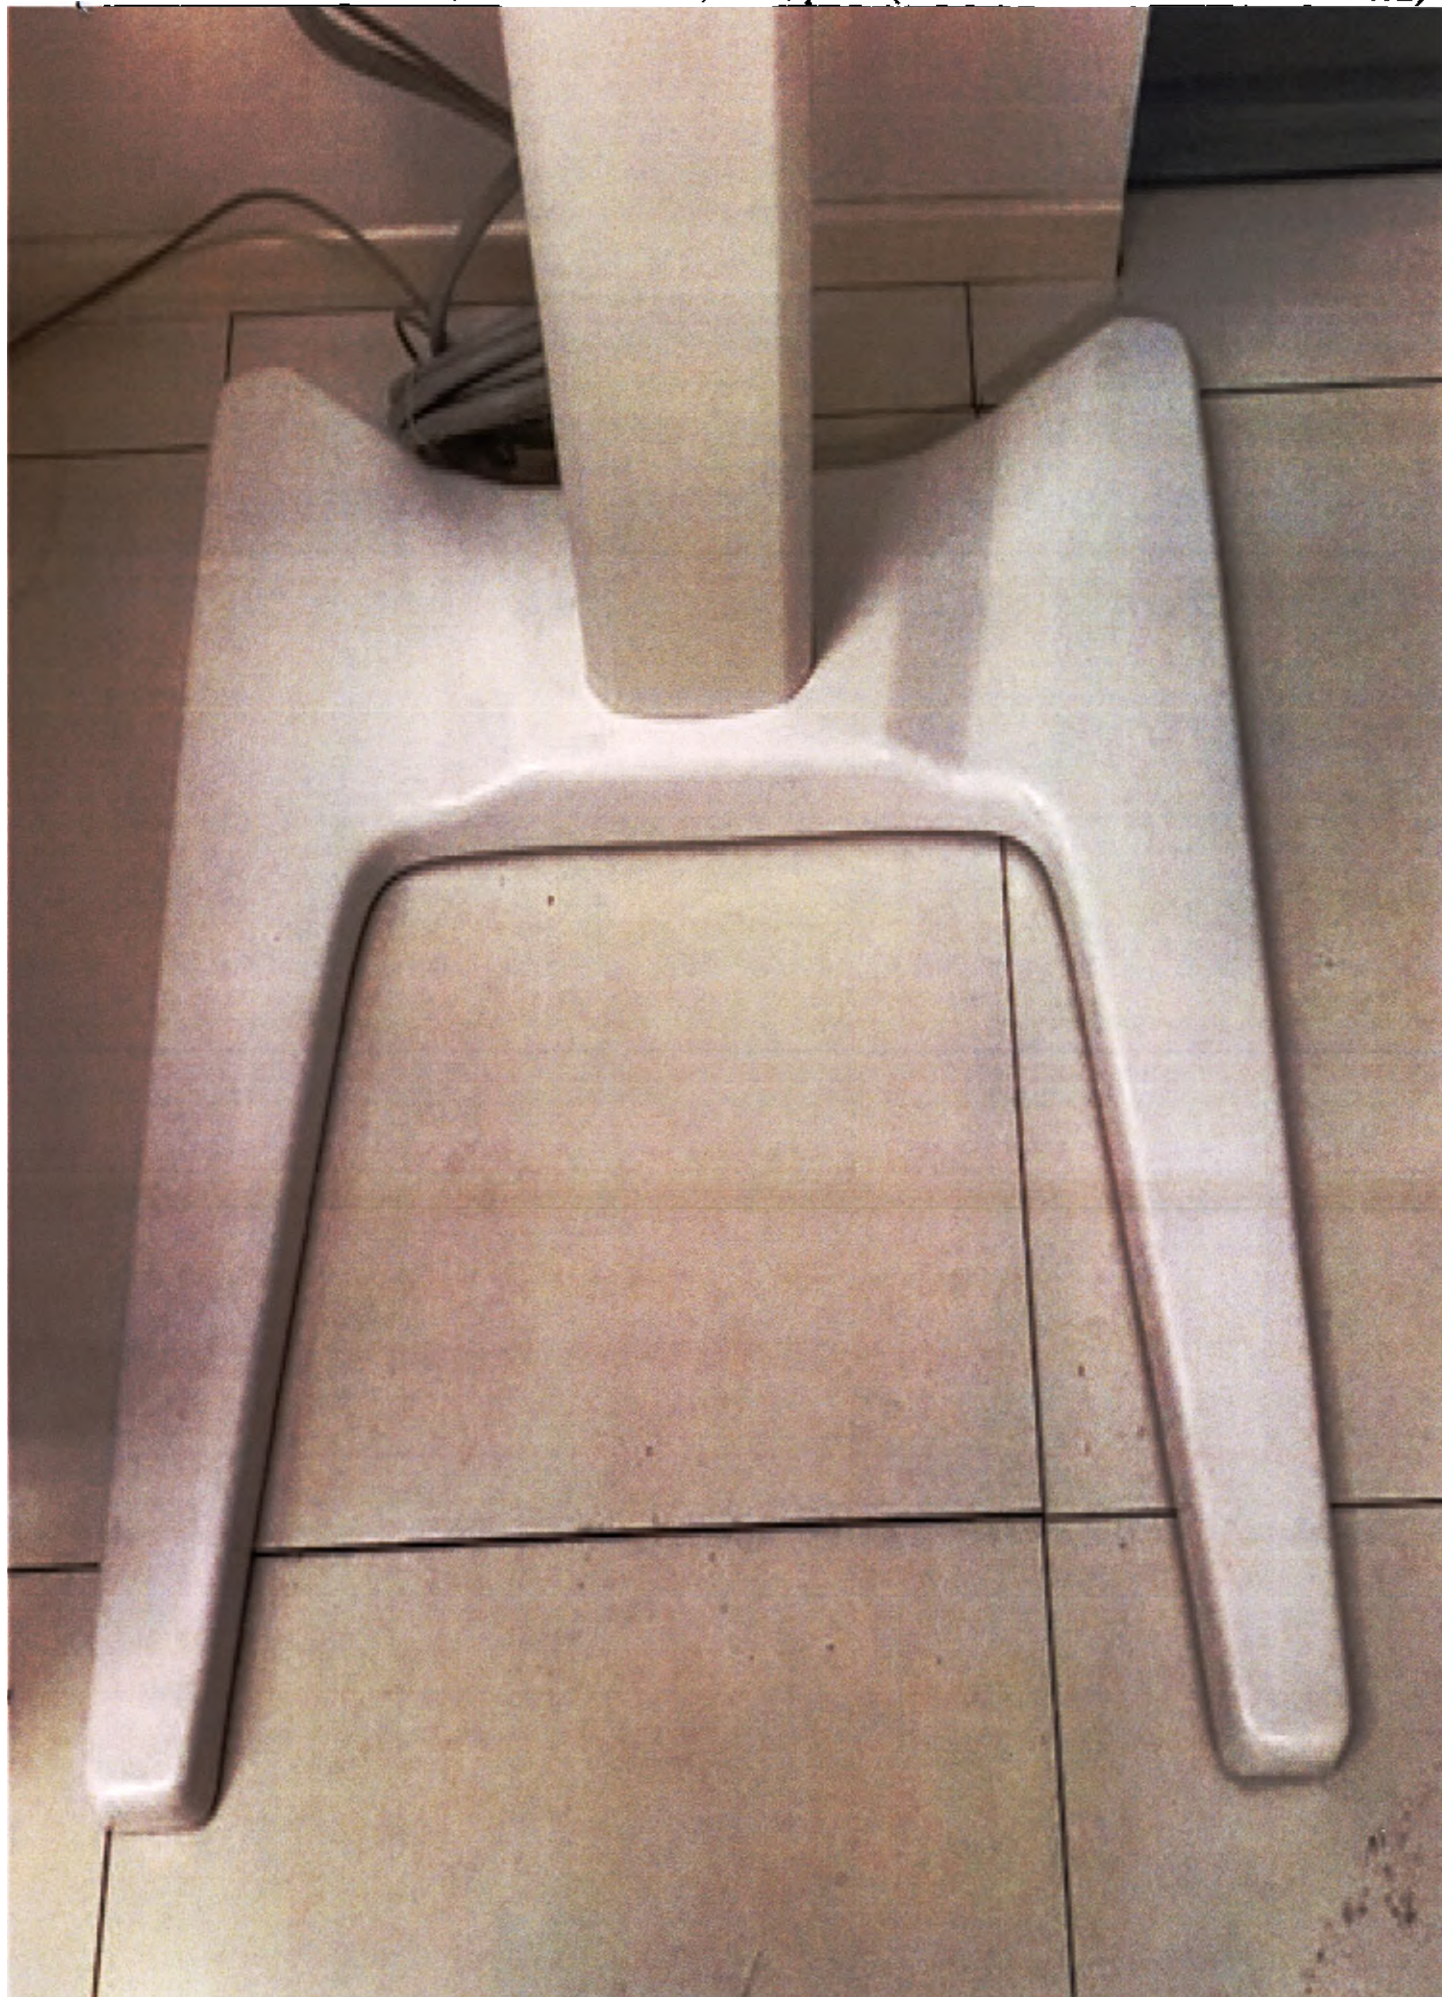


8. Основание напольное для базового блока, «EASY-ACCESS» (EASY-ACCESS
FREESTANDING BASE)



...лект пользовательской документации системы MyRay Hyperion X9
Носитель с Руководством пользователя в электронном виде;
Носитель с программным обеспечением iRYS и Лицензией пользов.

USB-Носитель с Руководством
пользователя в электронном виде

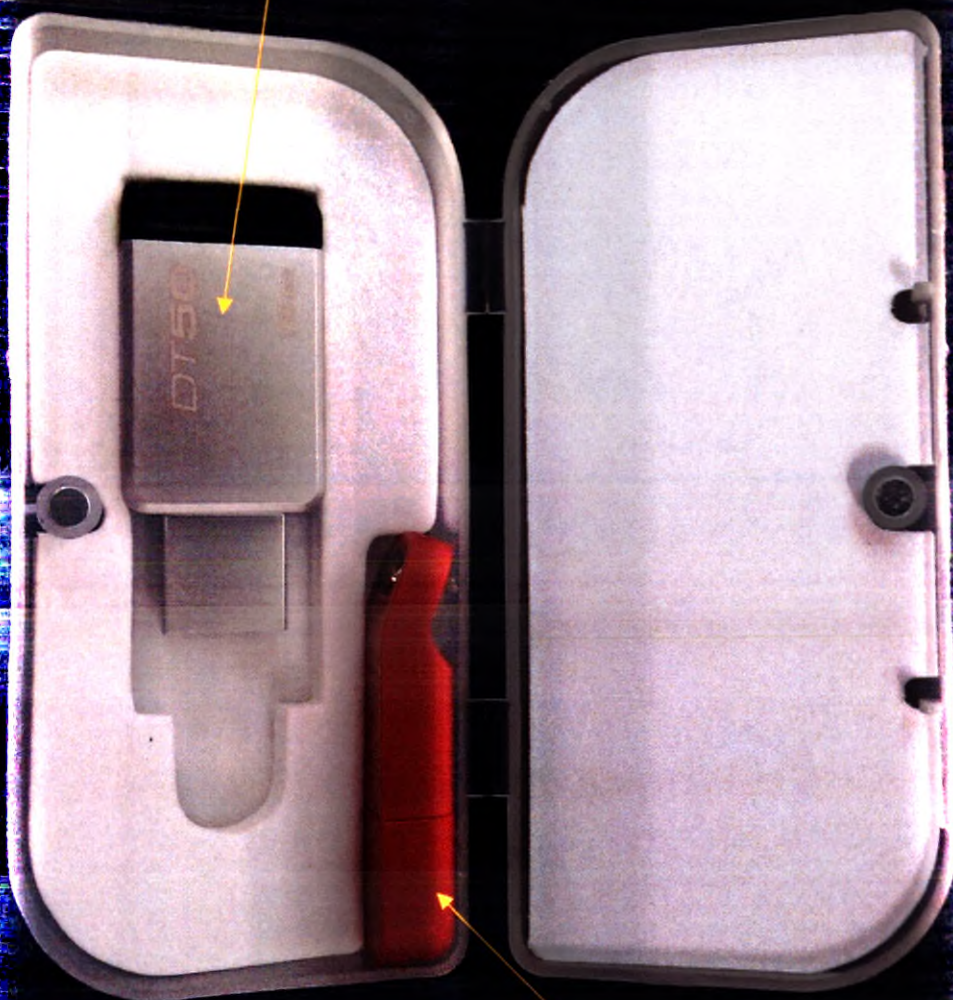


USB-Носитель с программным
обеспечением iRYS и Лицензией
пользователя.

10. Рабочая станция для обработки 2D изображений (WORKSTATION 2D ENG)



11. Рабочая станция для обработки 3D изображений (WORKSTATION 3D ENG)

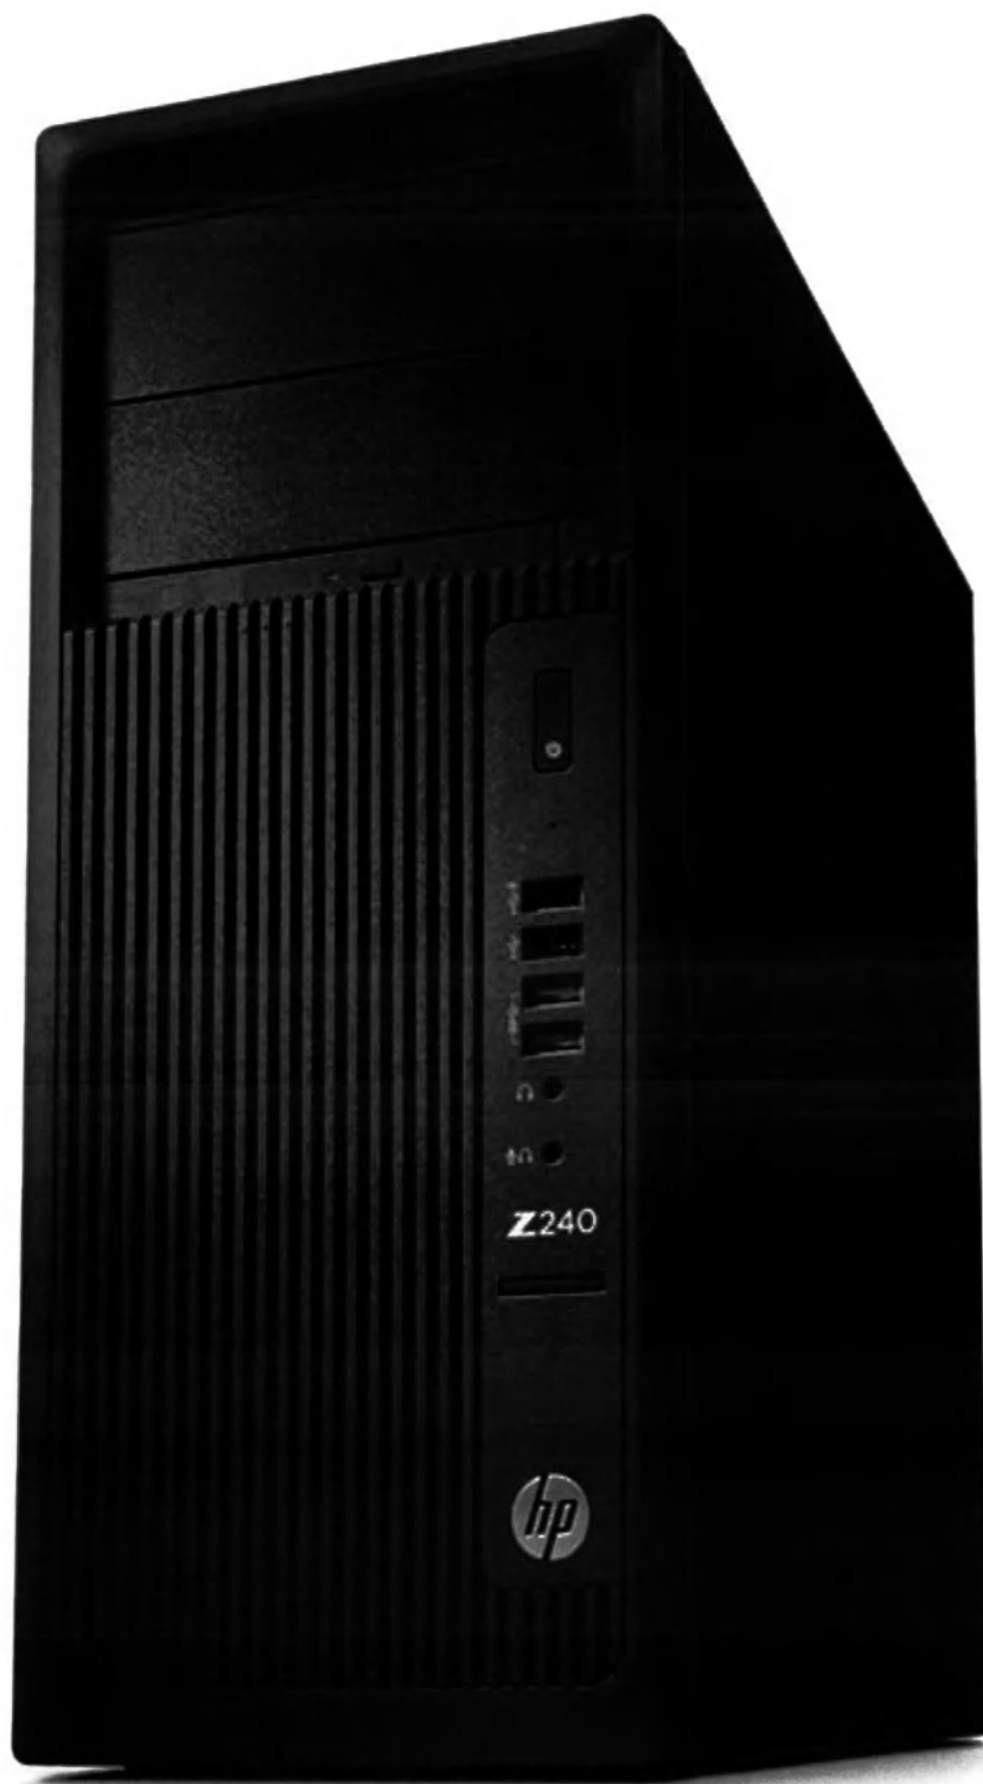


12. Выносная кнопка экспозиции (REMOTE X-RAY BUTTON)



13. Кнопка аварийной остановки (EMERGENCY BUTTON).



14. Крепление угловое 45° для монтажа системы (45° ANGULAR BRACKET)

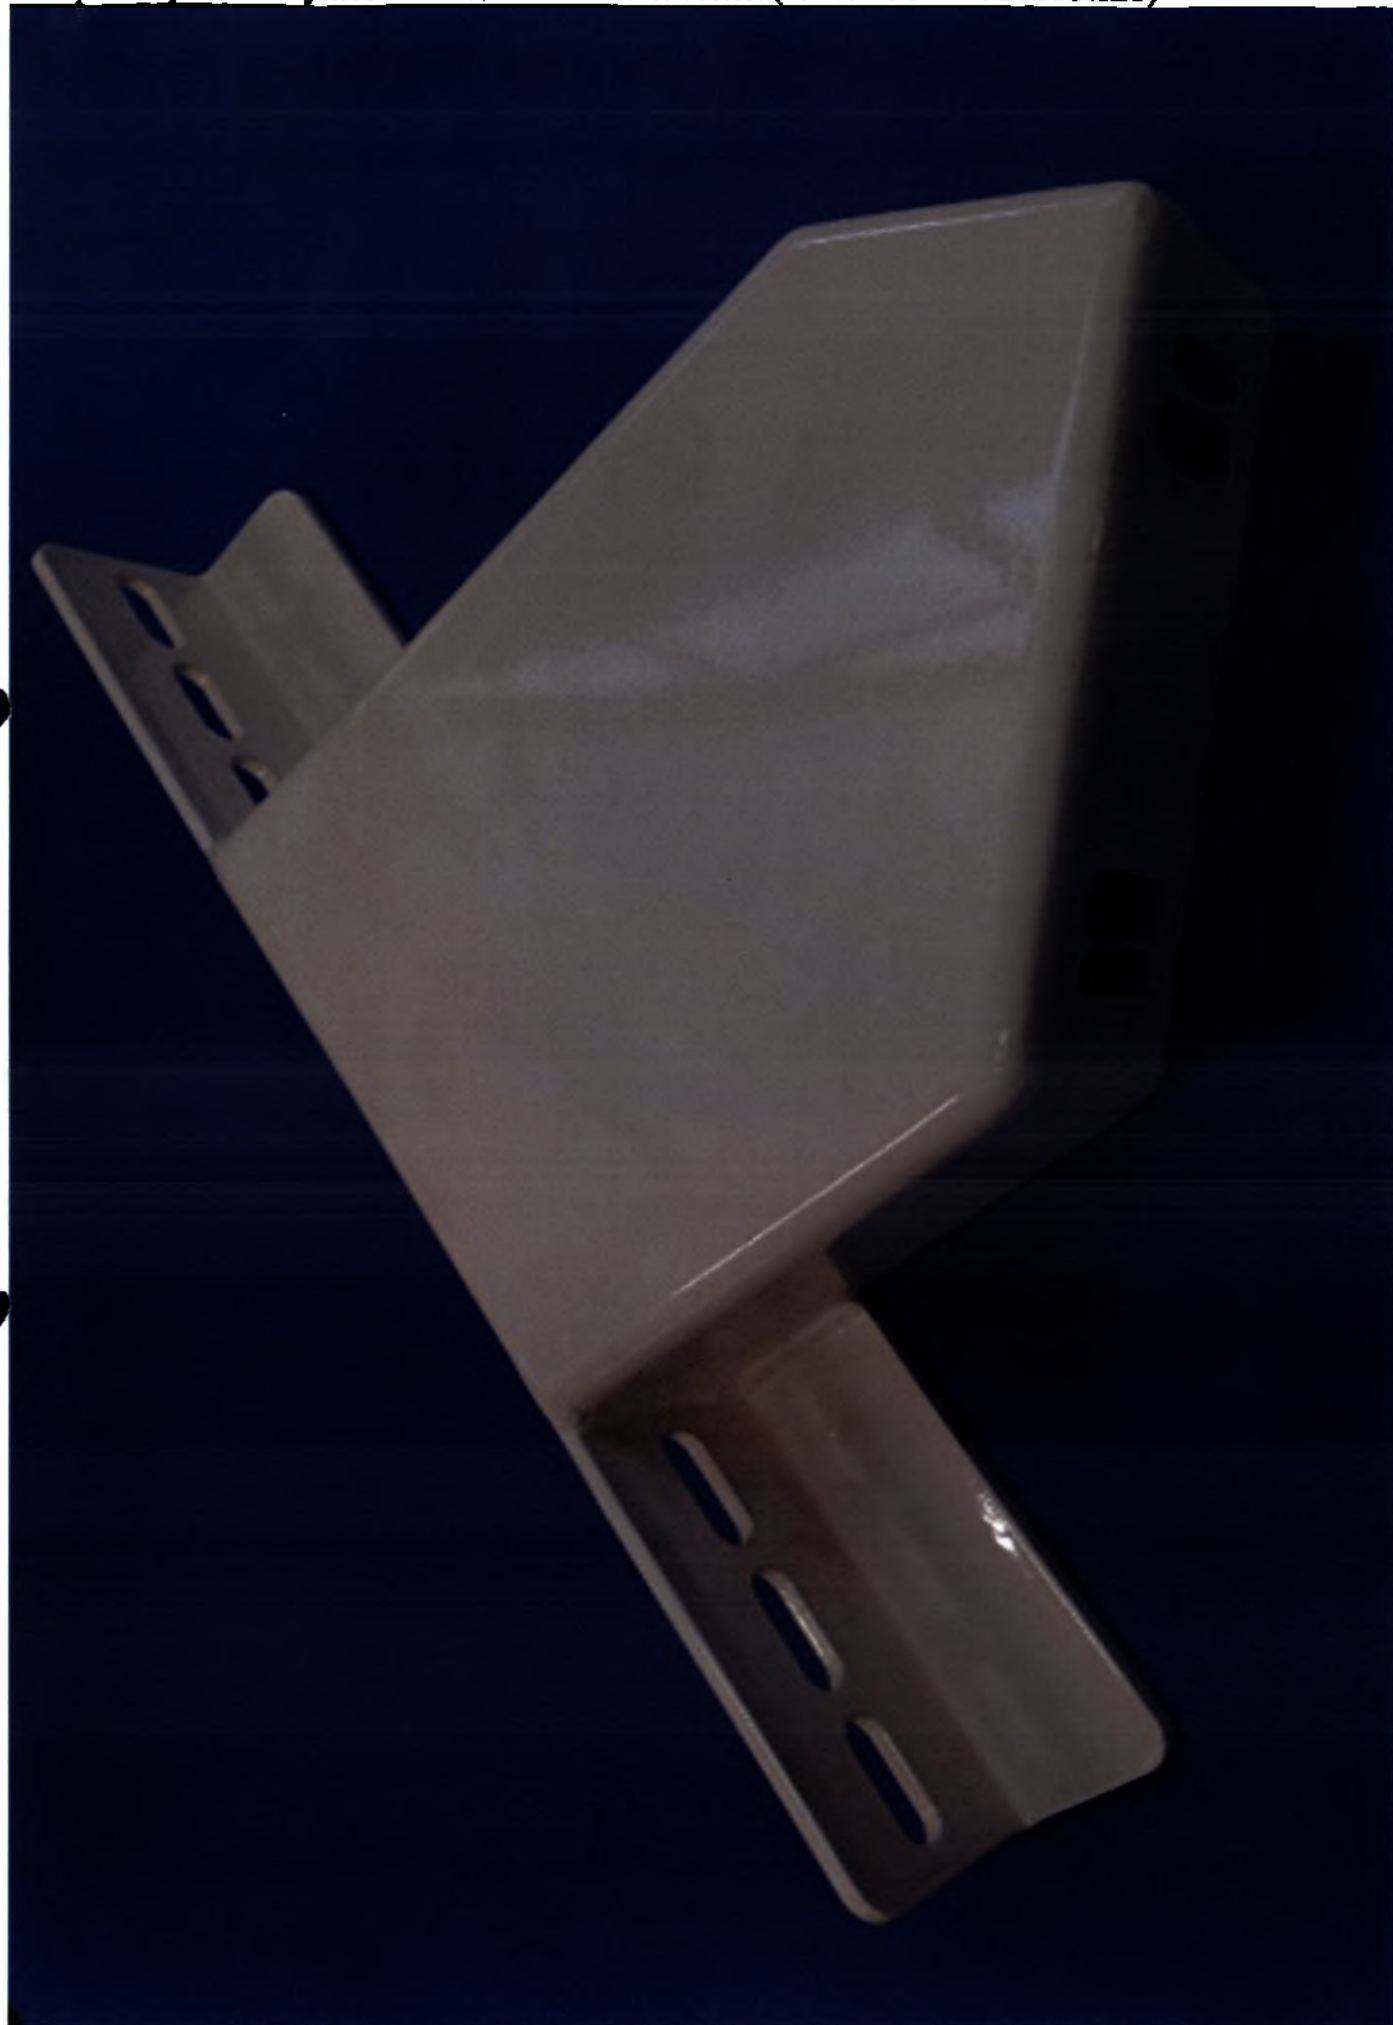

15. Крепление дополнительное для монтажа системы (ADDITIONAL BRACKET)



16. Крепление для монтажа системы 16" (BRACKET FOR SINGLE STUD-16")



17. Пластина для поддержки запястья (X-RAY WRIST SUPPORT)



Пластина для поддержки запястья
(X-RAY WRIST SUPPORT)

18. Кожух цефалостата внешний, в сборе, белого цвета (POCKET-NO CONS.PAN WHITE VERS)



19. Кожух цефалостата внешний, в сборе, сиреневого цвета (POCKET-NO CONS.PAN GLICINE VERS.)



20. Комплект внешних кожных цефалостата, в сборе, белого цвета (POCKET-NO
CONS.PAN/СЕРН WHITE VERS)



21. Комплект внешних кожухов цефалостата, сиреневого цвета (POCKET-NO CONS.PAN/СЕРН
GLICINE VERS.)



22. Упор для подбородка фиксированный (FIXED CHINREST)




Упор для подбородка,
установленный на краниостат

23. Упор для подбородка моторизованный, в сборе (MOBILE CHINREST).



24. Подставка для сканирования протезов (3D SCAN SUPPORT)

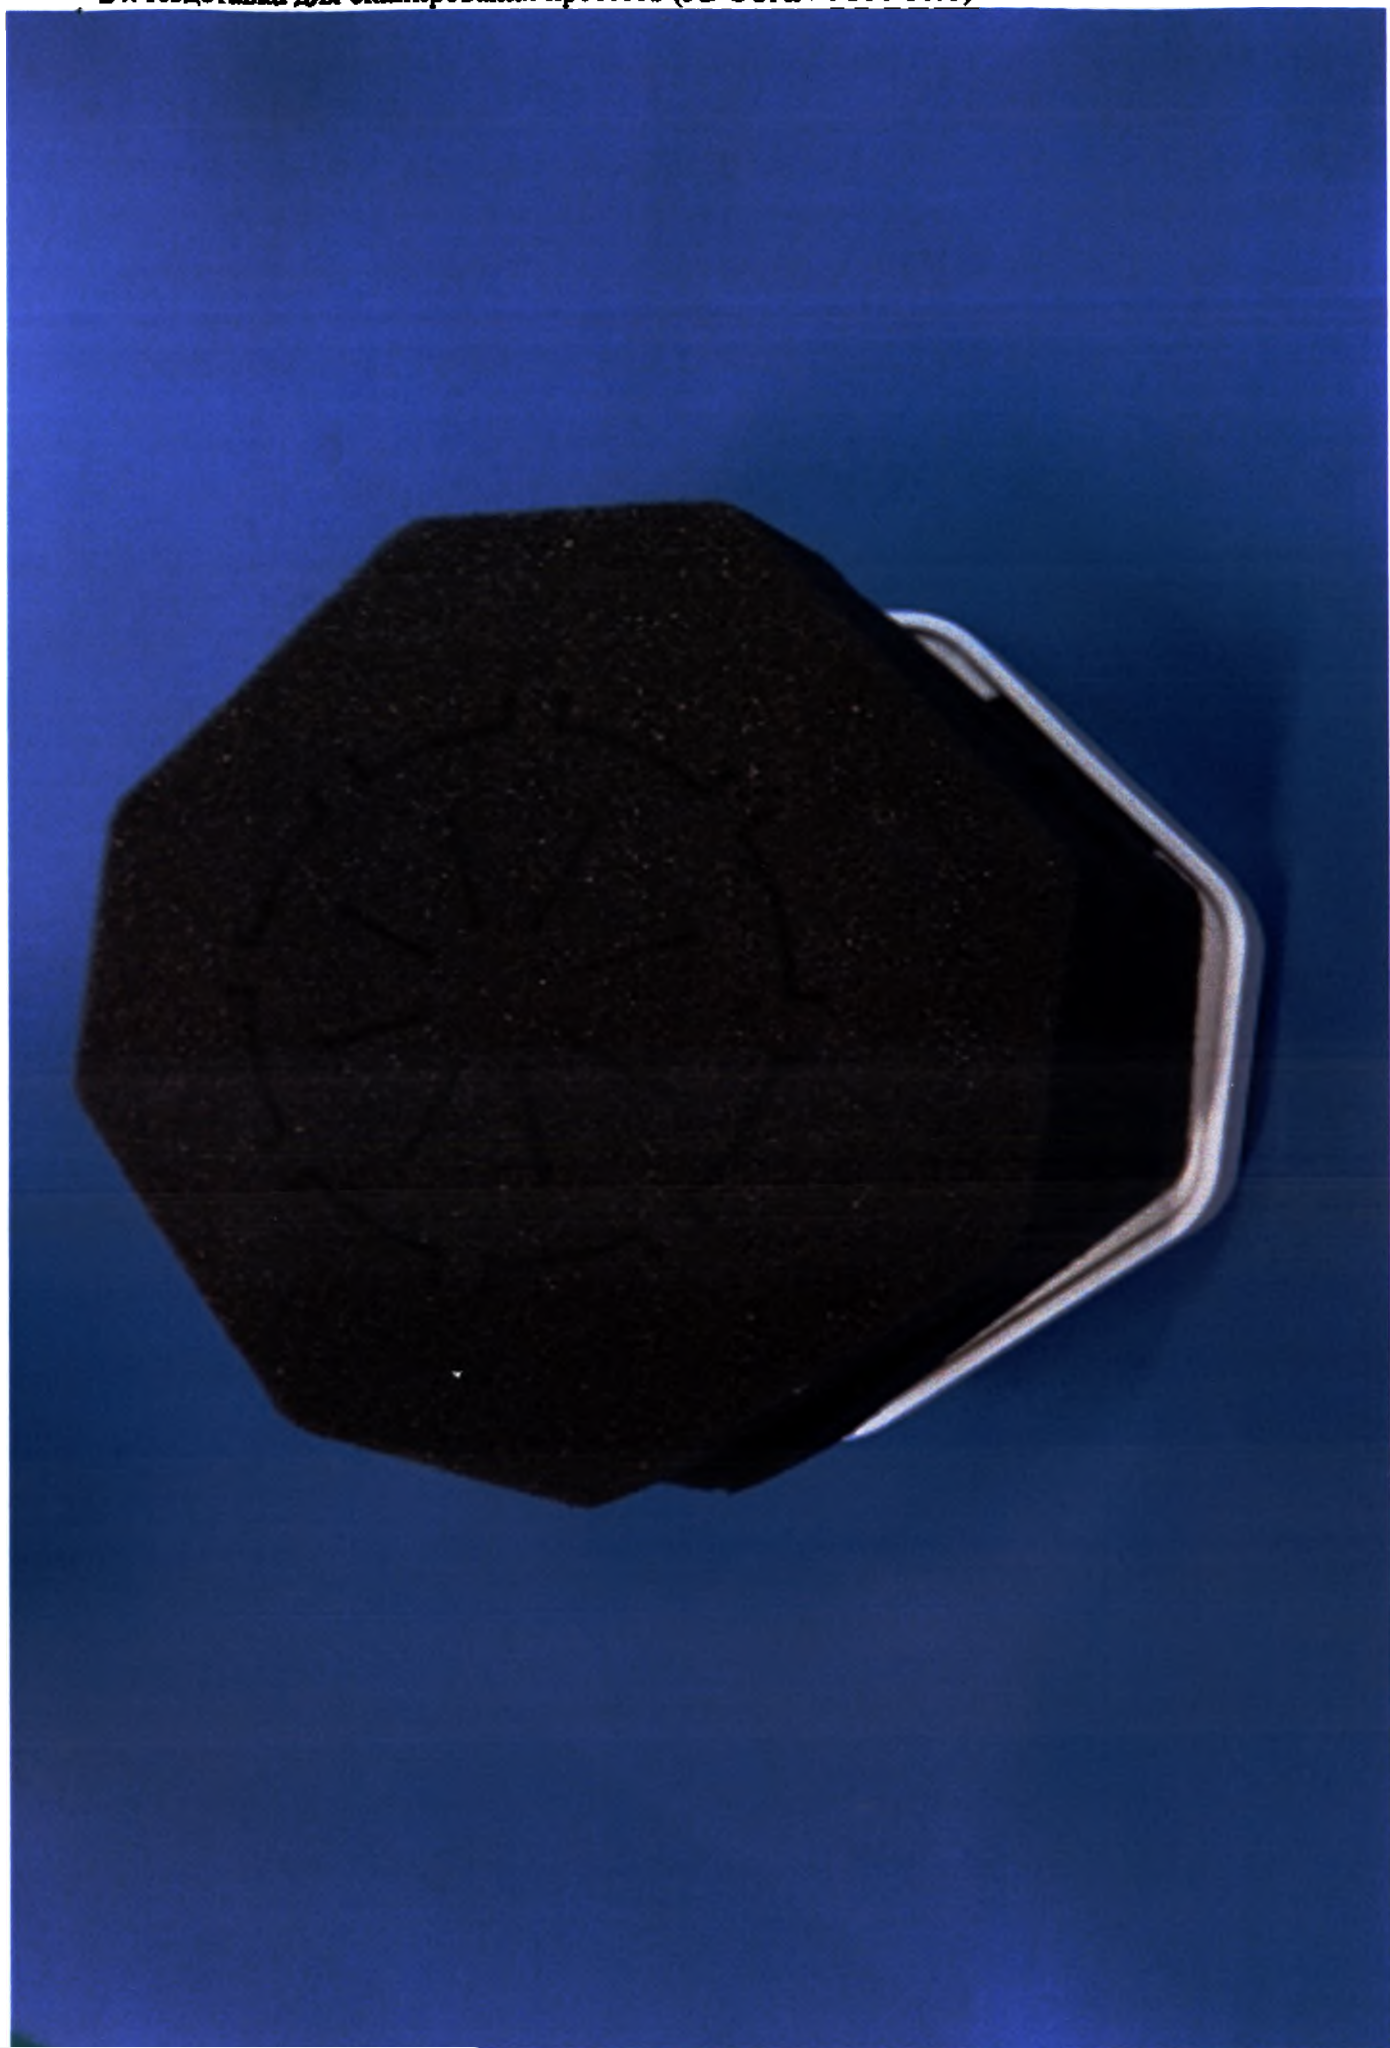

25. Кабель соединительный, 5 м.



26. Вилки прикусные, 3 шт.



27. Упор для носа






Элементы позиционера

29. Фантом СВЗД для контроля качества (CB3D QUALITY CONTROL)



• 30. Фантом для контроля качества панорамных снимков (PANORAMIC QUALITY CONTROL)

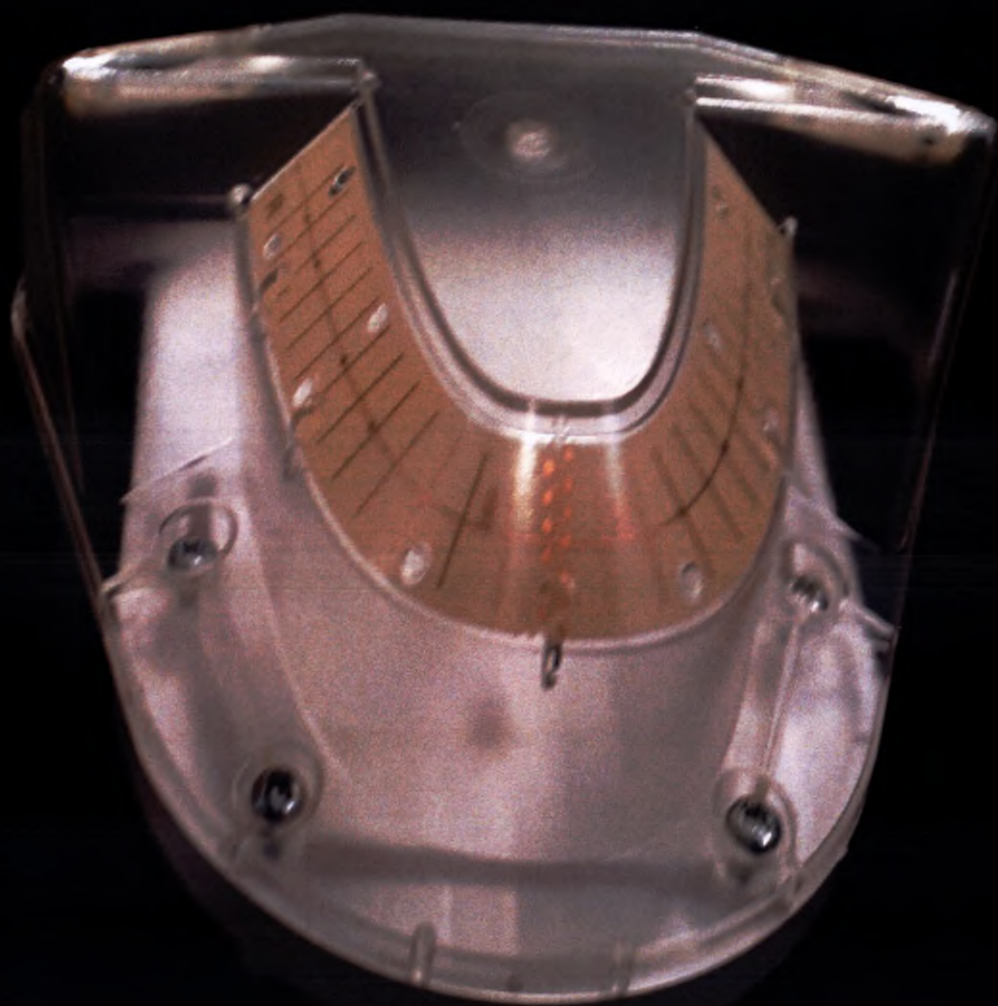


31. Стул для пациента (MYRAY PATIENT SEAT)




32. Монитор FUJITSU, стандартный, размер экрана 22 дюйма (LCD 22" STANDARD MONITOR)



33. Монитор BARCO, размер экрана 22 дюйма (LCD 22" BARCO MONITOR)

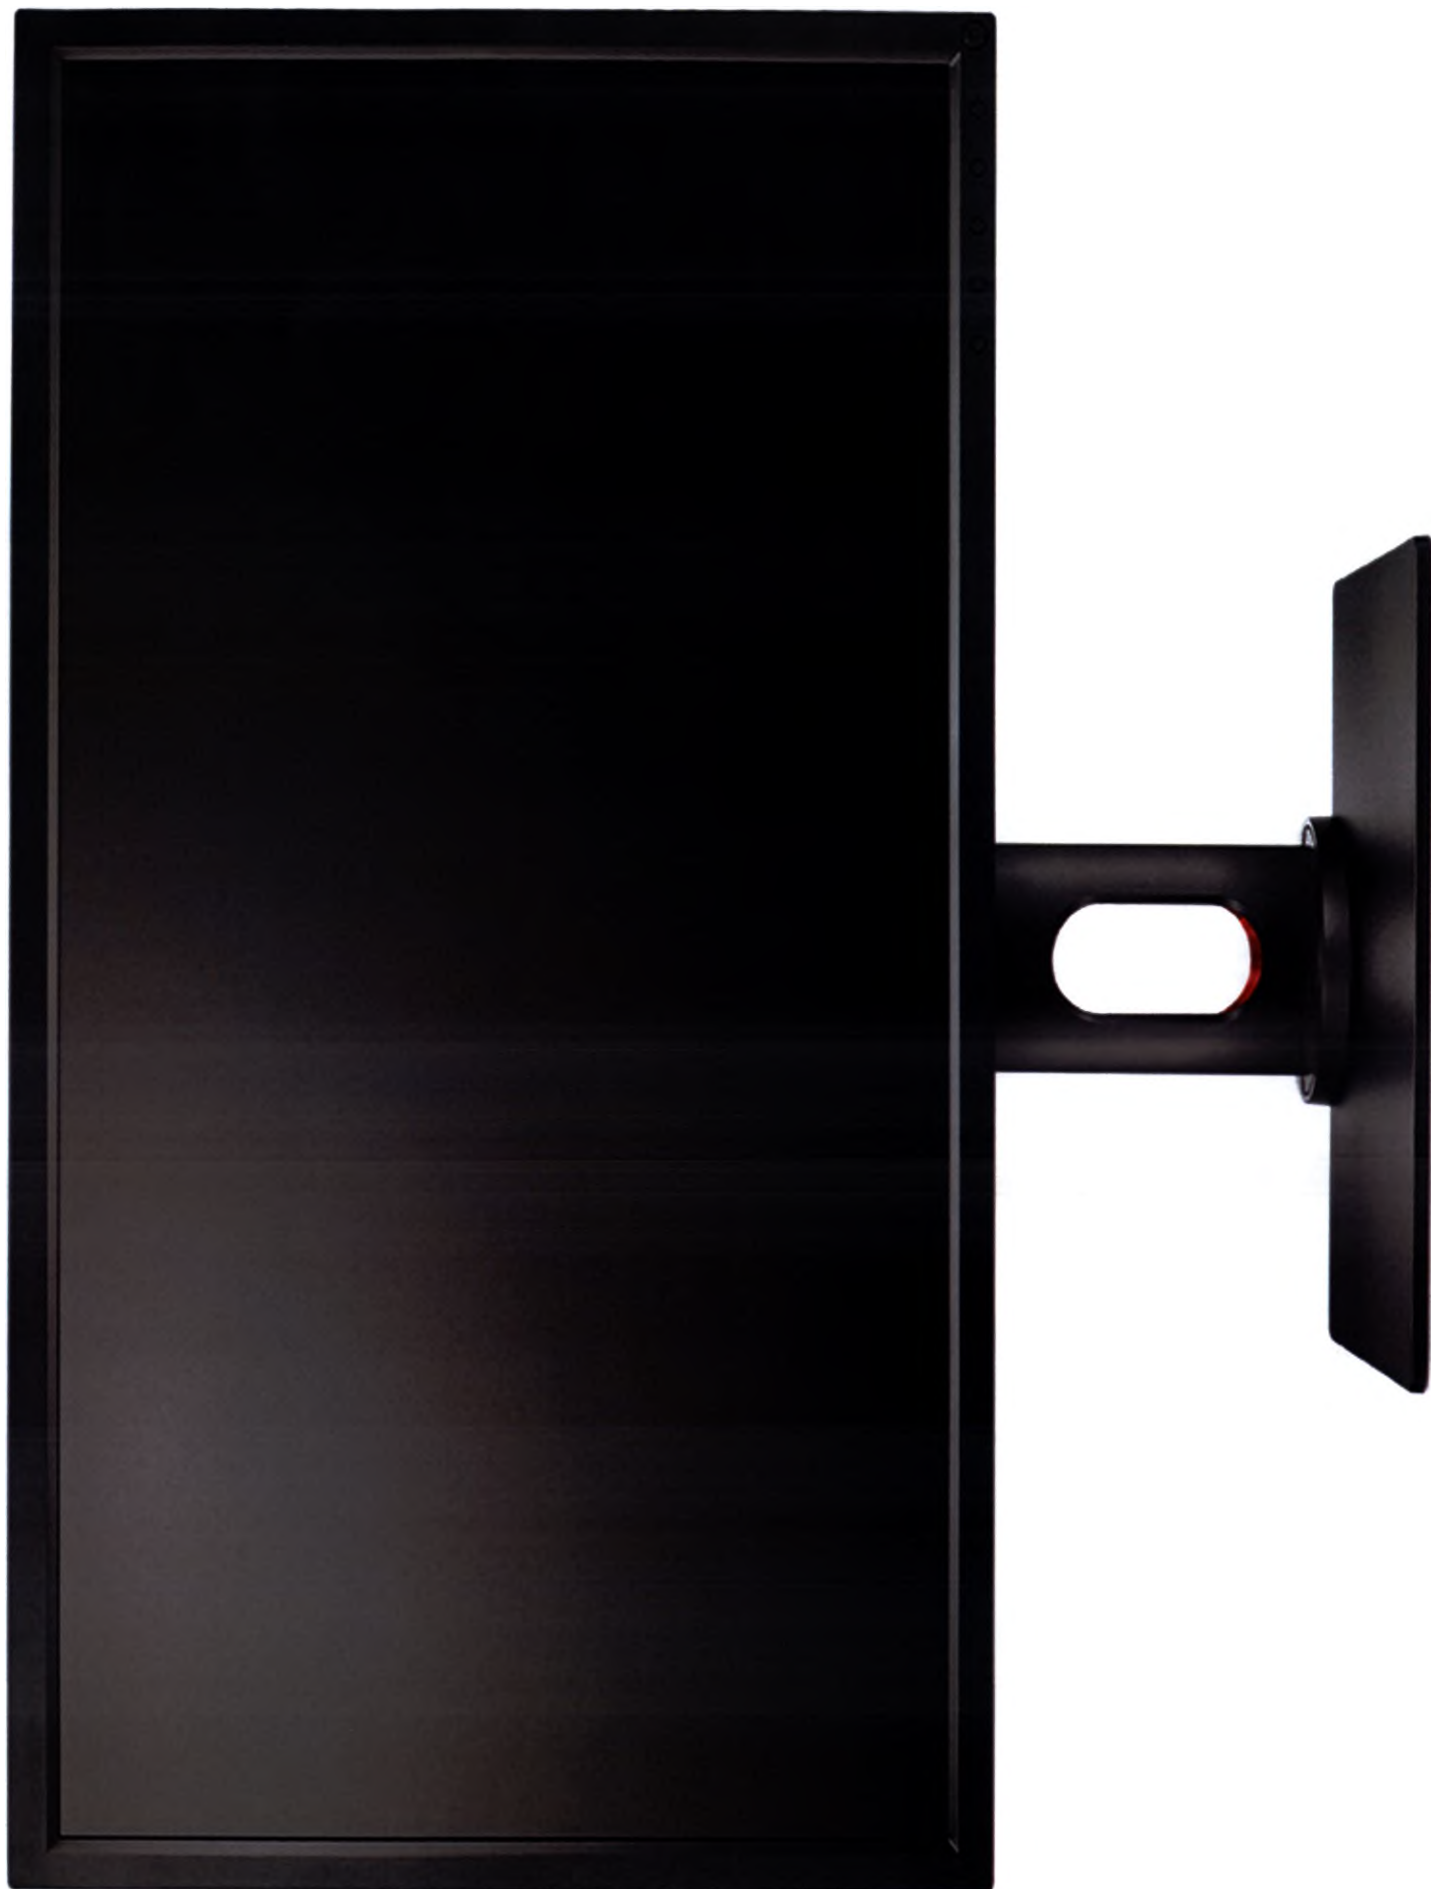

34. Монитор BARCO, размер экрана 24 дюйма (LCD 24" BARCO MONITOR)

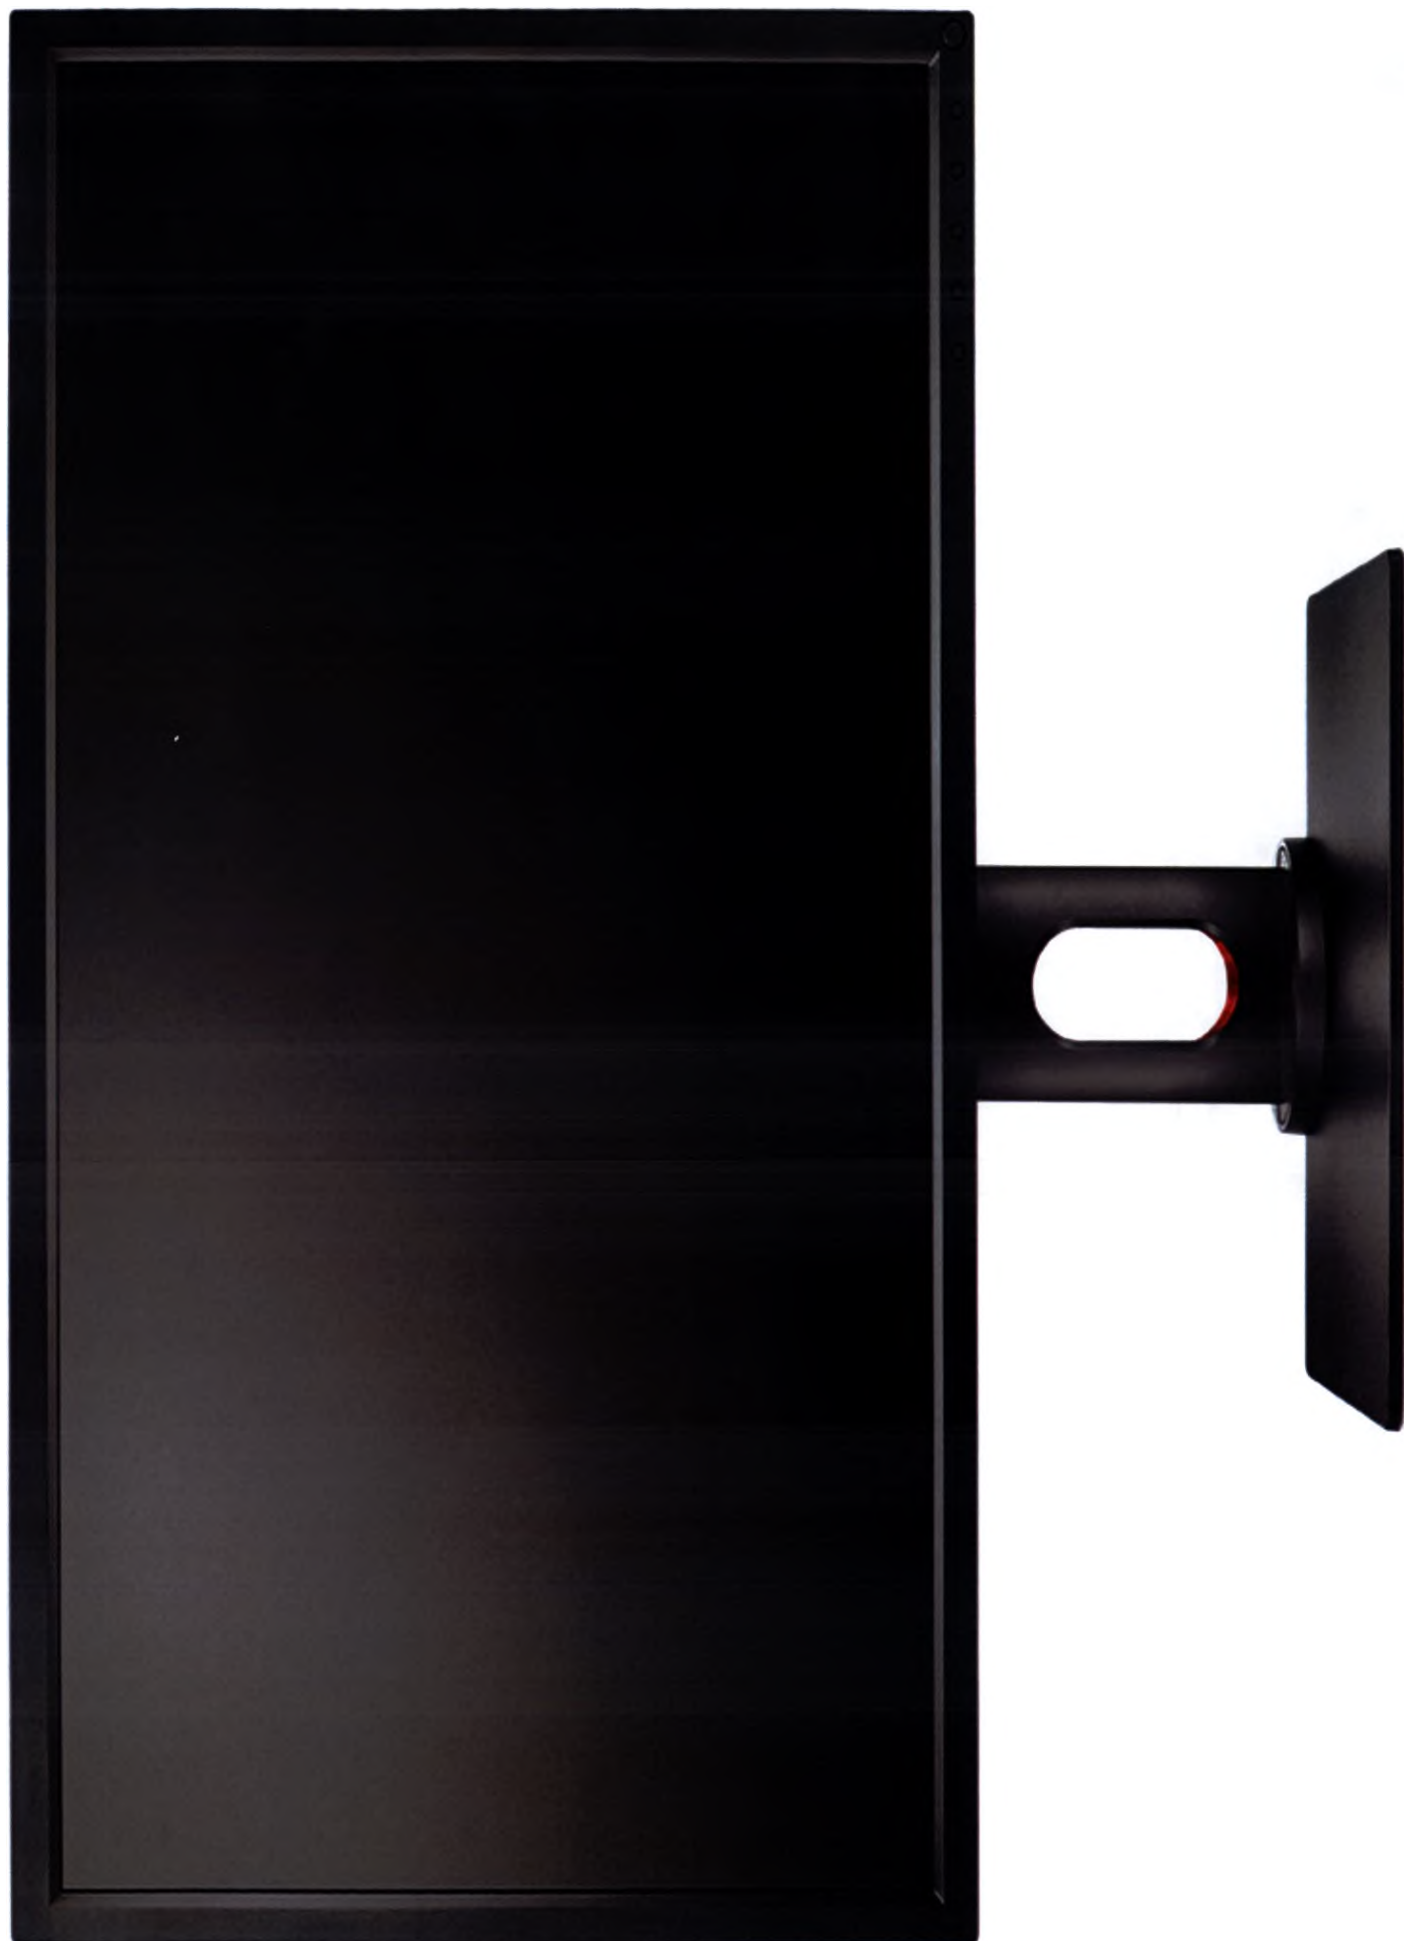

35. Фантом TIN (CB3D CALIBRATION)



• **Принадлежности**

1. USB-Носитель с Лицензией на одного пользователя (USB DONGLE ADDIT. SINGLE USER)
(при необходимости).




Следующие позиции выглядят одинаково:

2. USB-Носитель с Лицензией на 5 пользователей (MULTI USER DONGLE 5 USER) (при необходимости).
3. USB-Носитель с Лицензией на 10 пользователей (MULTI USER DONGLE 10 USER) (при необходимости).
4. USB-Носитель с Лицензией на двадцать 25 пользователей (MULTI USER DONGLE 25 USER) (при необходимости).
5. USB-Носитель с Лицензией на 50 пользователей (MULTI USER DONGLE 50 USER) (при необходимости).
6. USB-Носитель с Лицензией на 250 пользователей (MULTI USER DONGLE 250 USER) (при необходимости).




7. Комплект для модернизации системы в составе (FULL T.CON.S. - PAN WHITE), (при необходимости):

- сенсорная панель;
- кожухи внешние белого цвета, 2 шт.

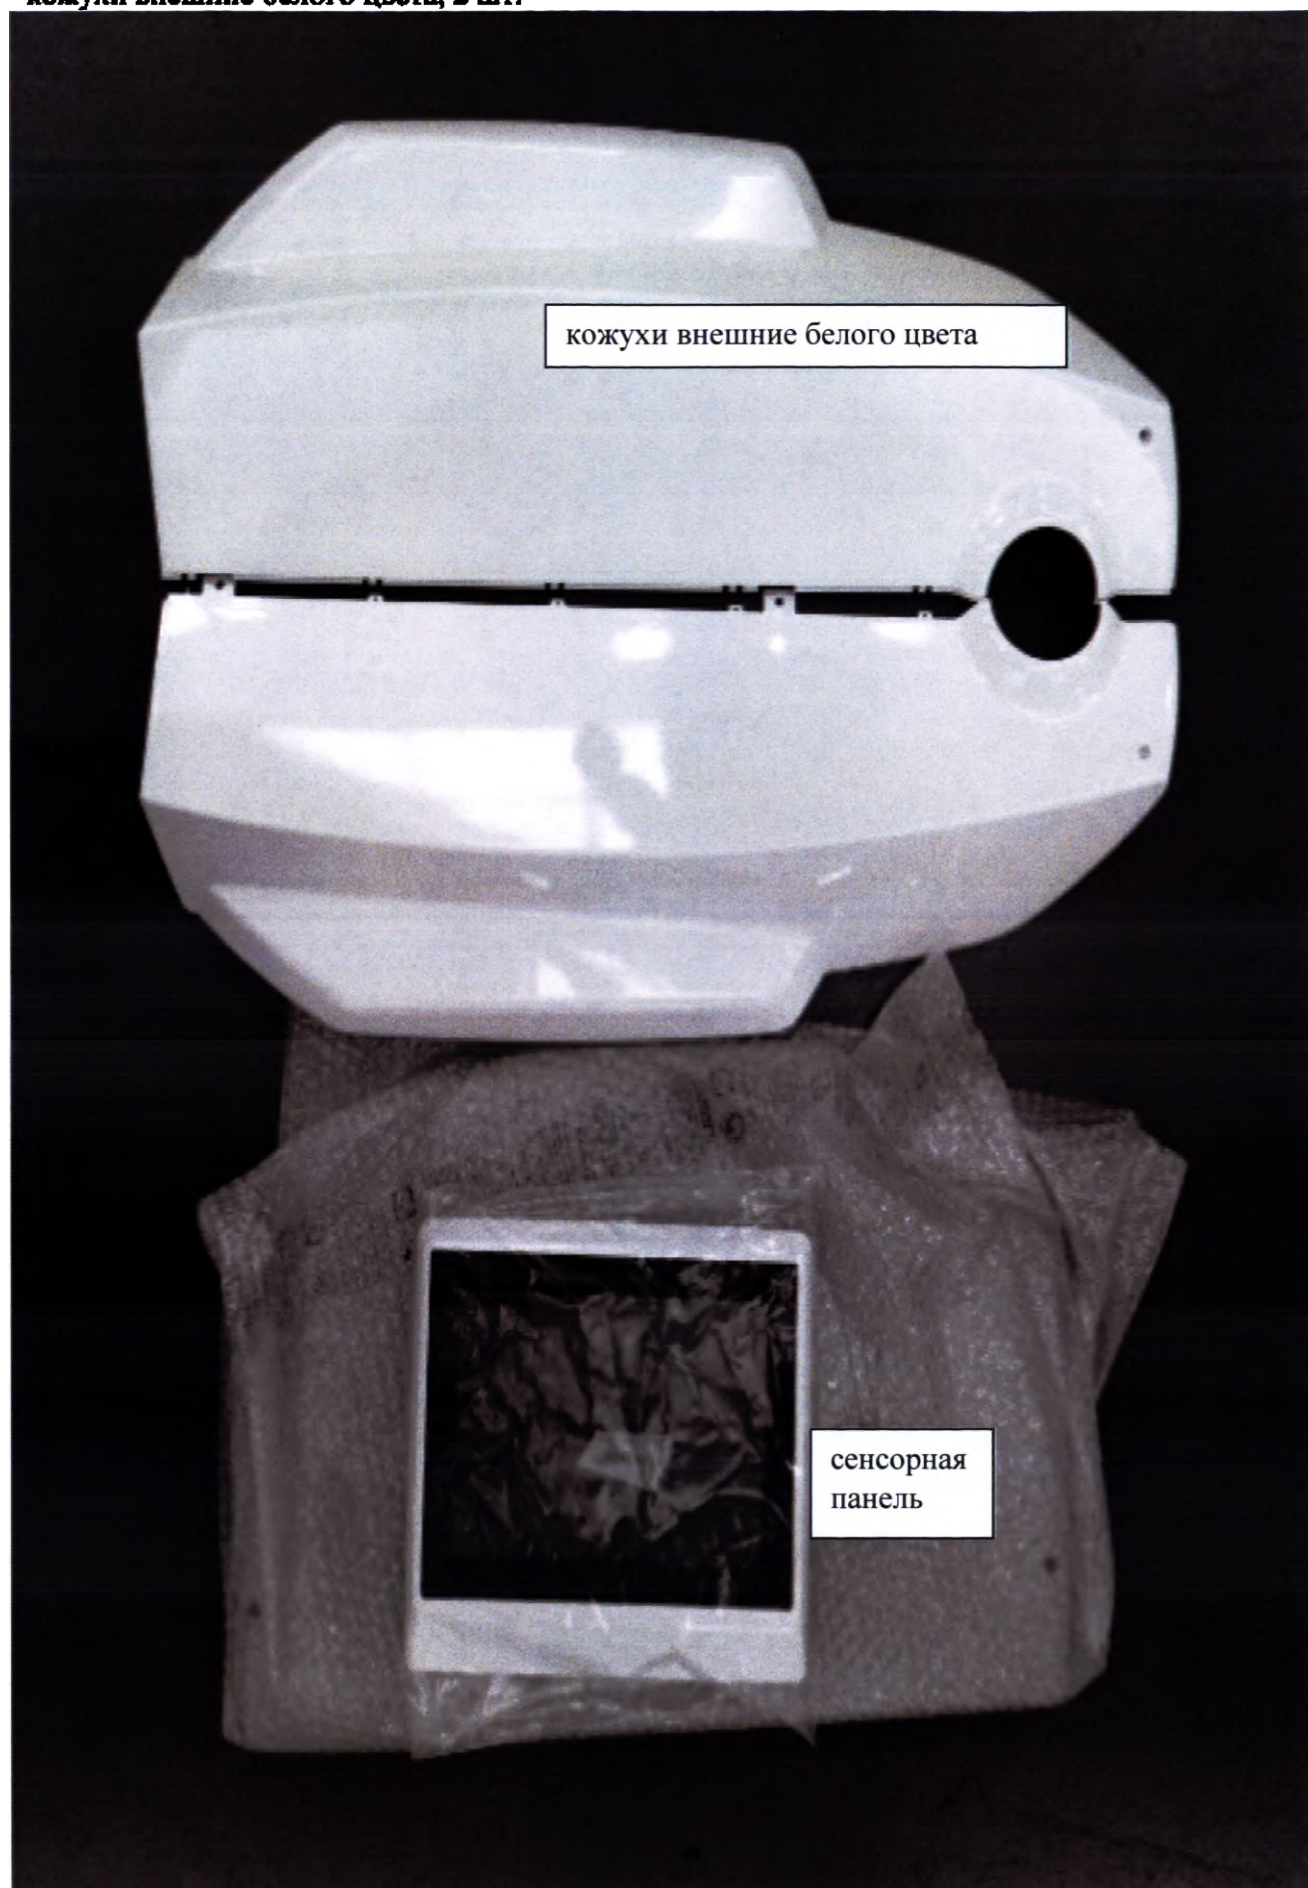


8. Набор для модернизации системы в составе (FULL T.CON.S. - PAN GLICINE), (при необходимости):

- сенсорная панель;
- кожухи внешние сиреневого цвета, 2 шт.

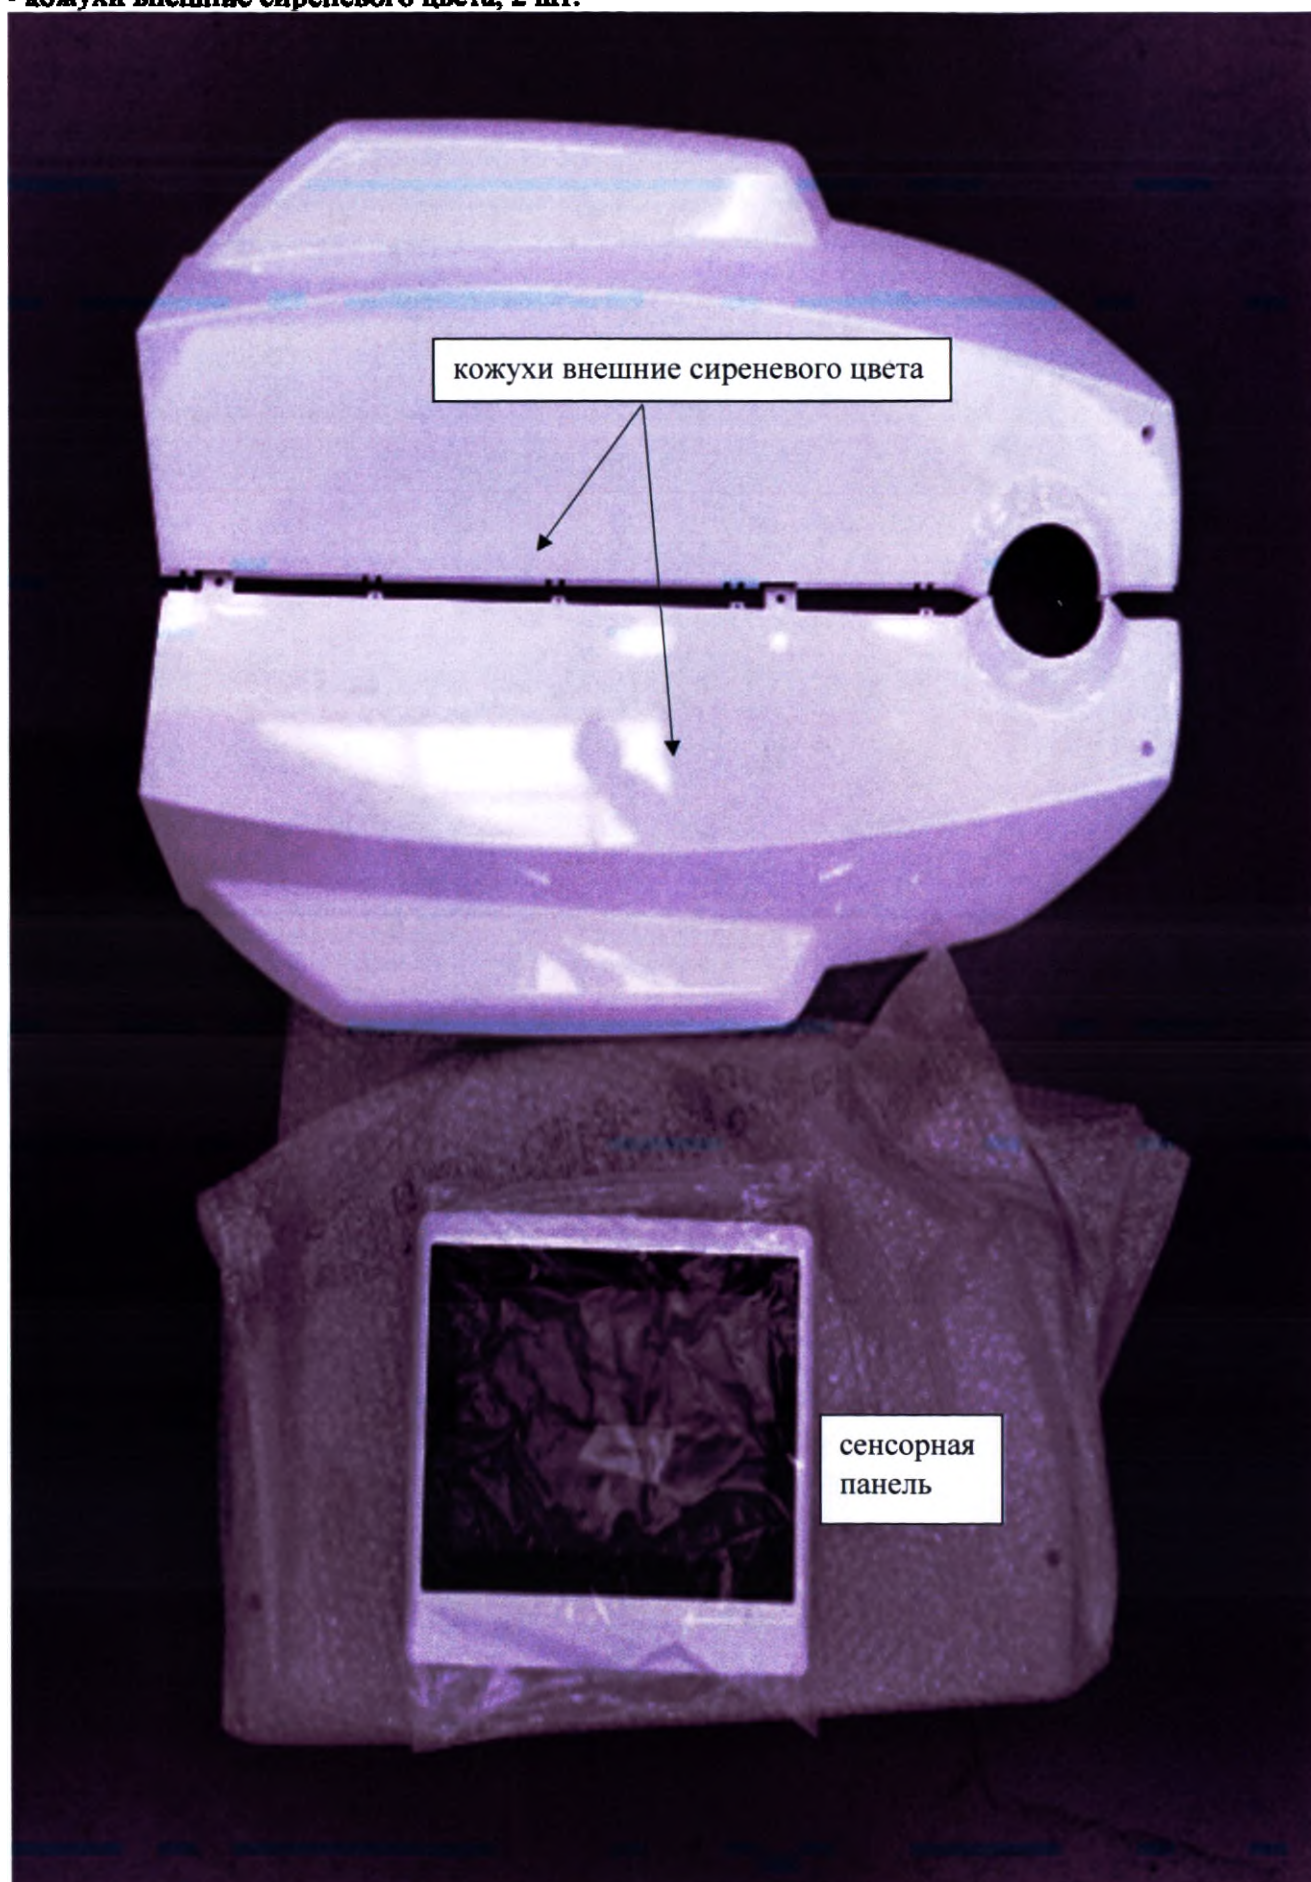

9. Комплект для модернизации системы в составе (FULL T.CON.S. - PAN/СЕРН WHITE), (при необходимости):

- сенсорная панель;
- кожухи внешние белого цвета, 2 шт.

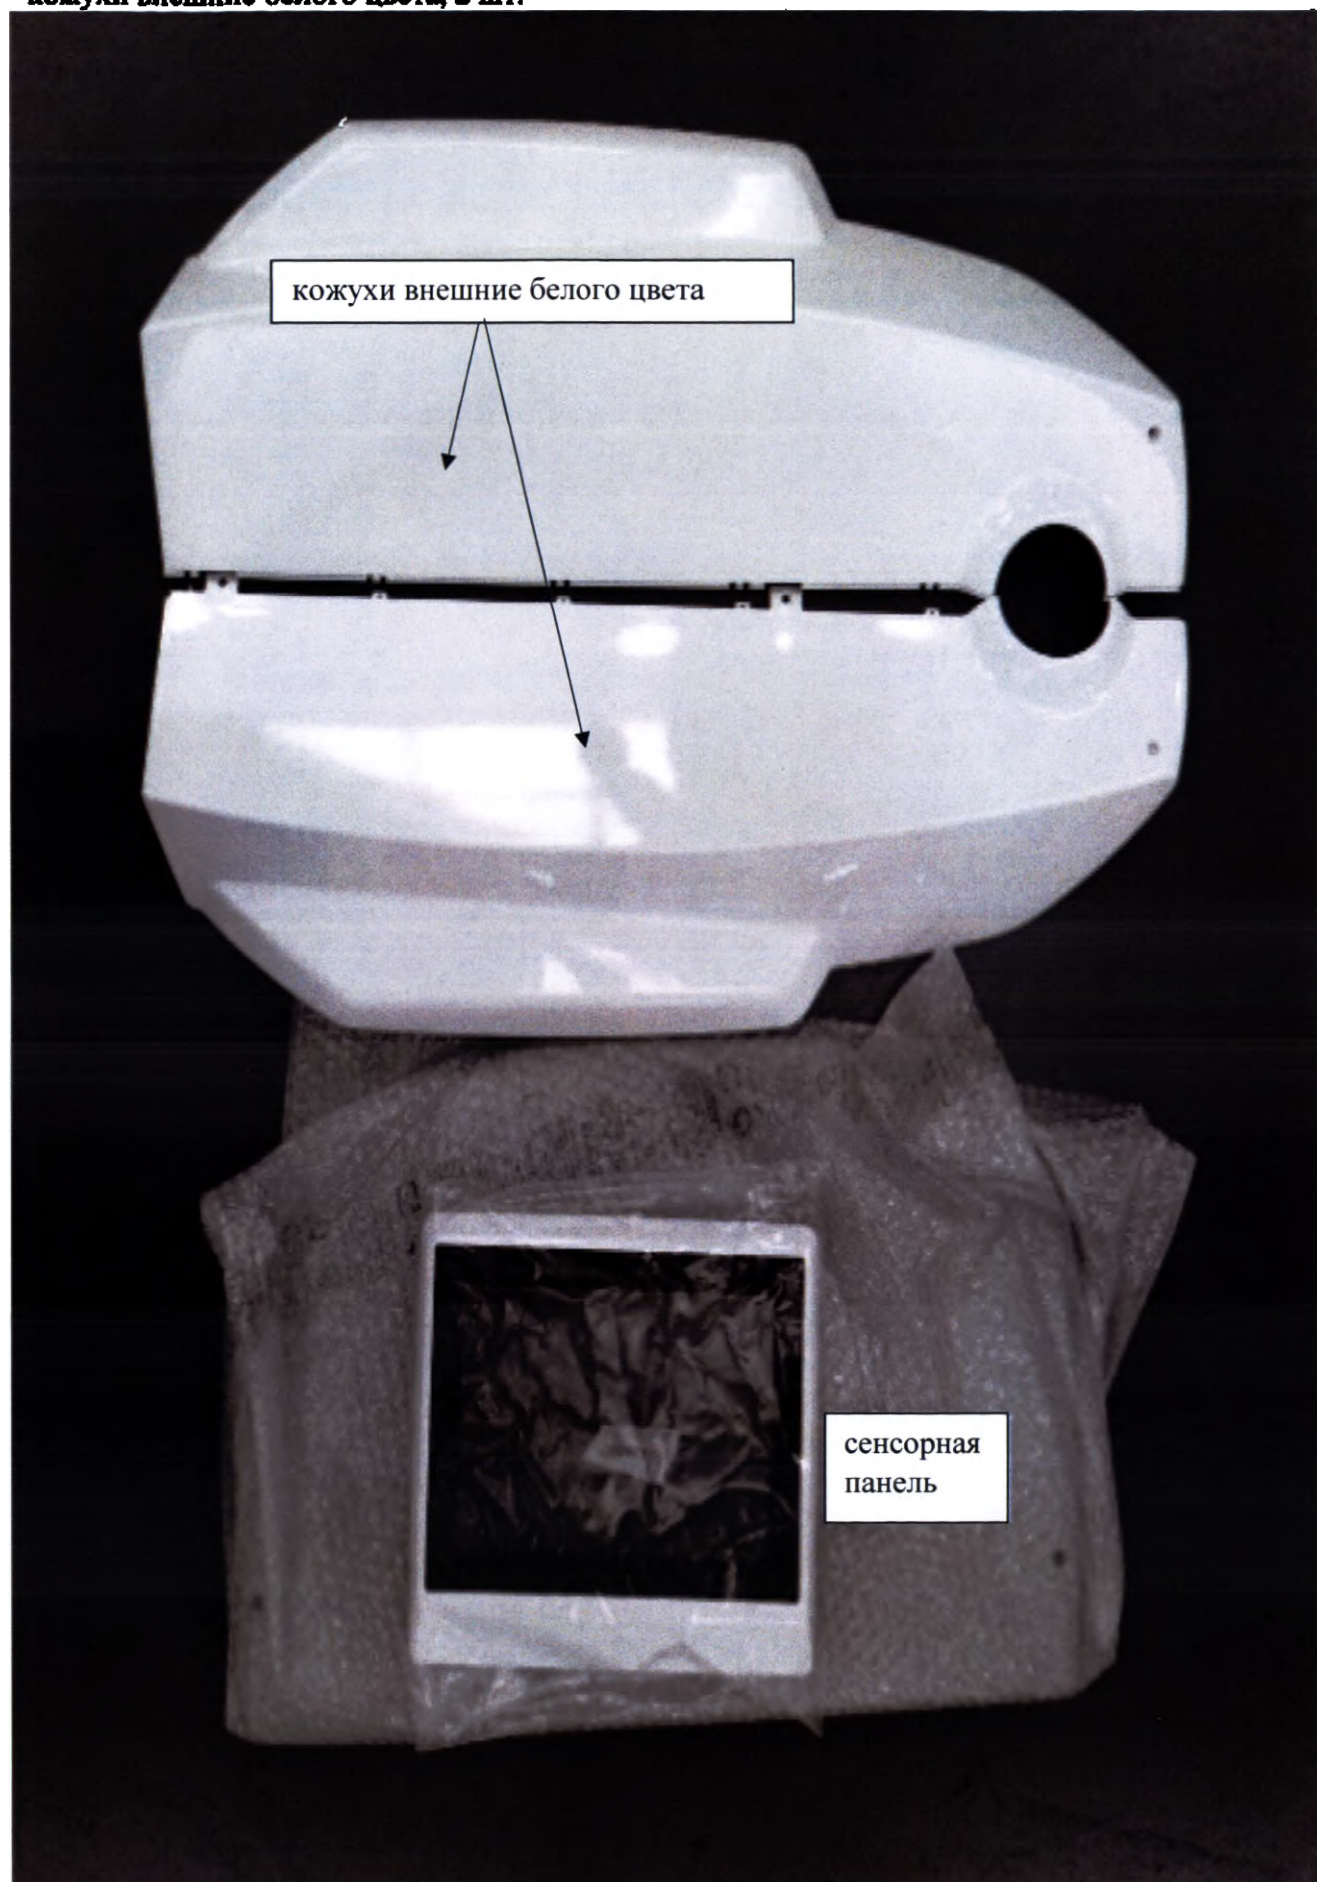

10. Набор для модернизации системы в составе (FULL T.CON.S. - PAN/СЕРН GLICINE), (при необходимости):


- сенсорная панель;

- кожухи внешние сиреневого цвета, 2 шт.




11. Комплект для модернизации цефалостата, белого цвета (WHITE CEPH UPGRADE KIT), (при необходимости):

- панель управления
- крышка цефалостата

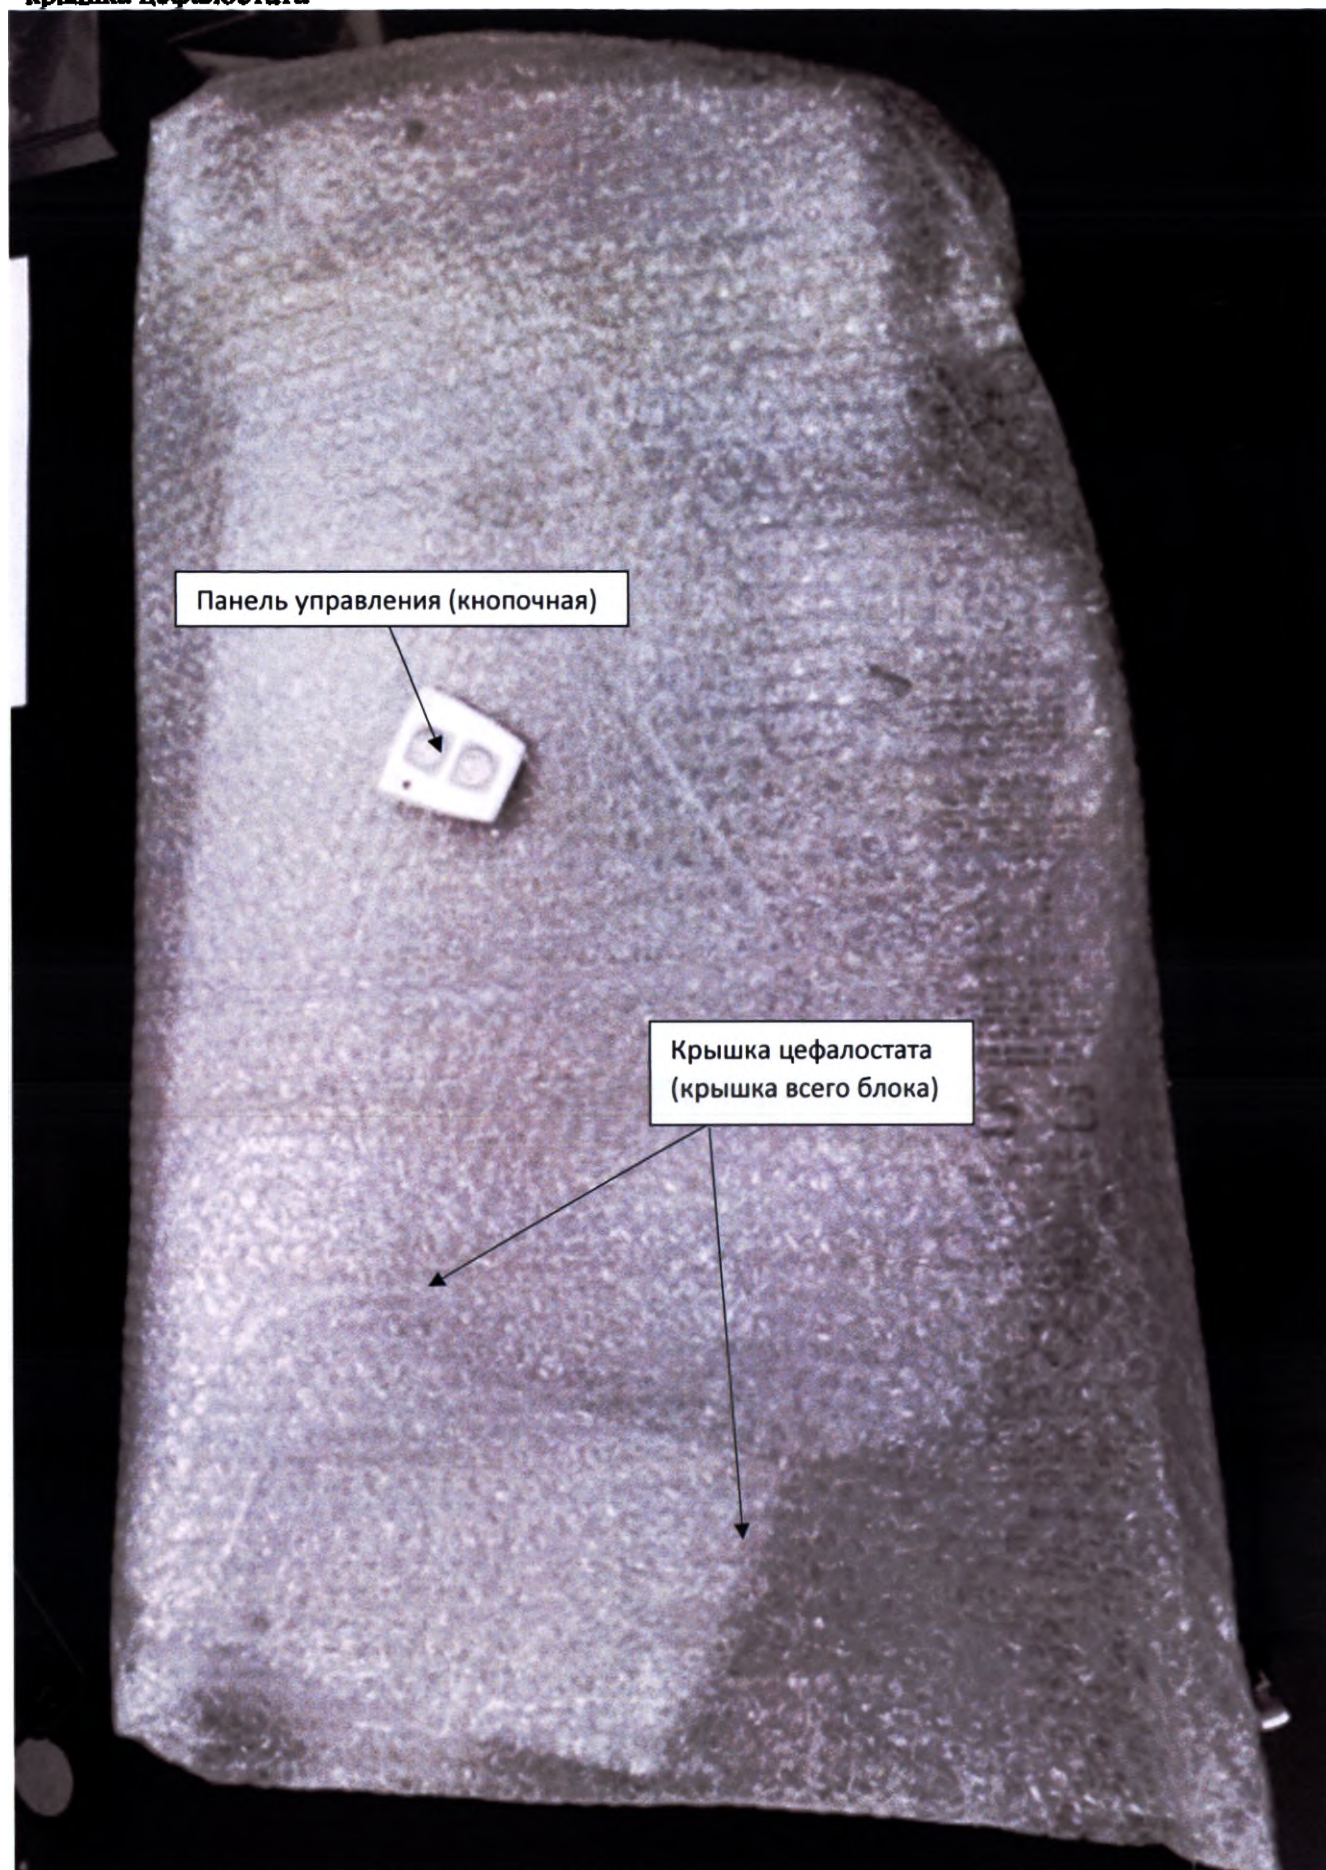

12. Комплект для модернизации цефалостата, сиреневого цвета (GLICINE CEPH UPGRADE KIT), (при необходимости):


- панель управления
- крышка цефалостата

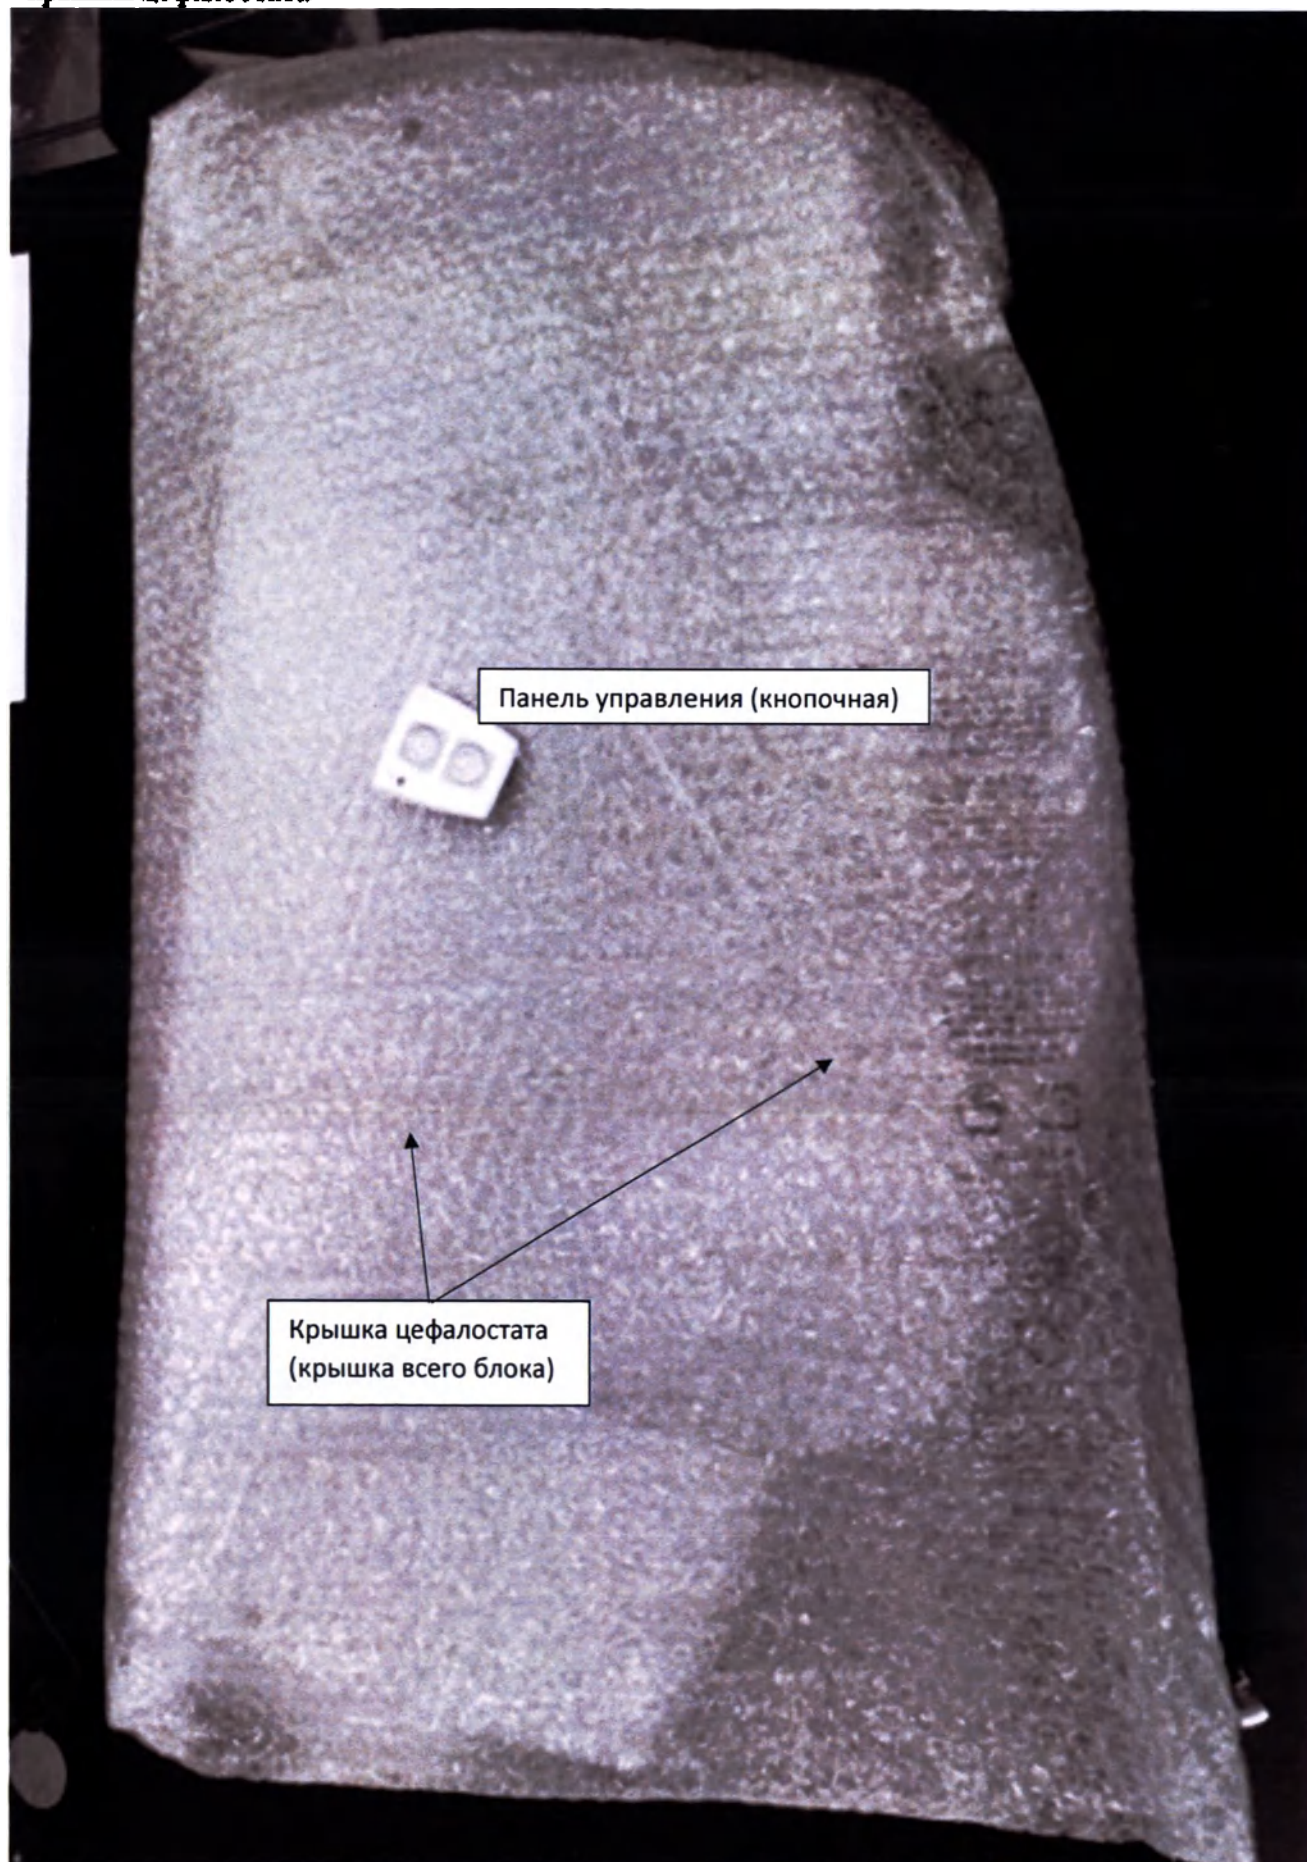

- 13. Комплект для модернизации с сенсорной консолью, цвет белый (FULL TOUCH CONSOLE - PAN WHITE) (при необходимости).



14. Комплект для модернизации с сенсорной консолью, цвет сиреневый (FULL TOUCH CONSOLE - PAN GLICI) (при необходимости).

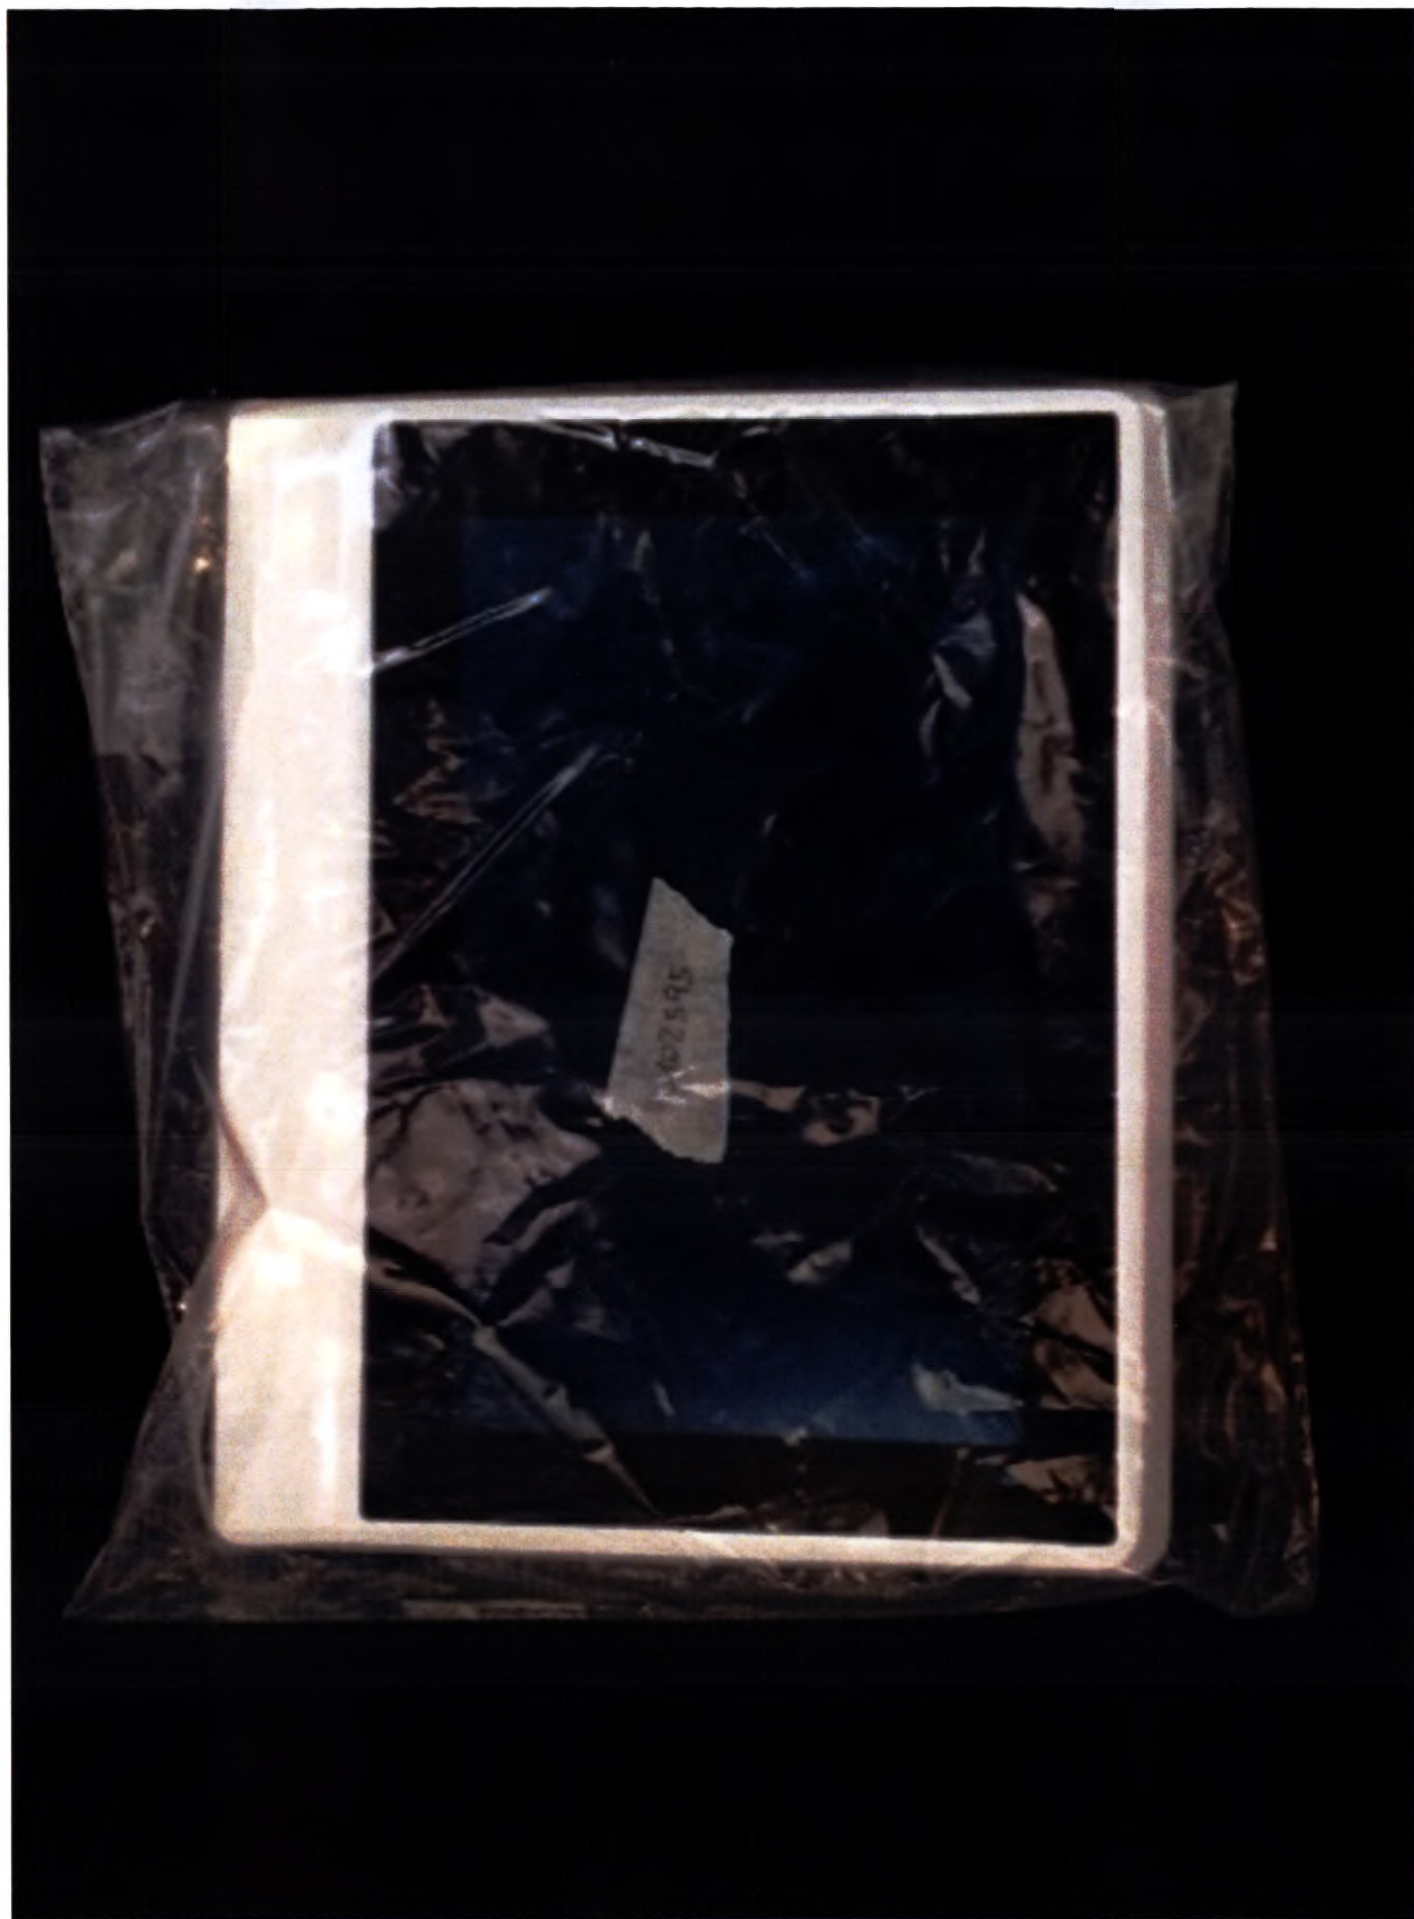


15. Комплект для модернизации системы с 2D до 3D (UPGRADE FROM 2D TO 3D VERS.) в составе, (при необходимости):

- 3D панель;
- Коллиматор;
- Наклейка;
- винты (не более 10 штук)
- плата управления;
- вставка металлическая.



16. Полный комплект для модернизации цефалостата (CERH READY COMPLETION KIT) в составе, (при необходимости):

- плата управления;
- вставка металлическая;
- болты крепежные (10 шт);
- блок сопряжения;
- кабель соединительный.

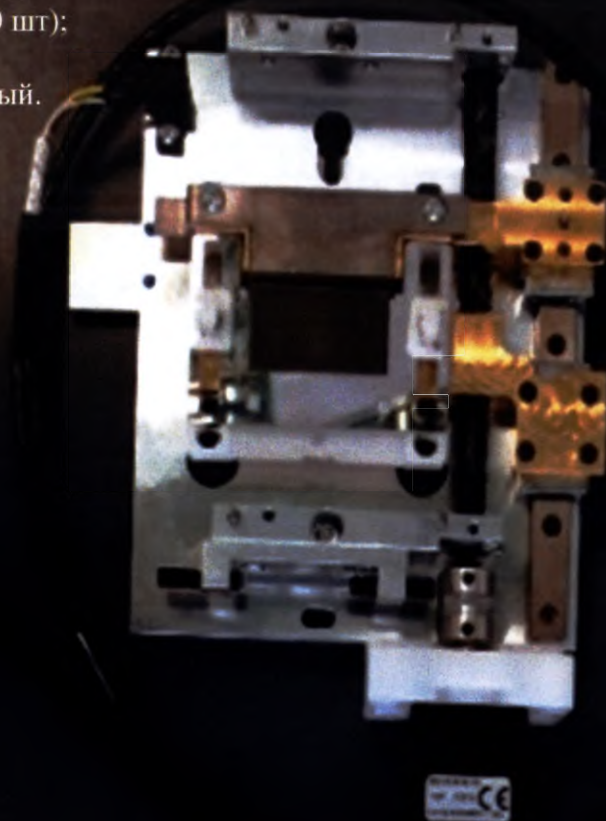


17. Комплект для модернизации функции CB3D (CB3D COMPLETION KIT) в составе (при необходимости):

- крышка пластиковая;
- опорная стойка краниостата;
- крепёж;
- вставка металлическая;
- электродвигатель;
- вставка металлическая;
- кабель соединительный;
- 3D сенсор;
- наклейка.




18. Насадки ушные одноразовые для цефалостата (не более 40 штук) (при необходимости).

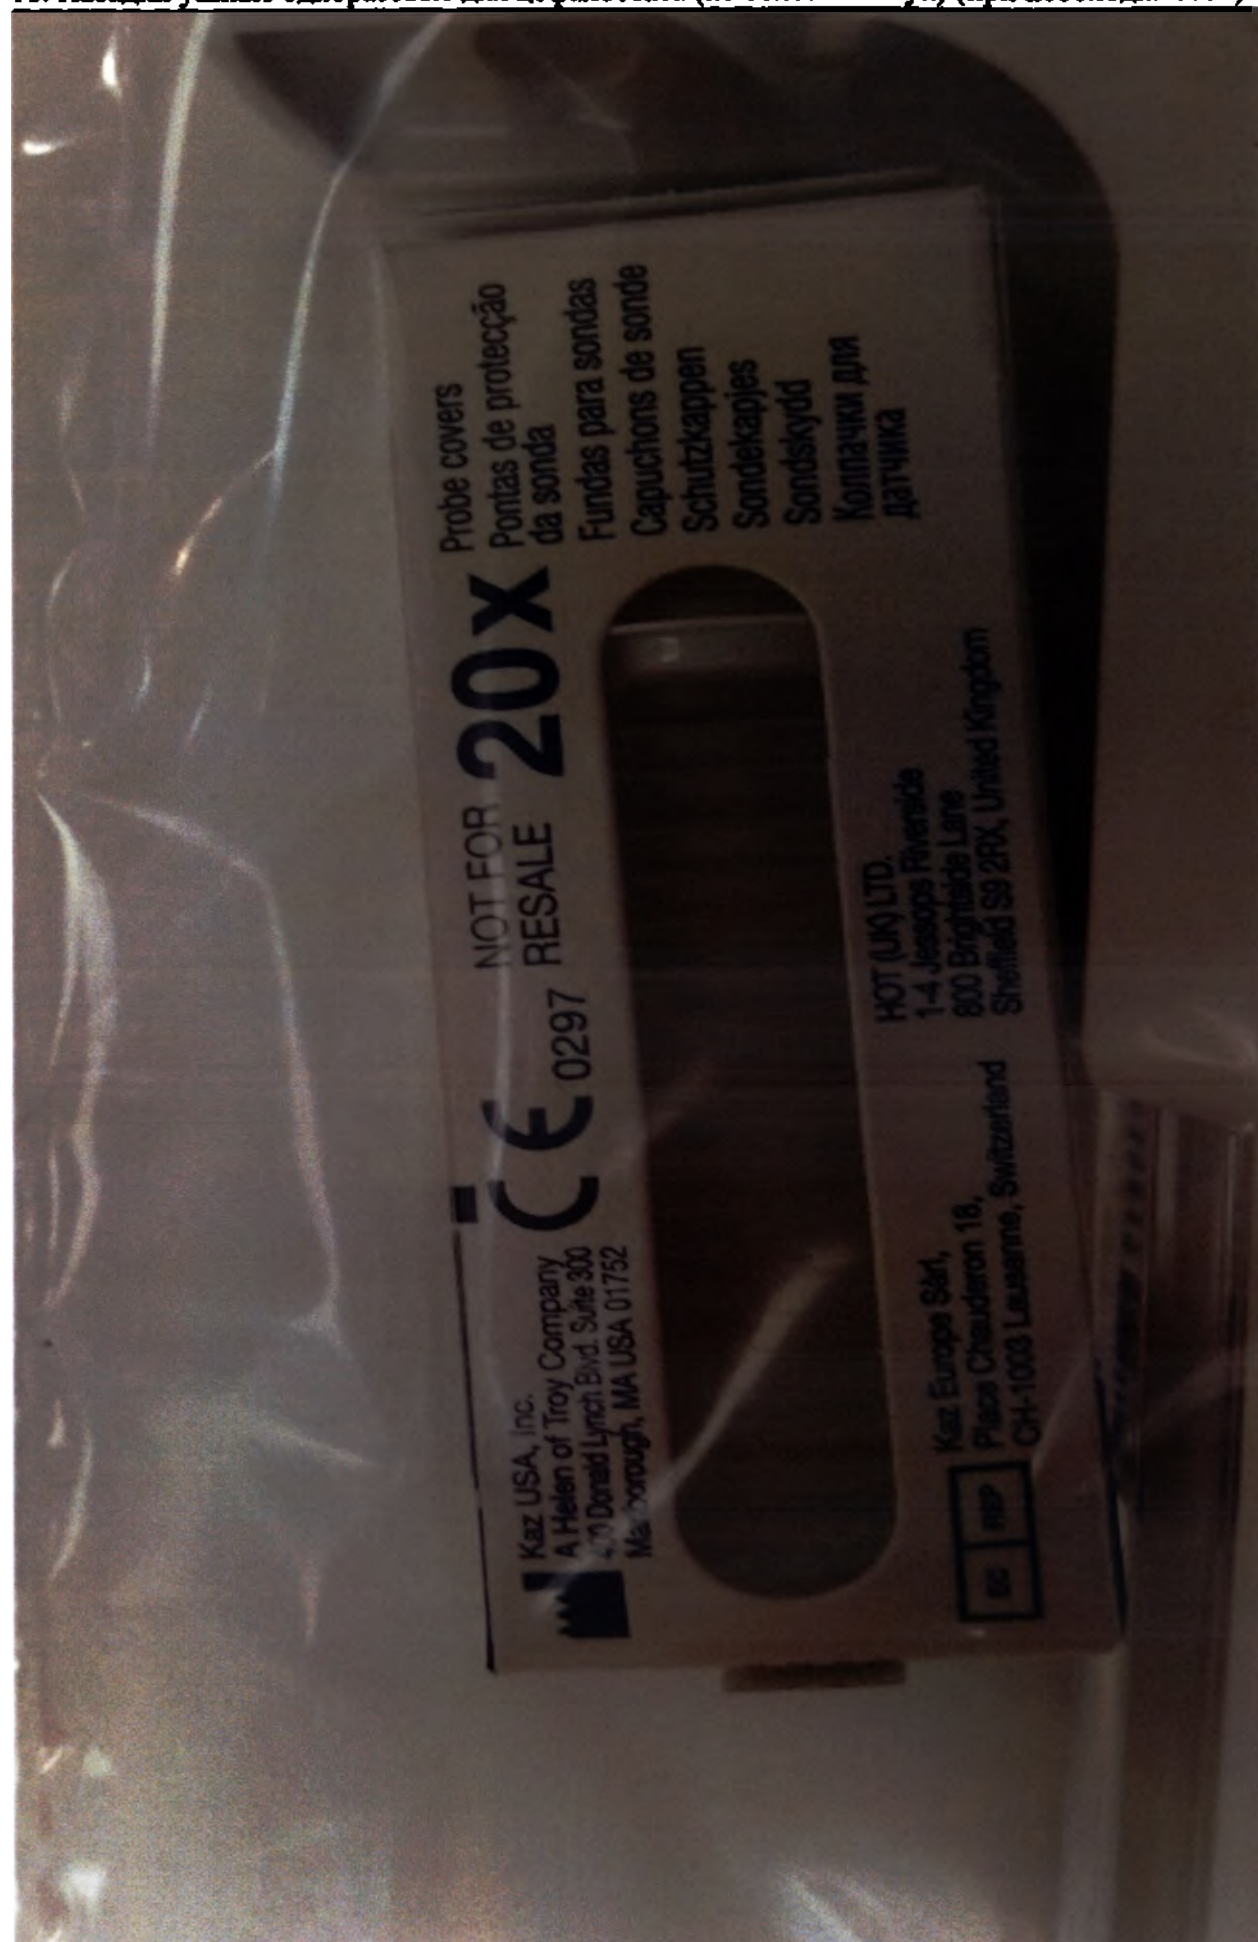

19. Чехлы гигиенические для прикусной вилки, не более 500 шт. (при необходимости).



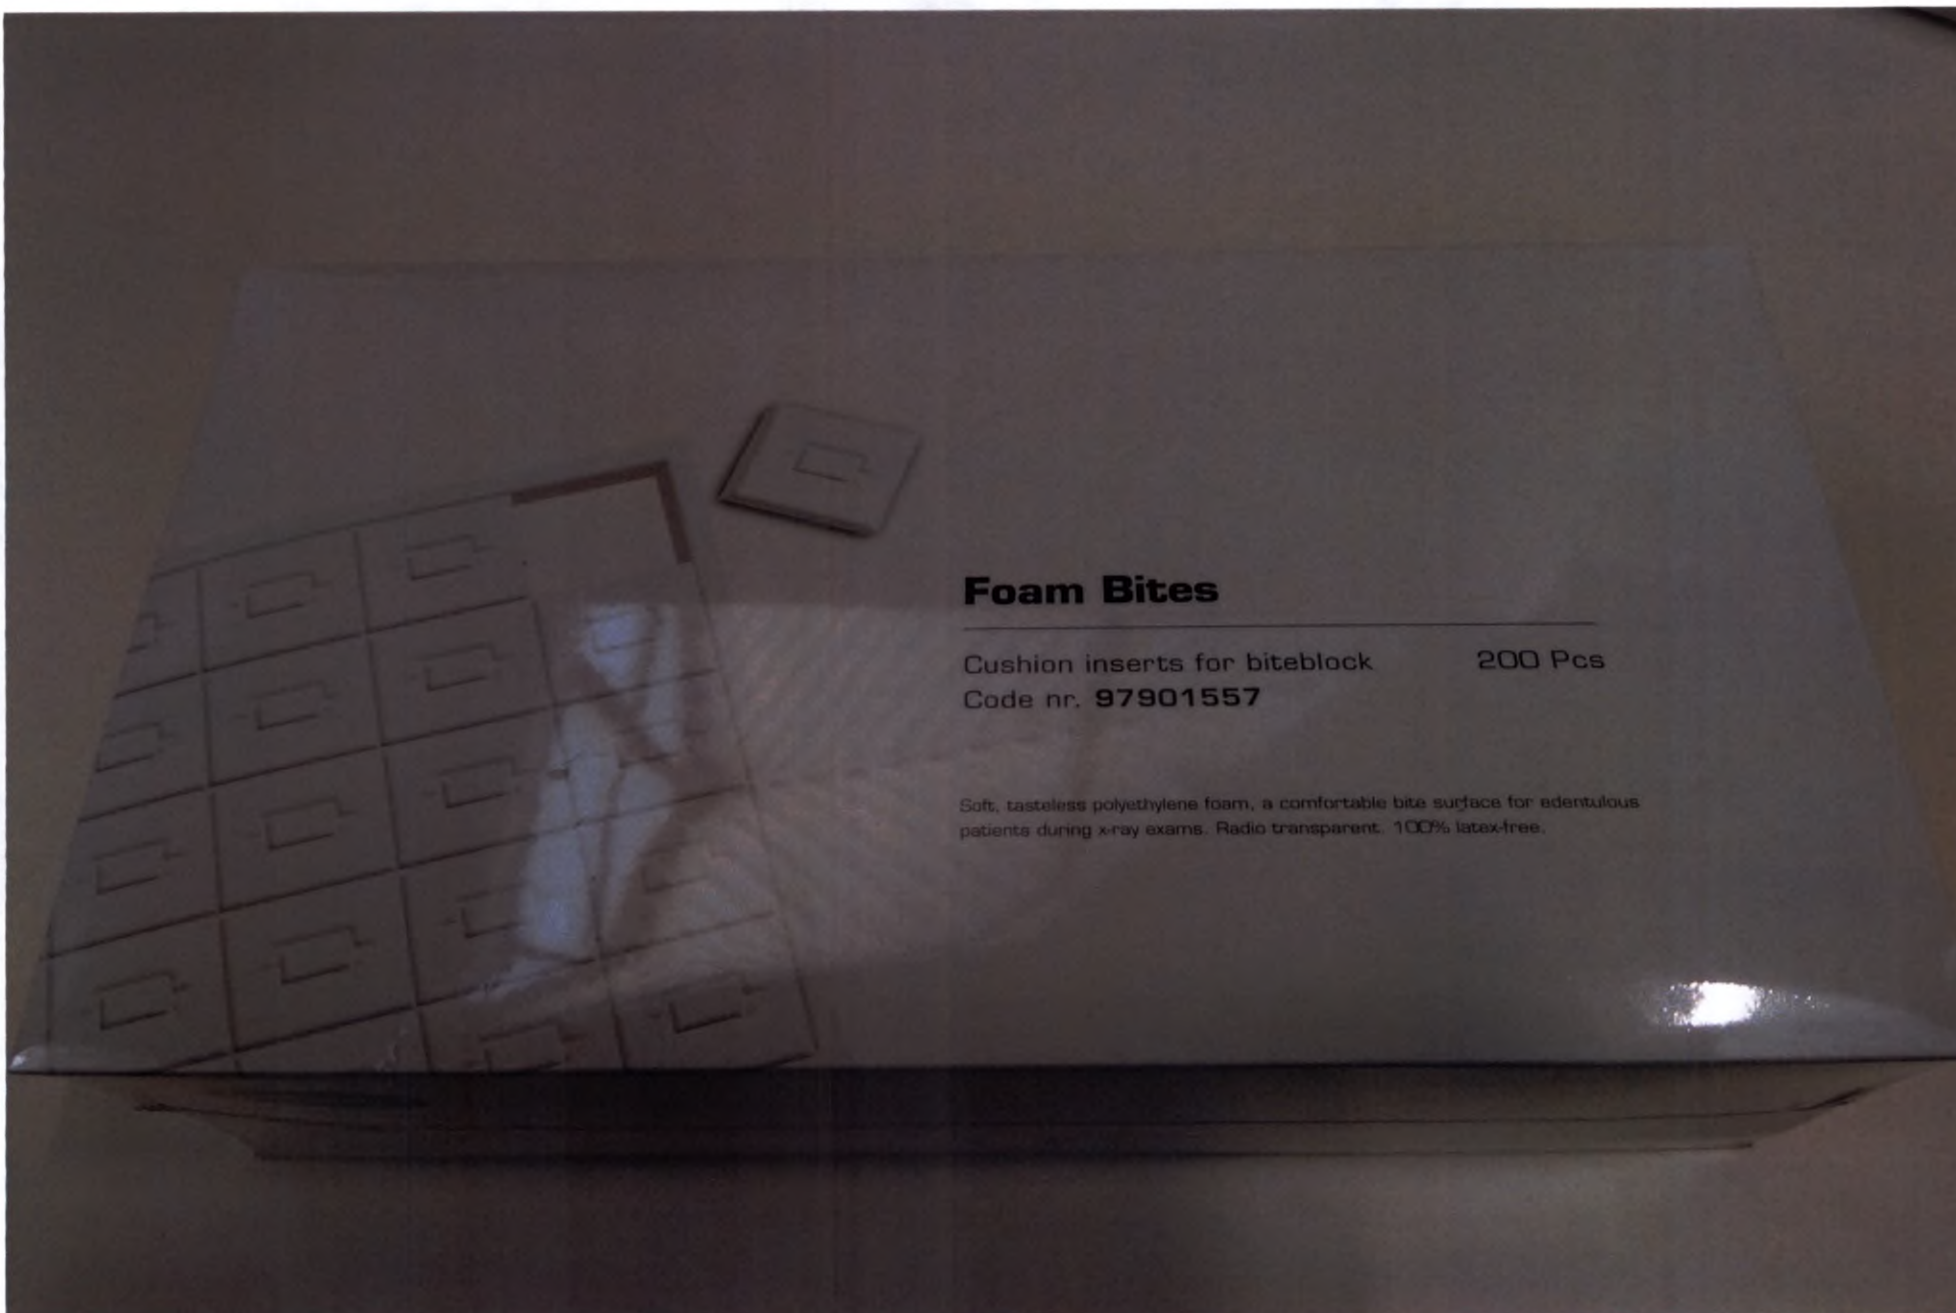

21. Вставки для краниостата (HEADREST CUSHION INSERTS), не более 10 шт. (при необходимости).



Данные изделия выглядят одинаково:

22. USB-Носитель с Лицензией DICOM 3D Data Import (DICOM 3D DATA IMPORT LICENCE) (при необходимости).
23. USB-Носитель с Лицензией DICOM MPPS (DICOM MPPS LICENCE) (при необходимости).
24. USB-Носитель с Лицензией DICOM PRINT (DICOM PRINT LICENCE) (при необходимости).
25. USB-Носитель с Лицензией DICOM QUERY/RETRIEVE (DICOM QUERY/RETRIEVE LICENCE) (при необходимости).
26. USB-Носитель с Лицензией DICOM SR DOCUMENT (DICOM SR DOCUMENT LICENCE) (при необходимости).
27. USB-Носитель с Лицензией и соглашением DICOM STORAGE LIC+COMMITMENT (DICOM STORAGE LIC+COMMITMENT) (при необходимости).
28. USB-Носитель с Лицензией DICOM WORKLIST + MPPS LICENCE (DICOM WORKLIST + MPPS LICENCE) (при необходимости).
29. USB-Носитель с Лицензией DICOM 3D DATA IMPORT (DICOM 3D DATA IMPORT LICENCE) (при необходимости).
30. USB-Носитель с Лицензией DTS (DTS LICENCE) (при необходимости).
31. USB-Носитель с Лицензией BASIC 3D NIP (BASIC 3D NIP LICENCE) (при необходимости).
32. USB-Носитель с Лицензией MASTER 3D NIP (MASTER 3D NIP LICENCE) (при необходимости).
33. USB-Носитель с обновлением программного обеспечения до 3D функций (3D FUNCT. UPGRADE KIT FOR 3D) (при необходимости).
34. USB-Носитель с Лицензией DATA GRABBER (DATA GRABBER LICENCE) (при необходимости).

Общее фото для позиций с 22 по 34 приведено на следующей странице.



Данные позиции представляют собой гиперссылки на объект, расположенный на сервере компании CEFLA S.C.:


35. Обновление программного обеспечения на виртуальном носителе с онлайн активацией до 10x8 (BASIC 3D FUNCT.UP TO 10X8) (при необходимости).
36. Обновление программного обеспечения на виртуальном носителе с онлайн активацией до 13x16 (ADV.3D FUNCT. UP TO 13X16) (при необходимости).
37. Обновление программного обеспечения на виртуальном носителе с онлайн активацией до 16x18 (3D MAX FUNCT. UP TO 16X18) (при необходимости).
38. Обновление программного обеспечения на виртуальном носителе с онлайн активацией пакета XF (XF PACK LIC. FOR ADDIT.FOV) (при необходимости).
39. Обновление программного обеспечения на виртуальном носителе с онлайн активацией 3D MAR (3D MAR LICENSE (METAL ART.RED.) (при необходимости).
40. Обновление программного обеспечения на виртуальном носителе с онлайн активацией RealGuide (REALGUIDE DESIGN LICENCE) (при необходимости).
41. Обновление программного обеспечения на виртуальном носителе с онлайн активацией RealGuide PRO (REALGUIDE PRO LICENCE) (при необходимости).
42. Лицензия для он-лайн активации доступа к сервису DI.VA на 1 год (DI.VA LICENCE - 1 YEAR) (при необходимости).
43. Лицензия для он-лайн активации доступа к сервису DI.VA на 3 года (DI.VA LICENCE - 3 YEARS) (при необходимости).
44. Лицензия для он-лайн активации доступа к сервису DI.VA на 4 года (DI.VA LICENCE - 4 YEARS) (при необходимости).
45. Лицензия для он-лайн активации доступа к сервису DI.VA на 5 лет (DI.VA LICENCE - 5 YEARS) (при необходимости).

46. Комплект для модернизации консоли (FULL TOUCH CONSOLE COMPLET. KIT), в составе, (при необходимости):

- плата электронная
- чувствительный элемент
- блок перемещения



47. Краниостат (Craniostat) (при необходимости).

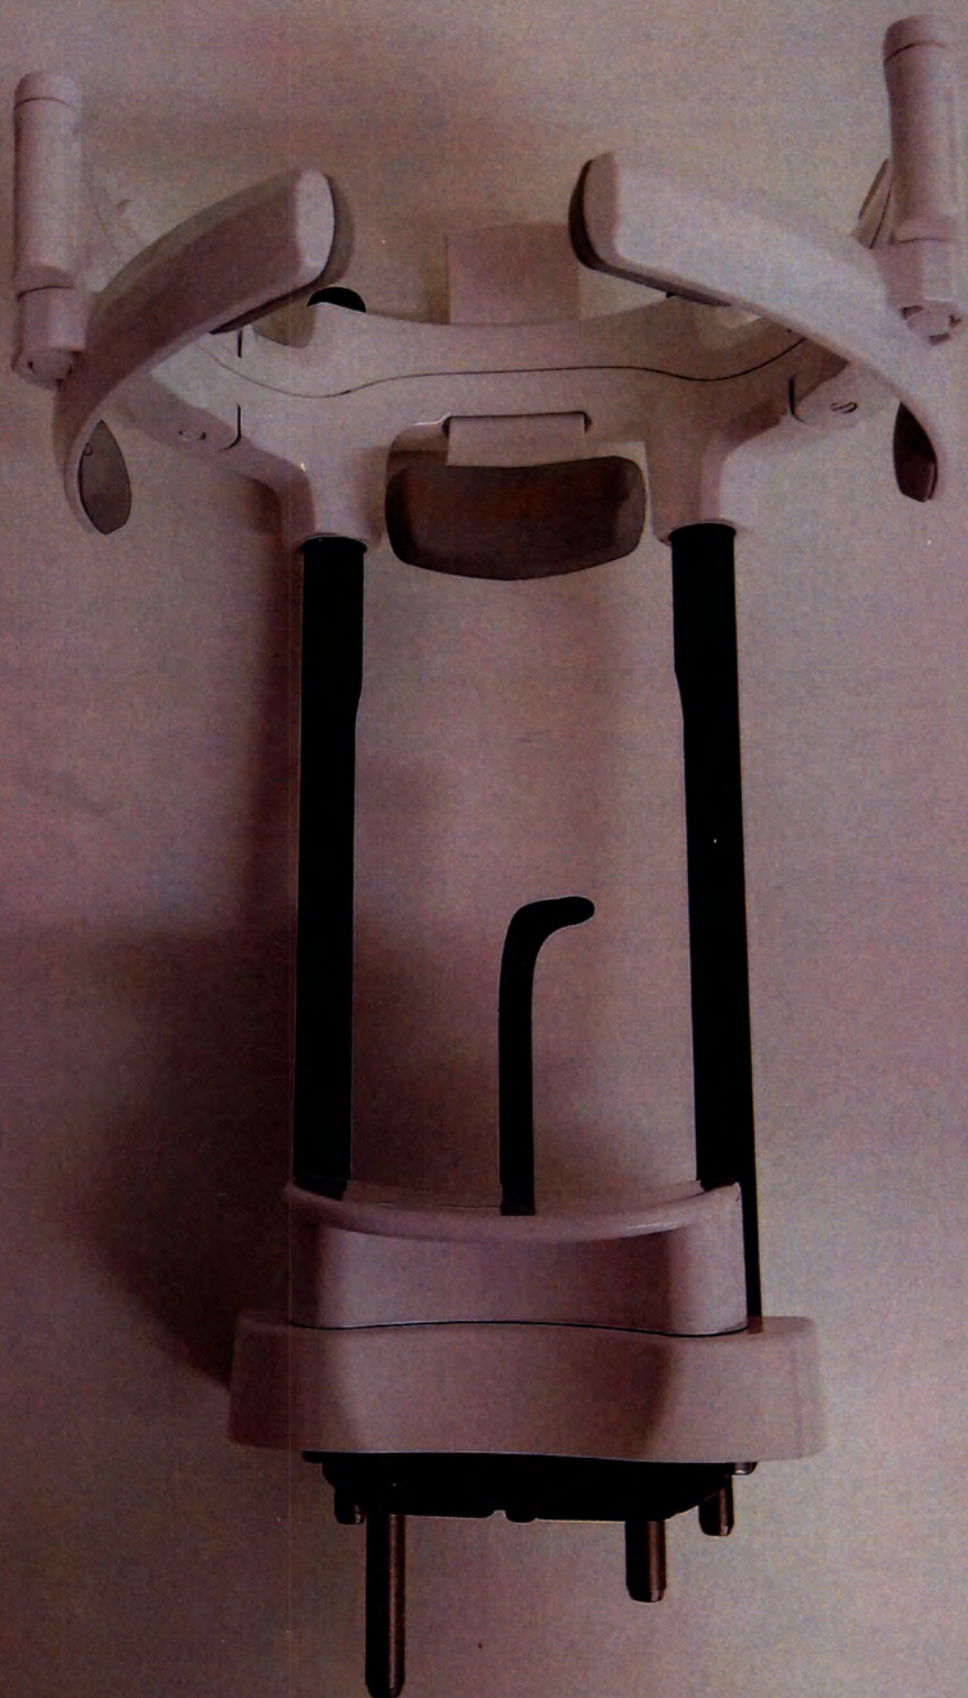



Проставлено, пронумеровано

лист 1 / 118796687 2687

лист

Генеральный директор

ООО «ЗЕНИТ Р.С.»

Аладина Елена Андреевна