


Руководитель отдела качества и
корпоративных технологий



Медведева И.Б.

« 10 » марта 2020 г.



Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики in vitro

Набор калибраторов С-реактивного белка_2 для анализаторов биохимических серии
Atellica (Atellica CH C-Reactive Protein_2 Calibrators (Atellica CH CRP_2 CAL))

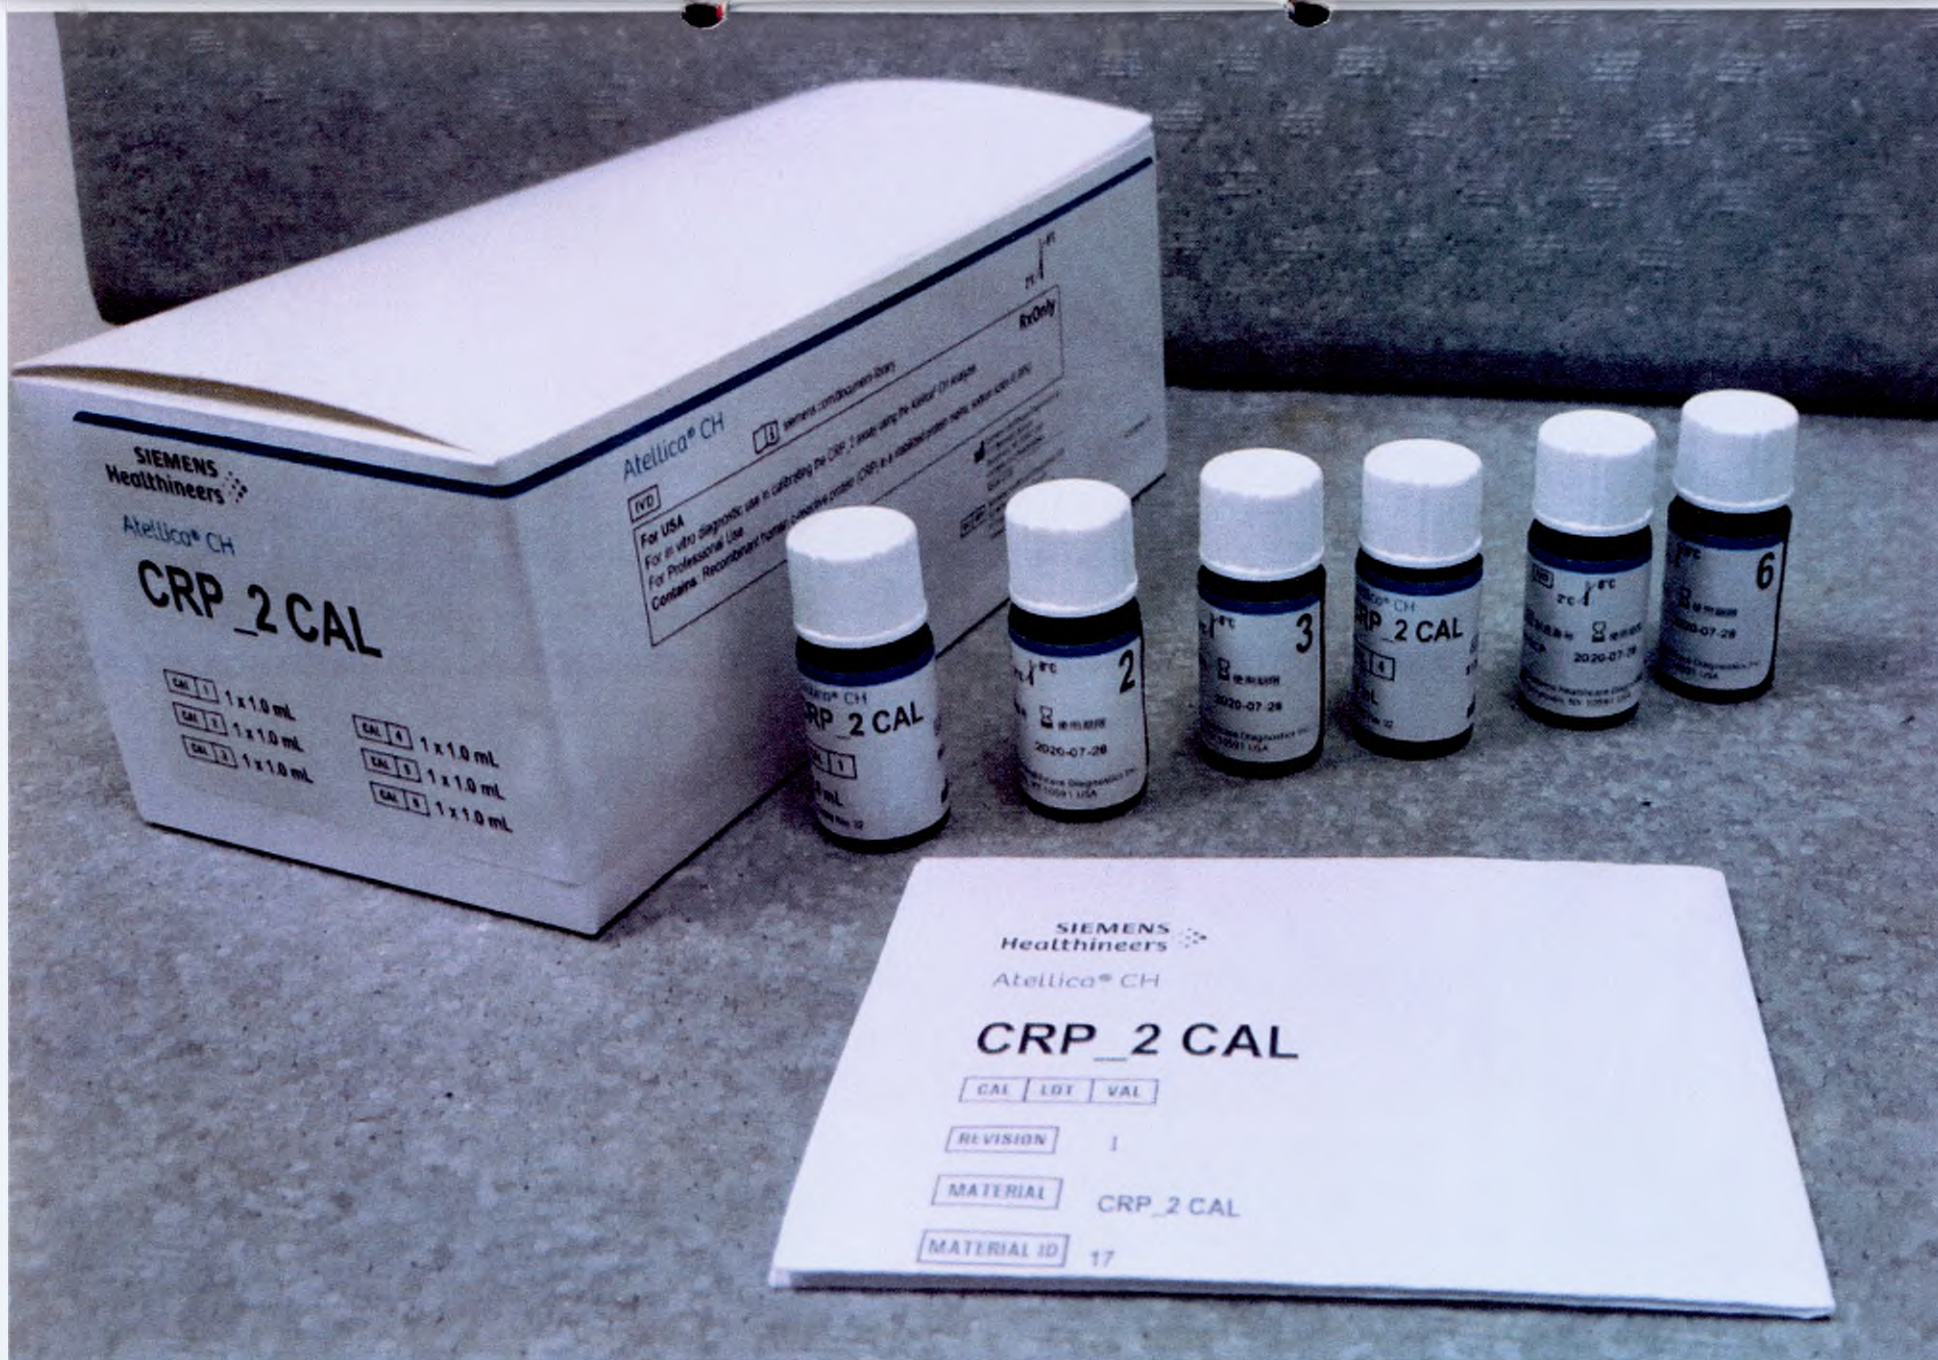


Рисунок 1. Набор калибраторов С-реактивного белка_2 для анализаторов биохимических серии Atellica (Atellica CH C-Reactive Protein_2 Calibrators (Atellica CH CRP_2 CAL)): общий вид изделия



Рисунок 2. Набор калибраторов С-реактивного белка_2 для анализаторов биохимических серии Atellica (Atellica CH C-Reactive Protein_2 Calibrators (Atellica CH CRP_2 CAL)): флакон с калибратором, общий вид, уровень 1

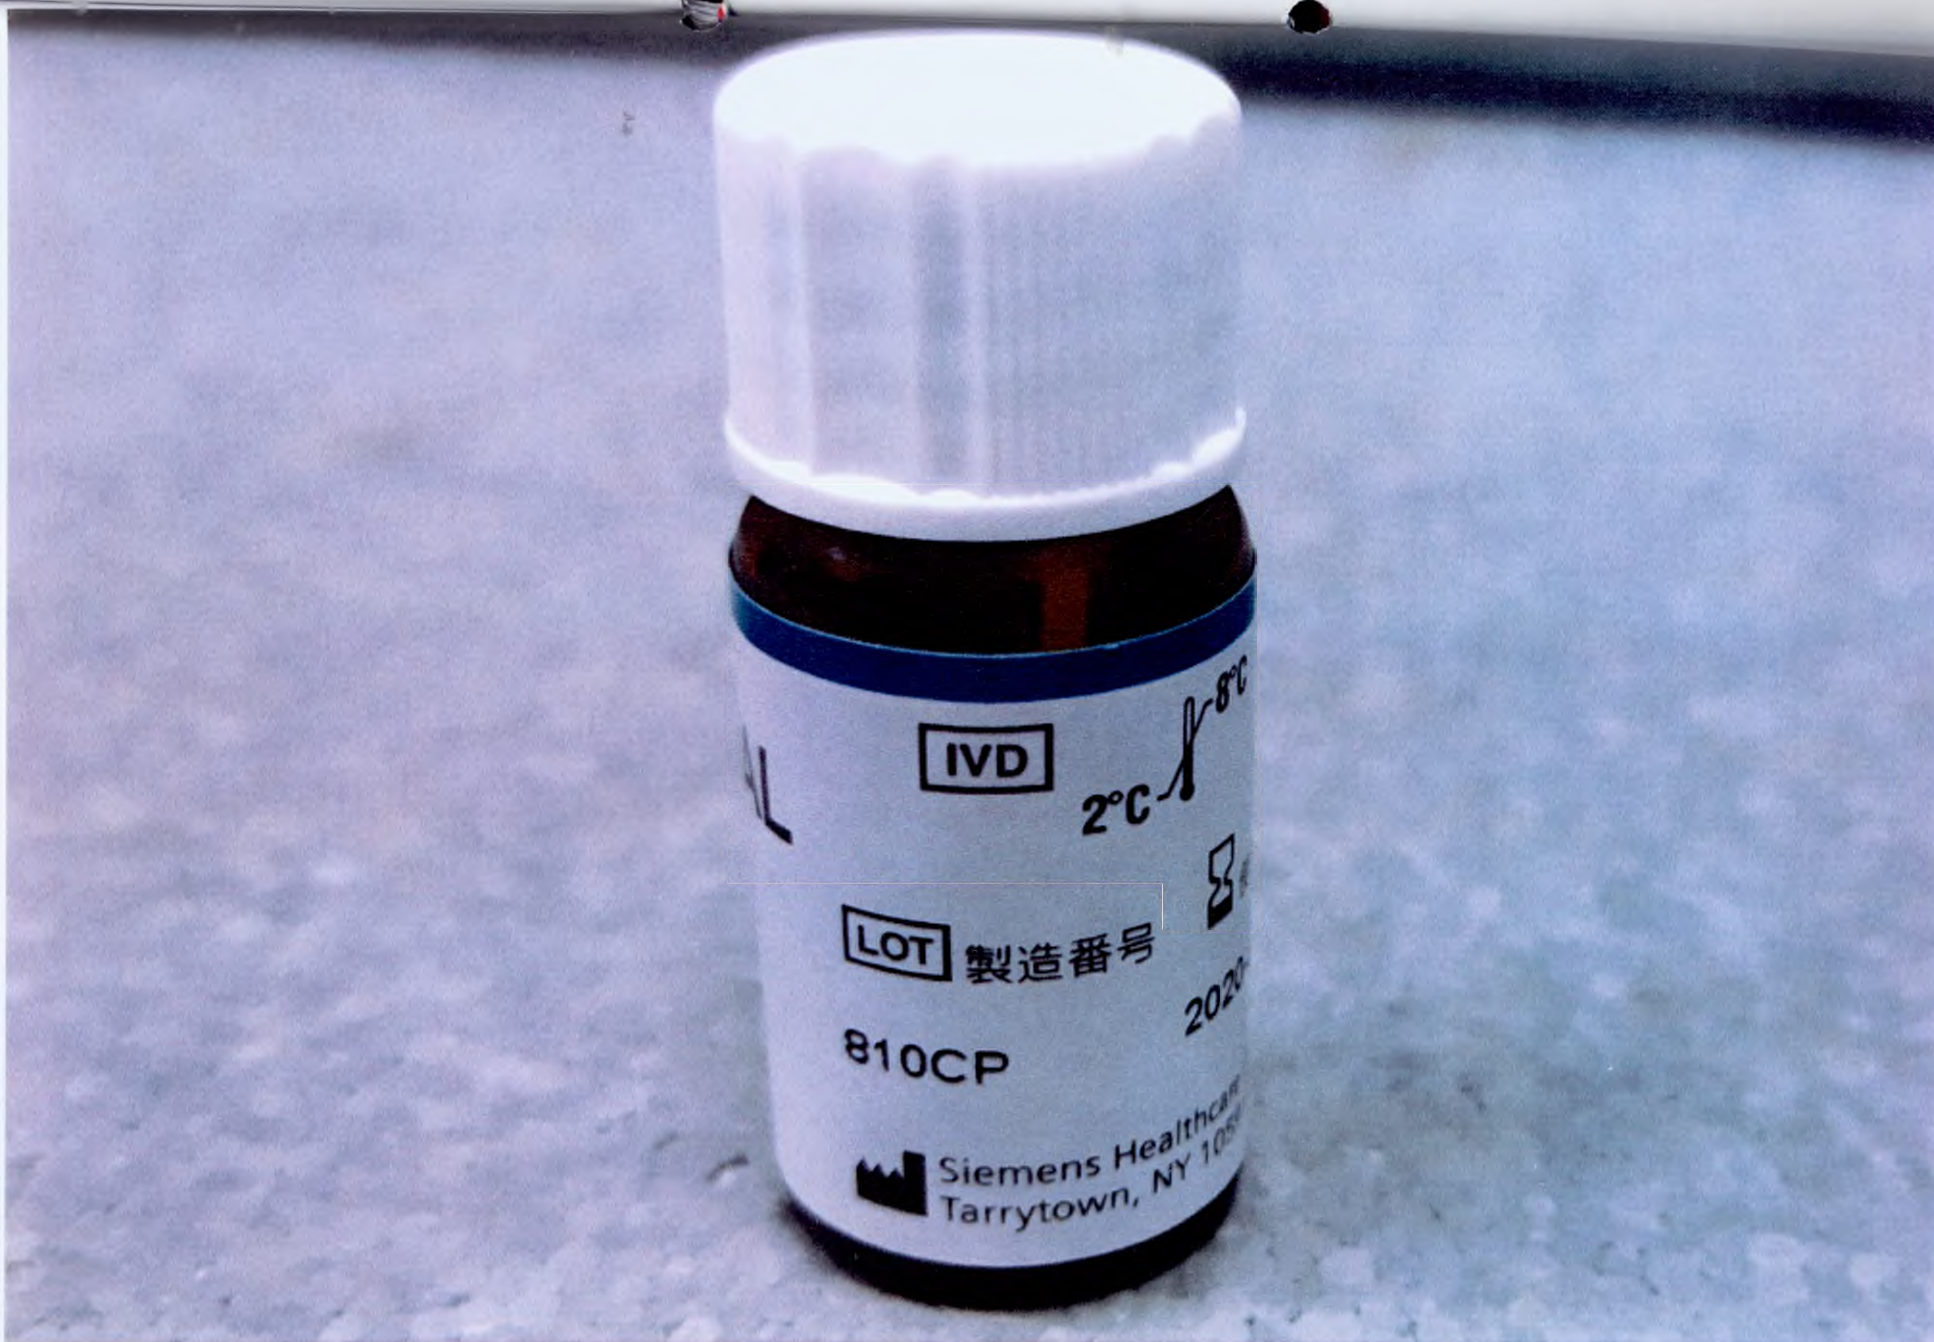


Рисунок 3 Набор калибраторов С-реактивного белка_2 для анализаторов биохимических серии Atellica (Atellica CH C-Reactive Protein_2 Calibrators (Atellica CH CRP_2 CAL)); флакон с калибратором, общий вид, уровень 2.



Рисунок 4 Набор калибраторов С-реактивного белка_2 для анализаторов биохимических серии Atellica (Atellica CH C-Reactive Protein_2 Calibrators (Atellica CH CRP_2 CAL)): флакон с калибратором, общий вид, уровень 3

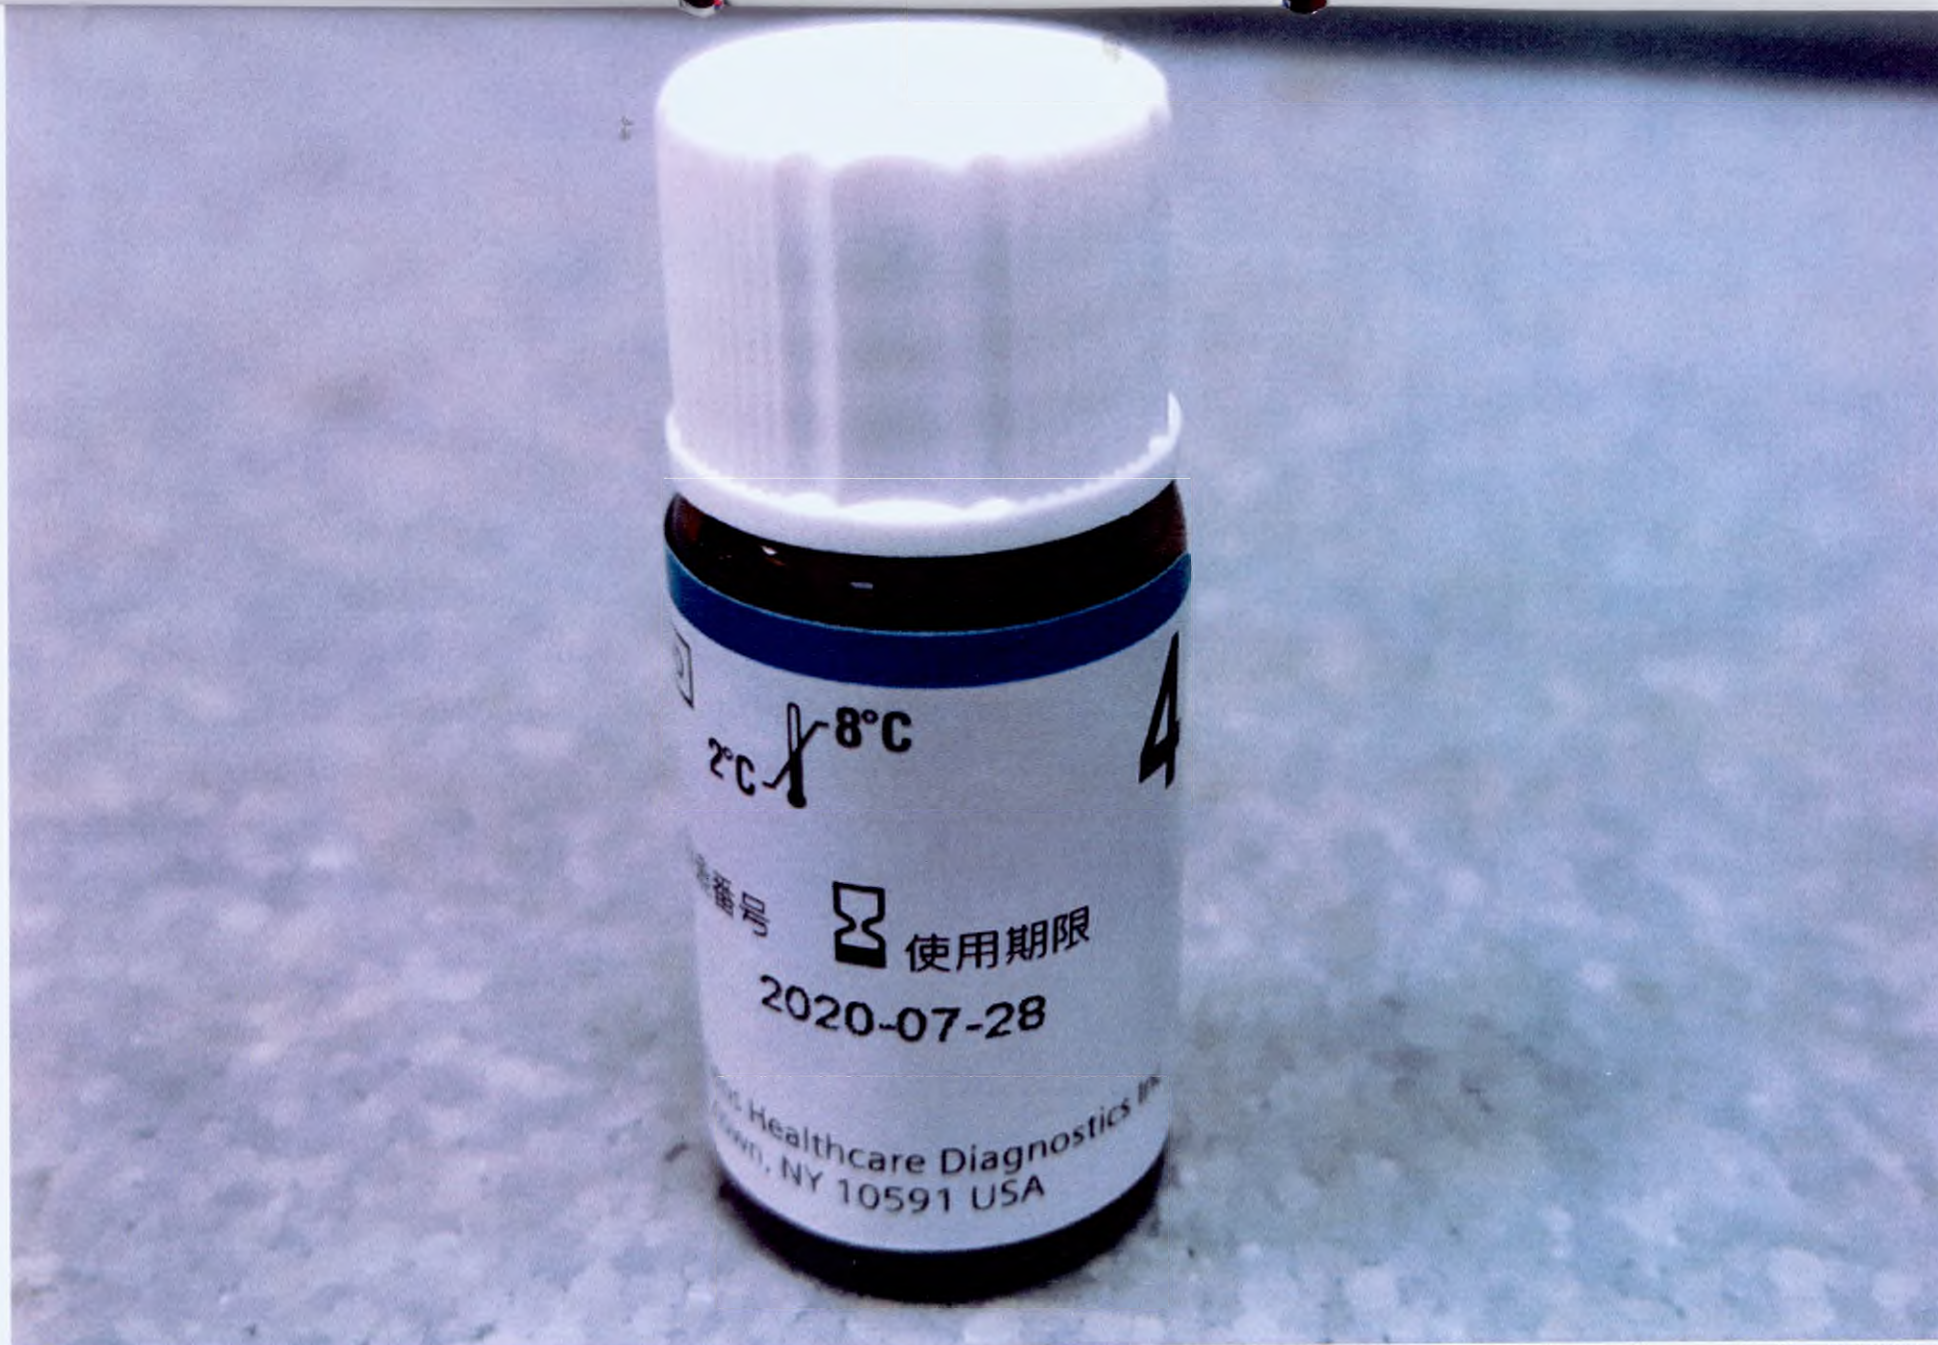


Рисунок 5 Набор калибраторов С-реактивного белка_2 для анализаторов биохимических серии Atellica (Atellica CH C-Reactive Protein_2 Calibrators (Atellica CH CRP_2 CAL)): флакон с калибратором, общий вид, уровень 4



Рисунок 6 Набор калибраторов С-реактивного белка_2 для анализаторов биохимических серии Atellica (Atellica CH C-Reactive Protein_2 Calibrators (Atellica CH CRP_2 CAL)): флакон с калибратором, общий вид, уровень 5

SIEMENS
Healthineers
Atellica® CH

CRP_2 CAL

CAL LOT VAL
REVISION 1
WATERMARK CRP_2 CAL
MATERIAL ID 17

CRP_2	UNITS C	UNITS SI
CAL 1	0.0 mg/dL	0.0 mg/L
CAL 2	0.5 mg/dL	5.0 mg/L
CAL 3	2.2 mg/dL	22 mg/L
CAL 4	4.1 mg/dL	41 mg/L
CAL 5	16.3 mg/dL	163 mg/L
CAL 6	32.8 mg/dL	328 mg/L

LOT 4396418
EXP. DATE 2019-08-28
REF 11099430

1 Siemens Healthineers Laboratory



1110000 Rev. 02

Рисунок 7 Набор калибраторов С-реактивного белка_2 для анализаторов биохимических серии Atellica (Atellica CH C-Reactive Protein_2 Calibrators (Atellica CH CRP_2 CAL)): лист значений параметров серии калибратора.

Всего прошито и пронумеровано 8 листа (ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»

