


Генеральный директор
ООО "ИНТЕЛМЕД"




С.З. Колесникова


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия

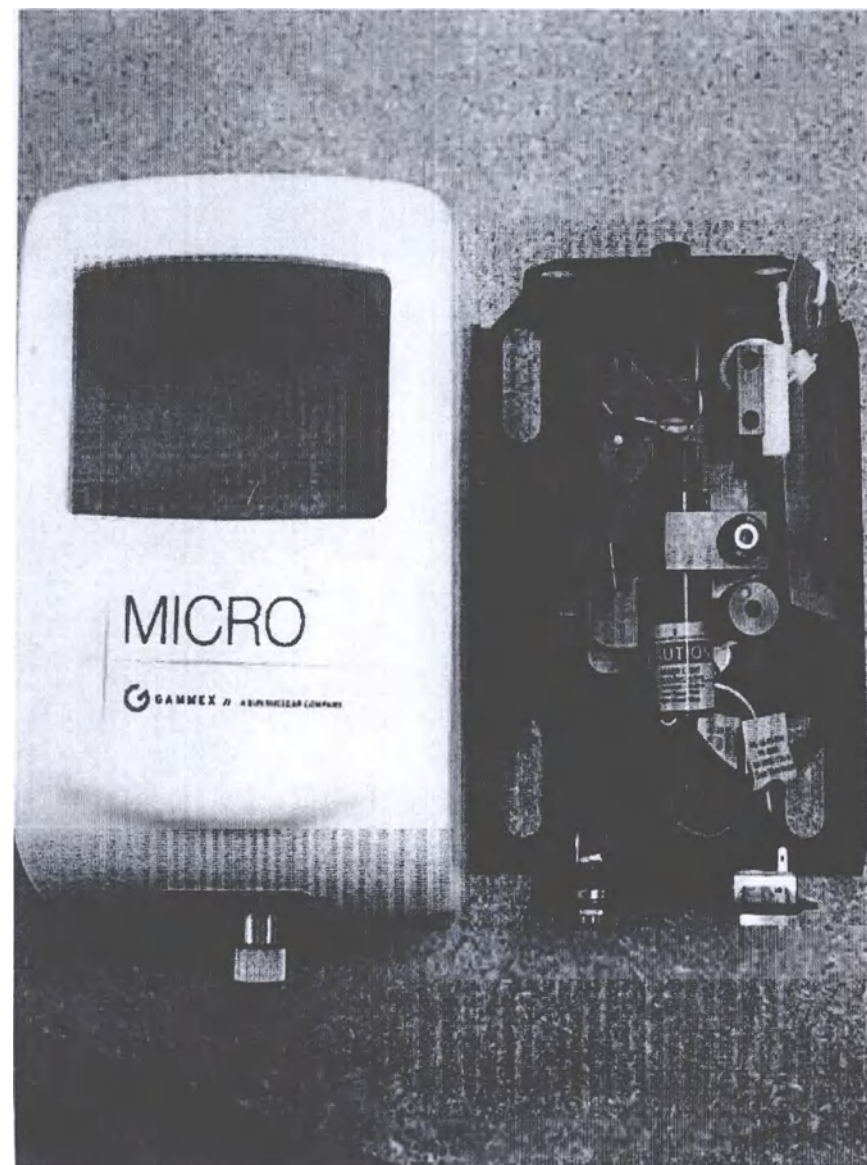

Лазерный модуль Micro

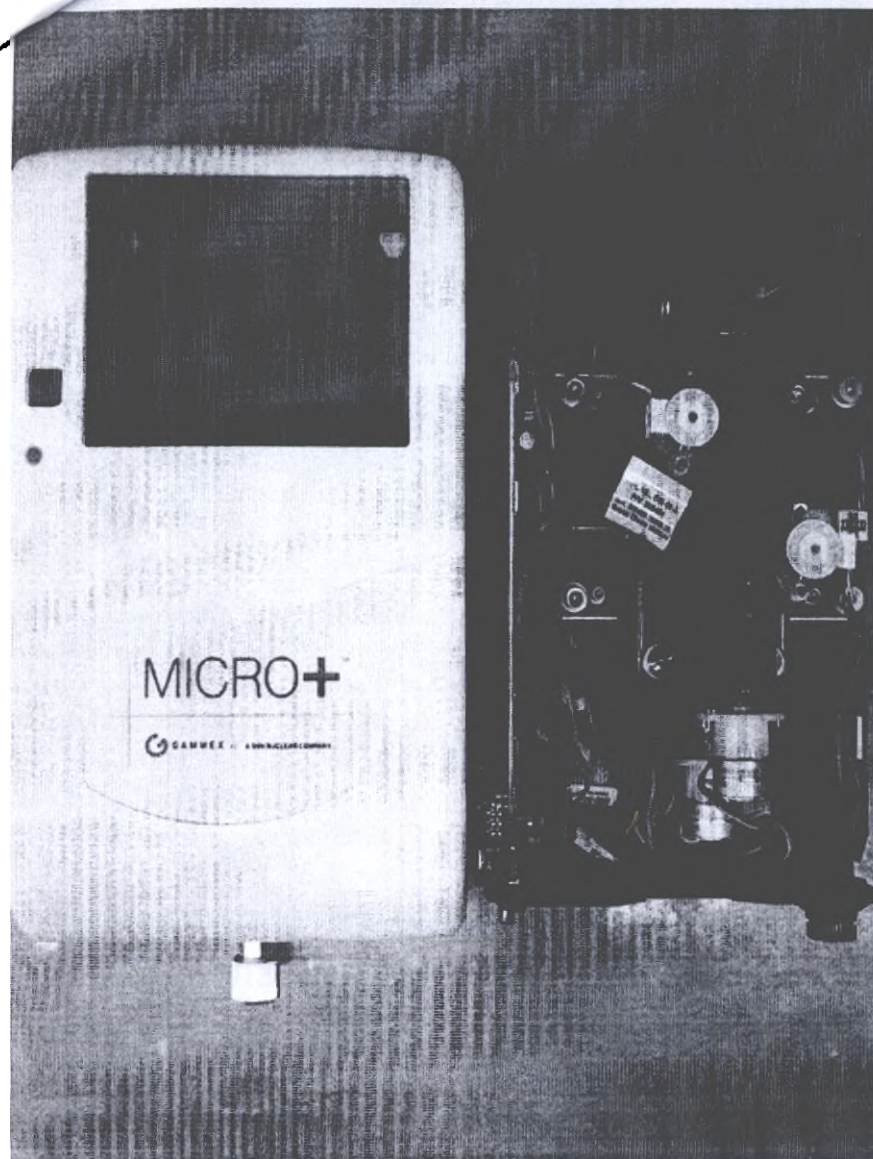


Лазерный модуль Micro+

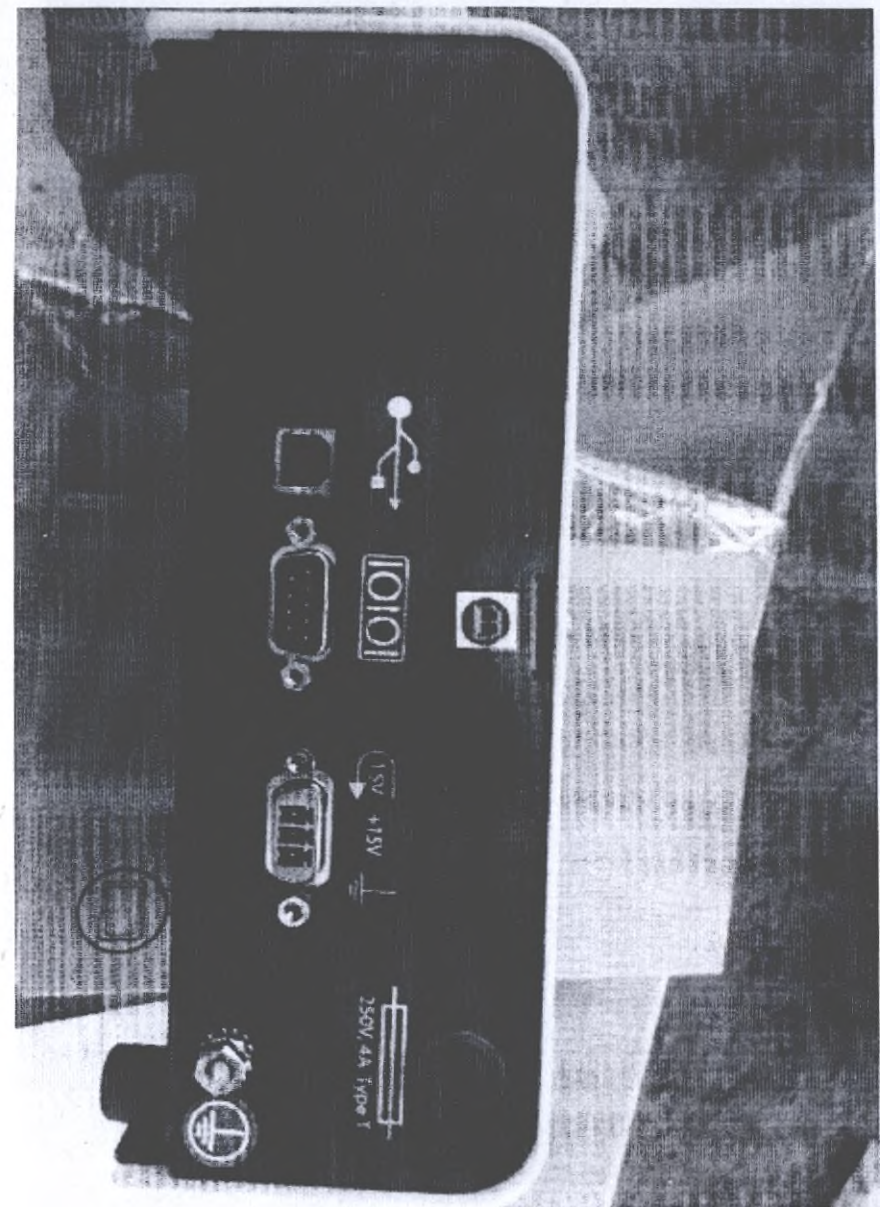


Блок управления/питания системы вид с торца




Блок управления Лифтшля системы

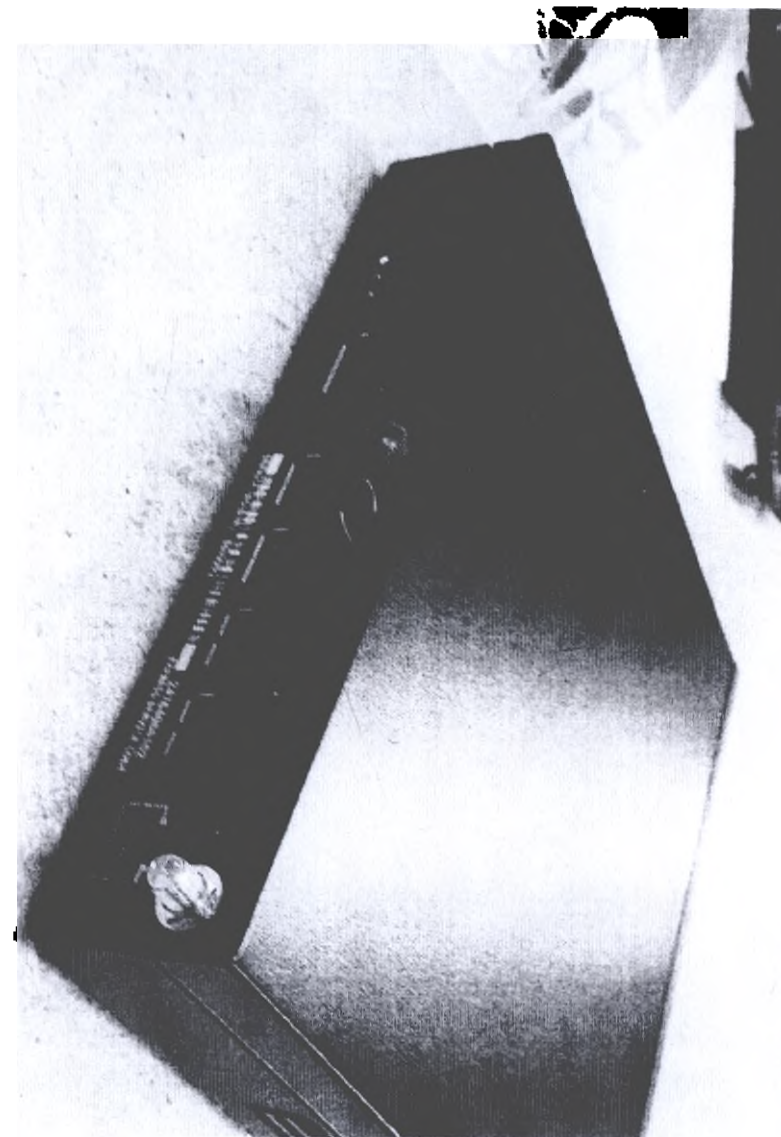


ПК с установленным программным обеспечением.

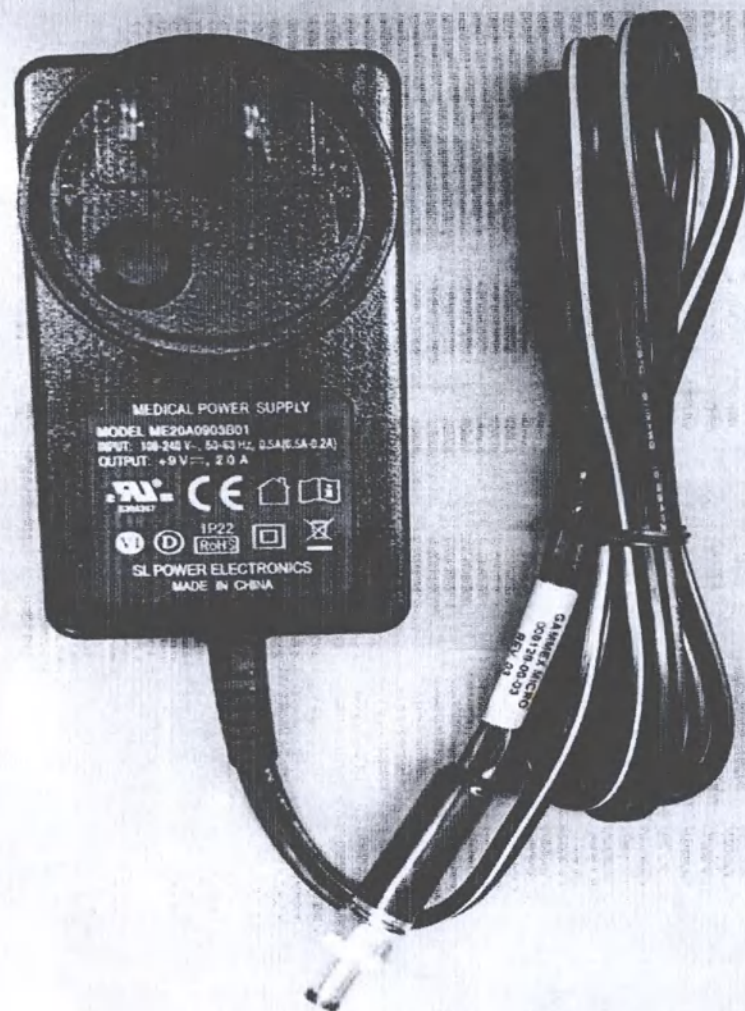


Блок питания Micro

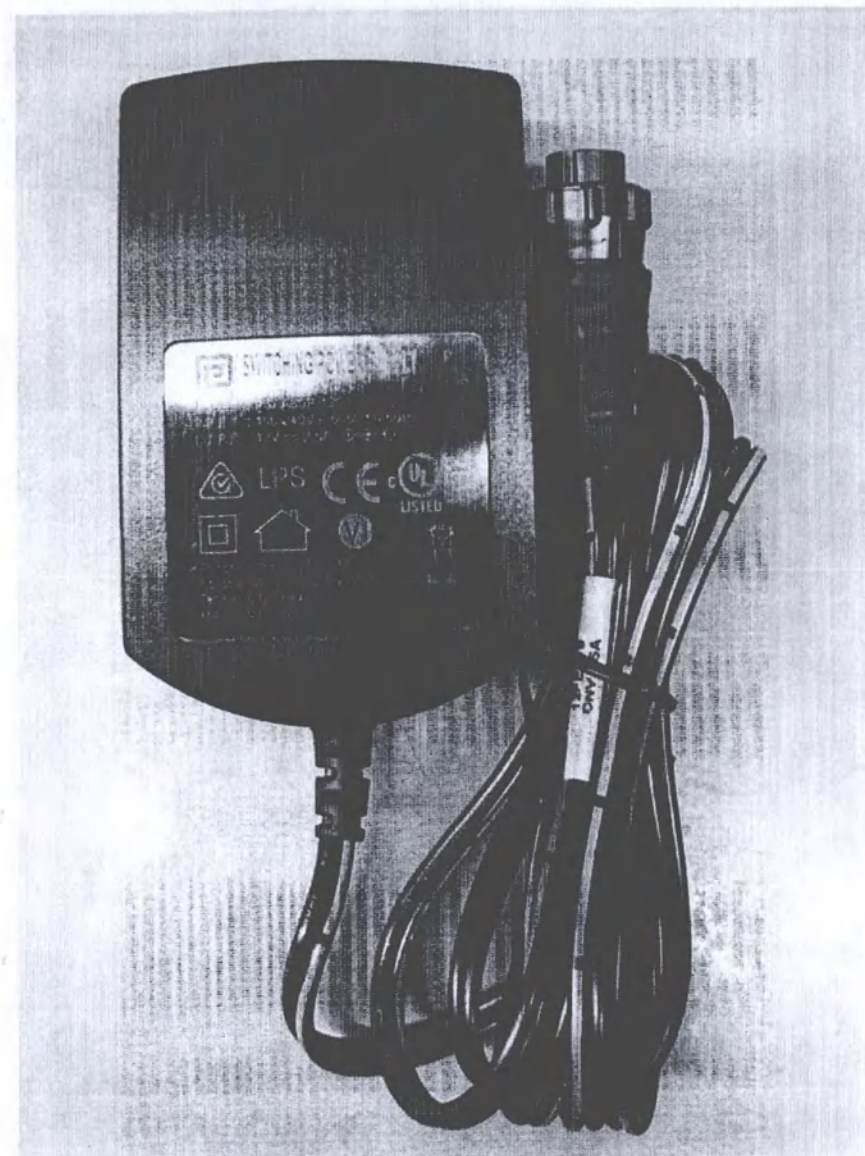


Блок питания Micro+

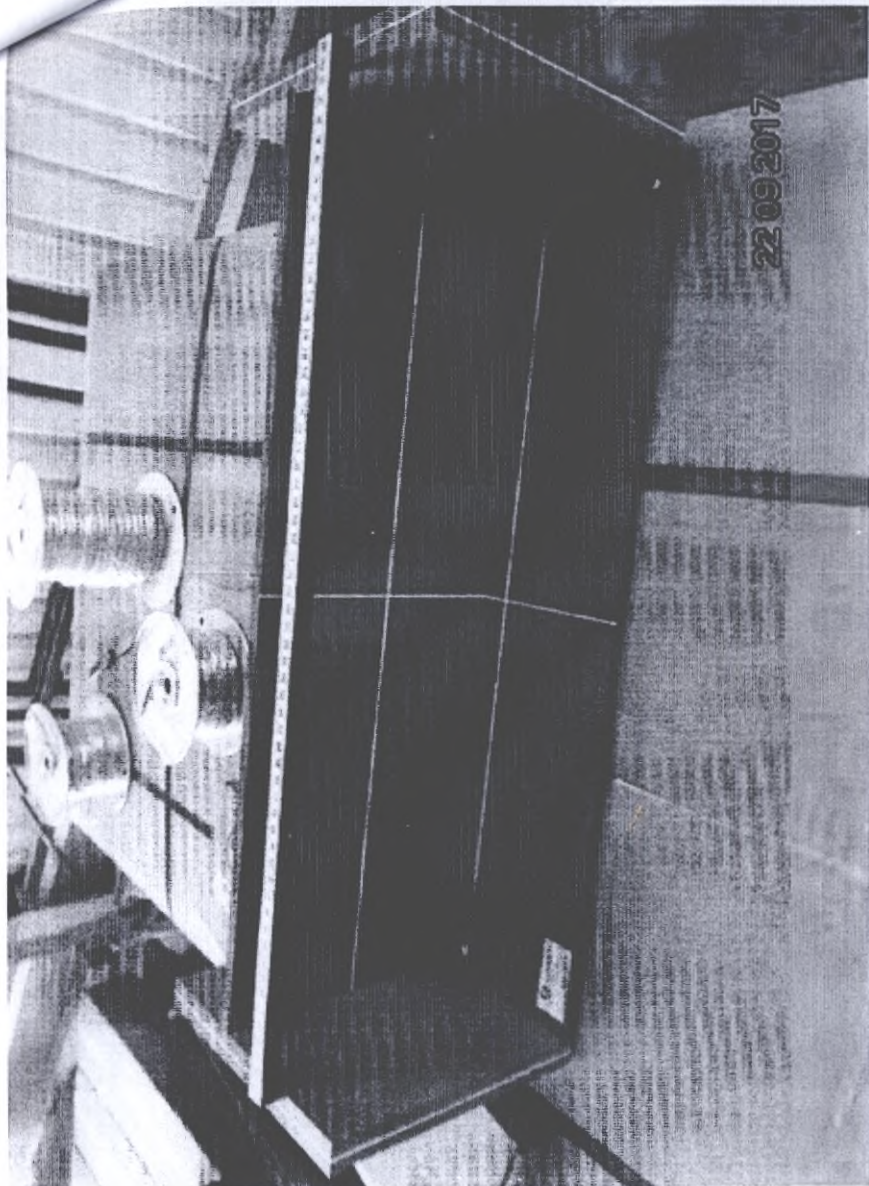

Калибровочный фланец

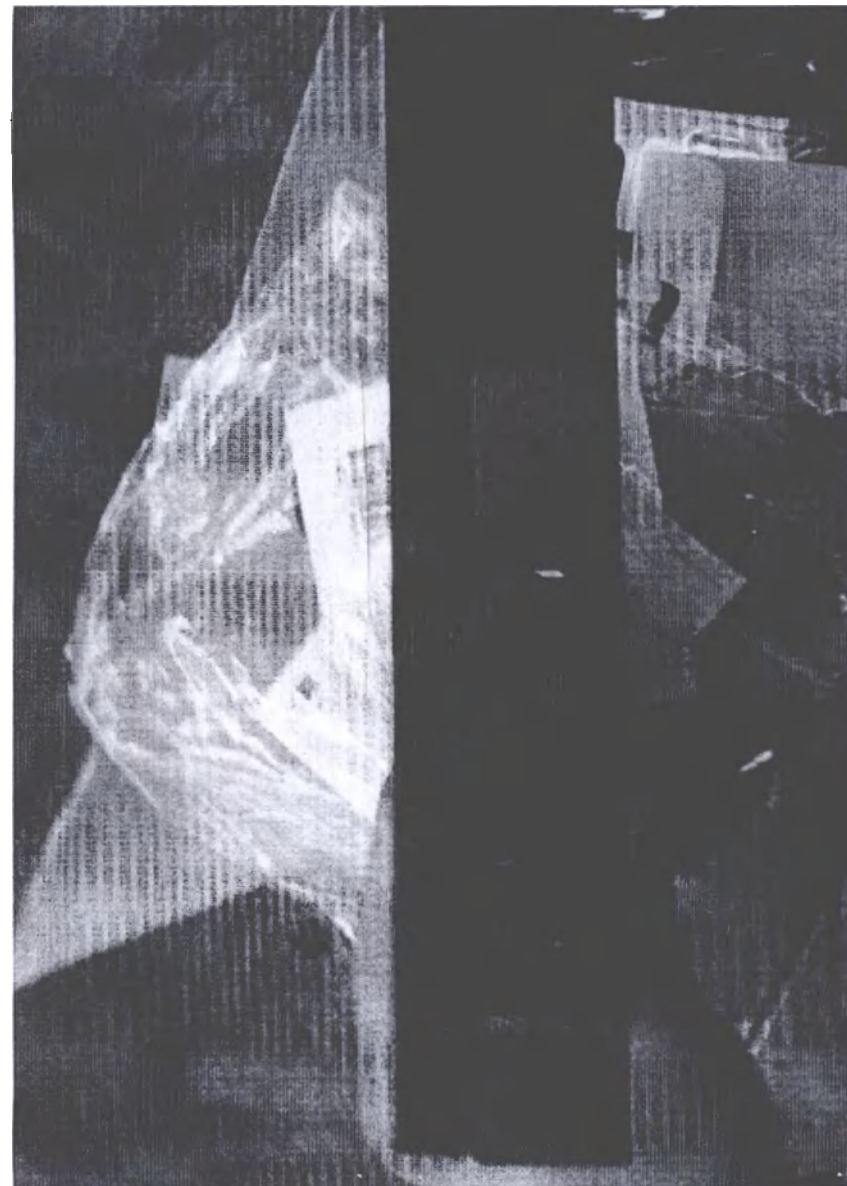

ПК с установленным программным обеспечением

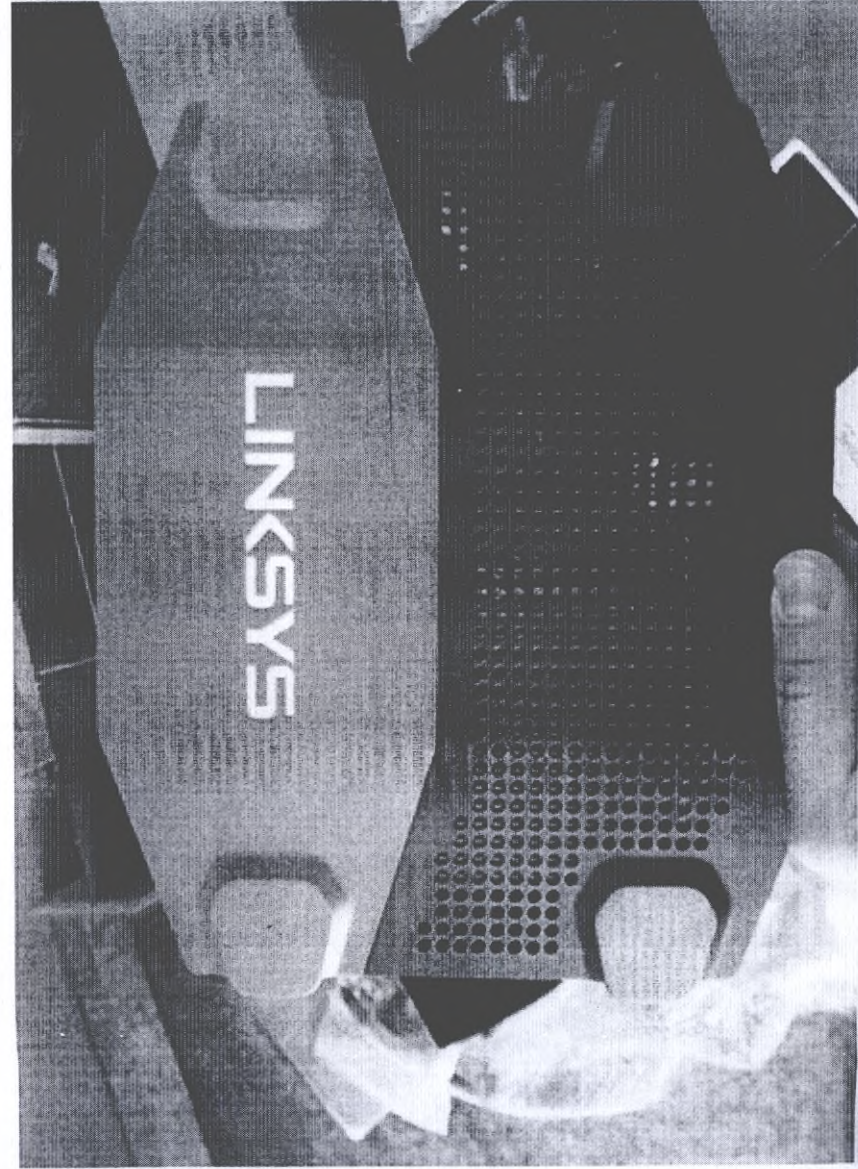

Ротер



Лазерный модуль ST Sim




Набор для монтажа: шайба, болт, коннекторы




Набор для монтажа: удлинительный антенный кабель



Набор для монтажа: кабель заземляющий

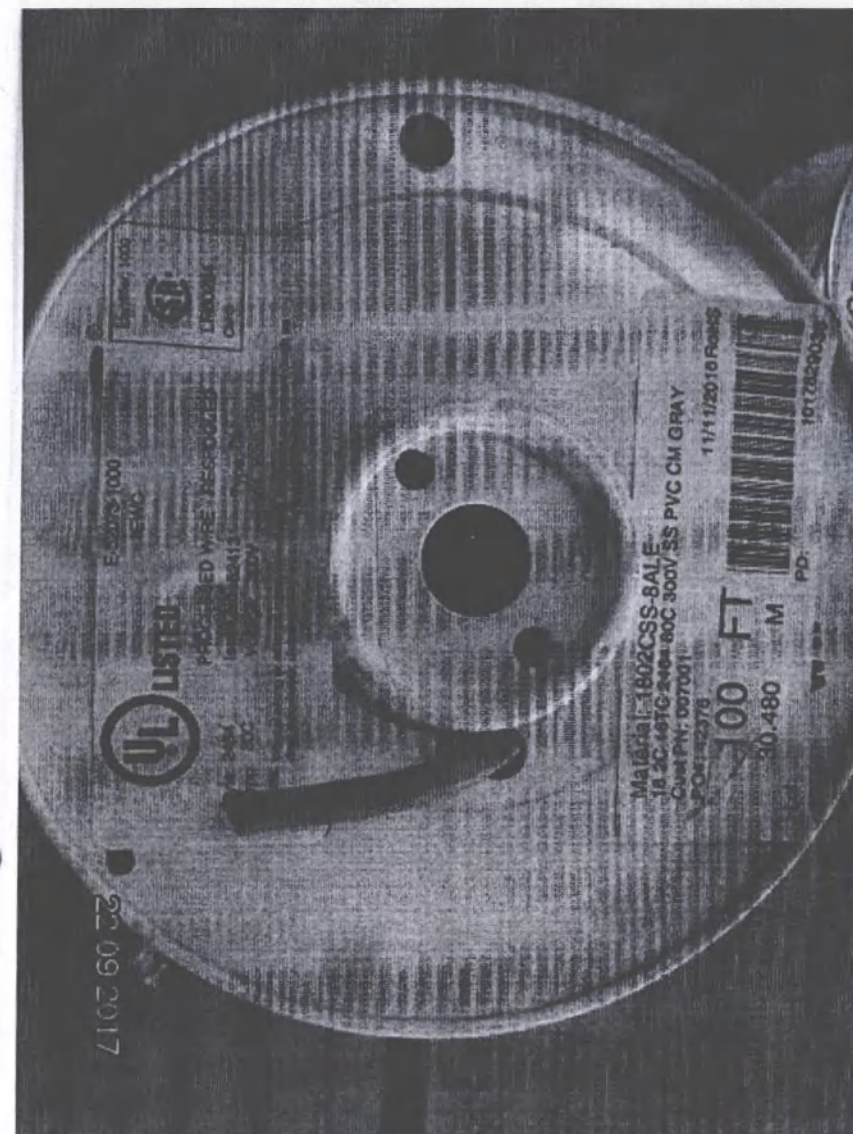

Набор для монтажа : кабель экранированный 3-х жильный с двойной изоляцией 18 А WG

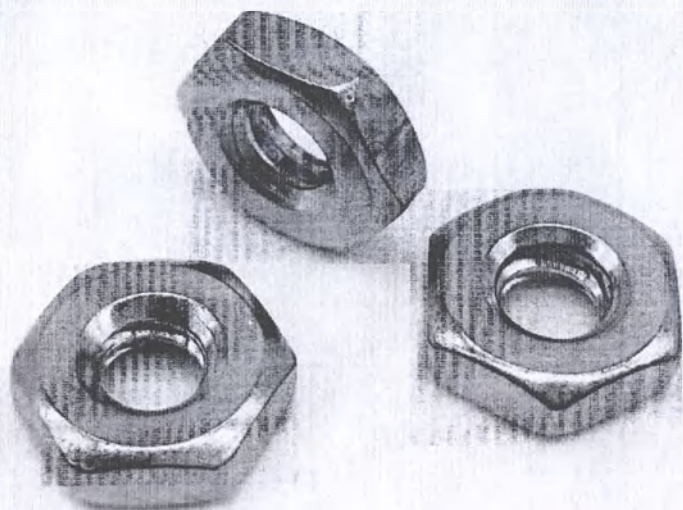


Набор для монтажа: Гайка кабельная круглая 18-22 А WG для заземляющего кабеля



Набор для монтажа: клемма кабельная круглая 18-22 А WG для заземляющего кабеля

Набор для монтажа: клемма кабельная круглая 10-12 А WG

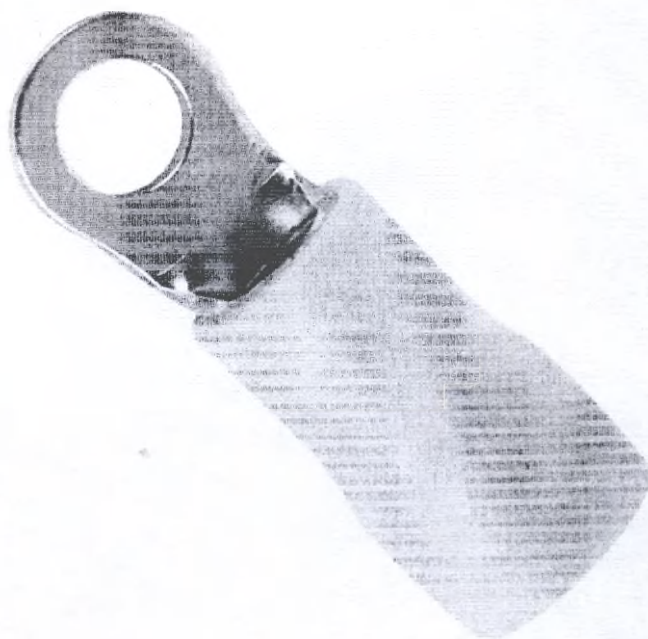

Сост
Недав
Необы
11541
Полн
ност
Аттек
Антт
Окисл

Сшито и заверено печатью
(Земельный) лист 66

М.С.С.
Генеральный директор
ООО «ИНТЕЛМЕД»
Колесникова С.З.