

St. Jude Medical, Inc.

Фотографические изображения
медицинского изделия

***Система для внутрисосудистого измерения
давления QUANTIEN с принадлежностями***


УТВЕРЖДАЮ




Генеральный директор ЗАО «ИМПЛАНТА»


Лутцев А.П.

« » 2017 г.

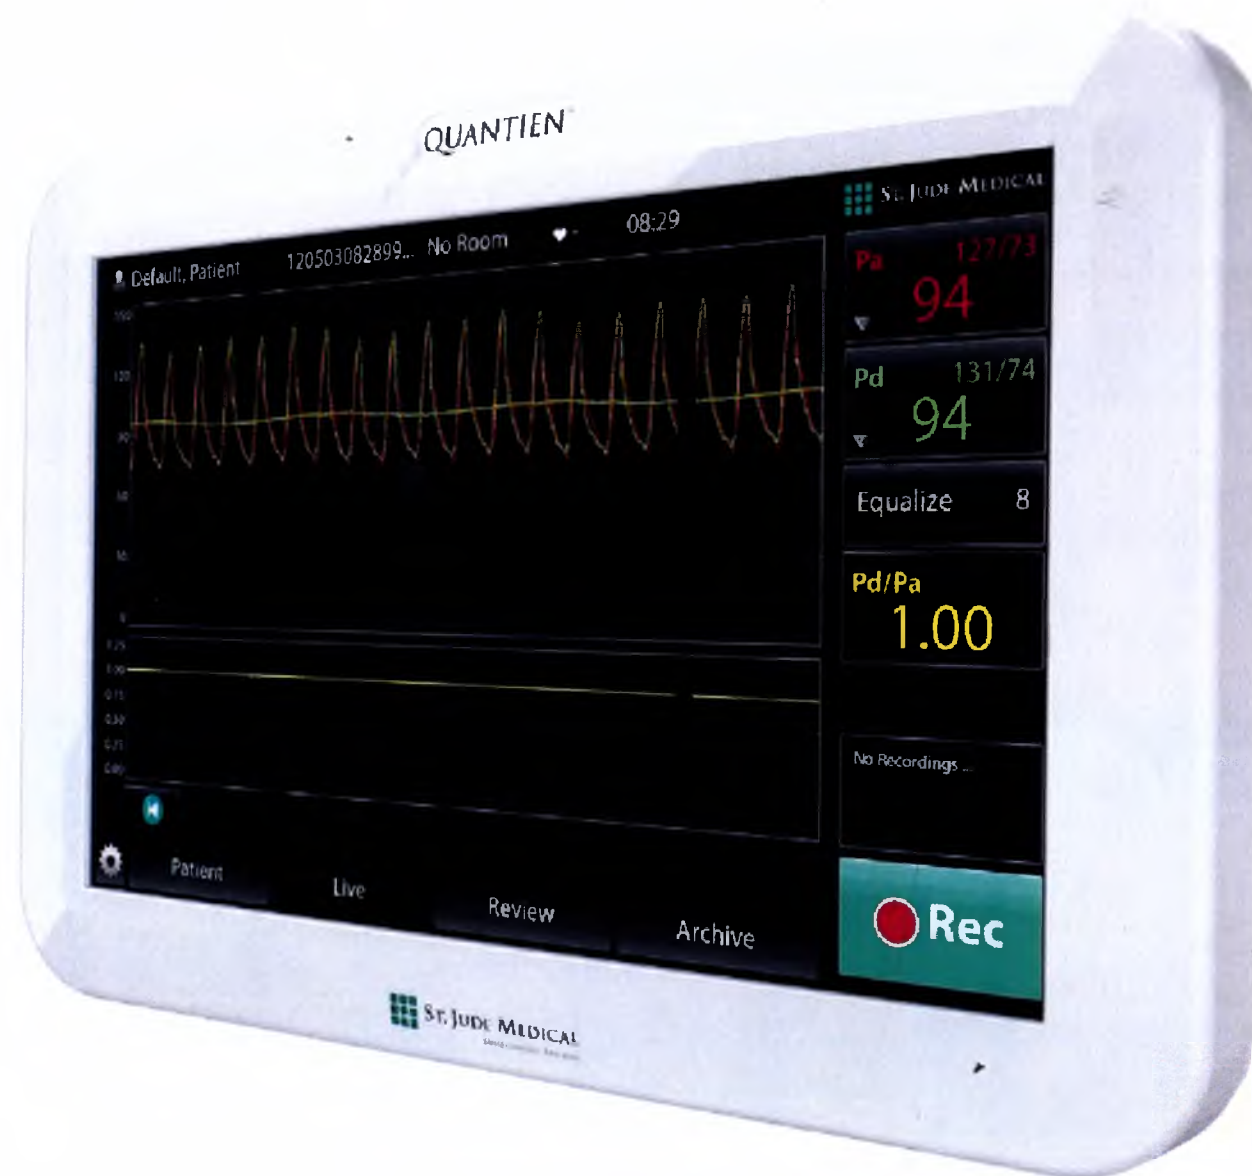

I. Состав: 1. Основной модуль.

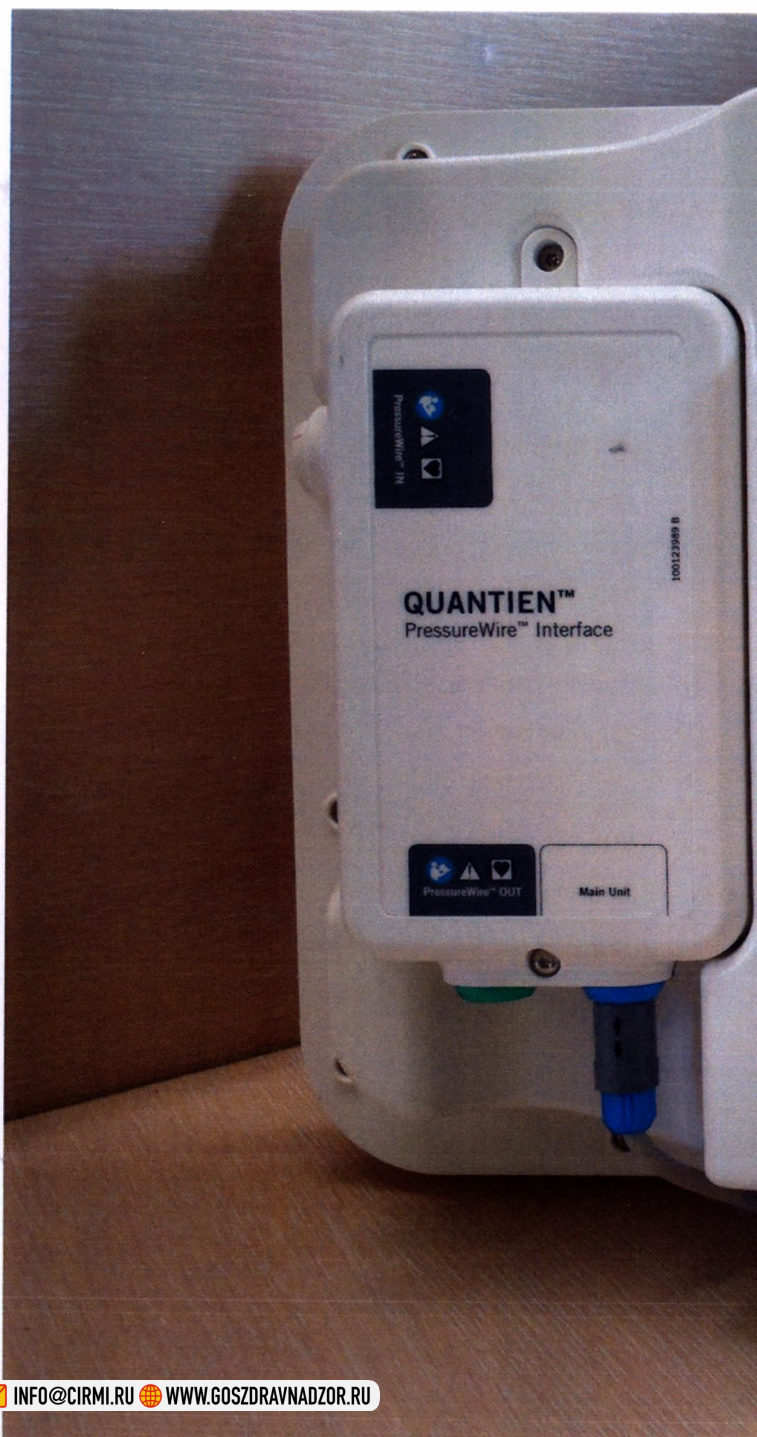

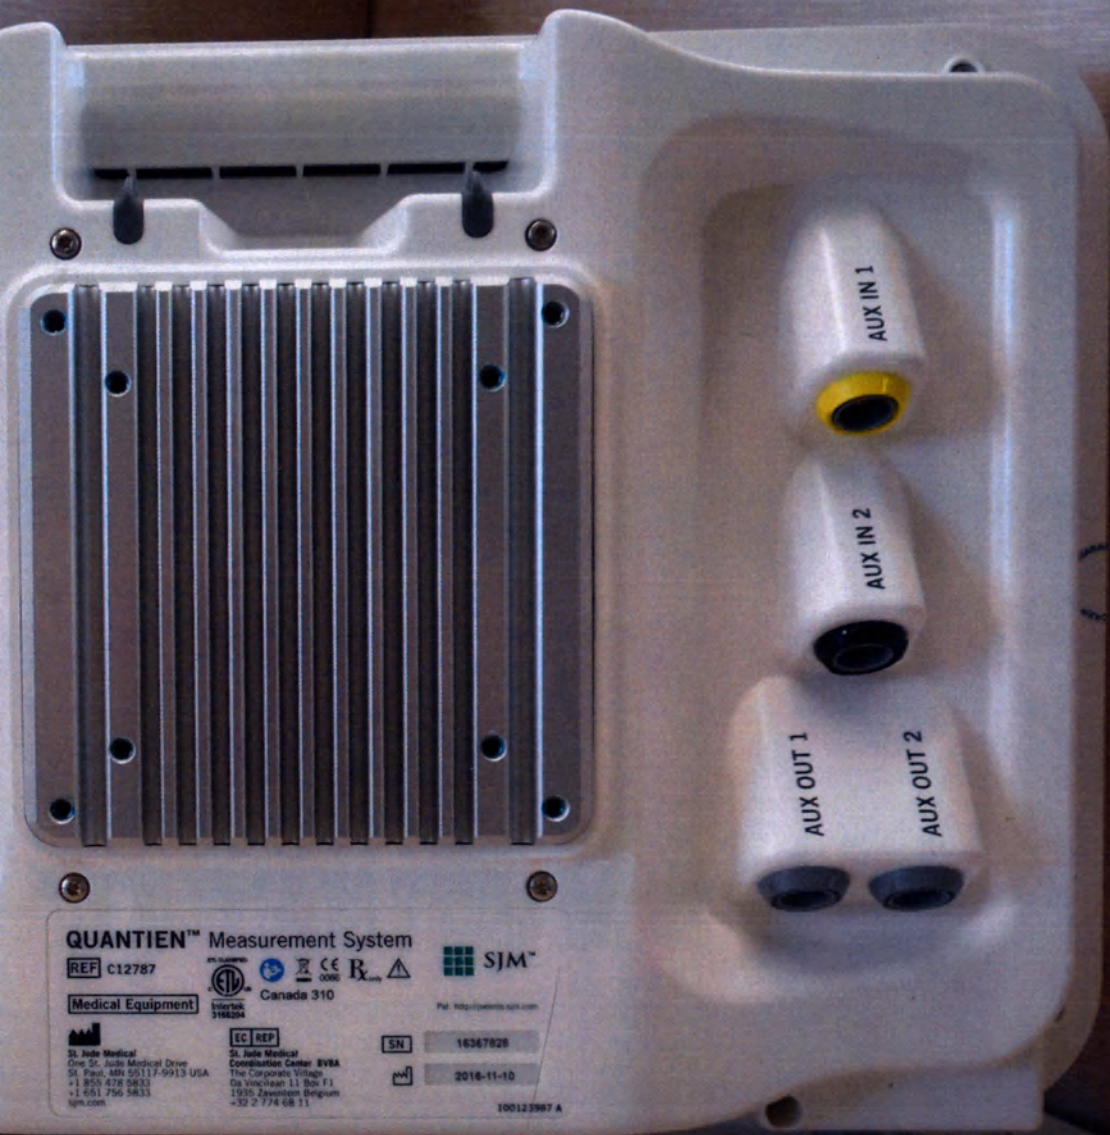

QUANTIEN™ Measurement System

REF C12787

Medical Equipment



Canada 310



Pub: <http://patients.sjm.com>



St. Jude Medical
One St. Jude Medical Drive
St. Paul, MN 55117-9913 USA
+1 855 478 5833
+1 651 796 5833
sjm.com

EC REP

St. Jude Medical
Compliance Center BVBA
The Corporate Village
De Vincennes 11, Box F1
1200, Zaventem, Belgium
+32 2 774 68 11

SN


16367828

MW

2018-11-10


100123987 A

2. Пульт дистанционного управления.

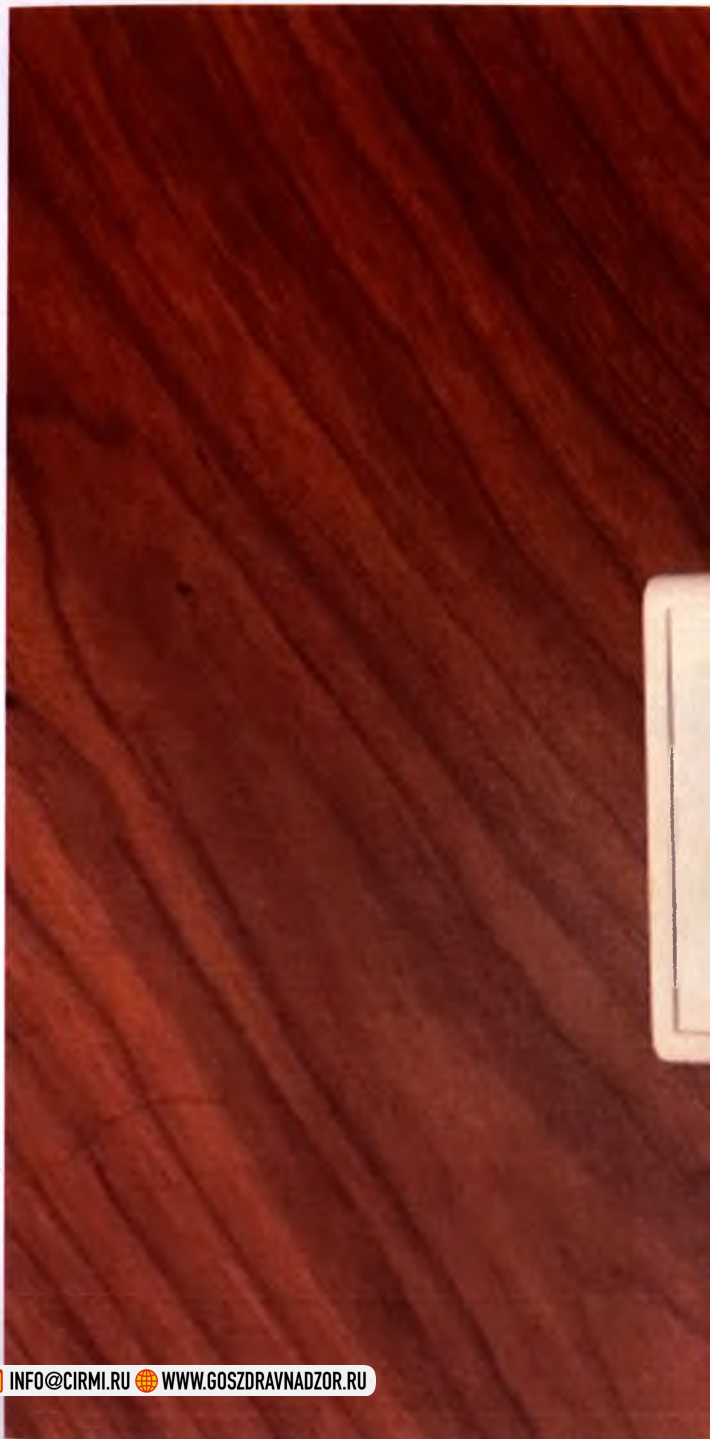





3. Блок питания для основного модуля.

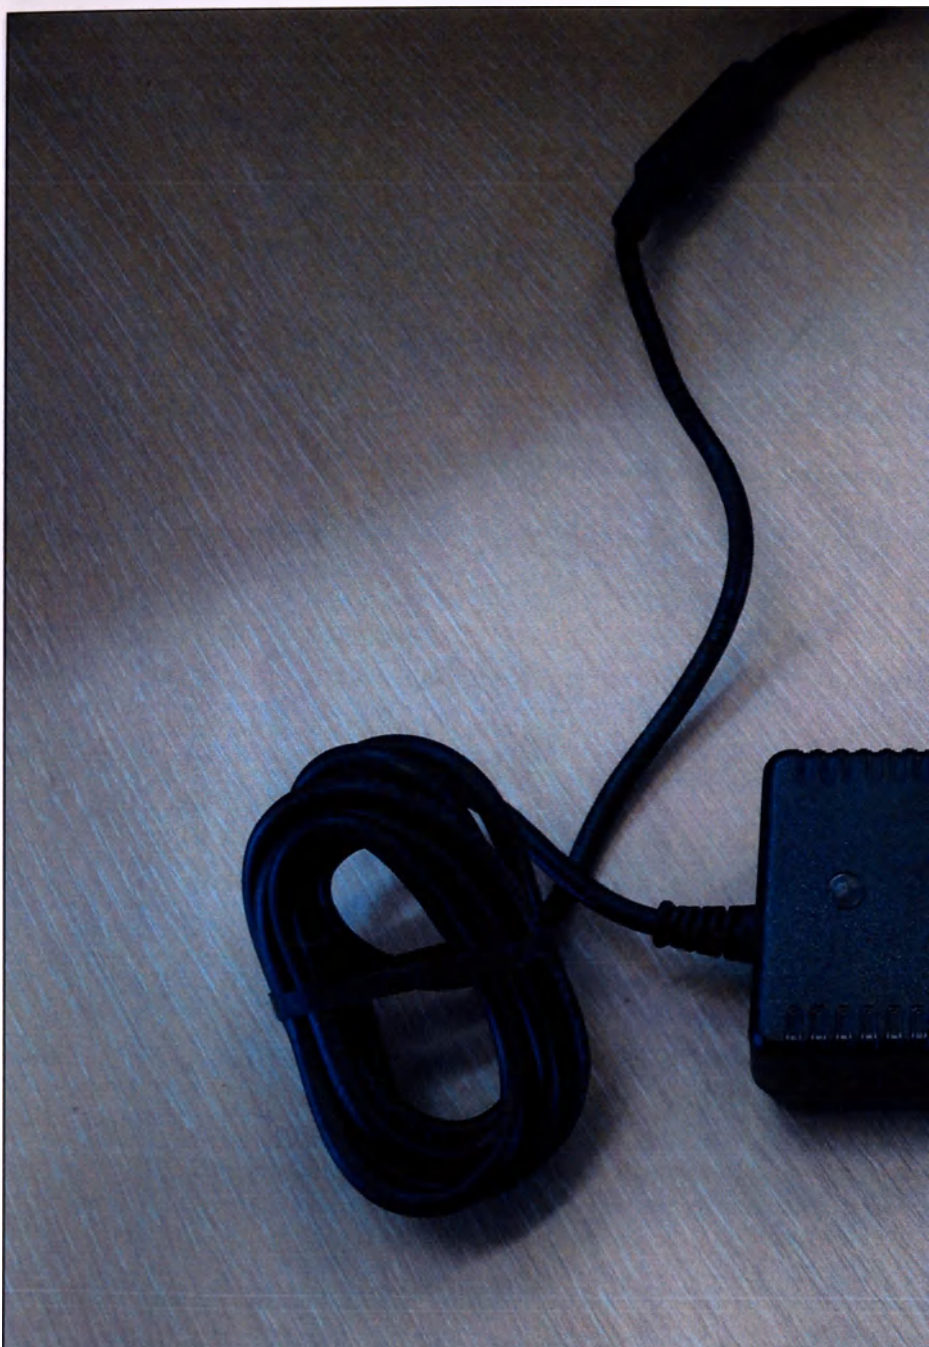




II. Принадлежности: 1. PressureWire Ресивер для приёма радиосигнала от трасмиттера с кронштейном для крепления.

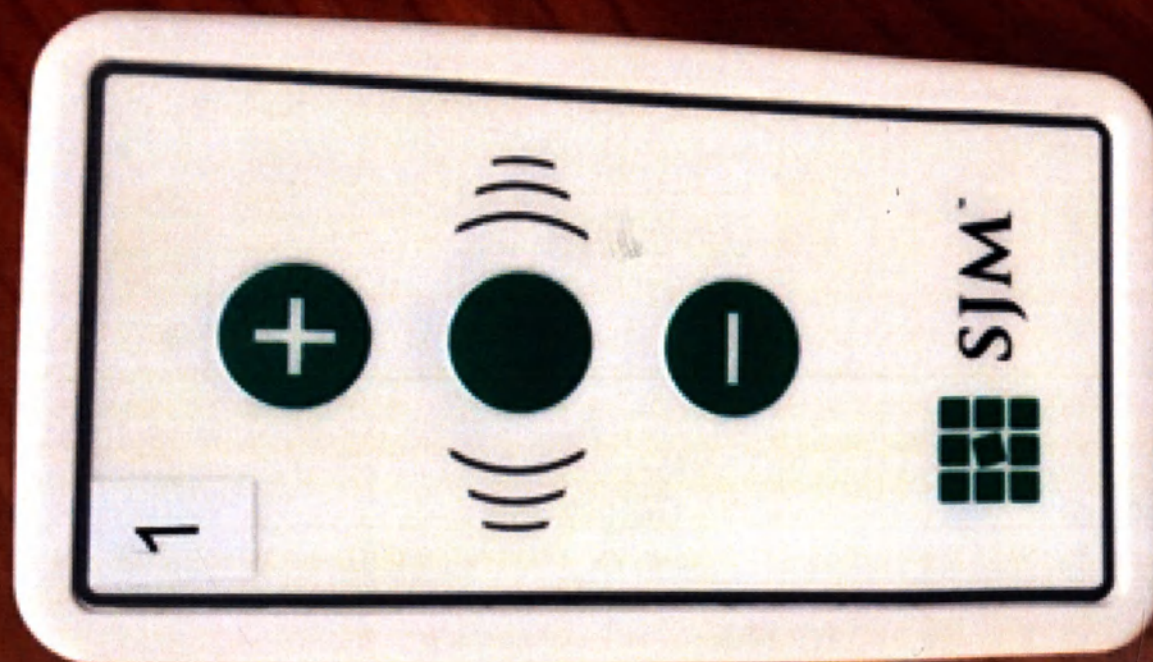

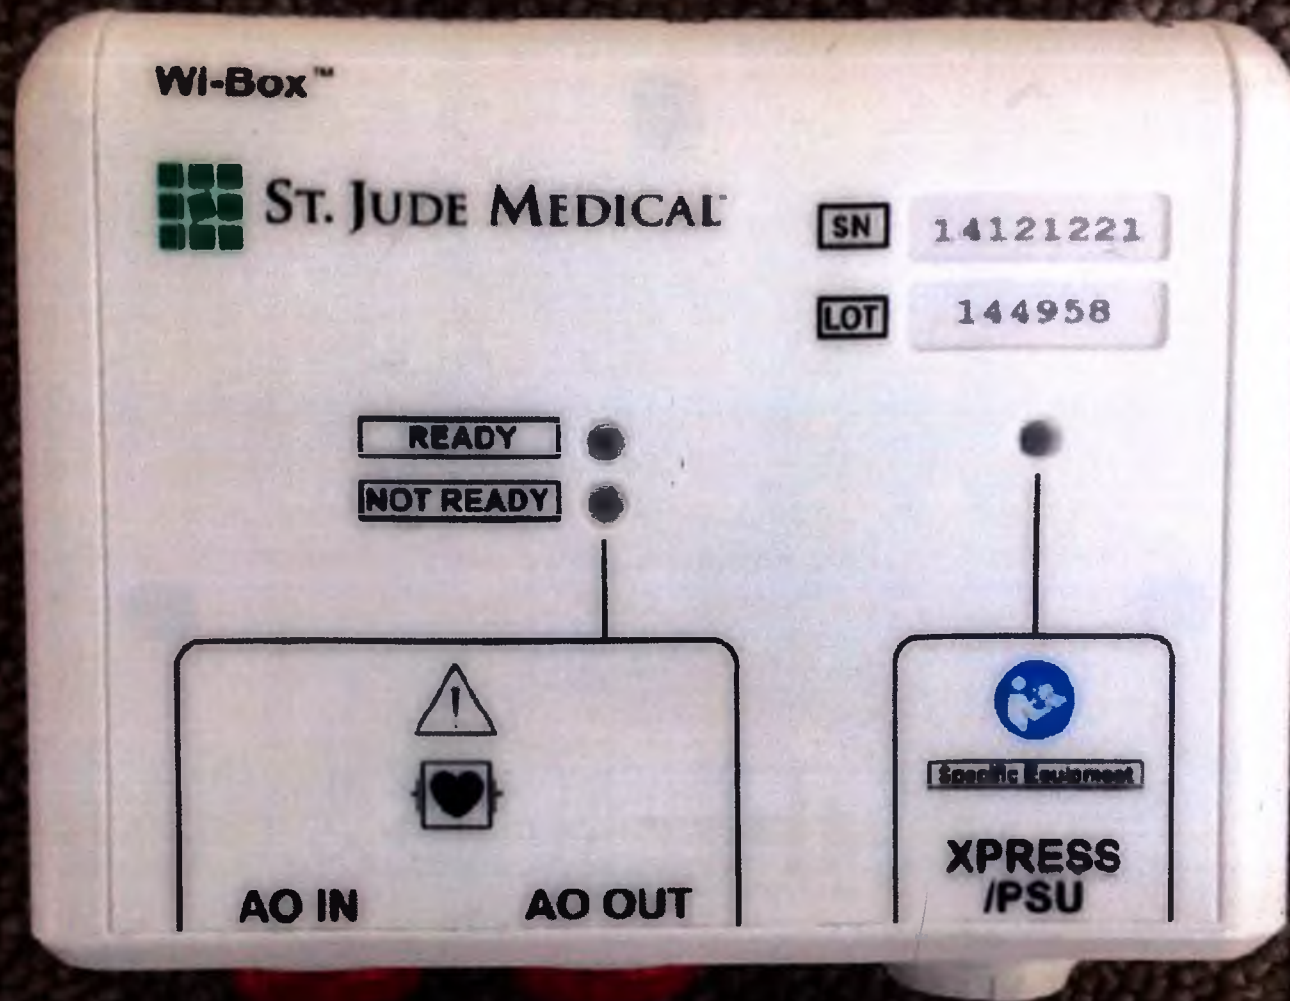

3. Блоки питания для модулей Wi-Вох в комплекте с пластиковой заглушкой (не более 10 шт.).

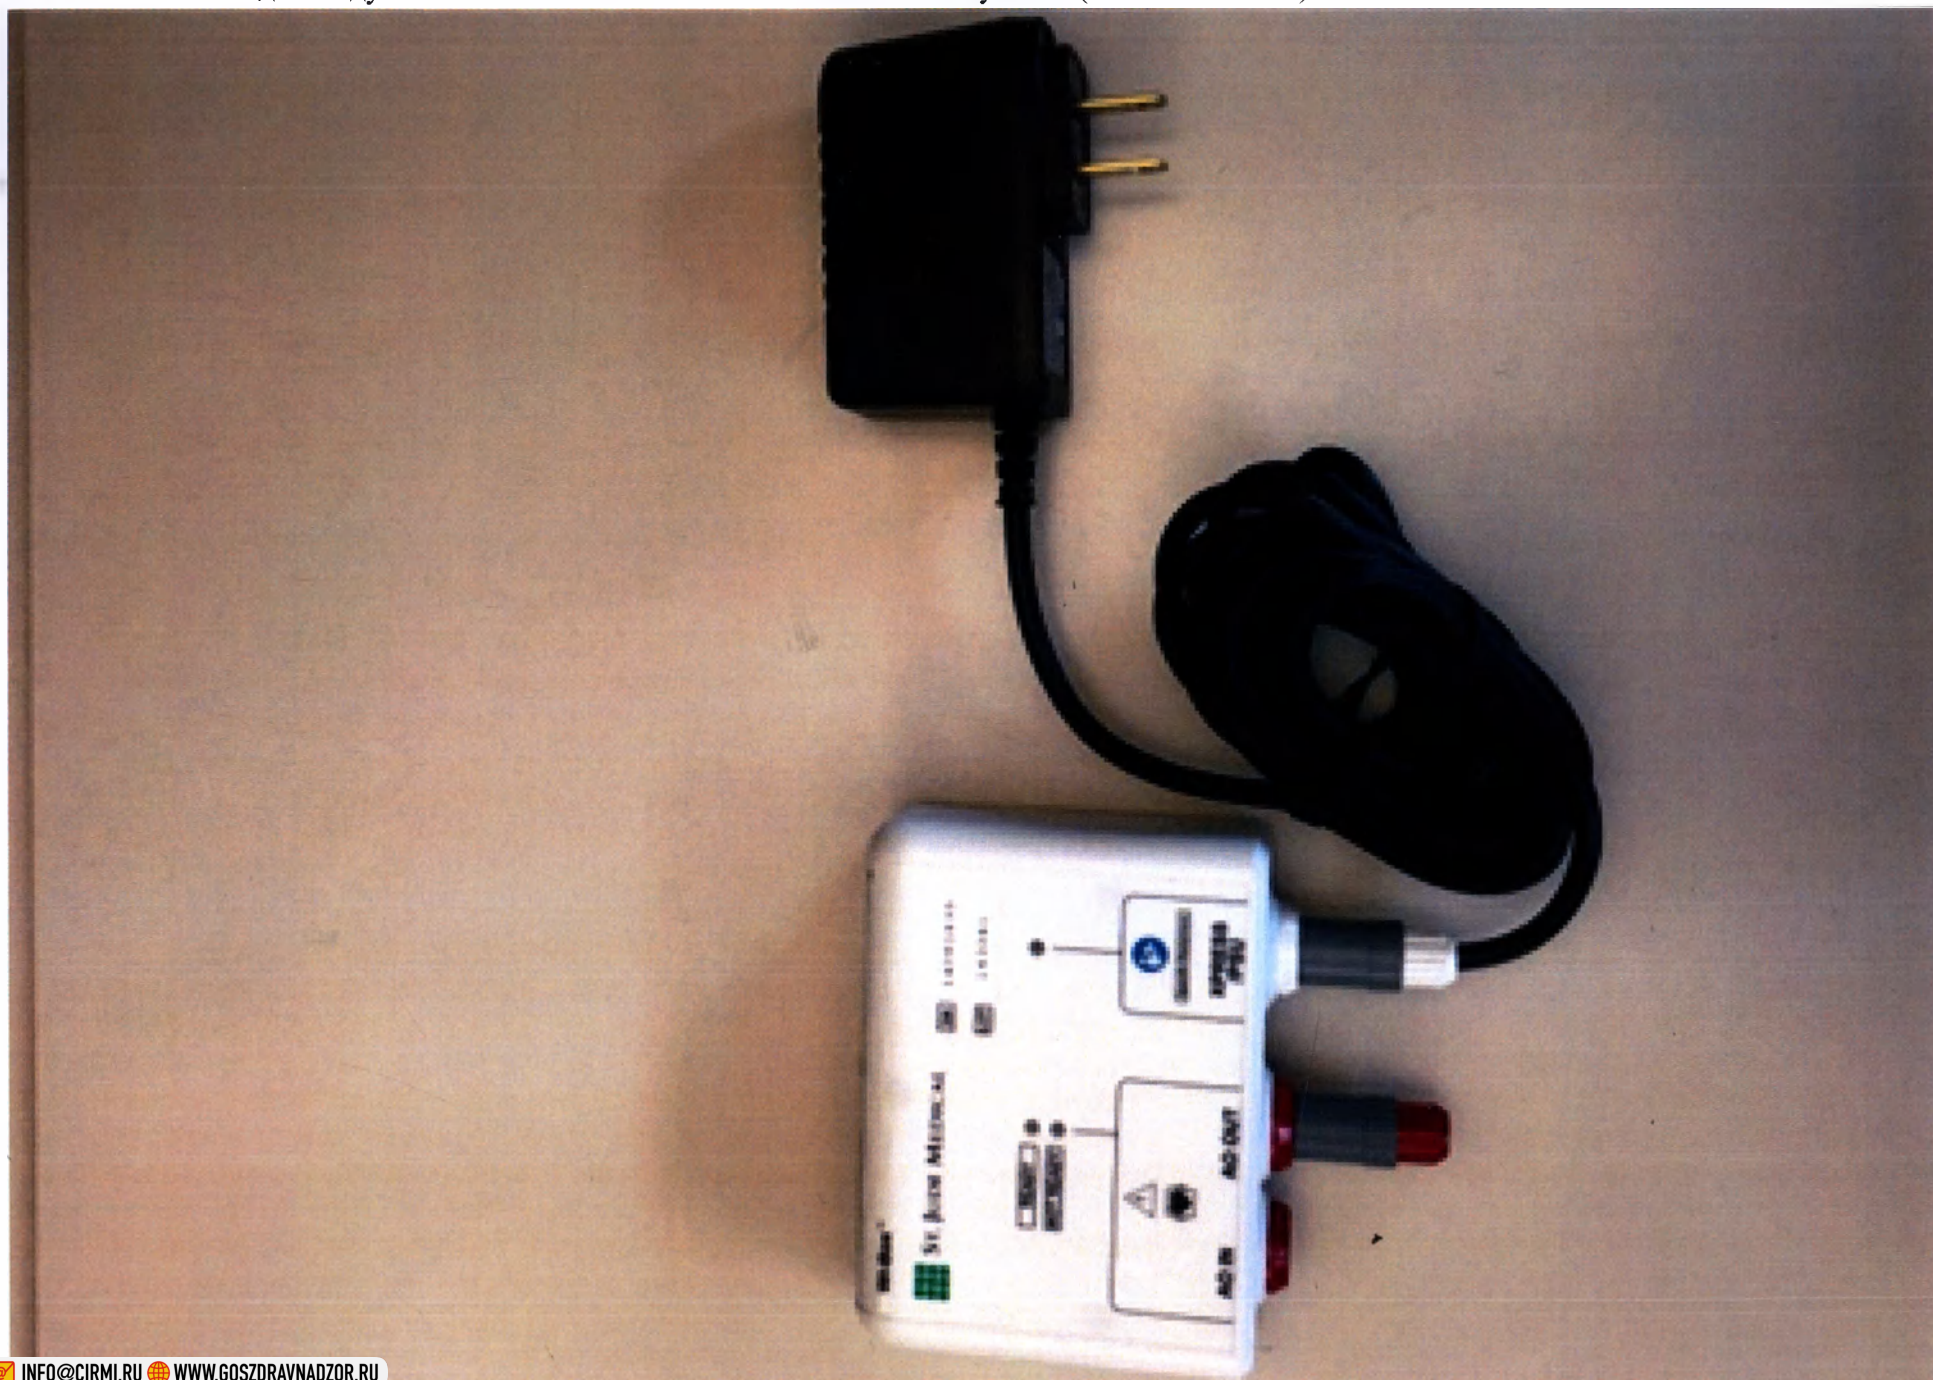

4. Кабели Wi-Box для подключения модуля Wi-Box к системе для внутрисосудистого измерения давления (не более 10 шт.).



5. Инсталляционные наборы RadiView Software Kit (руководство по эксплуатации).

RadiView™

INSTRUCTIONS FOR USE

 **ST. JUDE MEDICAL**
MORE CONTROL. LESS RISK.

7. Проводники для внутрисосудистого измерения давления PressureWire Certus (не более 10 шт.).




7. Проводники для внутрисосудистого измерения давления PressureWire Certus (не более 10 шт.).

PressureWire™ Certus™ Agile Tip

Guidewire Mounted Sensor

tr: Kılavuz Teline Monte Edilmiş Sensör

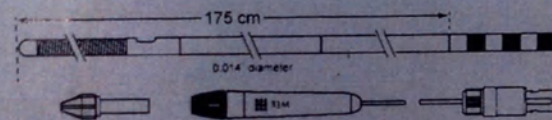

REF C12008



LOT 5859106




2017-02-15



2019-01-31

PressureWire™ Certus™




SJM™

REF C12008

LOT 5859106

PressureWire™ Certus™



SJM™

REF C12008

LOT 5859106

R_{ONLY}

CE
0086



STERILE EO



8. Проводники для внутрисосудистого измерения давления PressureWire Aeris (не более 10 шт.).





Проводники для внутрисосудистого
измерения давления PressureWire Aeris

Каталожный номер:	Серия/лот:	См. завод
C12058	Годен до:	упак.

Поставщик: ЗАО «Импланта»

Адрес: 119002 Москва, Караманский пер. 9

Тел: (495) 234-91-19 e-mail: info@implanta.ru




АЯ 46

PressureWire™ Aeris™ Agile Tip

Guidewire Mounted Sensor

Yol Kılavuz Taahhüt Montaj Edilmiş Sensör



REF C12058

LOT 5820498

2017-01-20

2018-12-31

PressureWire™ Aeris™

(01)05414734055772(17)181231(10)5820498

REF C12058

LOT 5820498

PressureWire™ Aeris™

(01)05414734055772(17)181231(10)5820498

REF C12058

LOT 5820498

R_x ONLY



CE
0086

-25°C

100%

STERILE EO

RECOGNIZED COMPONENT



Canada 310

201-140058

FCC ID: U4L2

IC: 8466A-2

Pat. <http://patents.sjm.com>

GTIN 05414734055772

(01)05414734055772(17)181231(10)5820498


St. Jude Medical
5050 Nathan Lane North
Plymouth, MN
55442 USA

ST. JUDE MEDICAL

1001200700

9. Проводники для внутрисосудистого измерения давления PressureWire X (не более 10 шт.).



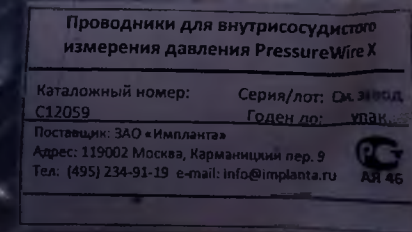

QUANTIENT™
Measurement System

INSTRUCTIONS FOR USE



ST. JUDE MEDICAL

QUANTIEN™
Measurement System

Инструкция по эксплуатации

 ST. JUDE MEDICAL

11. Сервисная инструкция.

Производитель:
St. Jude Medical
One St. Jude Medical Drive
St. Paul, MN 55117-9913 USA (США)
+1 855 478 5833
+1 651 756 5833

Официальное представительство в Европе:
St. Jude Medical
Coordination Center BVBA
The Corporate Village
De Vincleaan 11 Box F1
1935 Zaventem
Бельгия
+32 2 774 68 11

Австралийский спонсор:
St. Jude Medical Australia Pty. Limited
17 Orion Road
Lane Cove NSW 2066
Австралия

sjm.com



ST. JUDE MEDICAL



ARTRU100124638



2015-02
ARTRU100124638 A



0086
2014

12. Кабели электропитания (3 шт.).





12. Кабели электропитания (3 шт.).





Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
24.12.2019 листов
Закрытое акционерное общество «ИМПЛАНТА»
Генеральный директор Лутцев А.П.

