

Руководитель отдела качества
и корпоративных технологий
ООО «Сименс Здравоохранение»



Медведева И.Б.

2020 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO**

**Набор реагентов для определения тиреотропного гормона на анализаторах
иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Thyroid Stimulating Hormone 3-Ultra (Atellica
IM TSH3-UL))**

производства «Сименс Хелскеа Диагностикас Инк.», Siemens Healthcare Diagnostics Inc., США



Рисунок 1. Набор реагентов для определения тиреотропного гормона на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Thyroid Stimulating Hormone 3-Ultra (Atellica IM TSH3-UL)). Общий вид

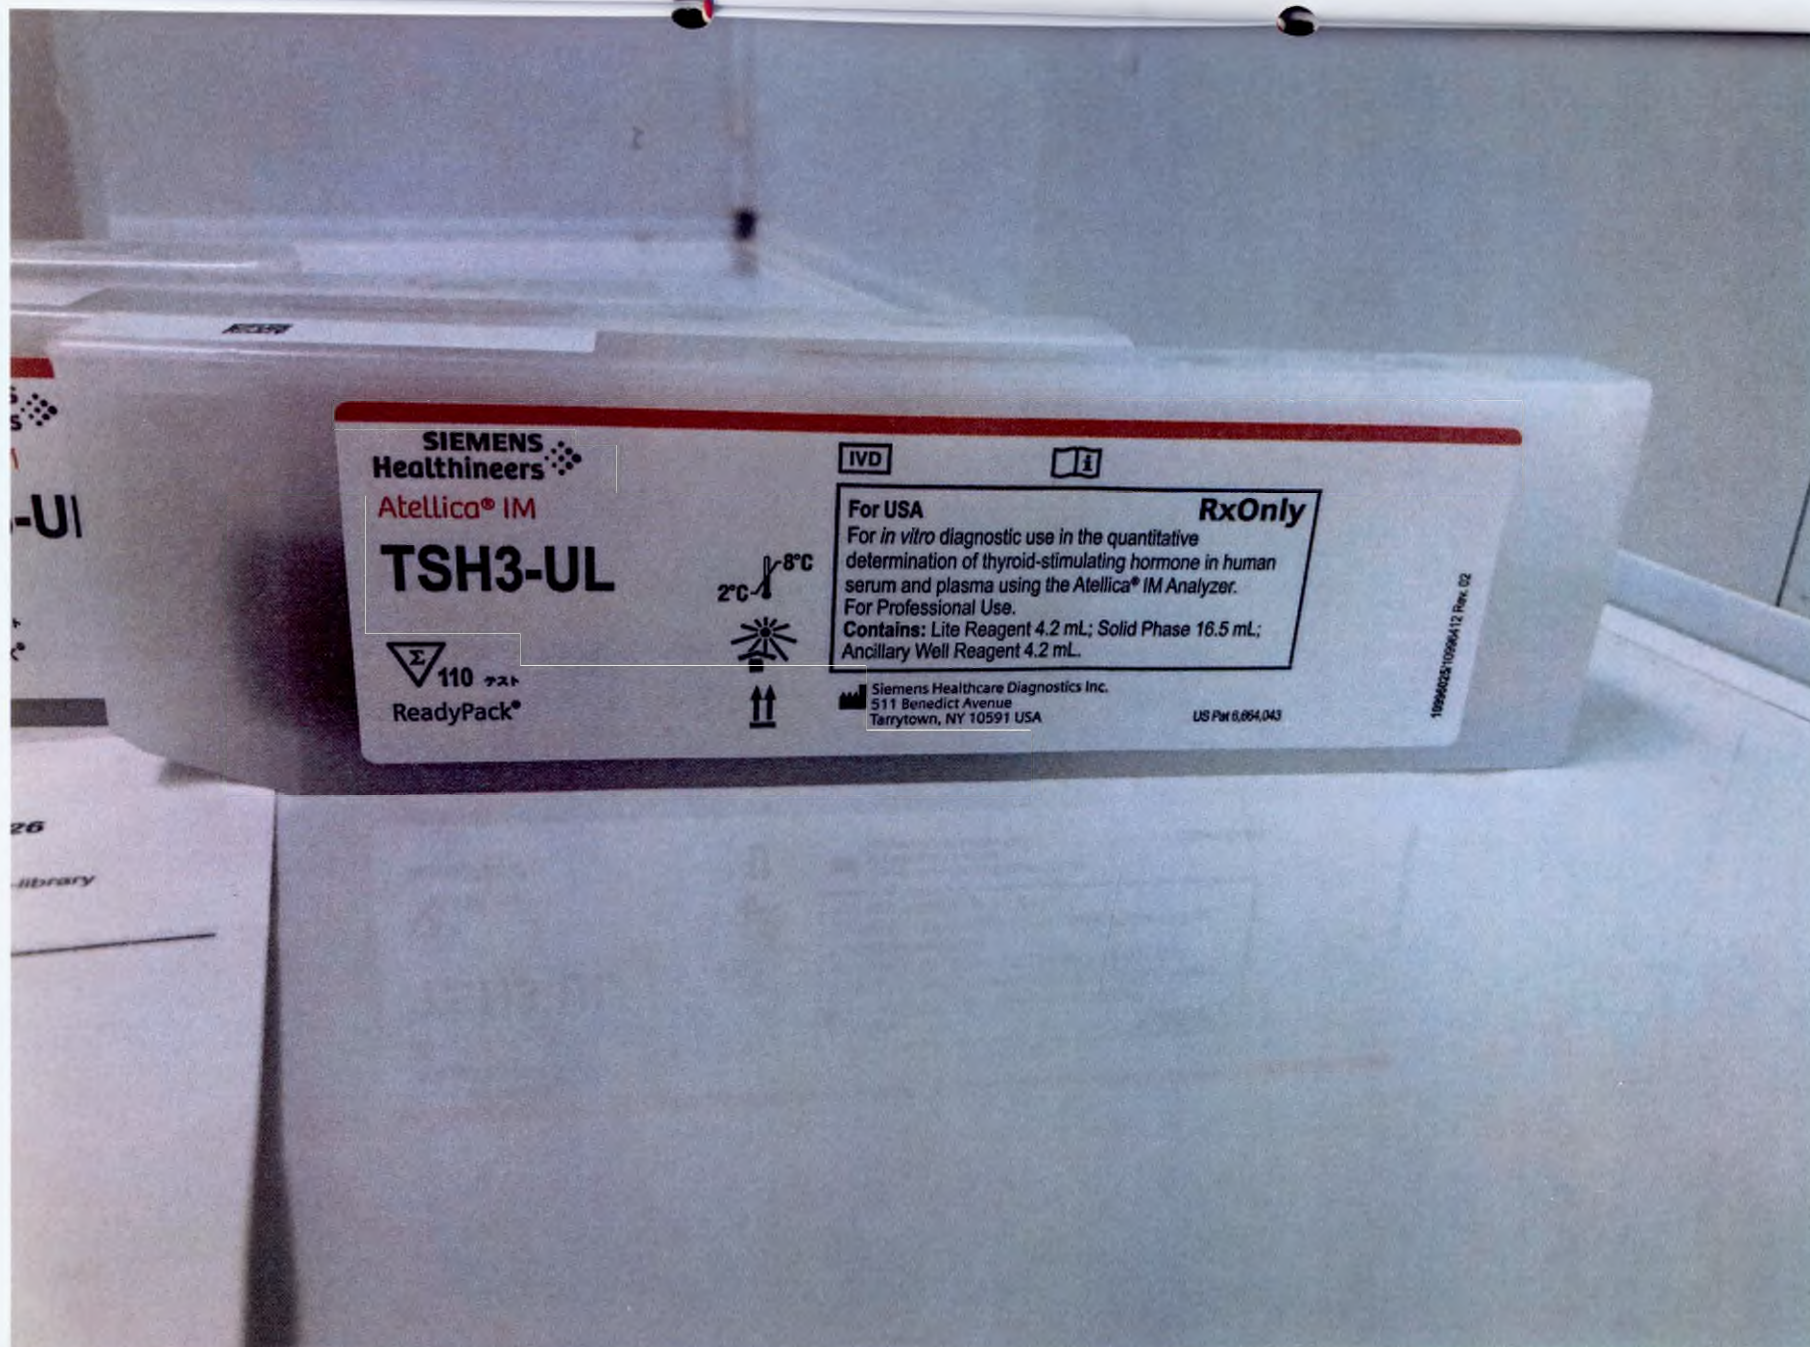


Рисунок 2. Набор реагентов для определения тиреотропного гормона на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Thyroid Stimulating Hormone 3-Ultra (Atellica IM TSH3-UL)): Основной реагент Atellica IM TSH3-UL

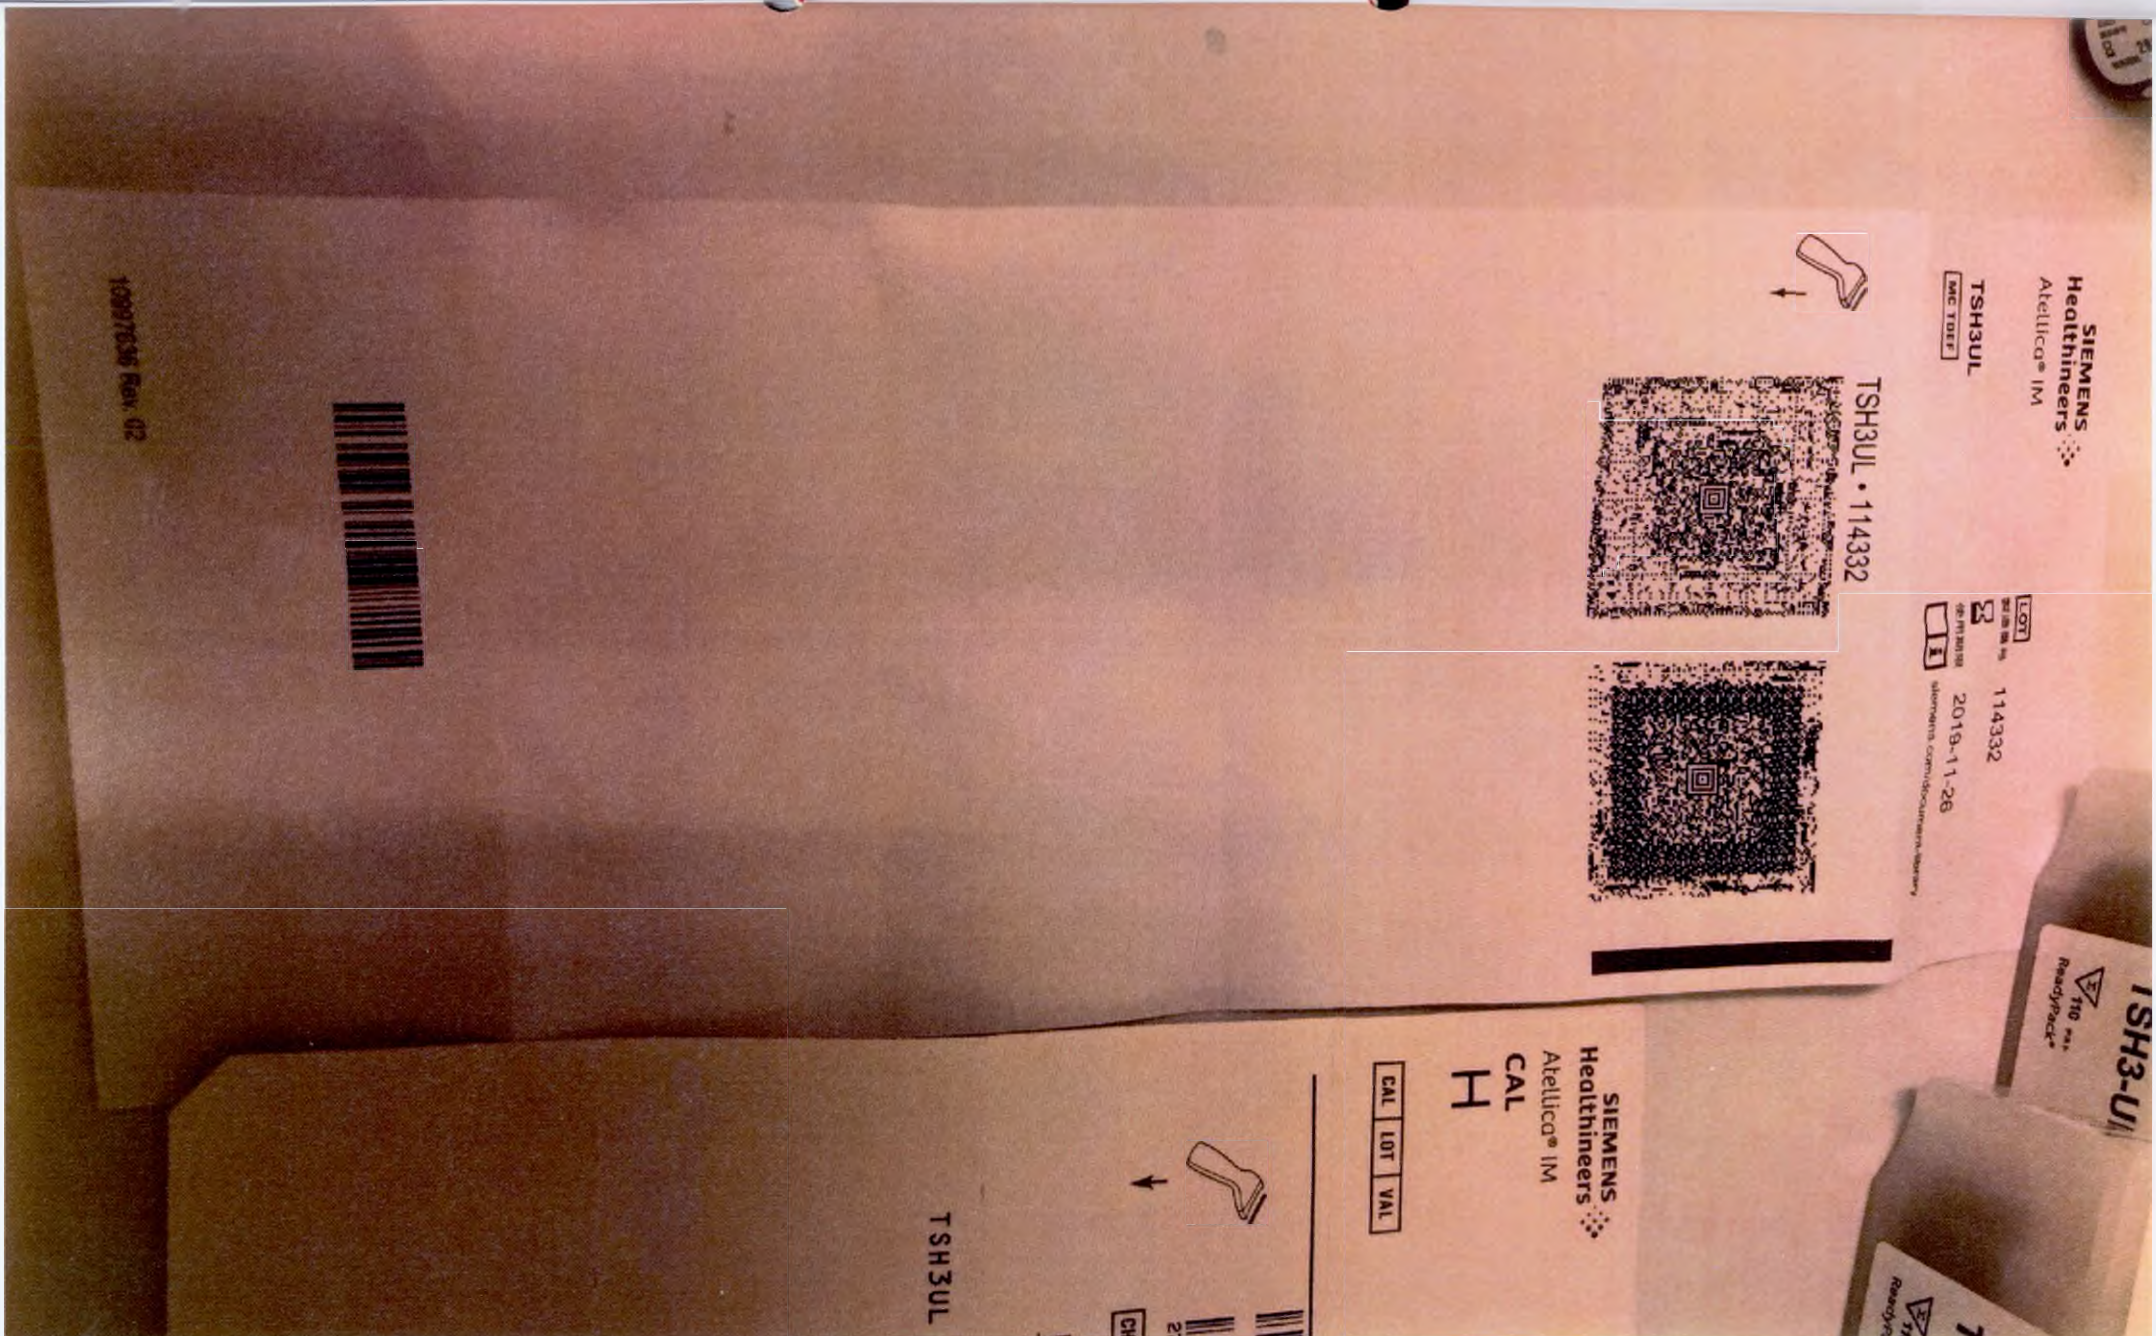


Рисунок 3. Набор реагентов для определения тиреотропного гормона на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Thyroid Stimulating Hormone 3-Ultra (Atellica IM TSH3-UL)): Вкладыш со штрих-кодом MC TDEF для Atellica IM TSH3-UL

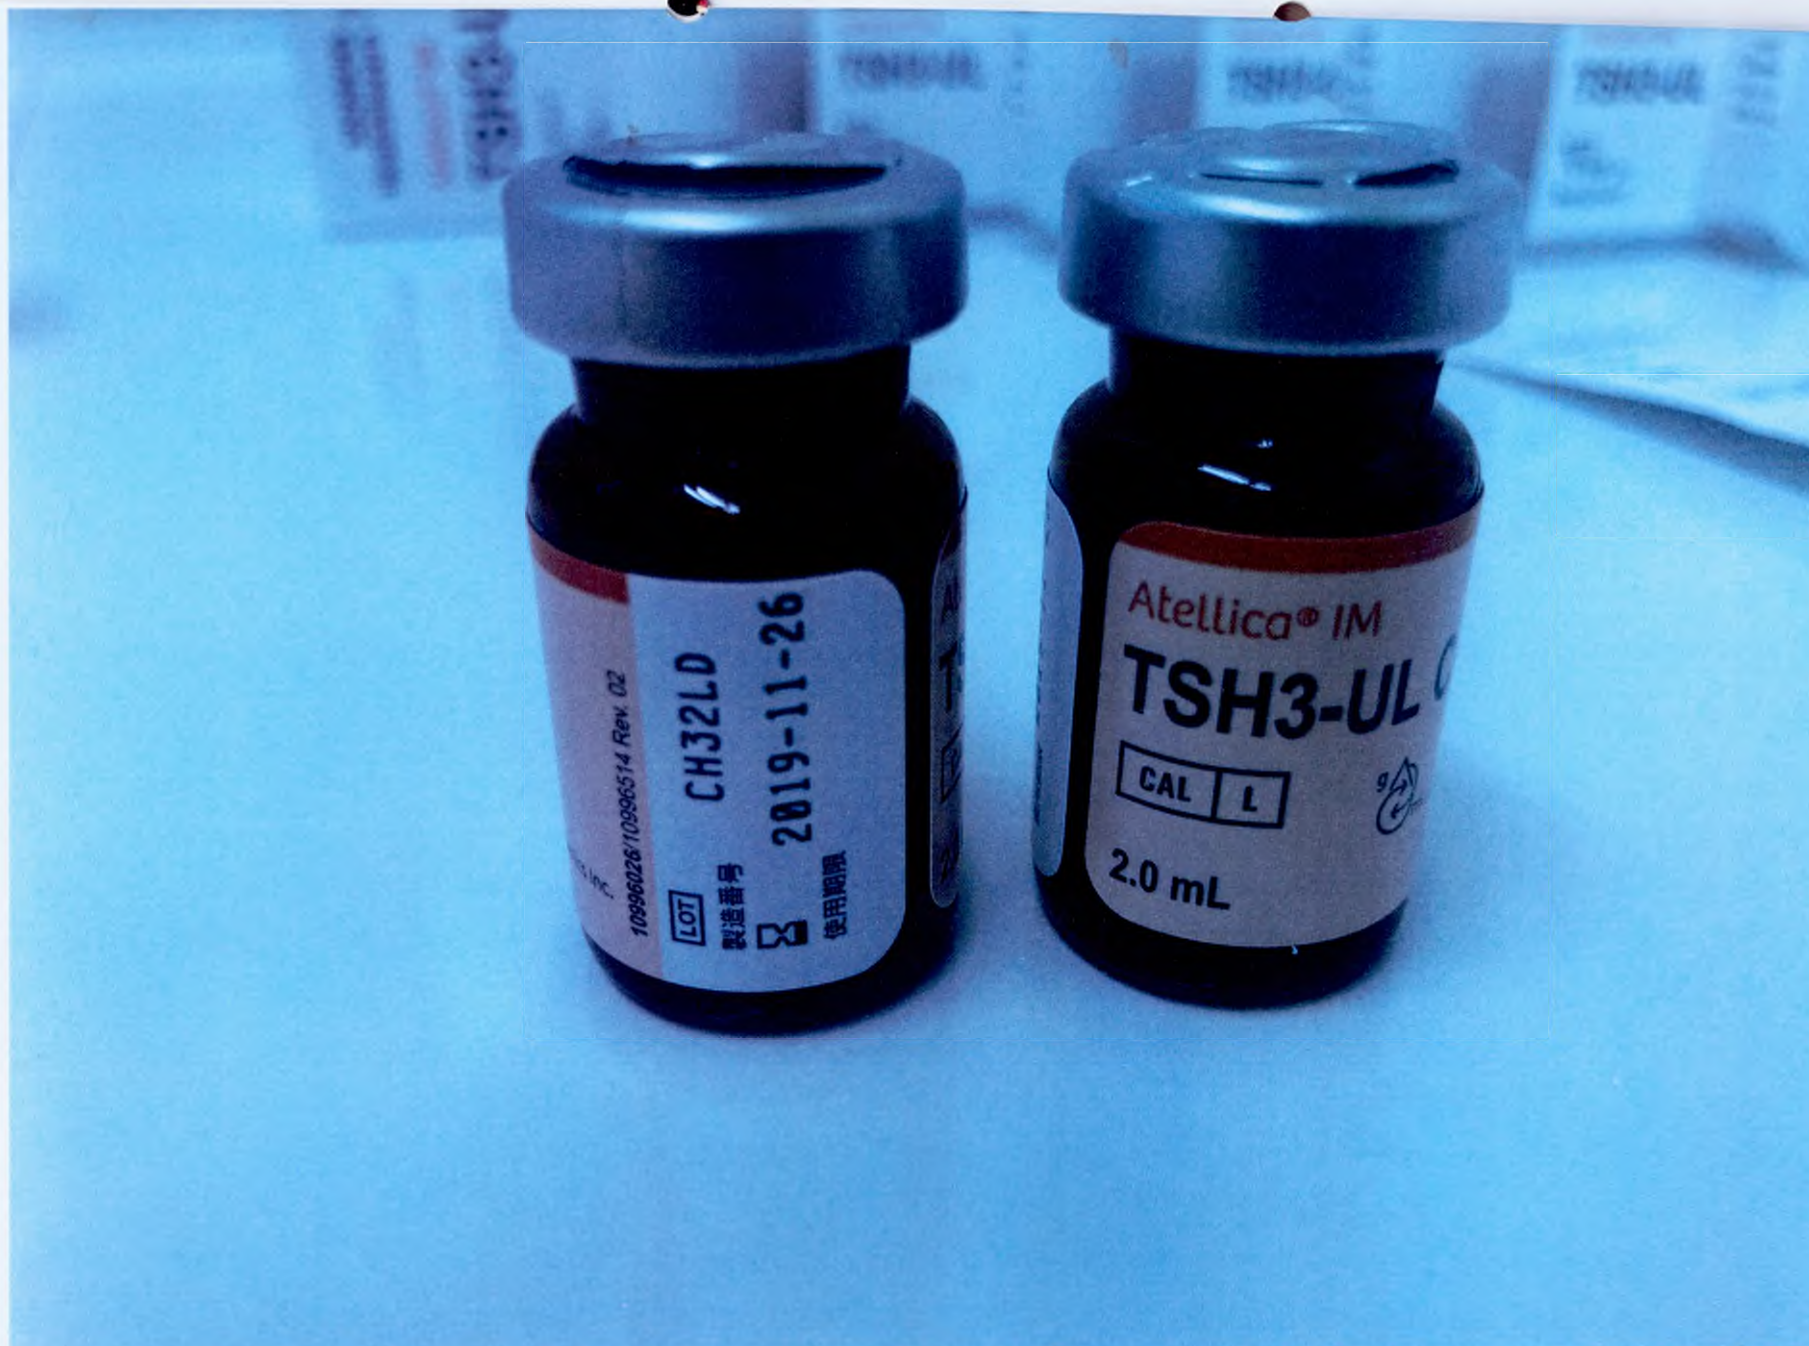


Рисунок 4. Набор реагентов для определения тиреотропного гормона на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Thyroid Stimulating Hormone 3-Ultra (Atellica IM TSH3-UL)): Калибратор с низкой концентрацией Atellica IM TSH3-UL CAL L, 2 мл



Рисунок 5. Набор реагентов для определения тиреотропного гормона на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Thyroid Stimulating Hormone 3-Ultra (Atellica IM TSH3-UL)): Калибратор с высокой концентрацией Atellica IM TSH3-UL CAL H, 2 мл

SIEMENS
Healthineers

Atellica® IM

CAL

H

CAL LOT VAL

LOT

製造番号



使用期限



CH32

2019-11-26

siemens.com/document-library



2795dc70

CHECKSUM

CAL L

UNITS C

UNITS SI

CAL H

UNITS C

UNITS SI

TSH3UL



0.03 UIU/ML 0.03 MIU/L 103 UIU/ML 103 MIU/L

10567640 Rev. 02

Рисунок 6. Набор реагентов для определения тиреотропного гормона на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Thyroid Stimulating Hormone 3-Ultra (Atellica IM TSH3-UL)): Лист значений параметров серии калибратора

Всего прошито и пронумеровано 4 листа (ов).
ООО «Сименс Здравоохранение»

