

Руководитель группы регистрации
ООО «Сименс Здоровоохранение»



Горшкова Н.А.

2021 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO**

**Набор реагентов для определения антител к *Treponema pallidum* на анализаторах
иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Syphilis (Atellica IM Syph))**

производства «Сименс Хелскеа Диагностикс Инк.», Siemens Healthcare Diagnostics Inc., США



Рисунок 1. Набор реагентов для определения антител к *Treponema pallidum* на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Syphilis (Atellica IM Syph)).
Общий вид

10995676 Набор реагентов для определения антител к *Treponema pallidum* на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Syphilis (Atellica IM Syph))

Информация о производителе и стране происхождения см. на упаковке

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/0239 от 14.05.2020

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO
Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на оригинальной упаковке

Инструкция по применению на русском языке Rev. 04
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют
Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению
Авторизованный представитель изготовителя на территории Российской Федерации
ООО «Симено Здоровоохранение», 116093, Москва, ул. Дубининская, 96

SIEMENS
Healthineers

Atellica® IM
Syph

Рисунок 2. Набор реагентов для определения антител к *Treponema pallidum* на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Syphilis (Atellica IM Syph)).
Маркировка для Российской Федерации

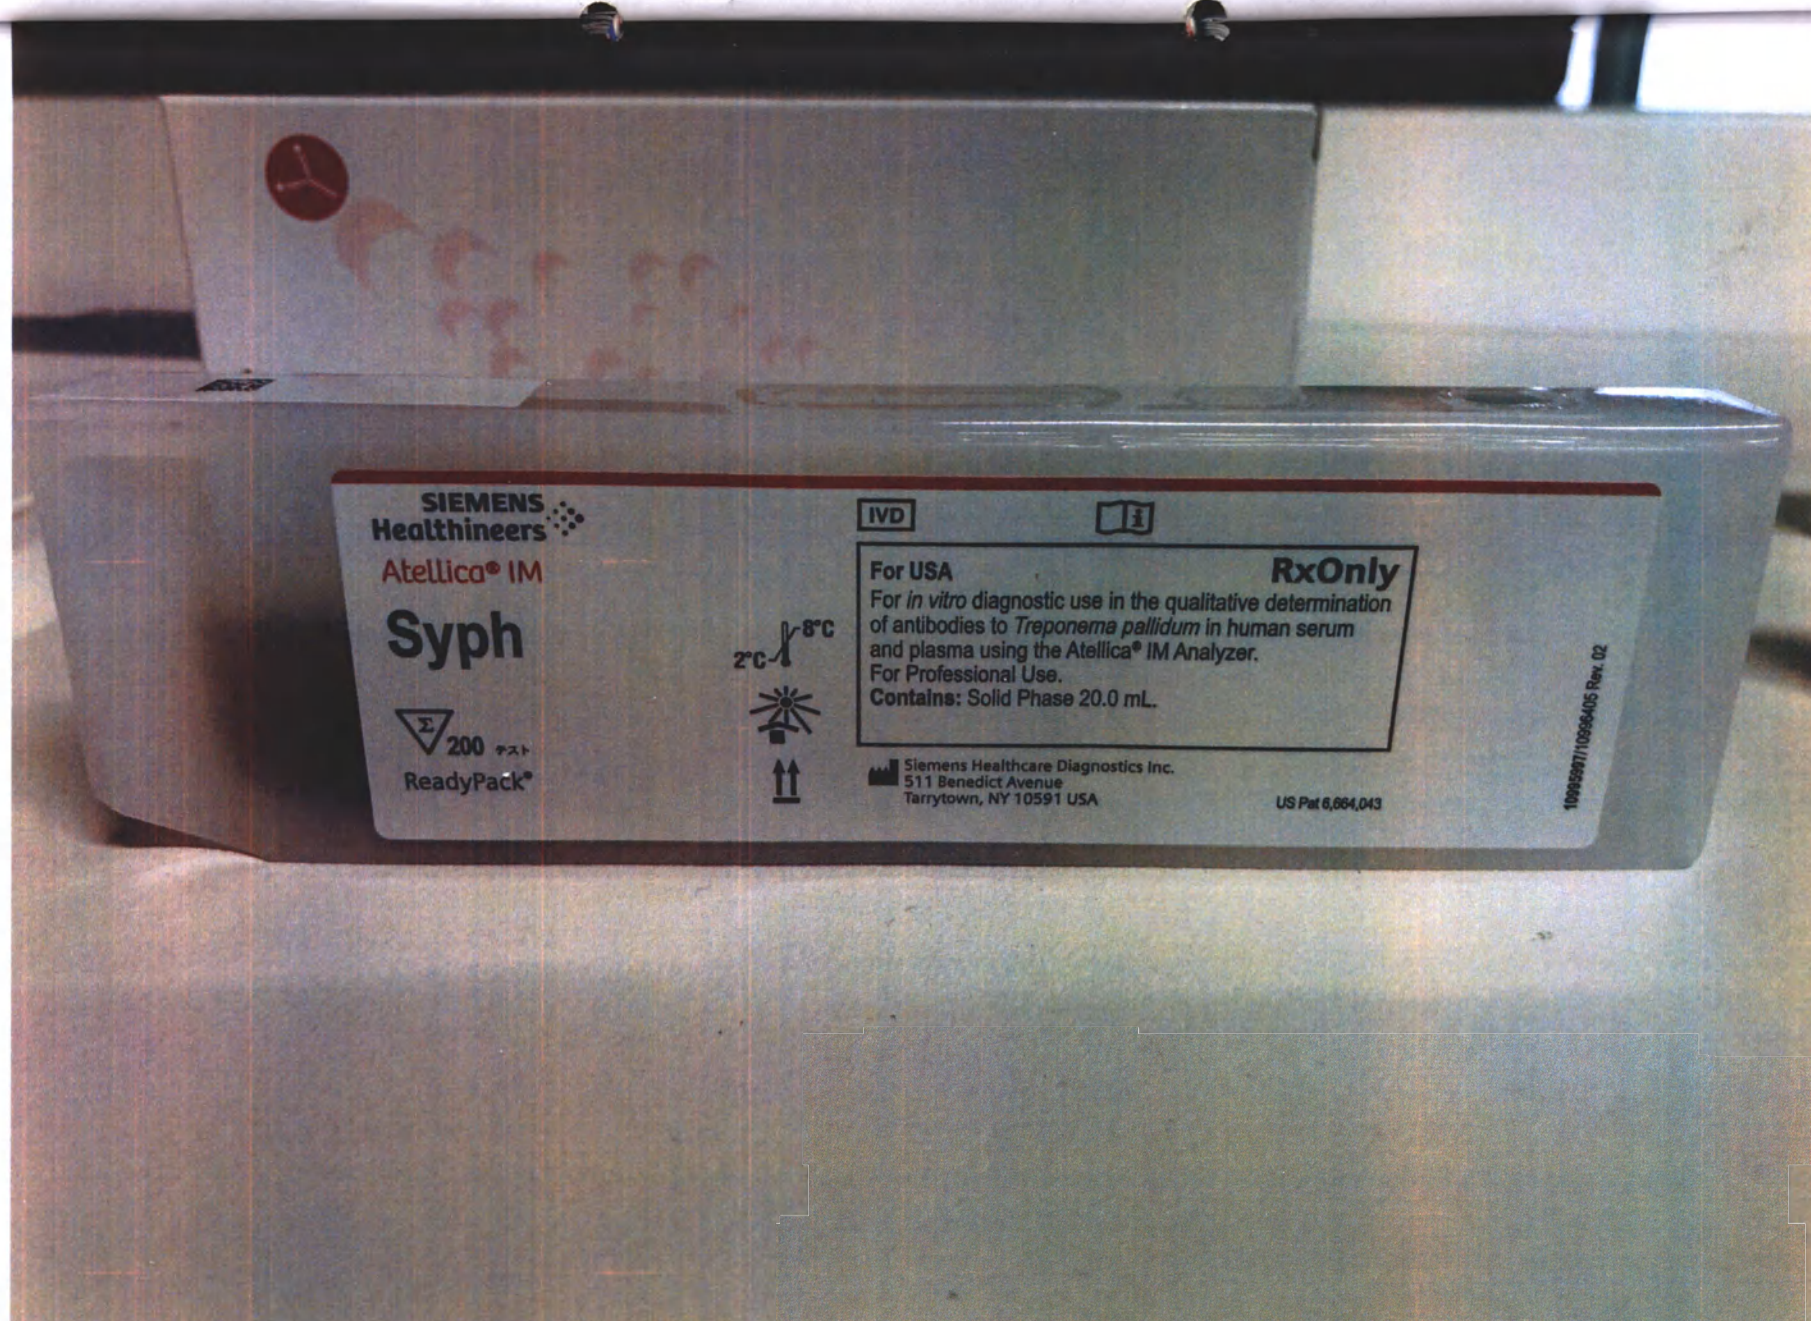


Рисунок 3. Набор реагентов для определения антител к *Treponema pallidum* на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Syphilis (Atellica IM Syph)): Первичный реагент Atellica IM Syph

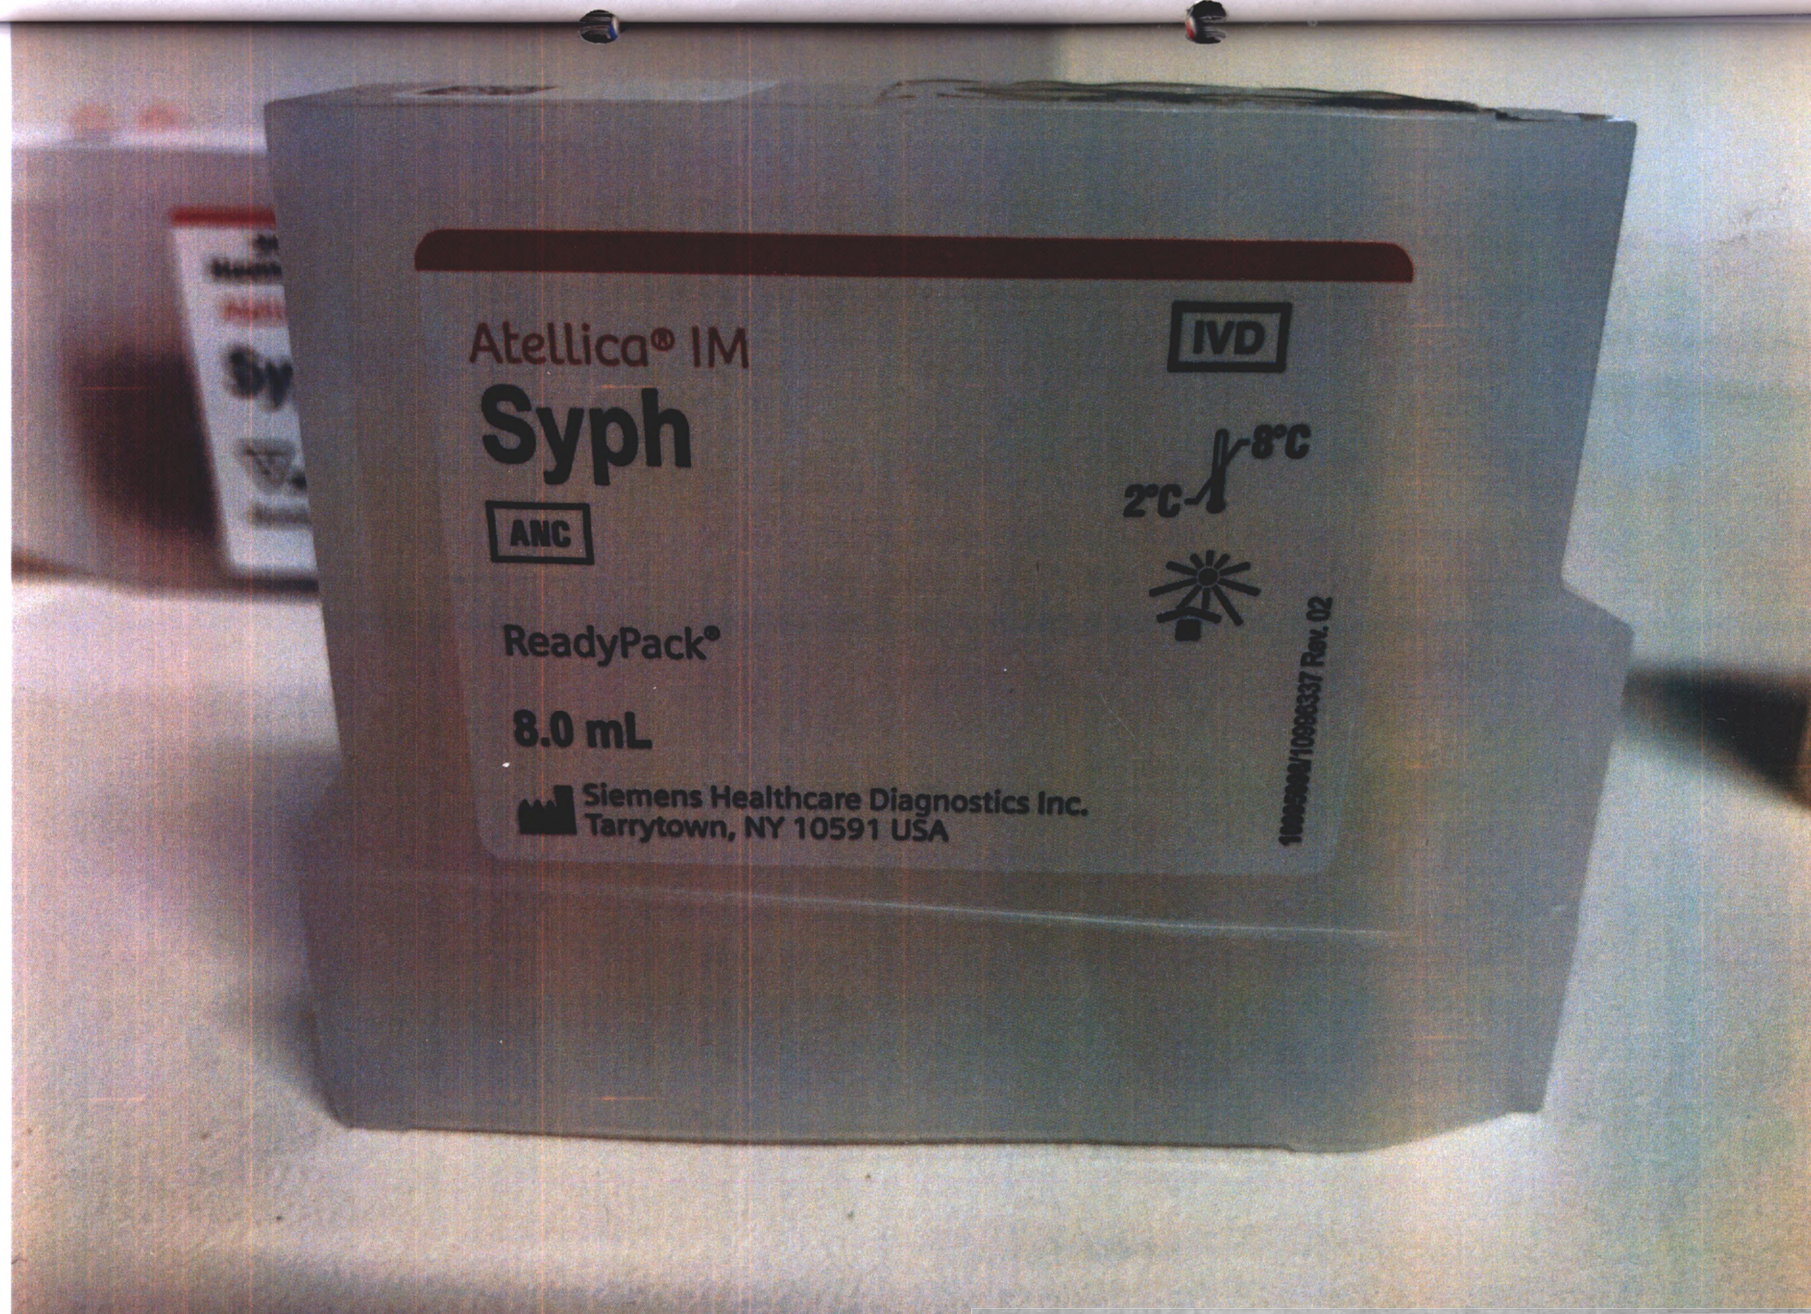


Рисунок 4. Набор реагентов для определения антител к *Treponema pallidum* на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Syphilis (Atellica IM Syph)):
Дополнительный реагент Atellica IM Syph, 8 мл

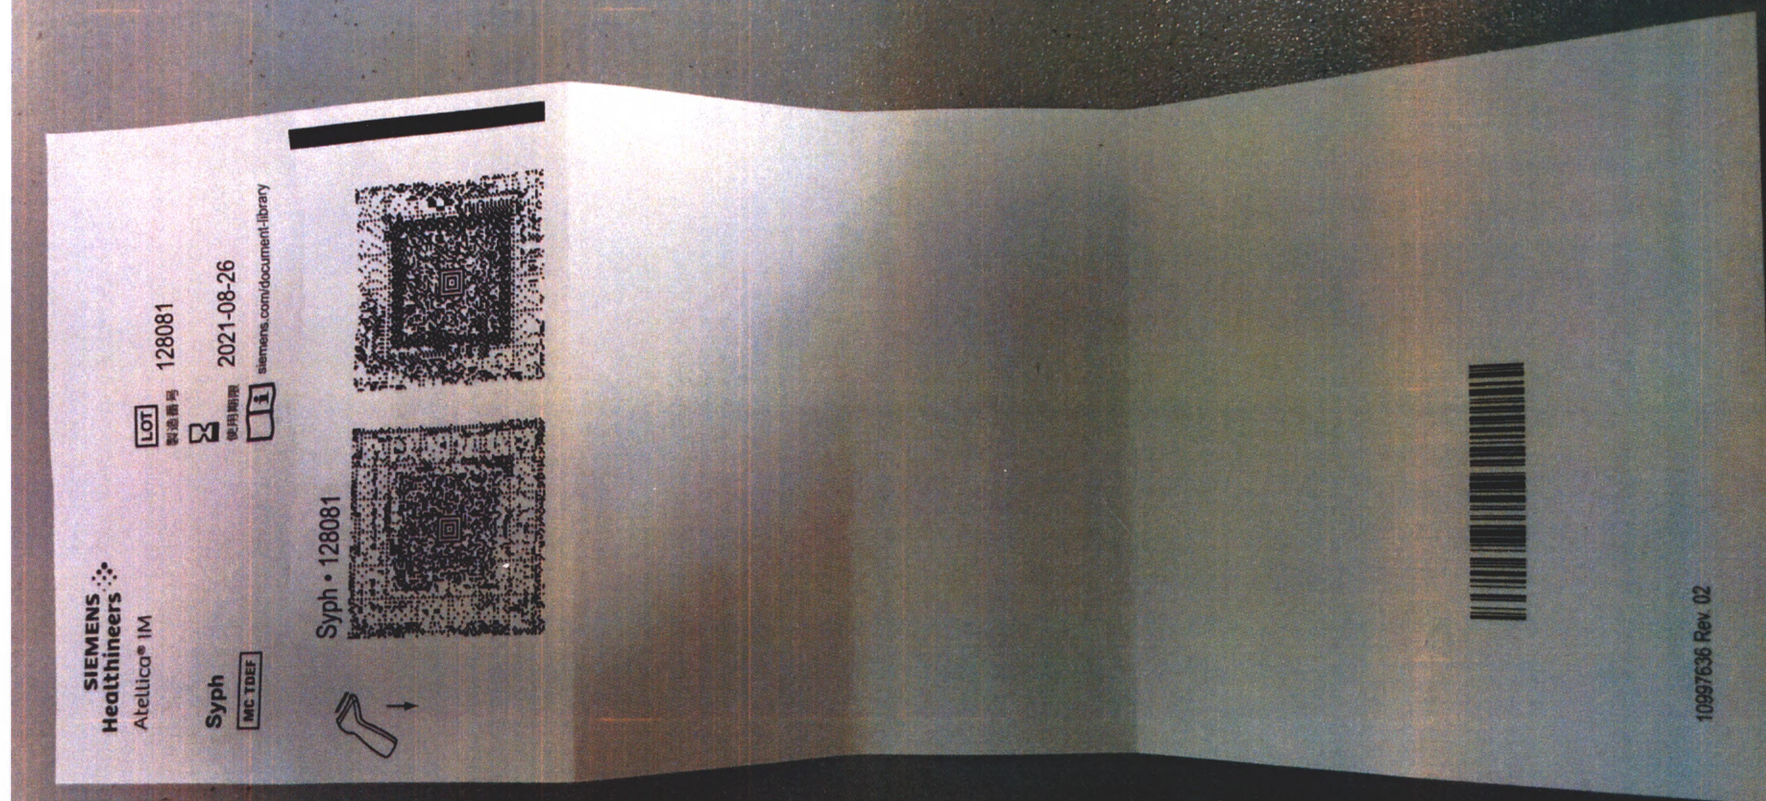


Рисунок 5. Набор реагентов для определения антител к *Treponema pallidum* на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Syphilis (Atellica IM Syph)): Вкладыш со штрих-кодом MC TDEF для Atellica IM Syph



Рисунок 6. Набор реагентов для определения антител к *Treponema pallidum* на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Syphilis (Atellica IM Syph)):
Калибратор с низкой концентрацией Atellica IM Syph CAL L, 2 мл

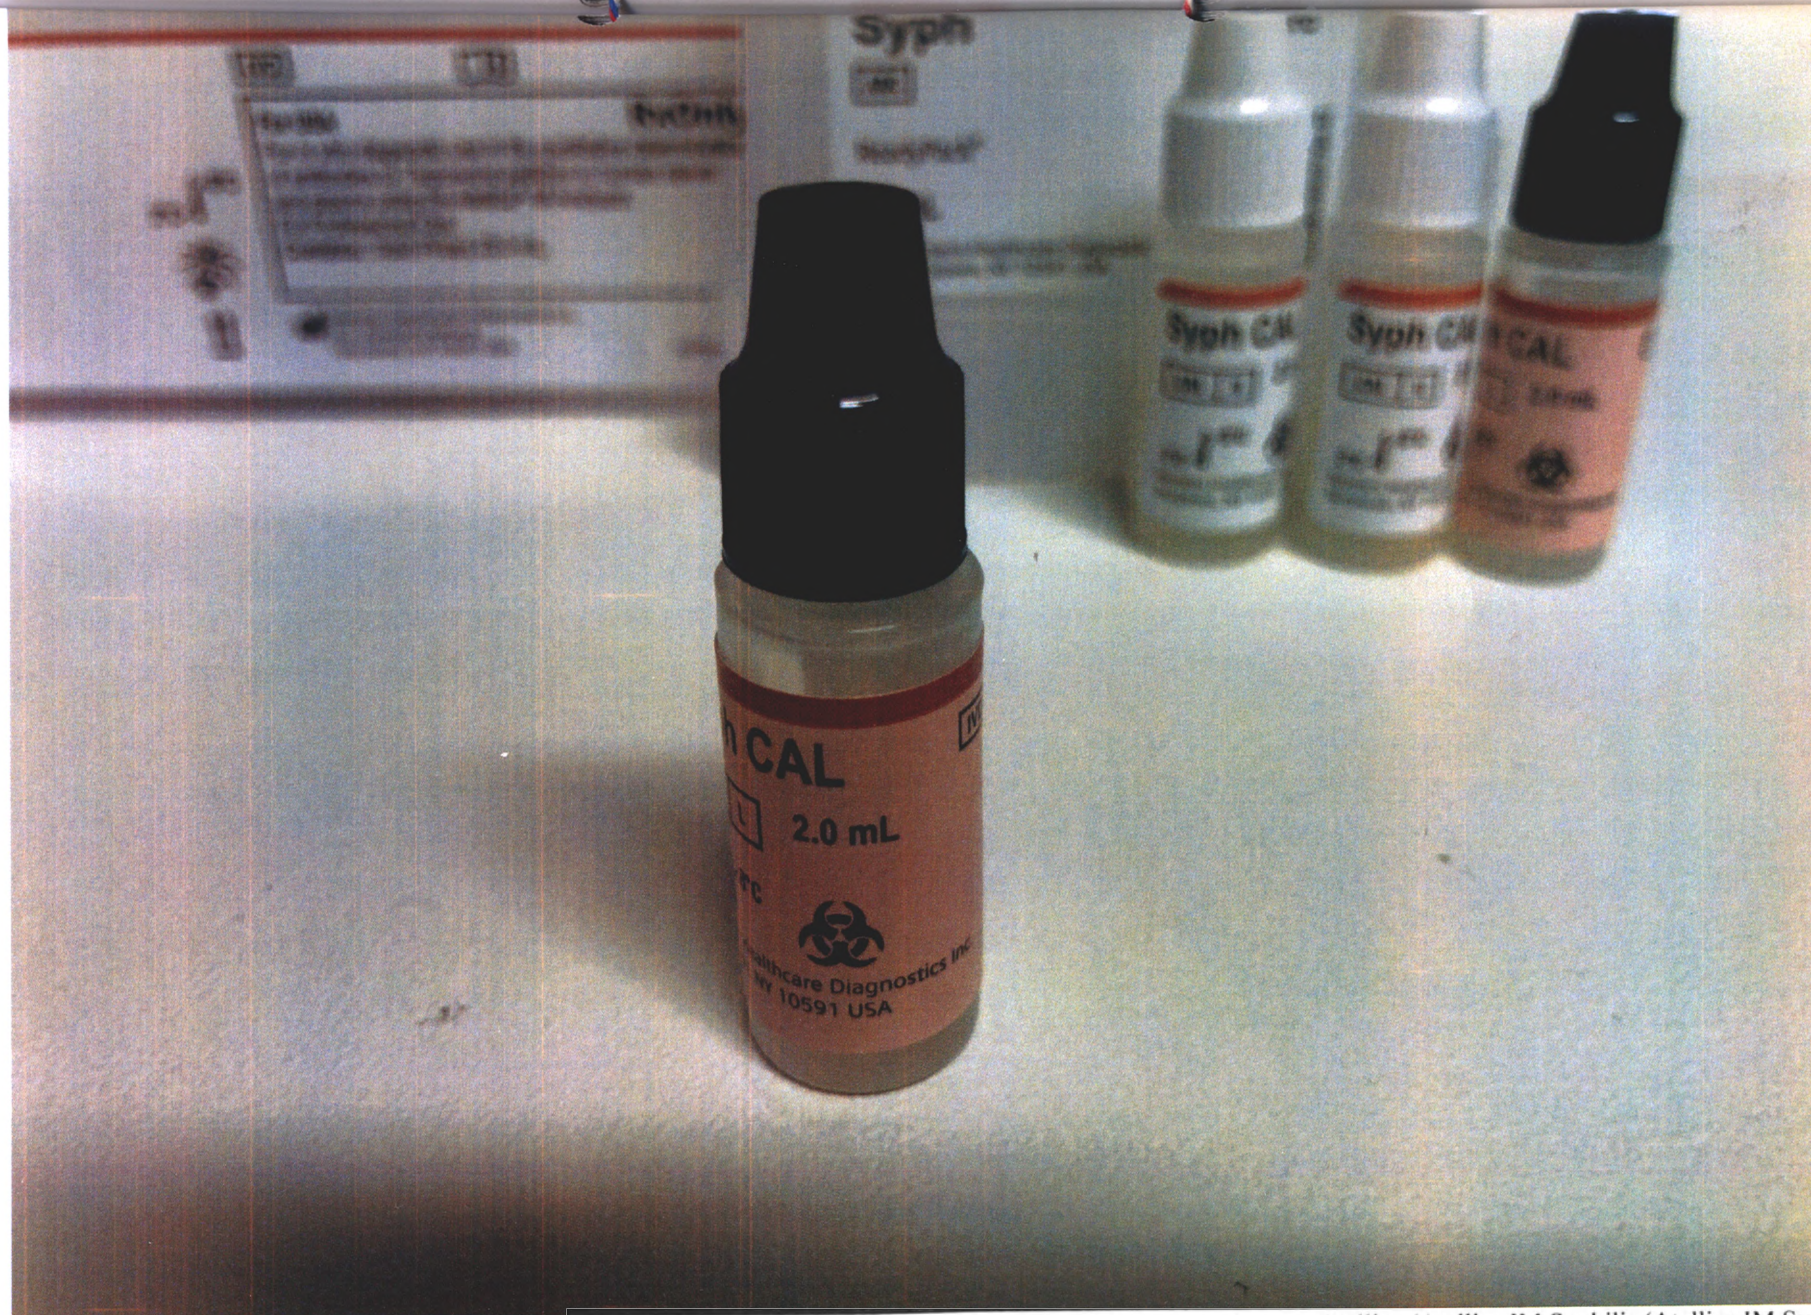


Рисунок 7. Набор реагентов для определения антител к *Treponema pallidum* на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Syphilis (Atellica IM Syph)):
Калибратор с низкой концентрацией Atellica IM Syph CAL L, 2 мл

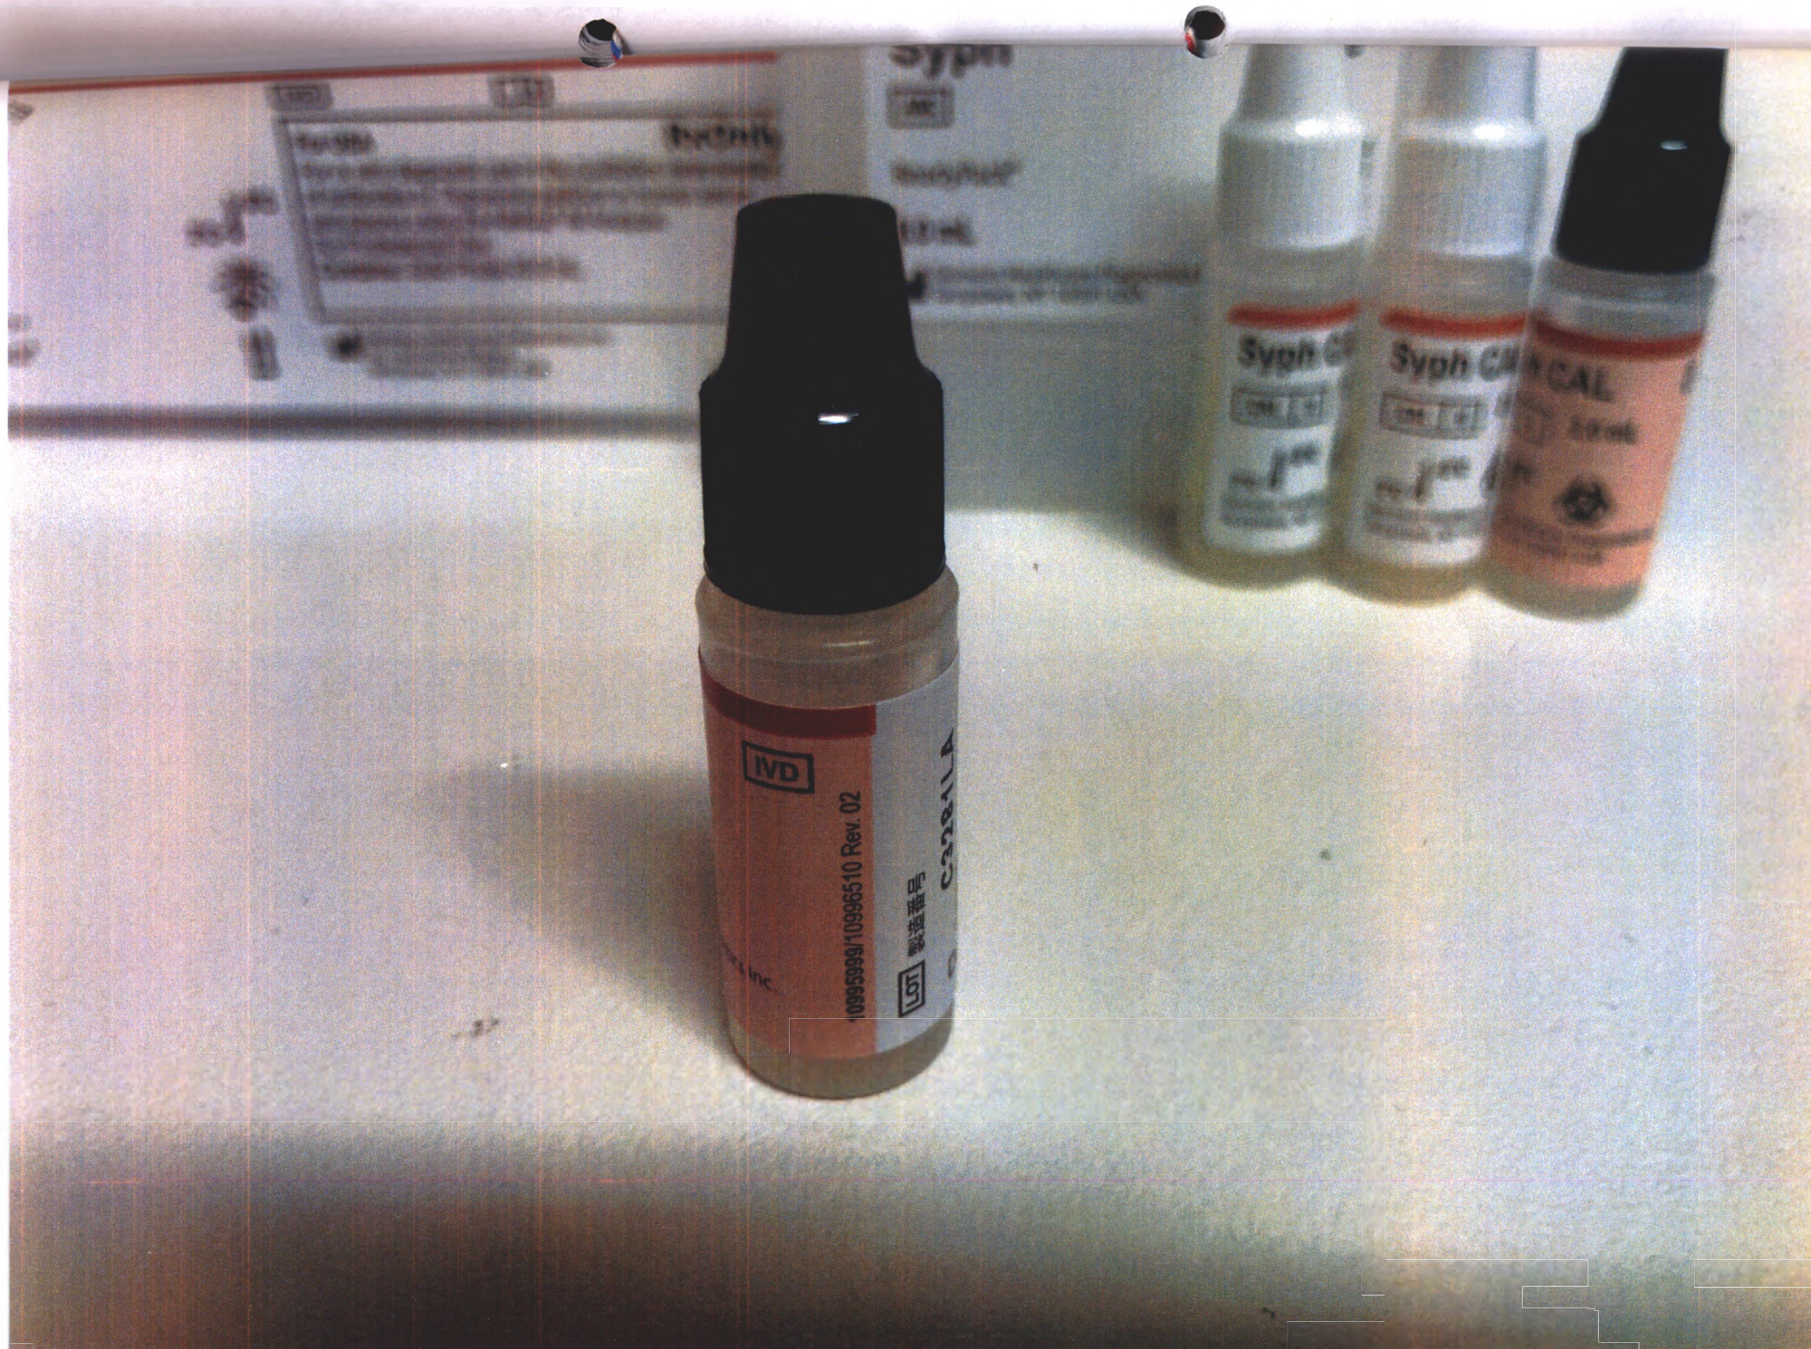


Рисунок 8. Набор реагентов для определения антител к *Treponema pallidum* на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Syphilis (Atellica IM Syph)):
Калибратор с низкой концентрацией Atellica IM Syph CAL L, 2 мл

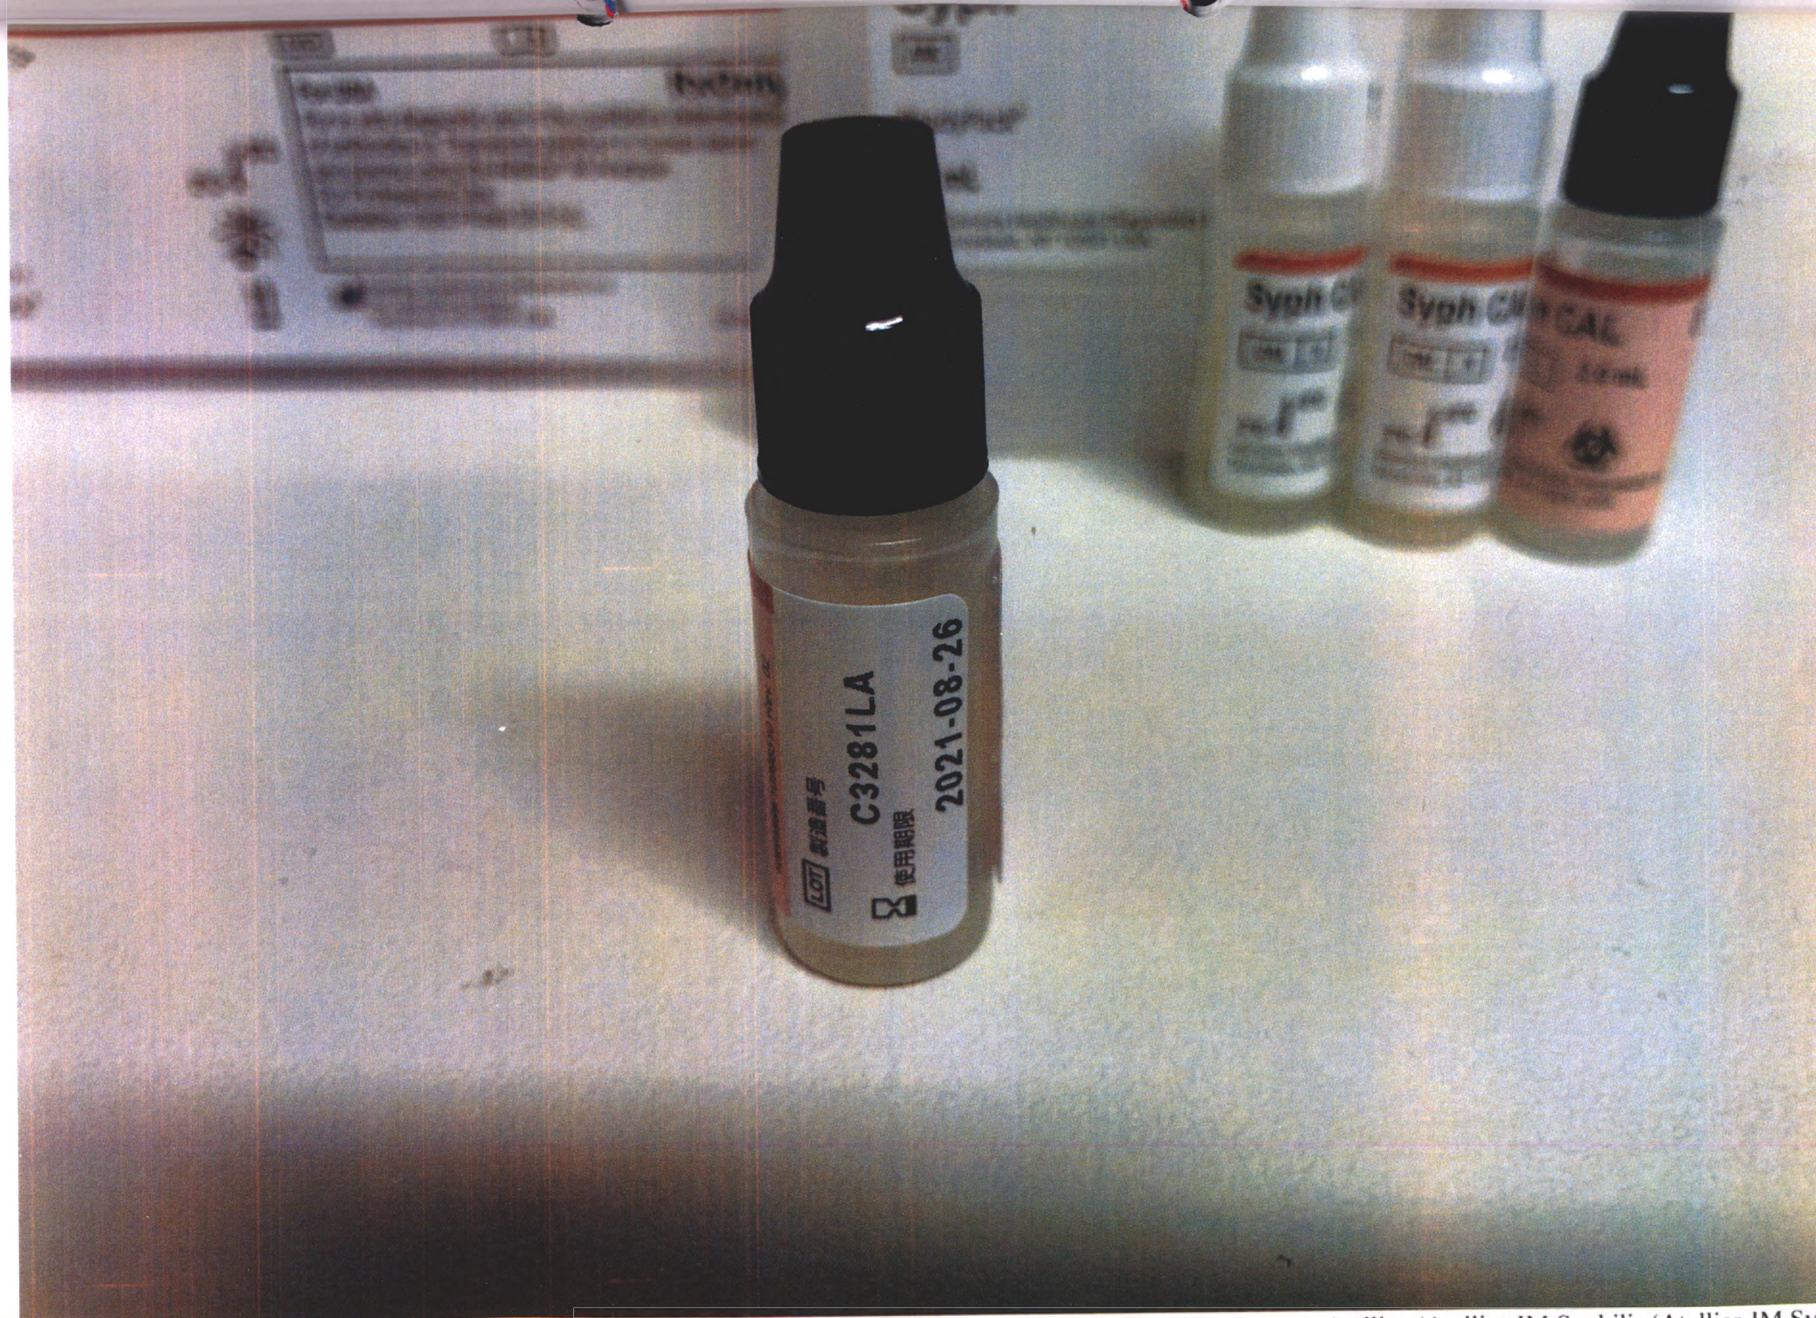


Рисунок 9. Набор реагентов для определения антител к *Трепонема pallidum* на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Syphilis (Atellica IM Syph)):
Калибратор с низкой концентрацией Atellica IM Syph CAL L, 2 мл



Рисунок 10. Набор реагентов для определения антител к *Трепонема pallidum* на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Syphilis (Atellica IM Syph)):
Калибратор с высокой концентрацией Atellica IM Syph CAL H, 2 мл



Рисунок 11. Набор реагентов для определения антител к *Treponema pallidum* на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Syphilis (Atellica IM Syph)):
Калибратор с высокой концентрацией Atellica IM Syph CAL H, 2 мл

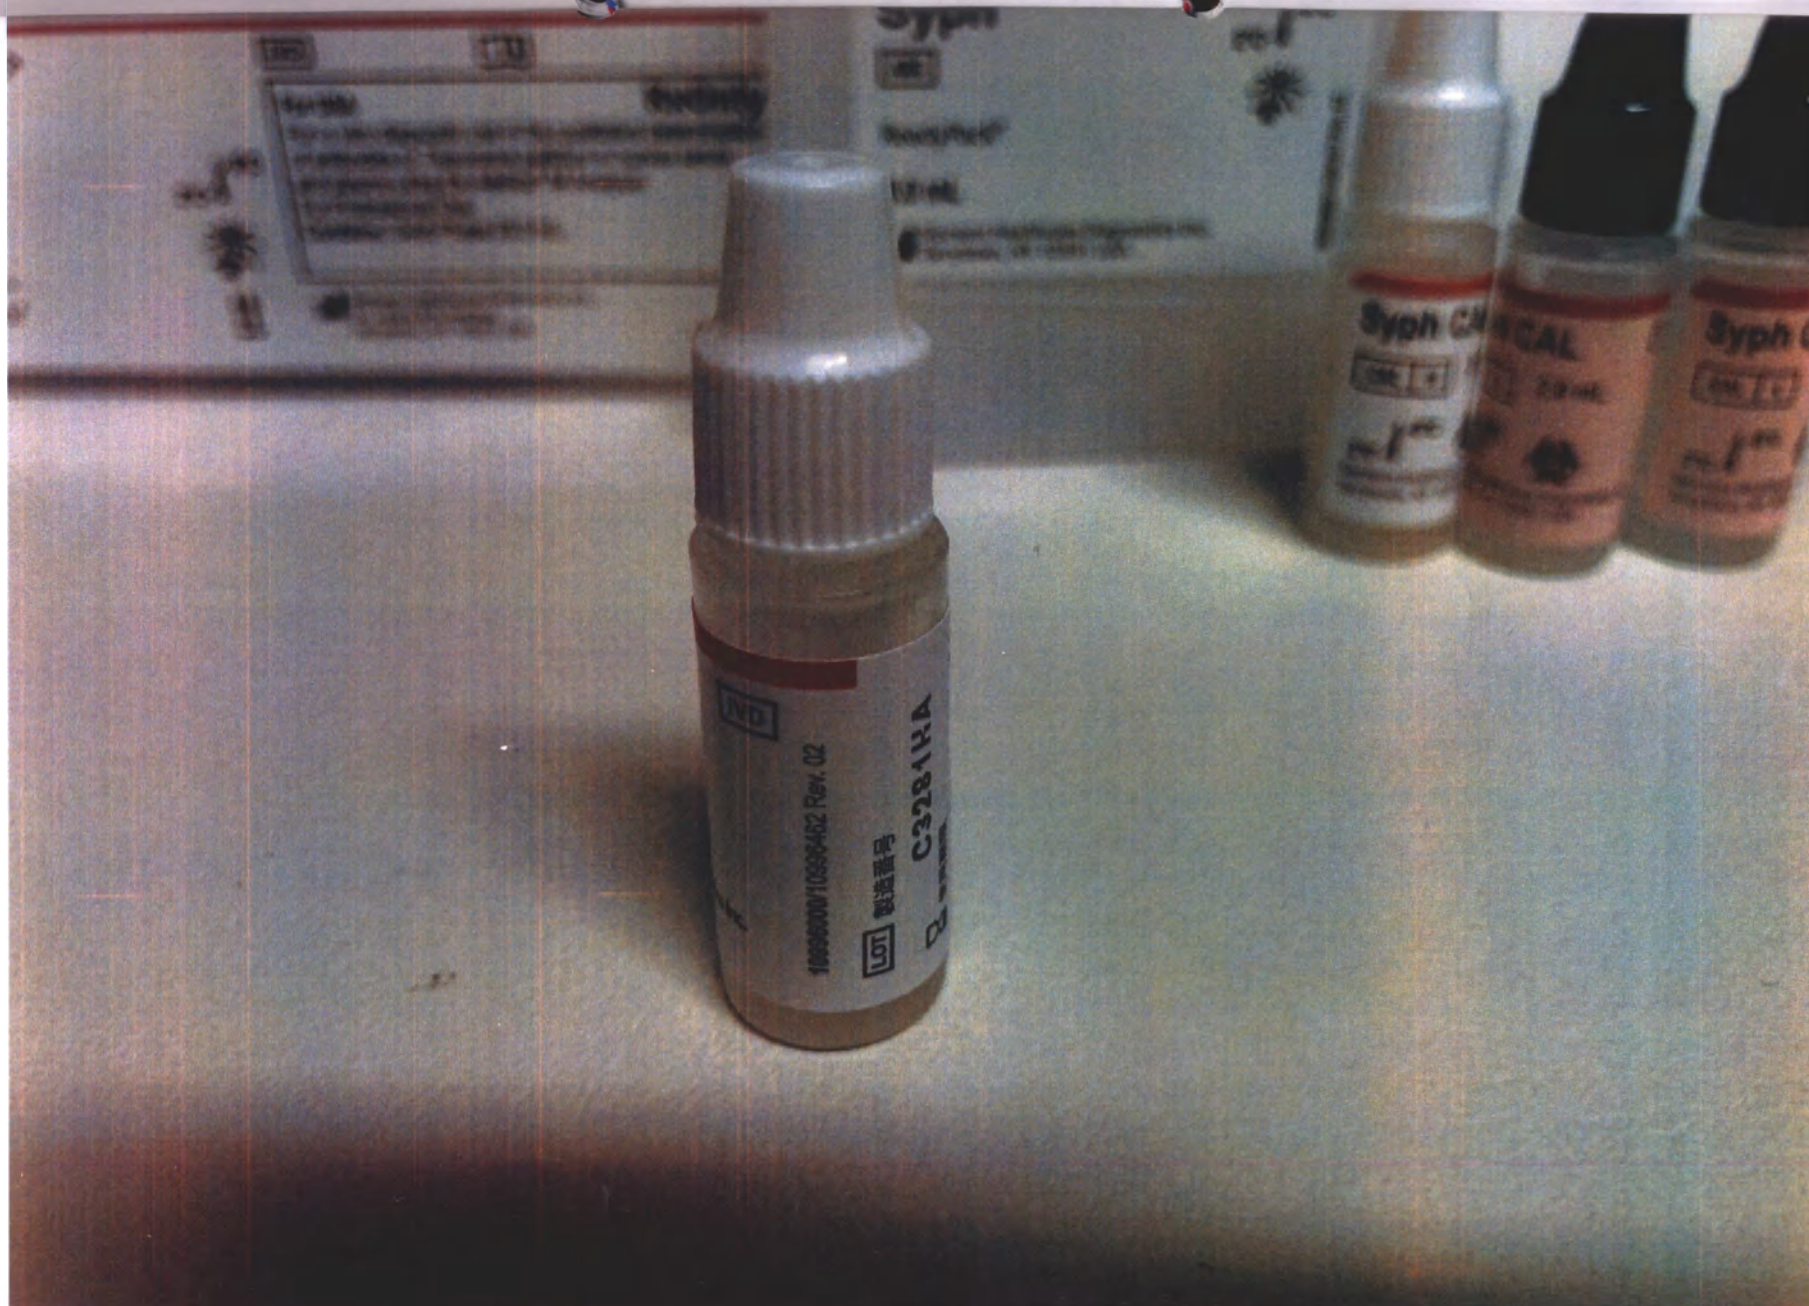


Рисунок 12. Набор реагентов для определения антител к *Treponema pallidum* на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Syphilis (Atellica IM Syph)):
Калибратор с высокой концентрацией Atellica IM Syph CAL H, 2 мл



Рисунок 13. Набор реагентов для определения антител к *Трепонема pallidum* на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Syphilis (Atellica IM Syph)):
Калибратор с высокой концентрацией Atellica IM Syph CAL H, 2 мл

SIEMENS
Healthineers

Atellica® IM

CAL

Syph

CAL LOT VAL

LOT

C3281

製造番号



2021-08-26

使用期限



siemens.com/document-library



d1b28a3c

CHECKSUM

CAL L

CAL H

UNITS C

UNITS SI

UNITS C

UNITS SI

Syph



8.607 INDEX

7.31 INDEX

10007640 Rev. 02

Рисунок 14. Набор реагентов для определения антител к *Treponema pallidum* на анализаторах иммунохимических серии Atellica Atellica IM Syphilis (Atellica IM Syph): Лист значений параметров серии калибратора.

Всего прошито и пронумеровано
15 листа (ов).

ООО «Сиенс Здоровоохранение»

