

ПОДТВЕРЖДАЮ

Руководитель группы регистрации

Горшкова Н.А.

«12» марта 2020 г.



Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики in vitro

Набор реагентов для определения глюкозы на анализаторах биохимических серии Atellica
(Atellica CH Glucose Hexokinase_3 (Atellica CH GluH_3))



Рисунок 1. Набор реагентов для определения глюкозы на анализаторах биохимических серий Atellica (Atellica CH Glucose Hexokinase_3 (Atellica CH GluH_3)): общий вид изделия

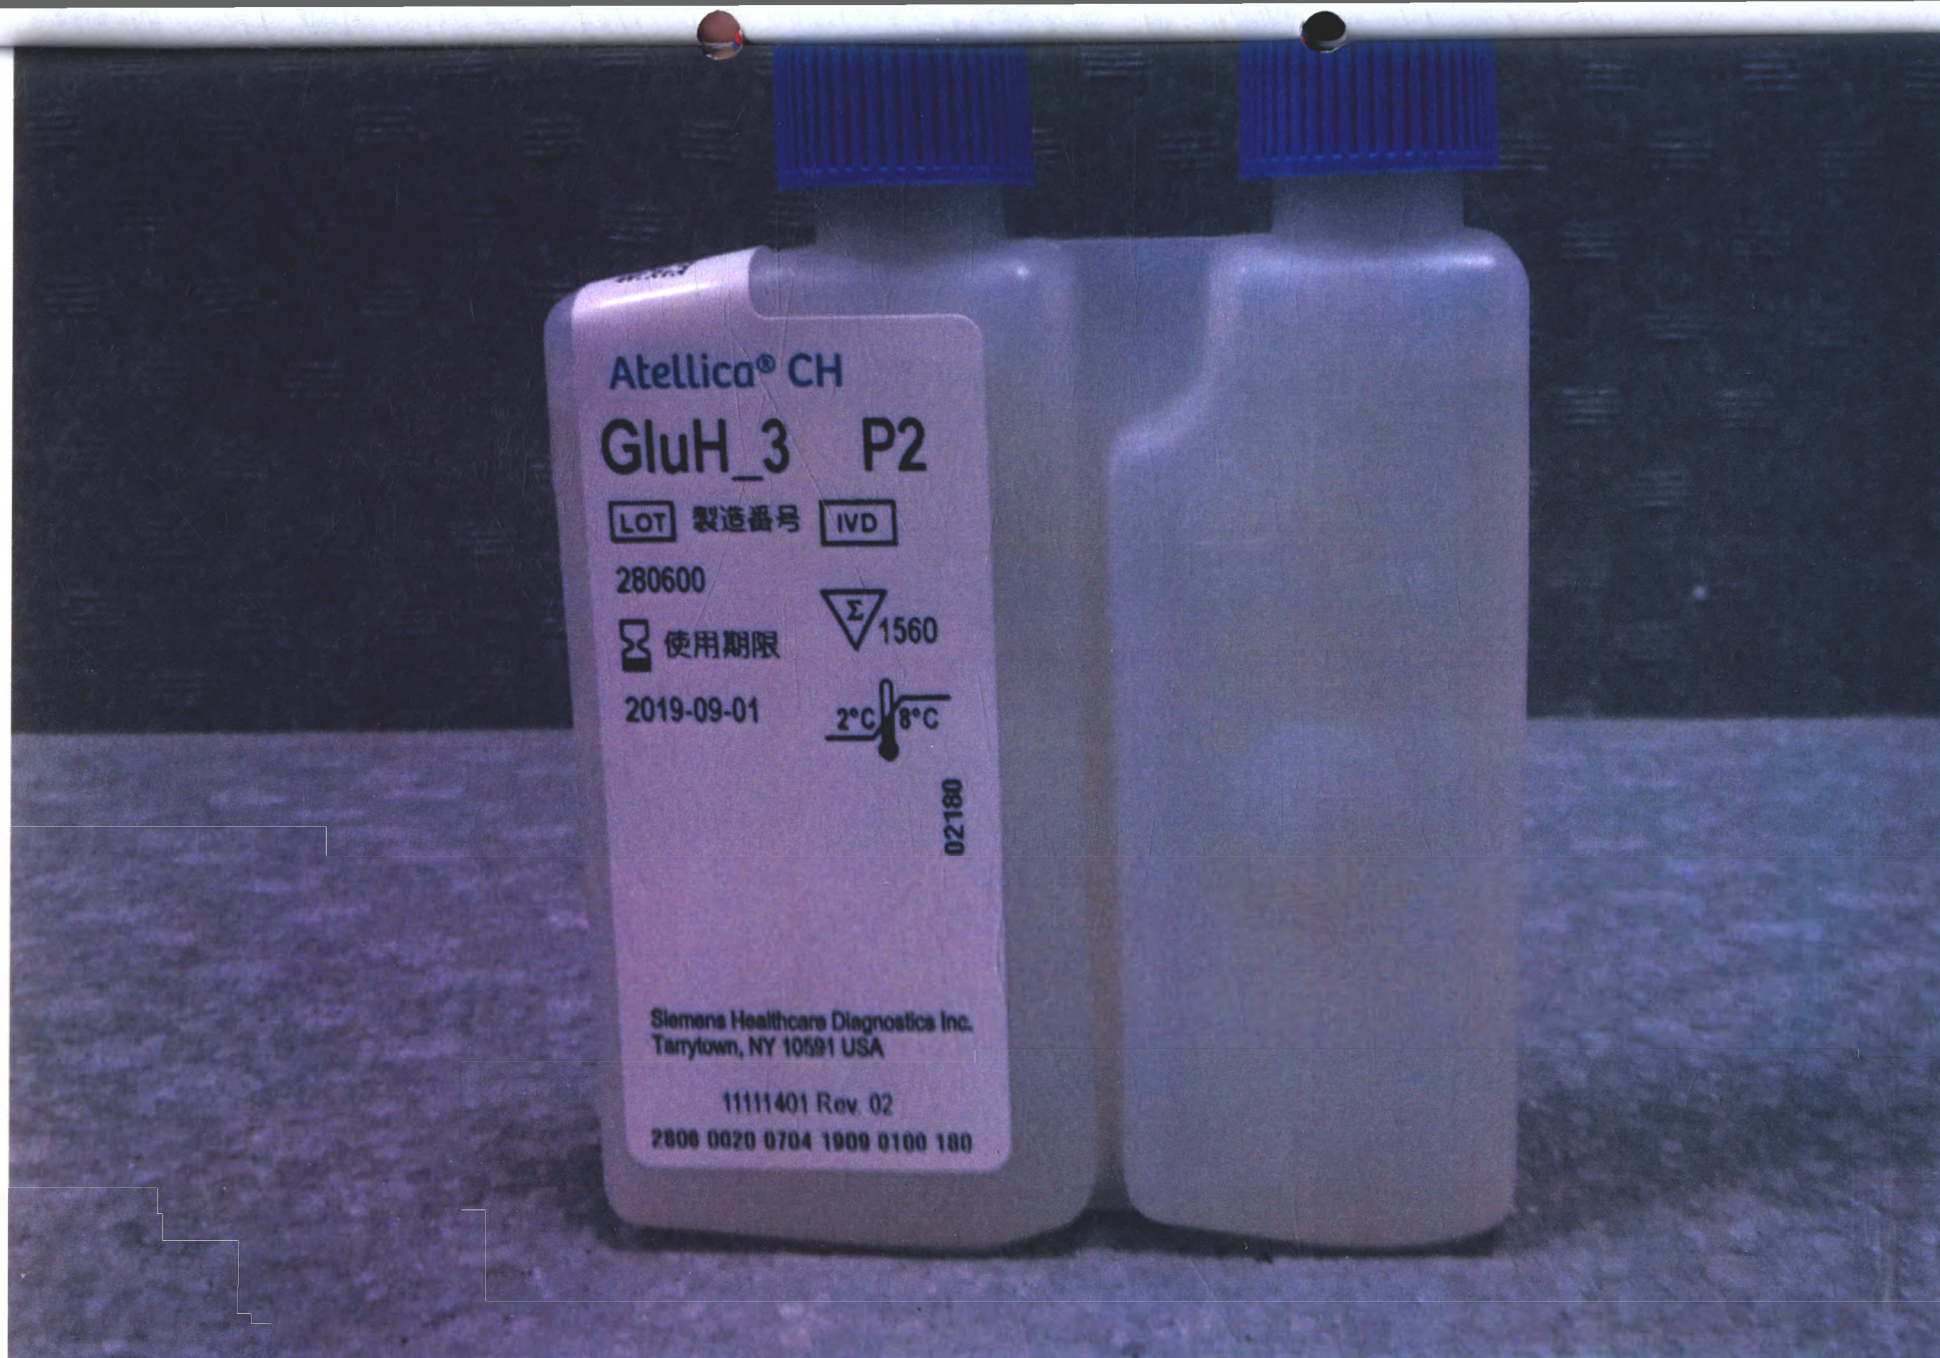


Рисунок 2. Набор реагентов для определения глюкозы на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica CH Glucose Hexokinase_3 (Atellica CH GluH_3)): флаконы с реагентами, общий вид, упаковка 1

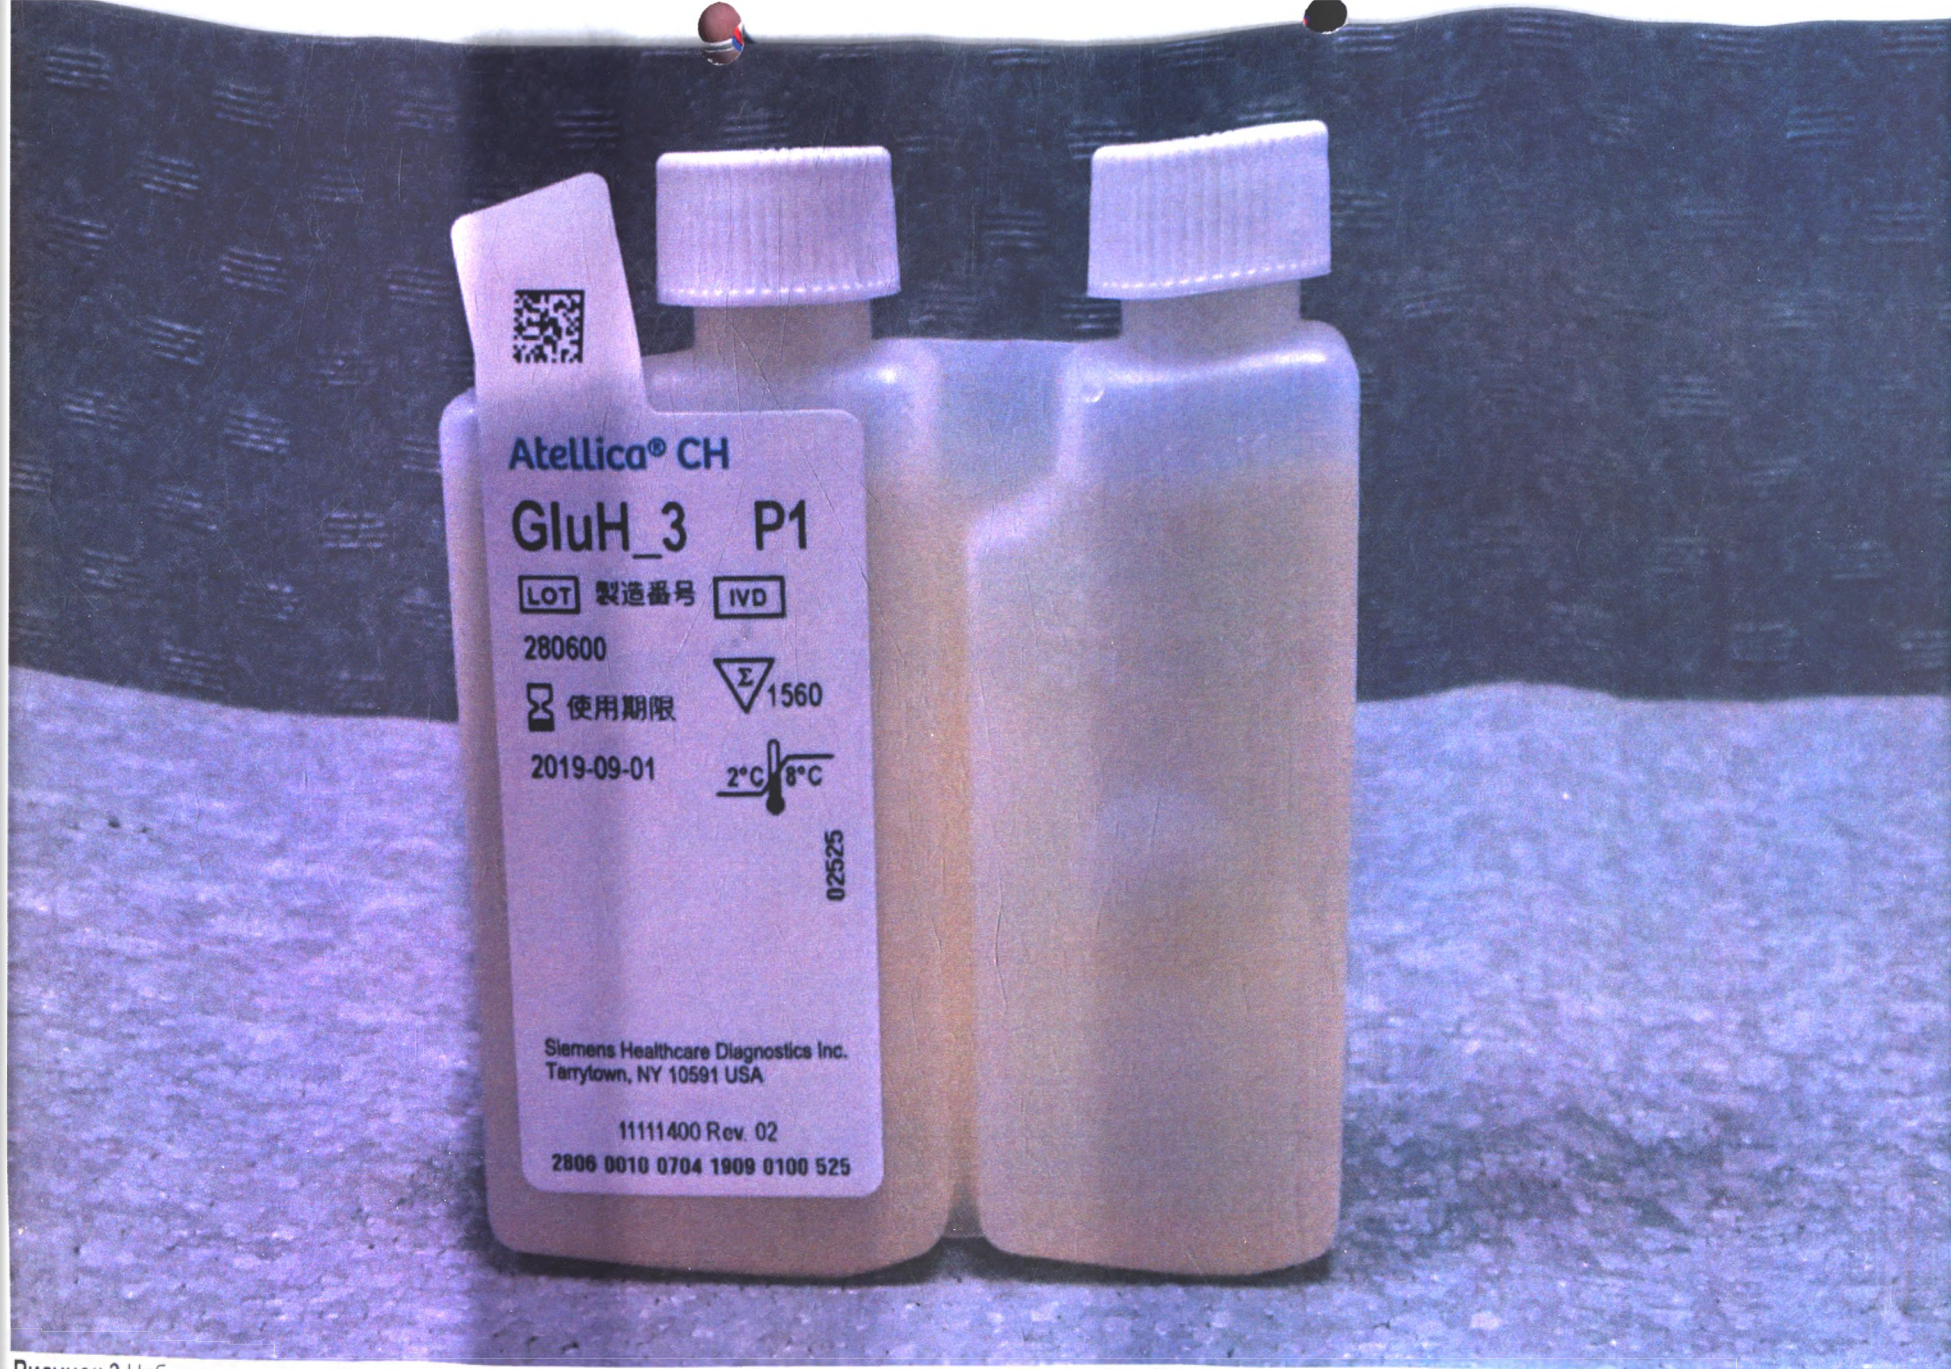


Рисунок 3 Набор реагентов для определения глюкозы на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica CH Glucose Hexokinase_3 (Atellica CH GluH_3)): флаконы с реагентами, общий вид, упаковка 2.

Всего прошито и пронумеровано 4 листа (ов)

ООО «Сиенс Здоровоохранение»

