

Руководитель группы регистрации
ООО «Сименс Здравоохранение»



Н.А. Горшкова
«22» июня 2021 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO**

**«Набор контрольных материалов для определения сифилиса на анализаторах
иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Syphilis Quality Control (Atellica IM Syph QC))»**

производства «Сименс Хелскеа Диагностикс Инк.», Siemens Healthcare Diagnostics Inc., США

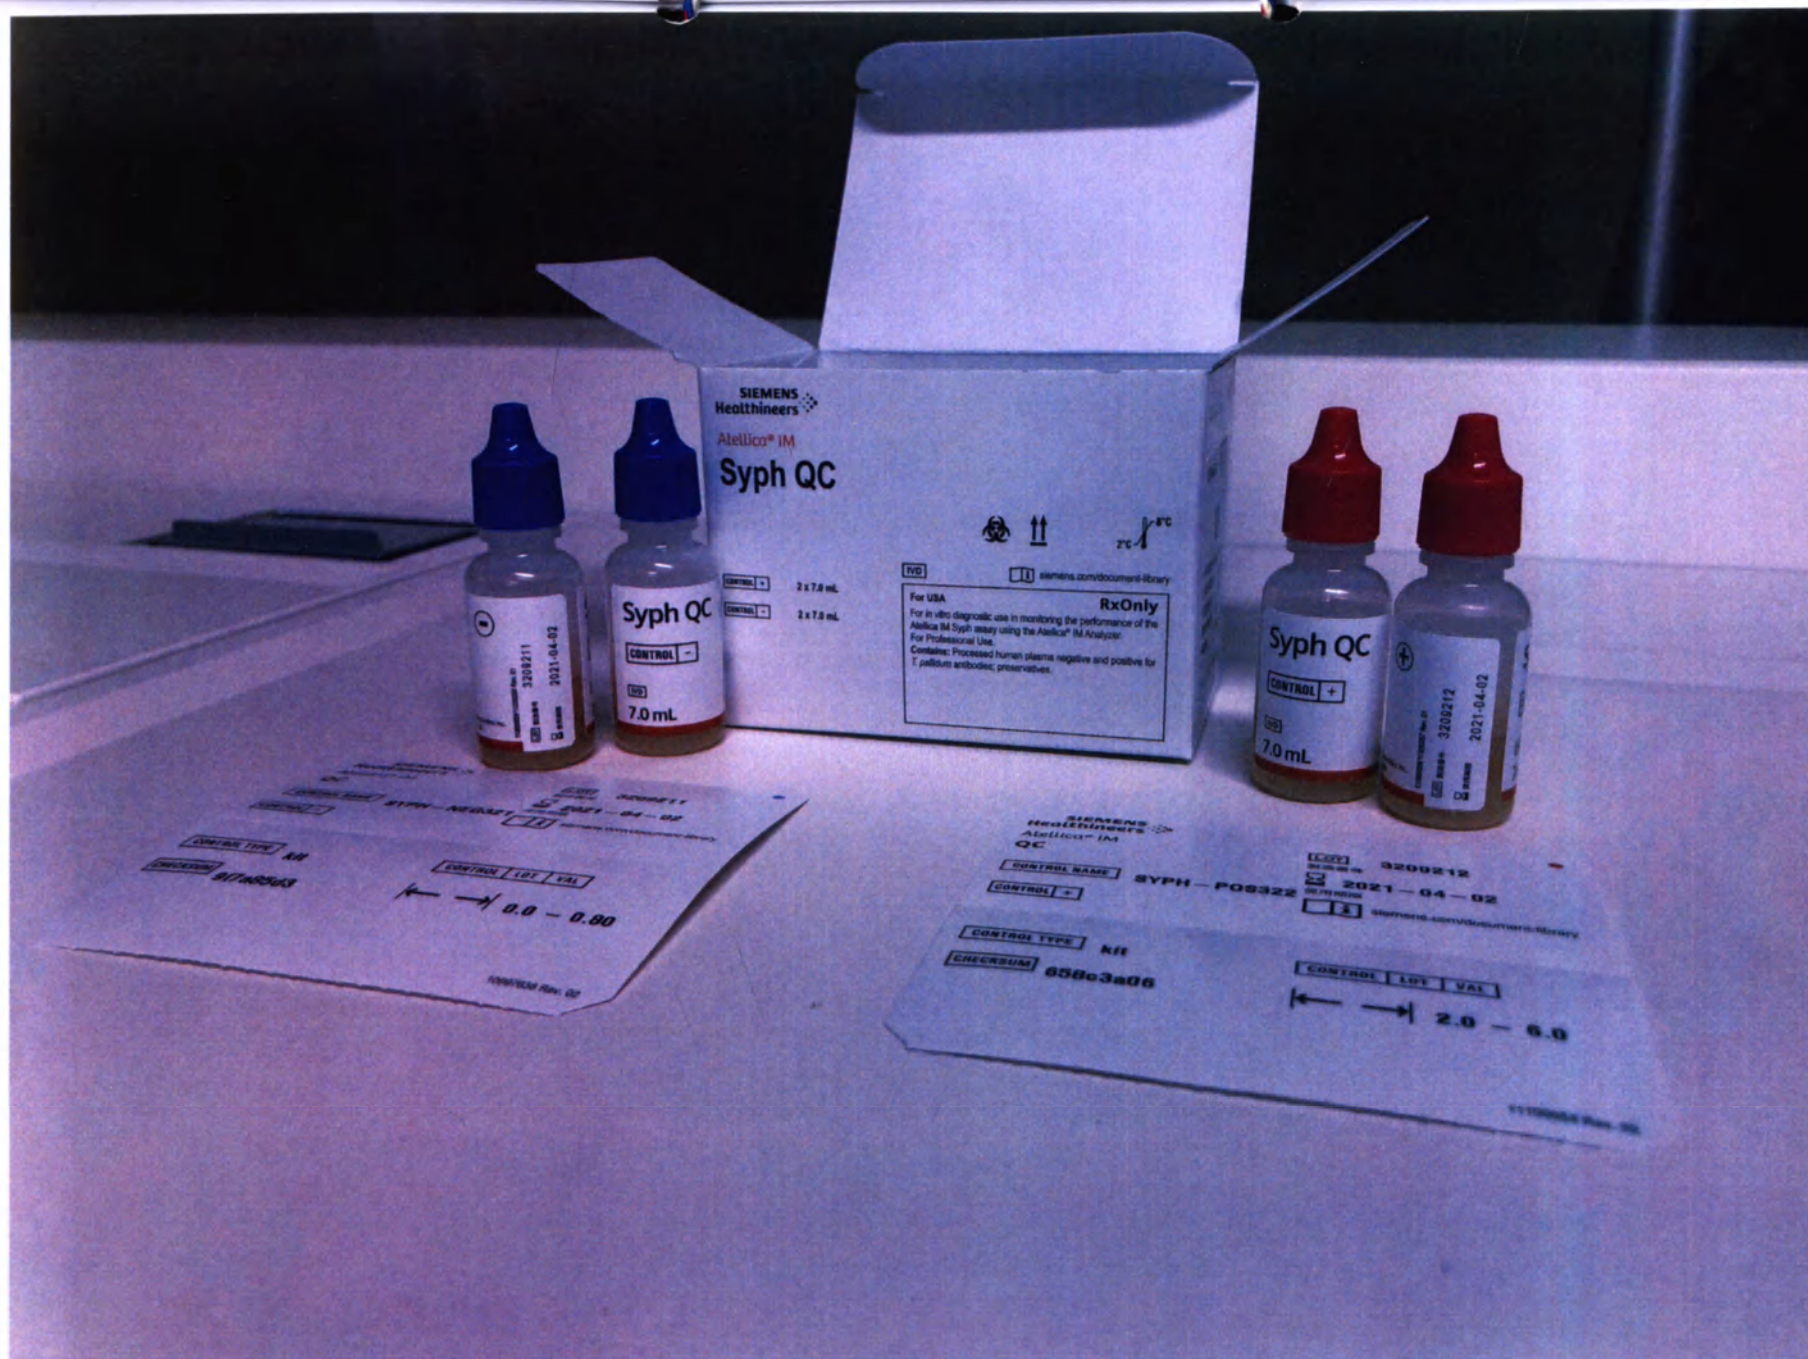


Рисунок 1. Набор контрольных материалов для определения сифилиса на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Syphilis Quality Control (Atellica IM Syph QC)). Общий вид



Рисунок 2. Набор контрольных материалов для определения сифилиса на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Syphilis Quality Control (Atellica IM Syph QC)): Контрольный материал отрицательный Atellica IM Syph QC CONTROL -, 7,0 мл



Рисунок 3. Набор контрольных материалов для определения сифилиса на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Syphilis Quality Control (Atellica IM Syph QC)): Контрольный материал отрицательный Atellica IM Syph QC CONTROL -, 7,0 мл



Рисунок 4. Набор контрольных материалов для определения сифилиса на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Syphilis Quality Control (Atellica IM Syph QC): Контрольный материал отрицательный Atellica IM Syph QC CONTROL -, 7,0 мл

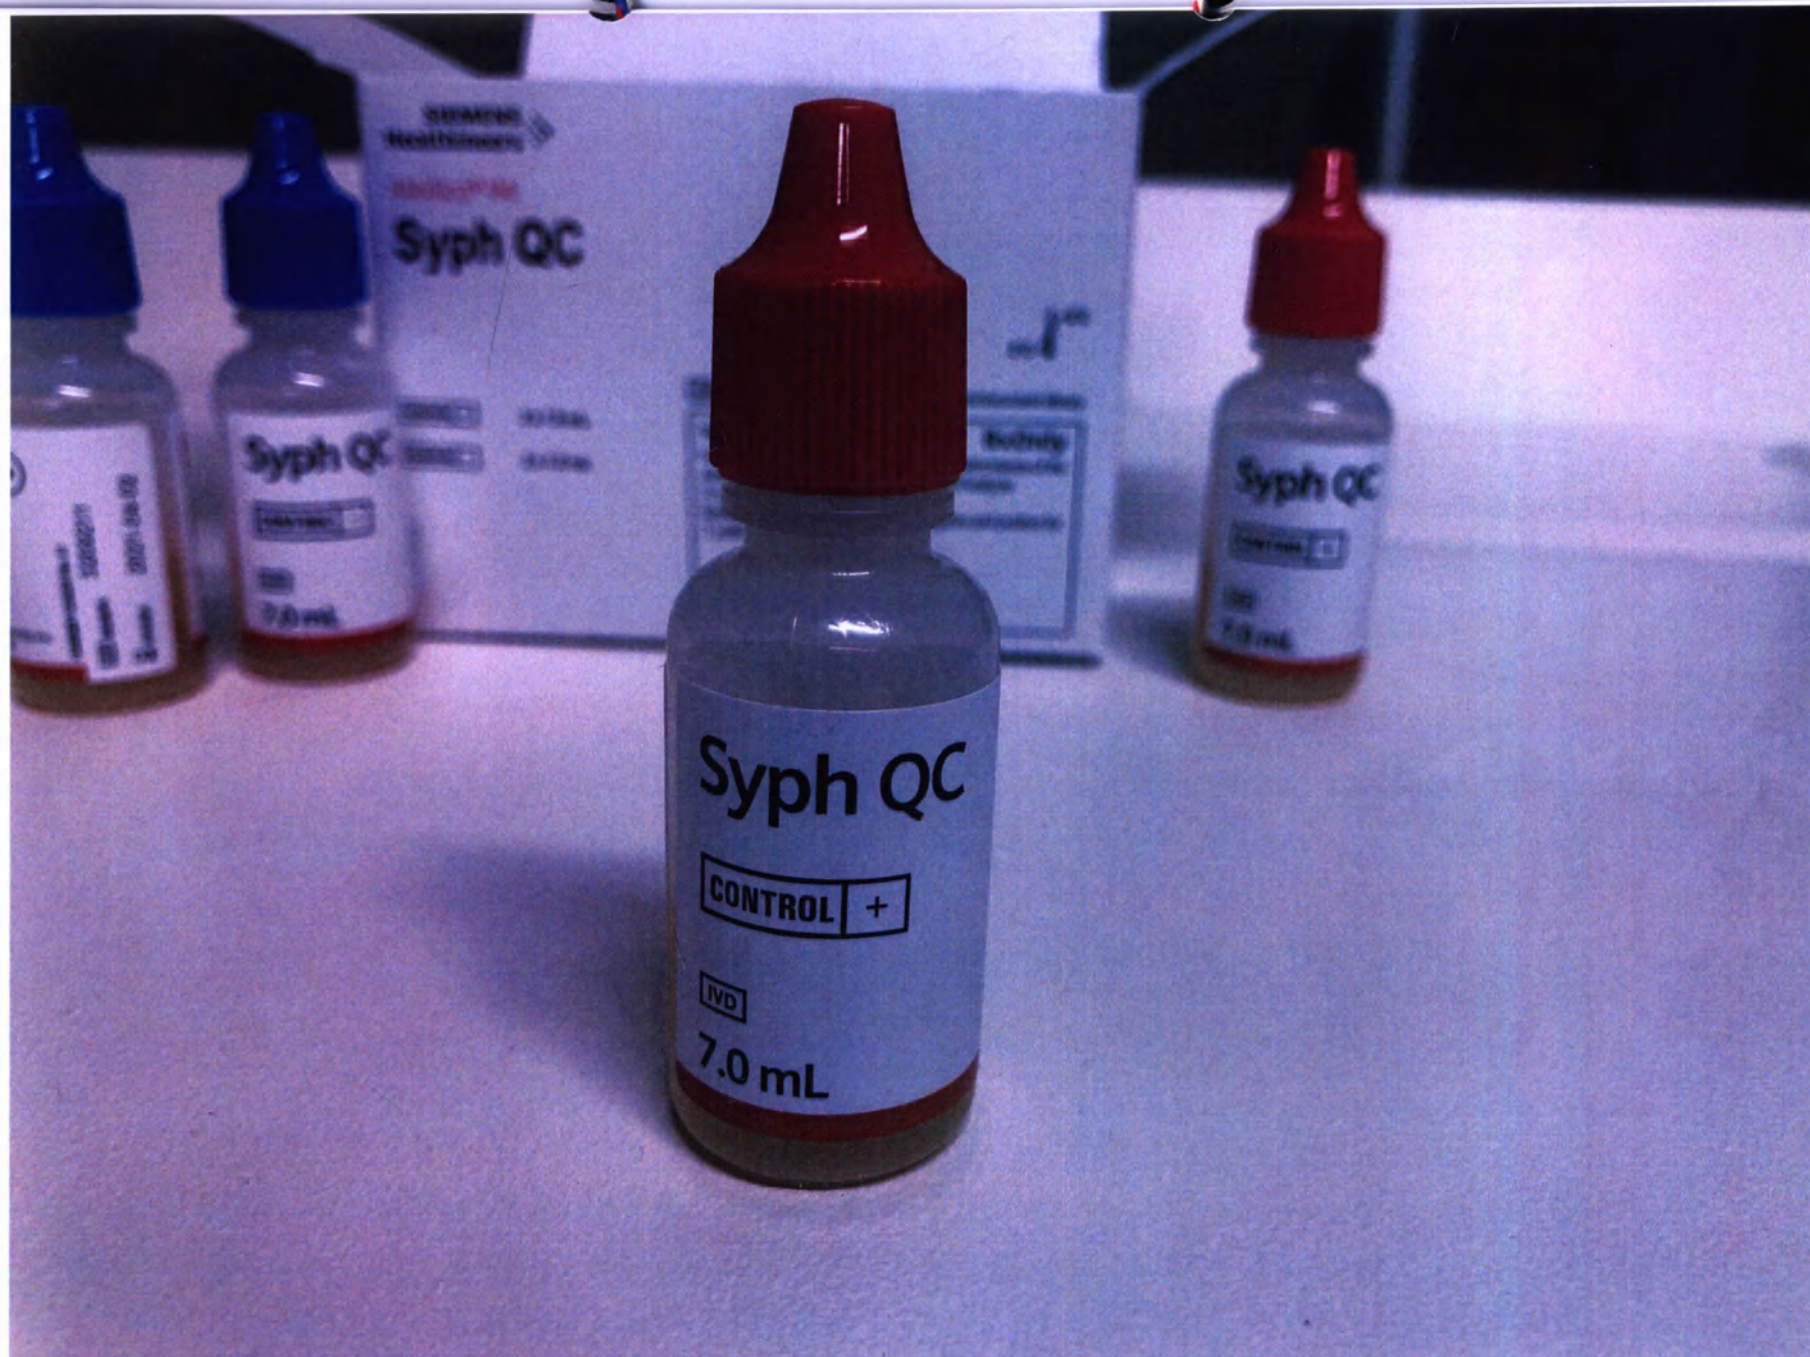


Рисунок 5. Набор контрольных материалов для определения сифилиса на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Syphilis Quality Control (Atellica



Рисунок 6. Набор контрольных материалов для определения сифилиса на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Syphilis Quality Control (Atellica

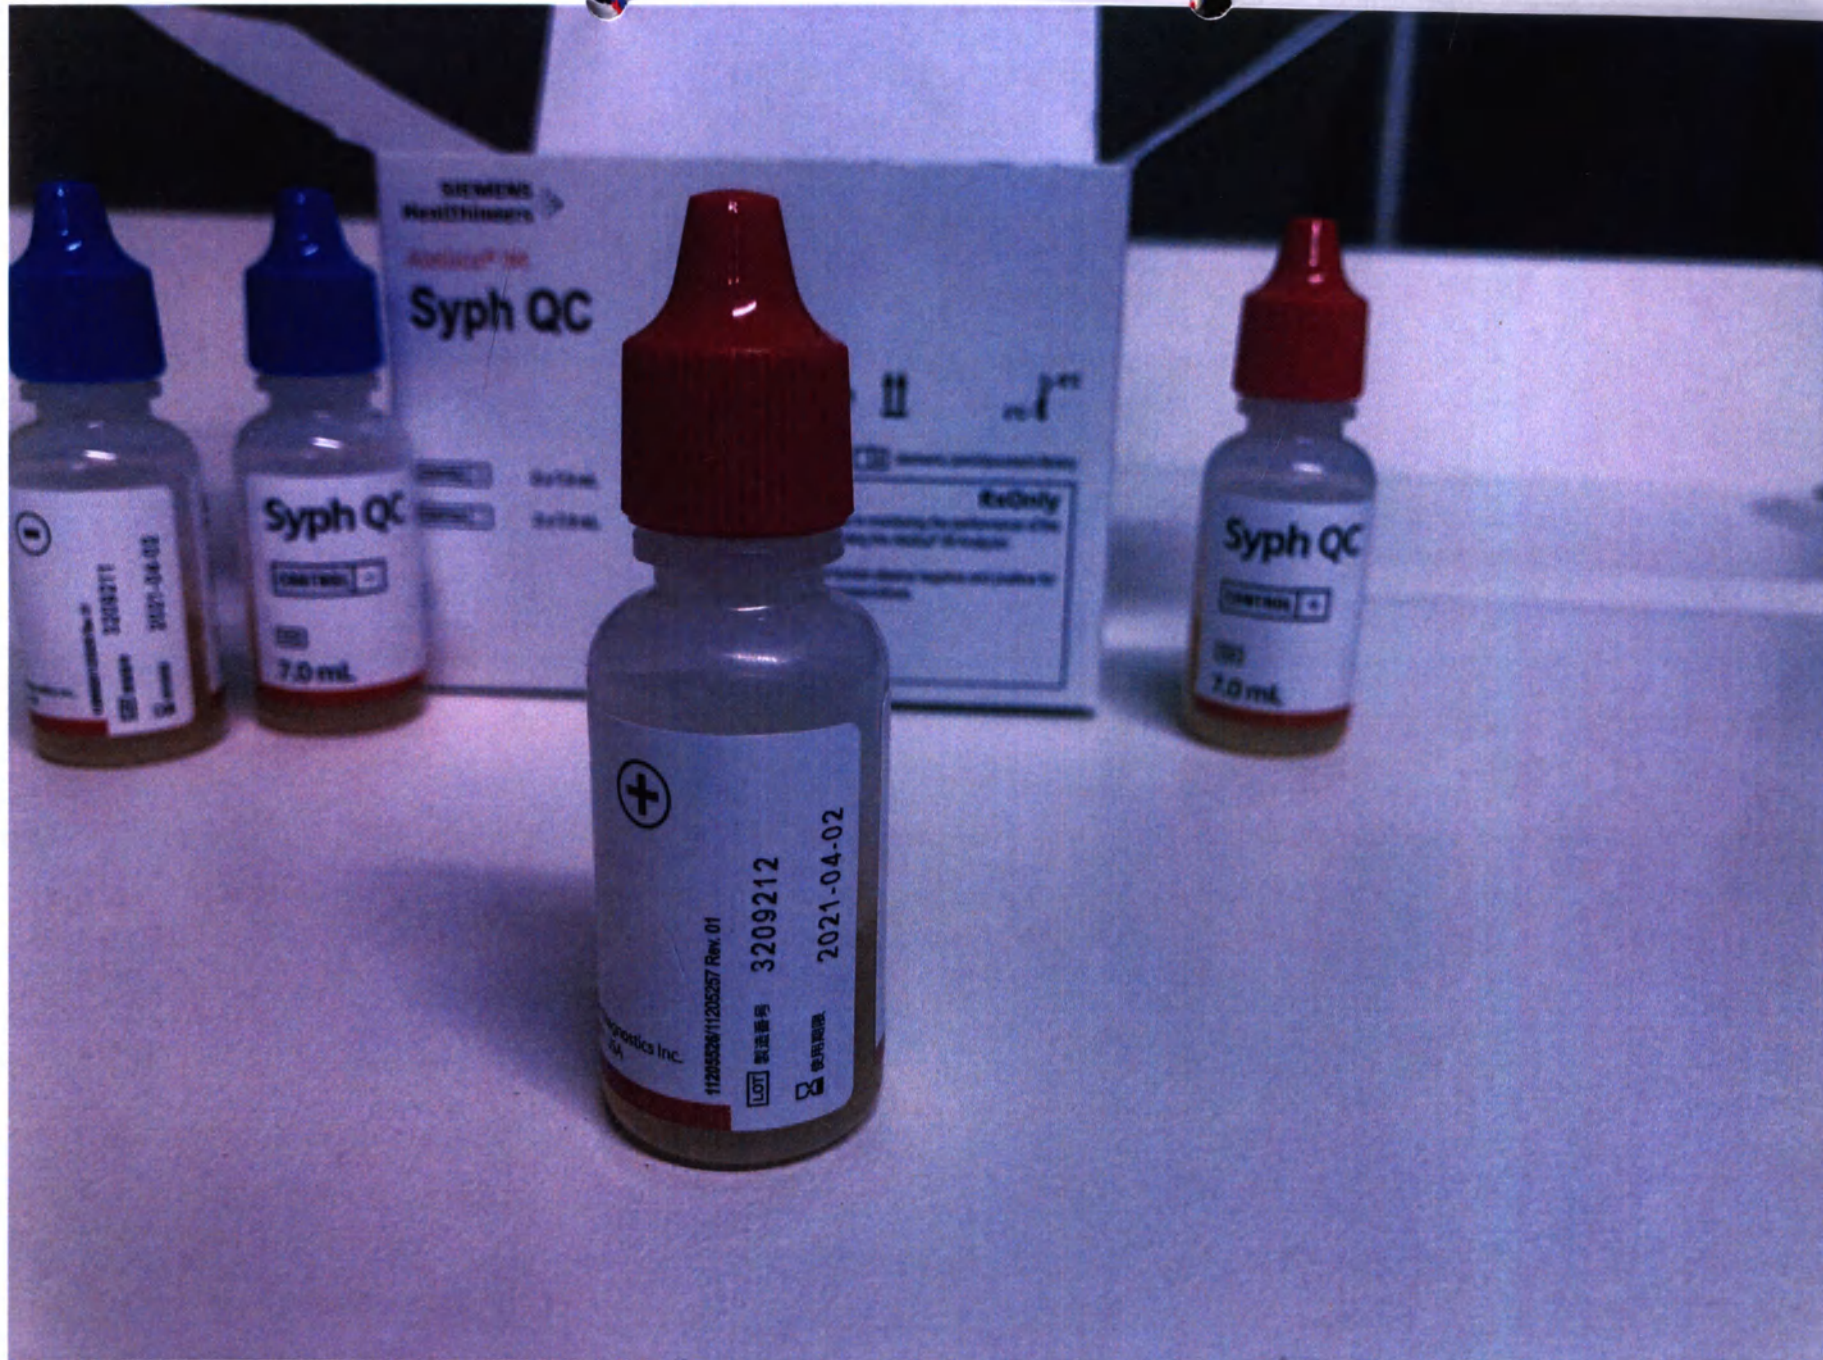


Рисунок 7. Набор контрольных материалов для определения сифилиса на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Syphilis Quality Control (Atellica IM Syph QC)). Контрольный материал положительный Atellica IM Syph QC CONTROL +, 7,0 мл

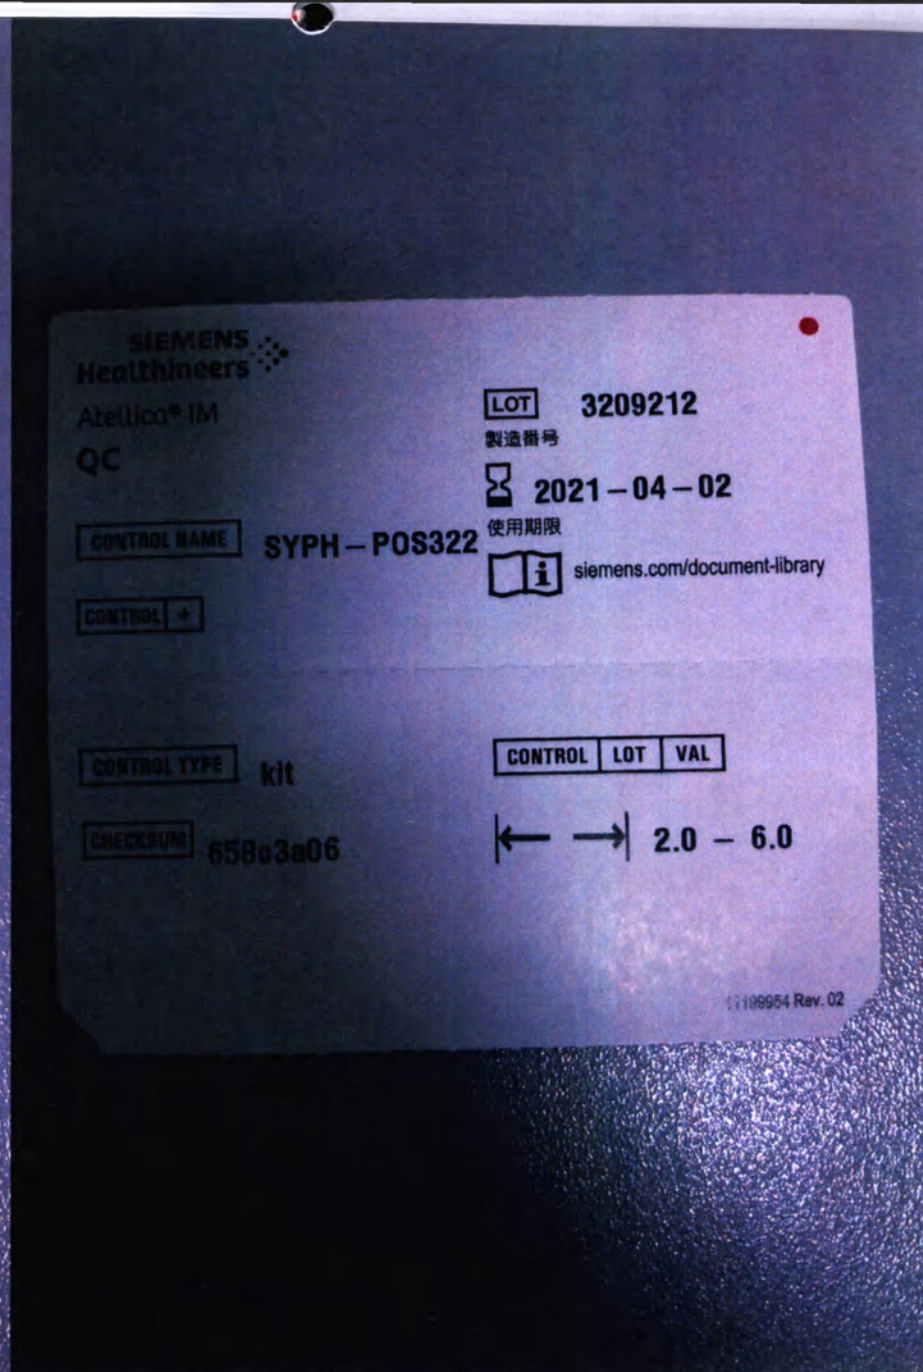
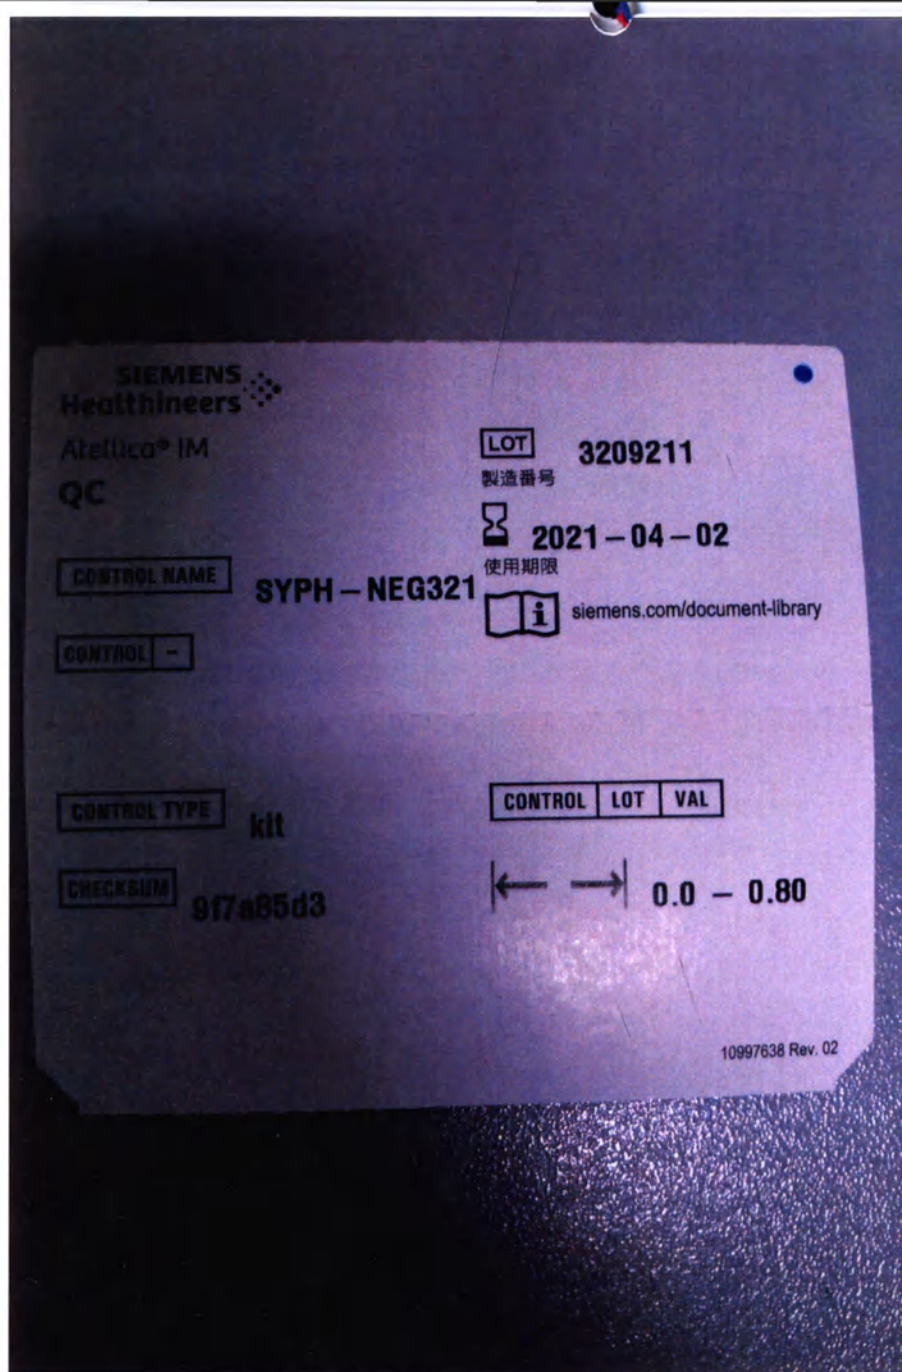


Рисунок 8. Набор контрольных материалов для определения сифилиса на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Syphilis Quality Control (Atellica IM Syph QC)).

SIEMENS
Healthineers

Atellica® IM

Syph QC

H412
P273, P501

10995676 Набор контрольных материалов для определения сифилиса на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Syphilis Quality Control (Atellica IM Syph QC))

Информация о производителе и стране происхождения см. на упаковке

Регистрационное удостоверение

№ РЗН 2020/10240 от 14.05.2020

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на оригинальной упаковке

Инструкция по применению на русском языке Явч. 82

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Остаток: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению

Апериодический производитель расположен на территории Российской Федерации

ООО «Сименс ЗдоровьеCare», 115093, Москва, ул. Дубининская, 98

アテリカIM TP抗体（梅毒）コントロール

Рисунок 9 Фотографическое изображение упаковки и макета маркировки медицинского изделия, содержащего информацию на русском языке.



Всего прошито и пронумеровано
10 листа (ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»

