

ПОДТВЕРЖДАЮ

Руководитель отдела качества и
корпоративных технологий


Медведева И.Б.

2020 г.



Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики *in vitro*

Набор реагентов для определения общего белка на анализаторах биохимических
серии Atellica (Atellica CH Total Protein II (Atellica CH TP))

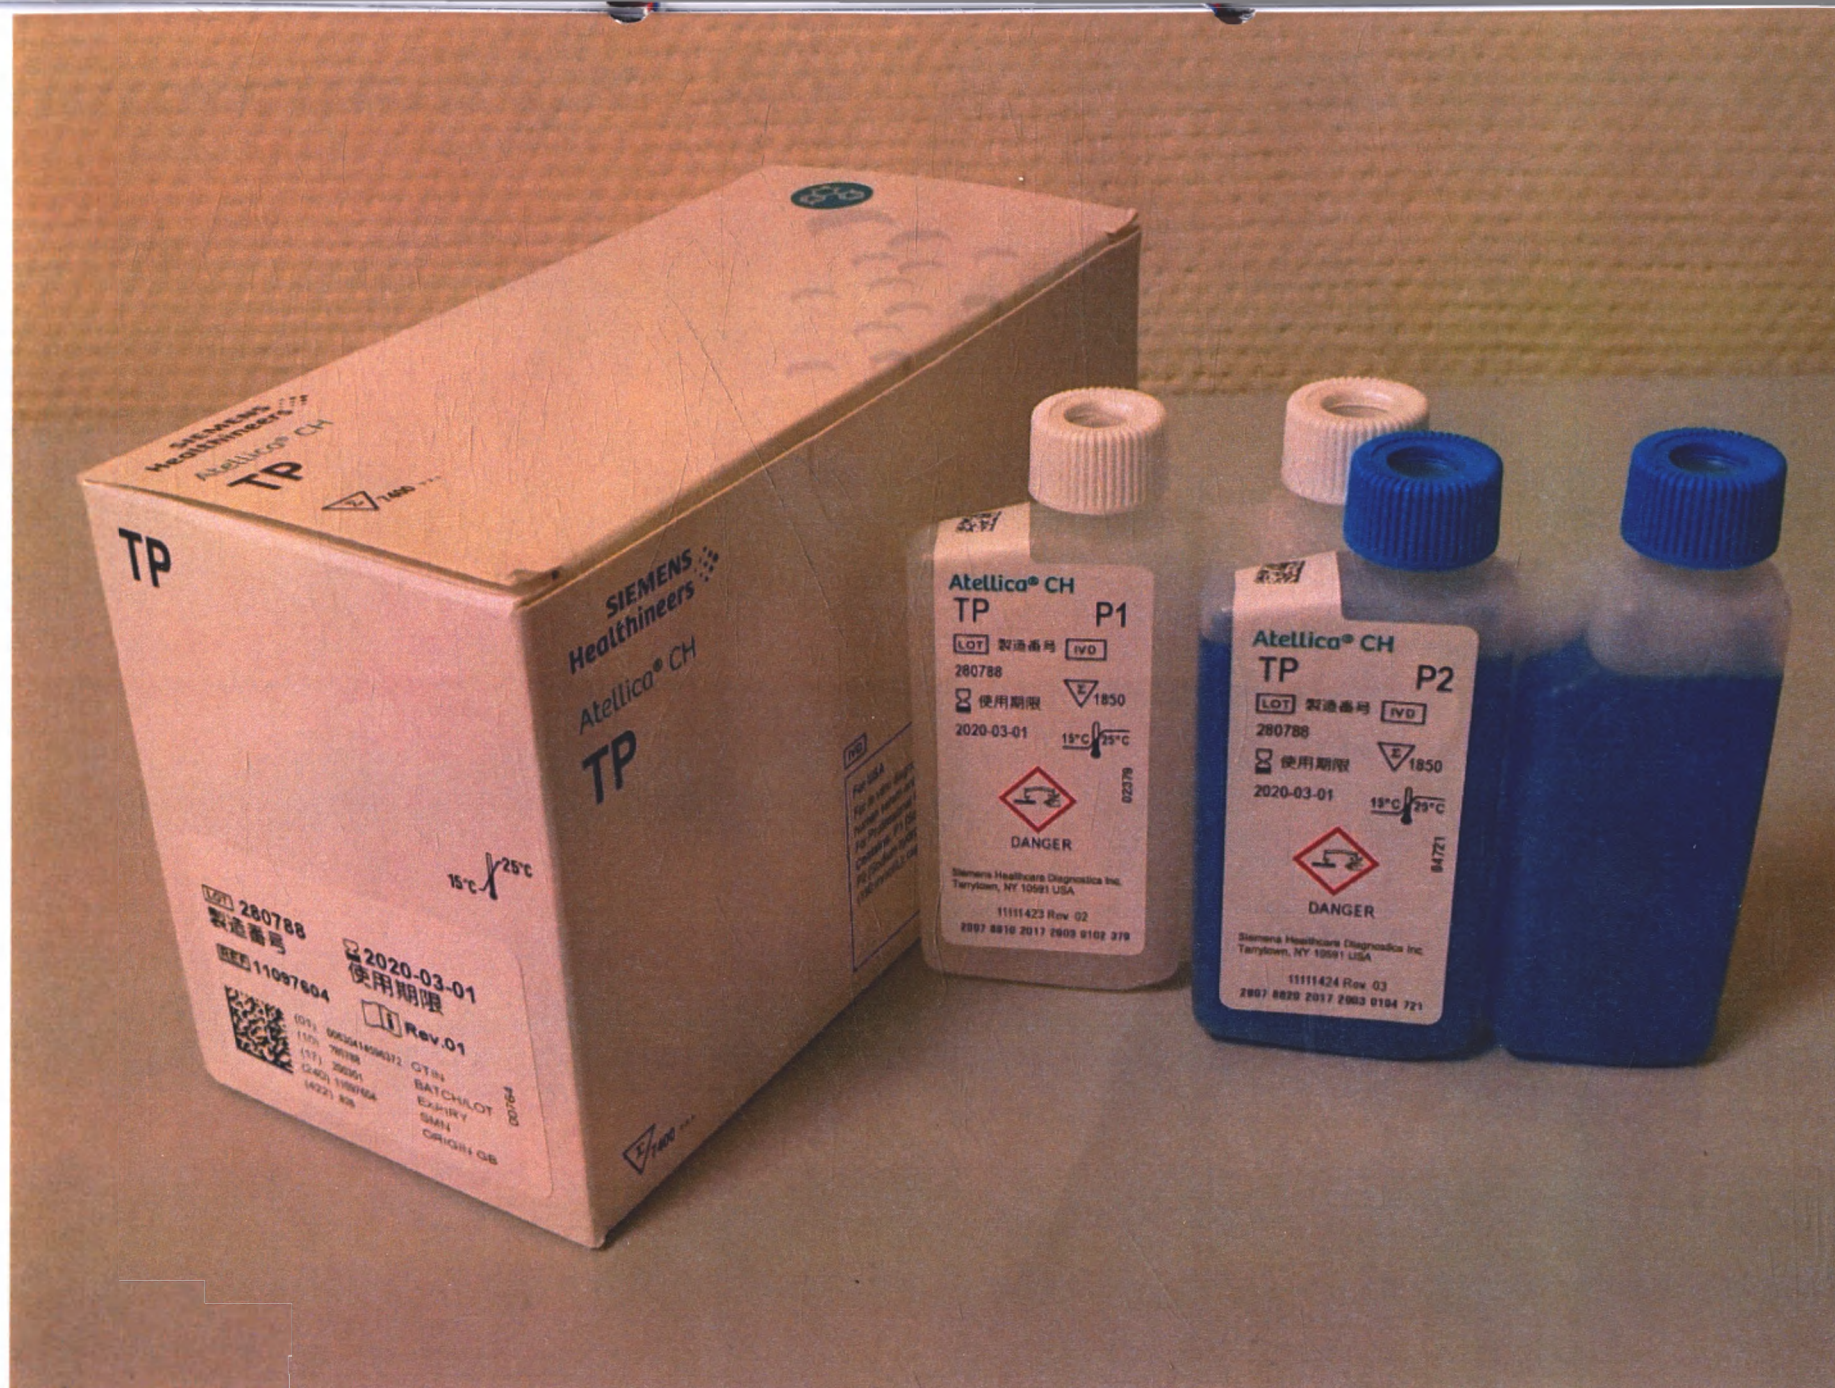



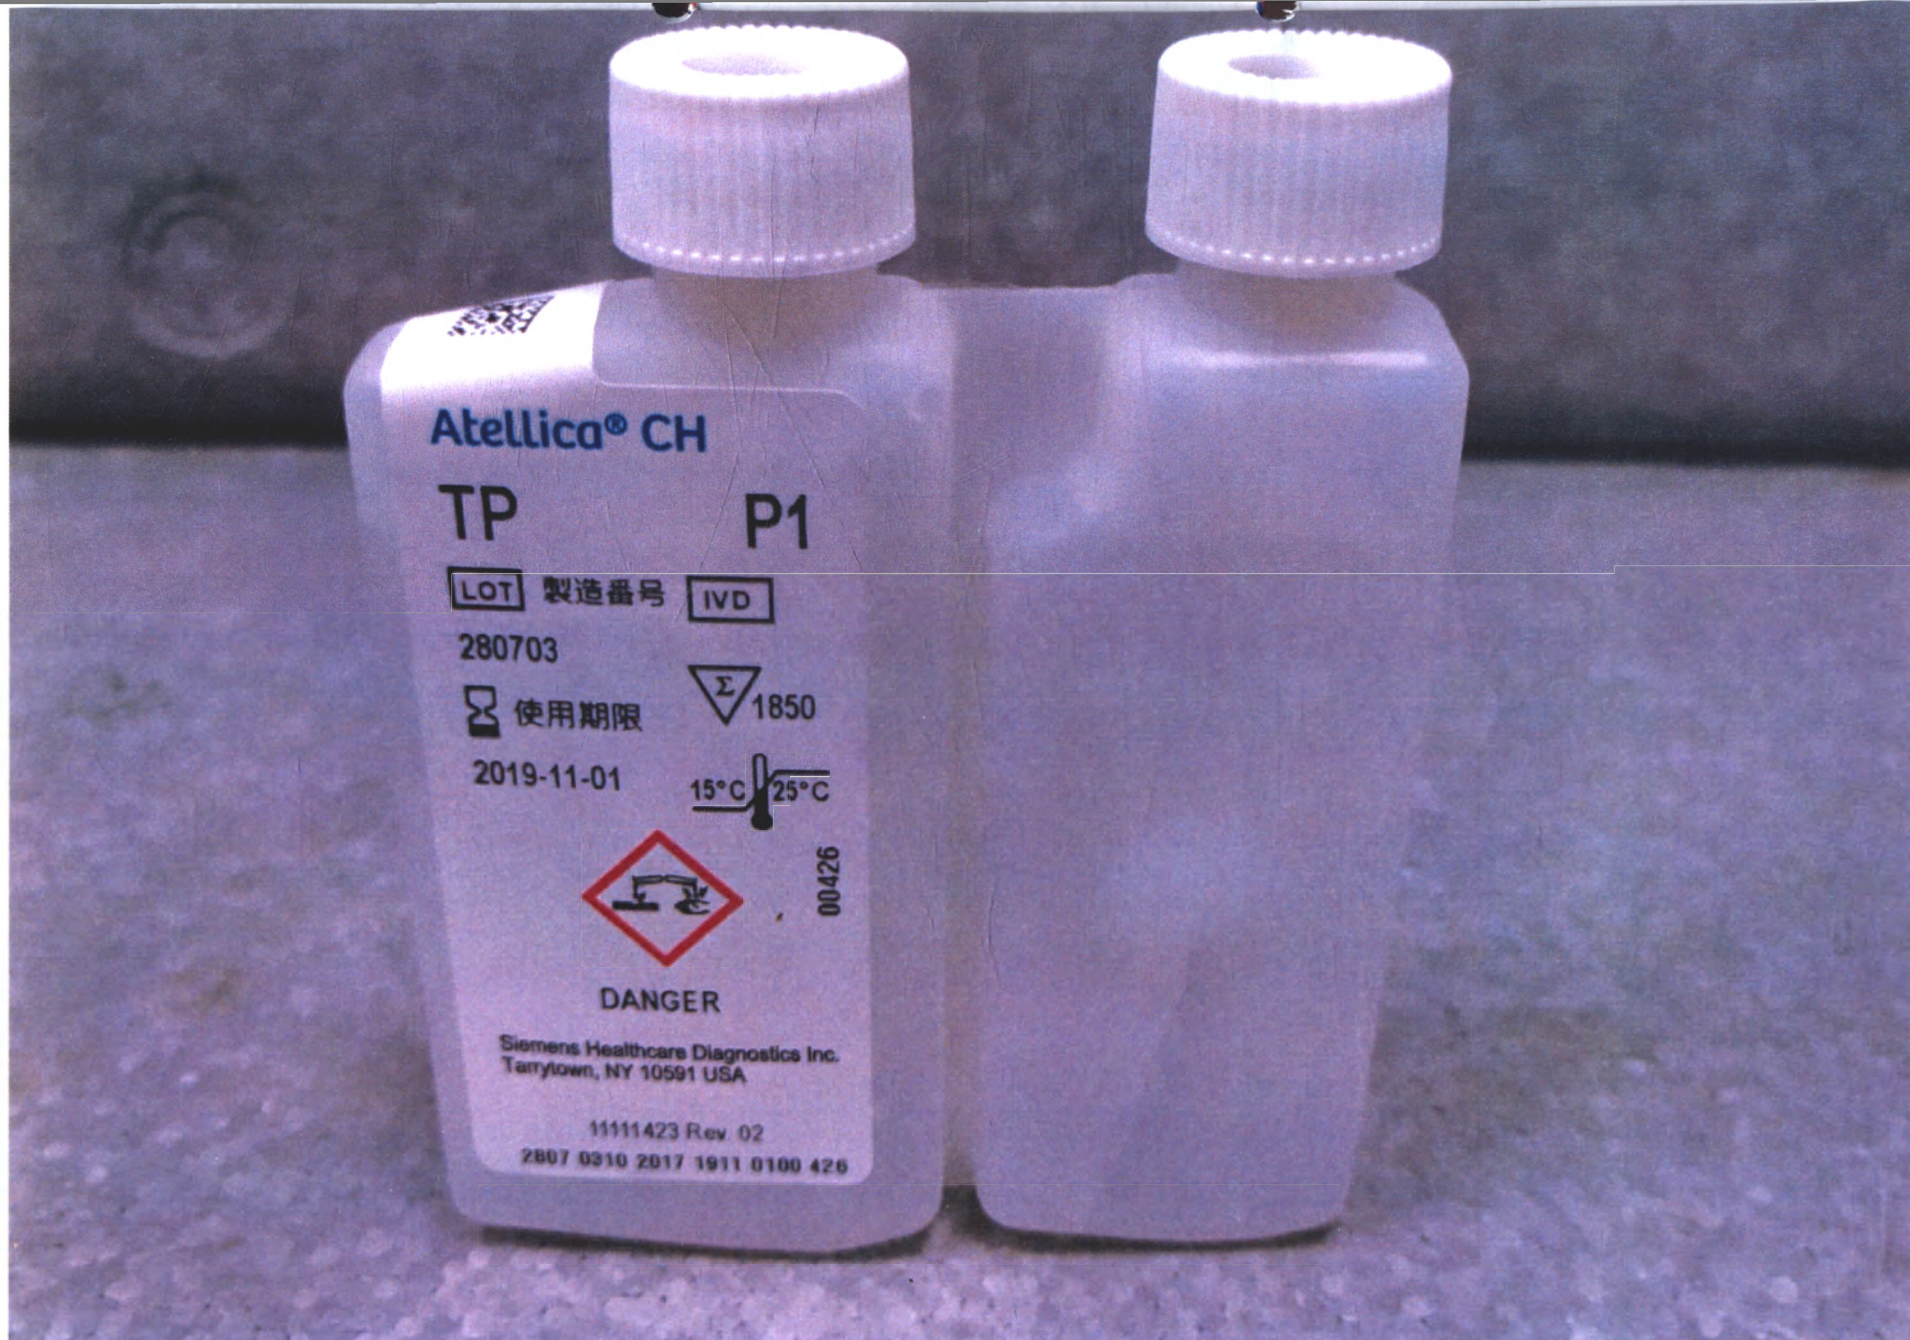


Рисунок 3 Набор реагентов для определения общего белка на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica CH Total Protein II (Atellica CH TP)): флаконы с реагентами, общий вид, пакет 2.



Всего прошито и пронумеровано 4 листа (ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»