

Руководитель отдела качества и
корпоративных технологий

• Медведева И.Б.

« 12 » марта 2020 г.



Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики in vitro

Набор реагентов для определения кальция на анализаторах биохимических серии
Atellica (Atellica CH Calcium (Atellica CH Ca))



Рисунок 1. Набор реагентов для определения кальция на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica CH Calcium (Atellica CH Ca)): общий вид изделия

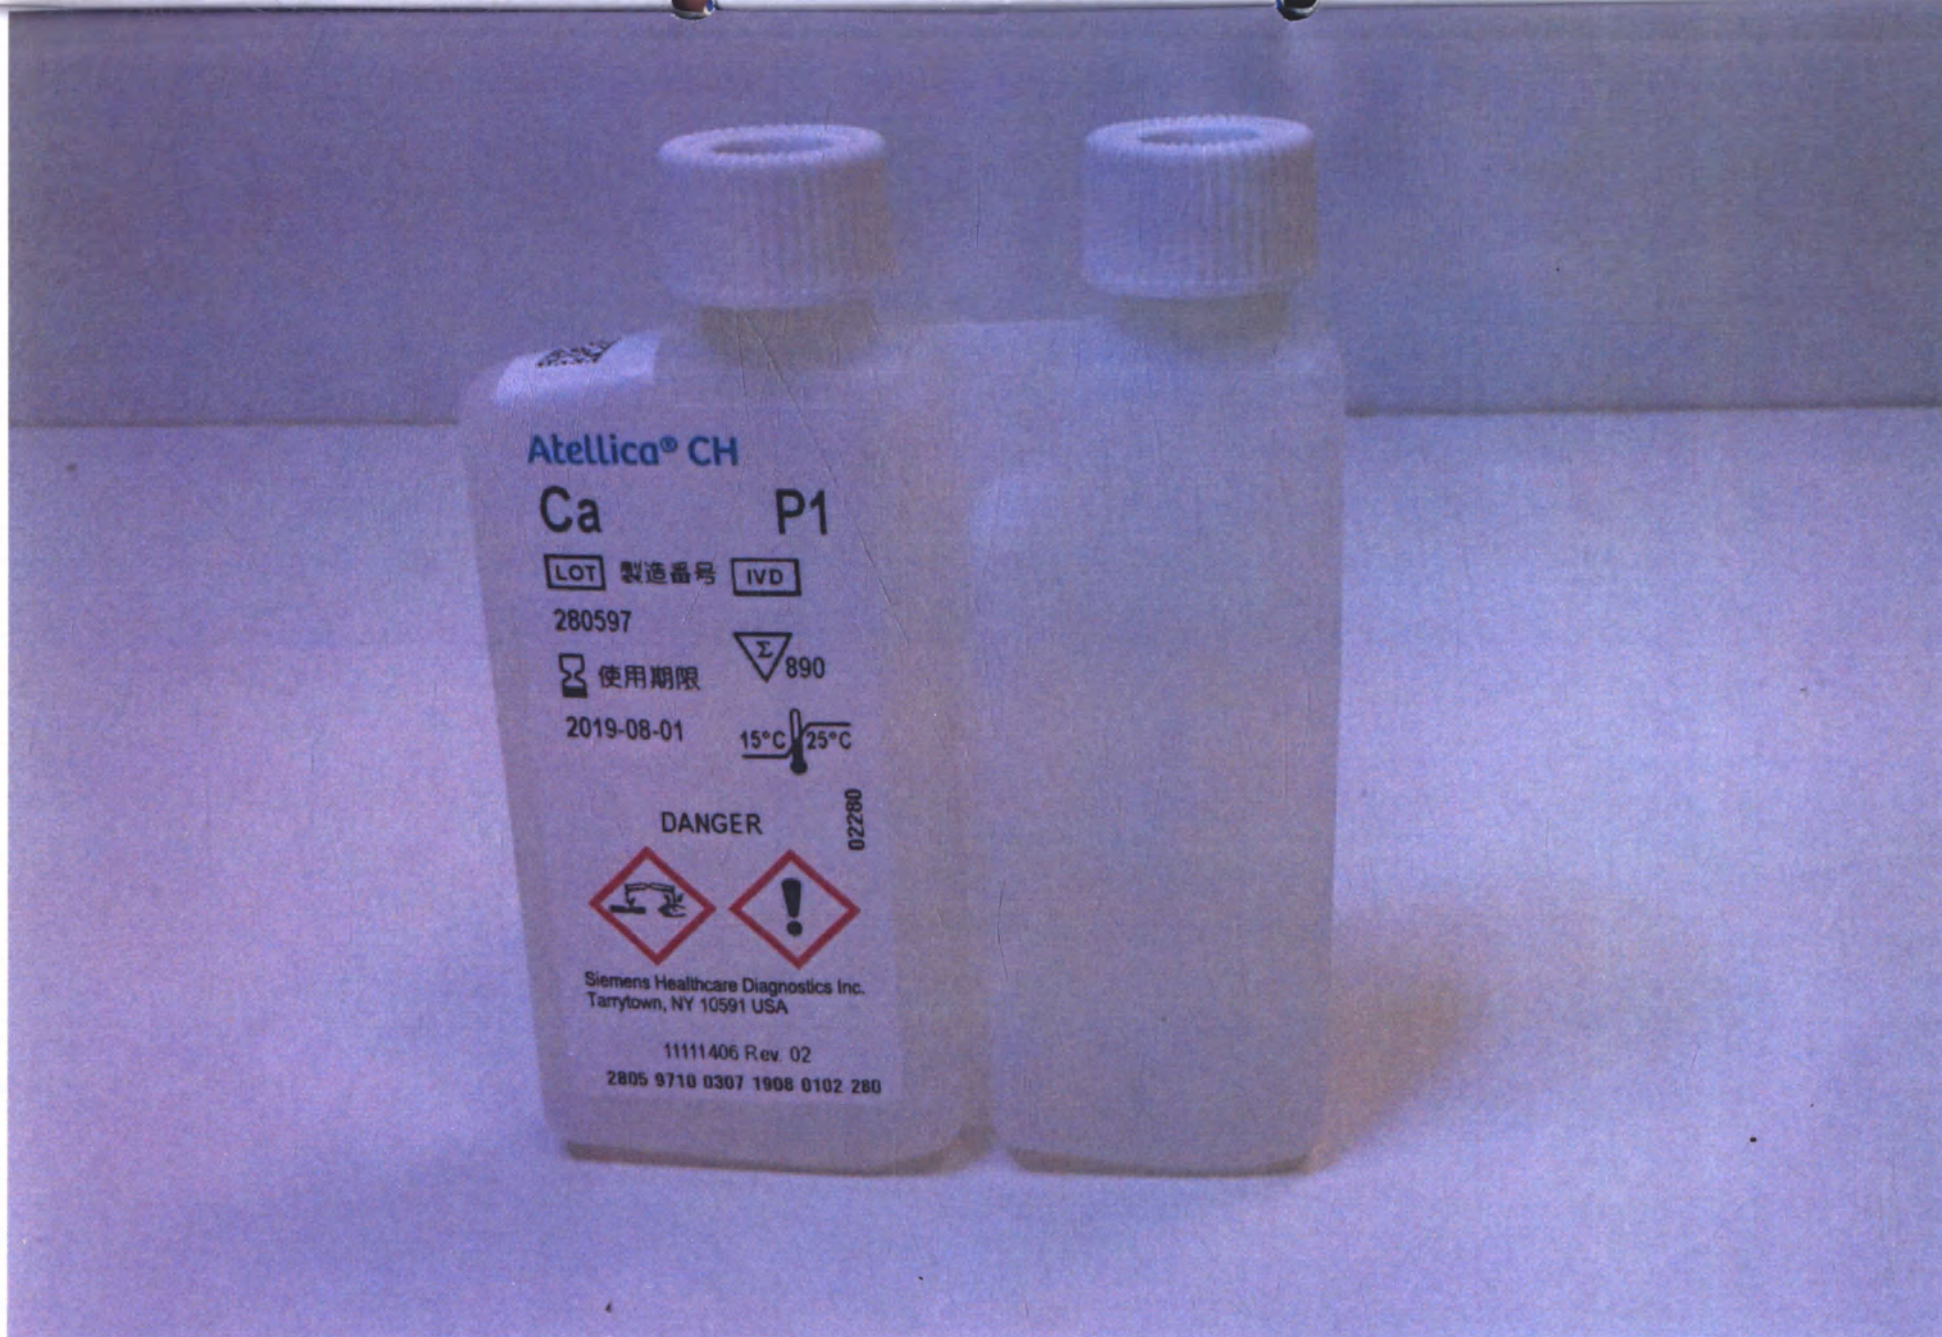


Рисунок 2. Набор реагентов для определения кальция на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica CH Calcium (Atellica CH Ca)): флаконы с реагентами, общий вид, упаковка I

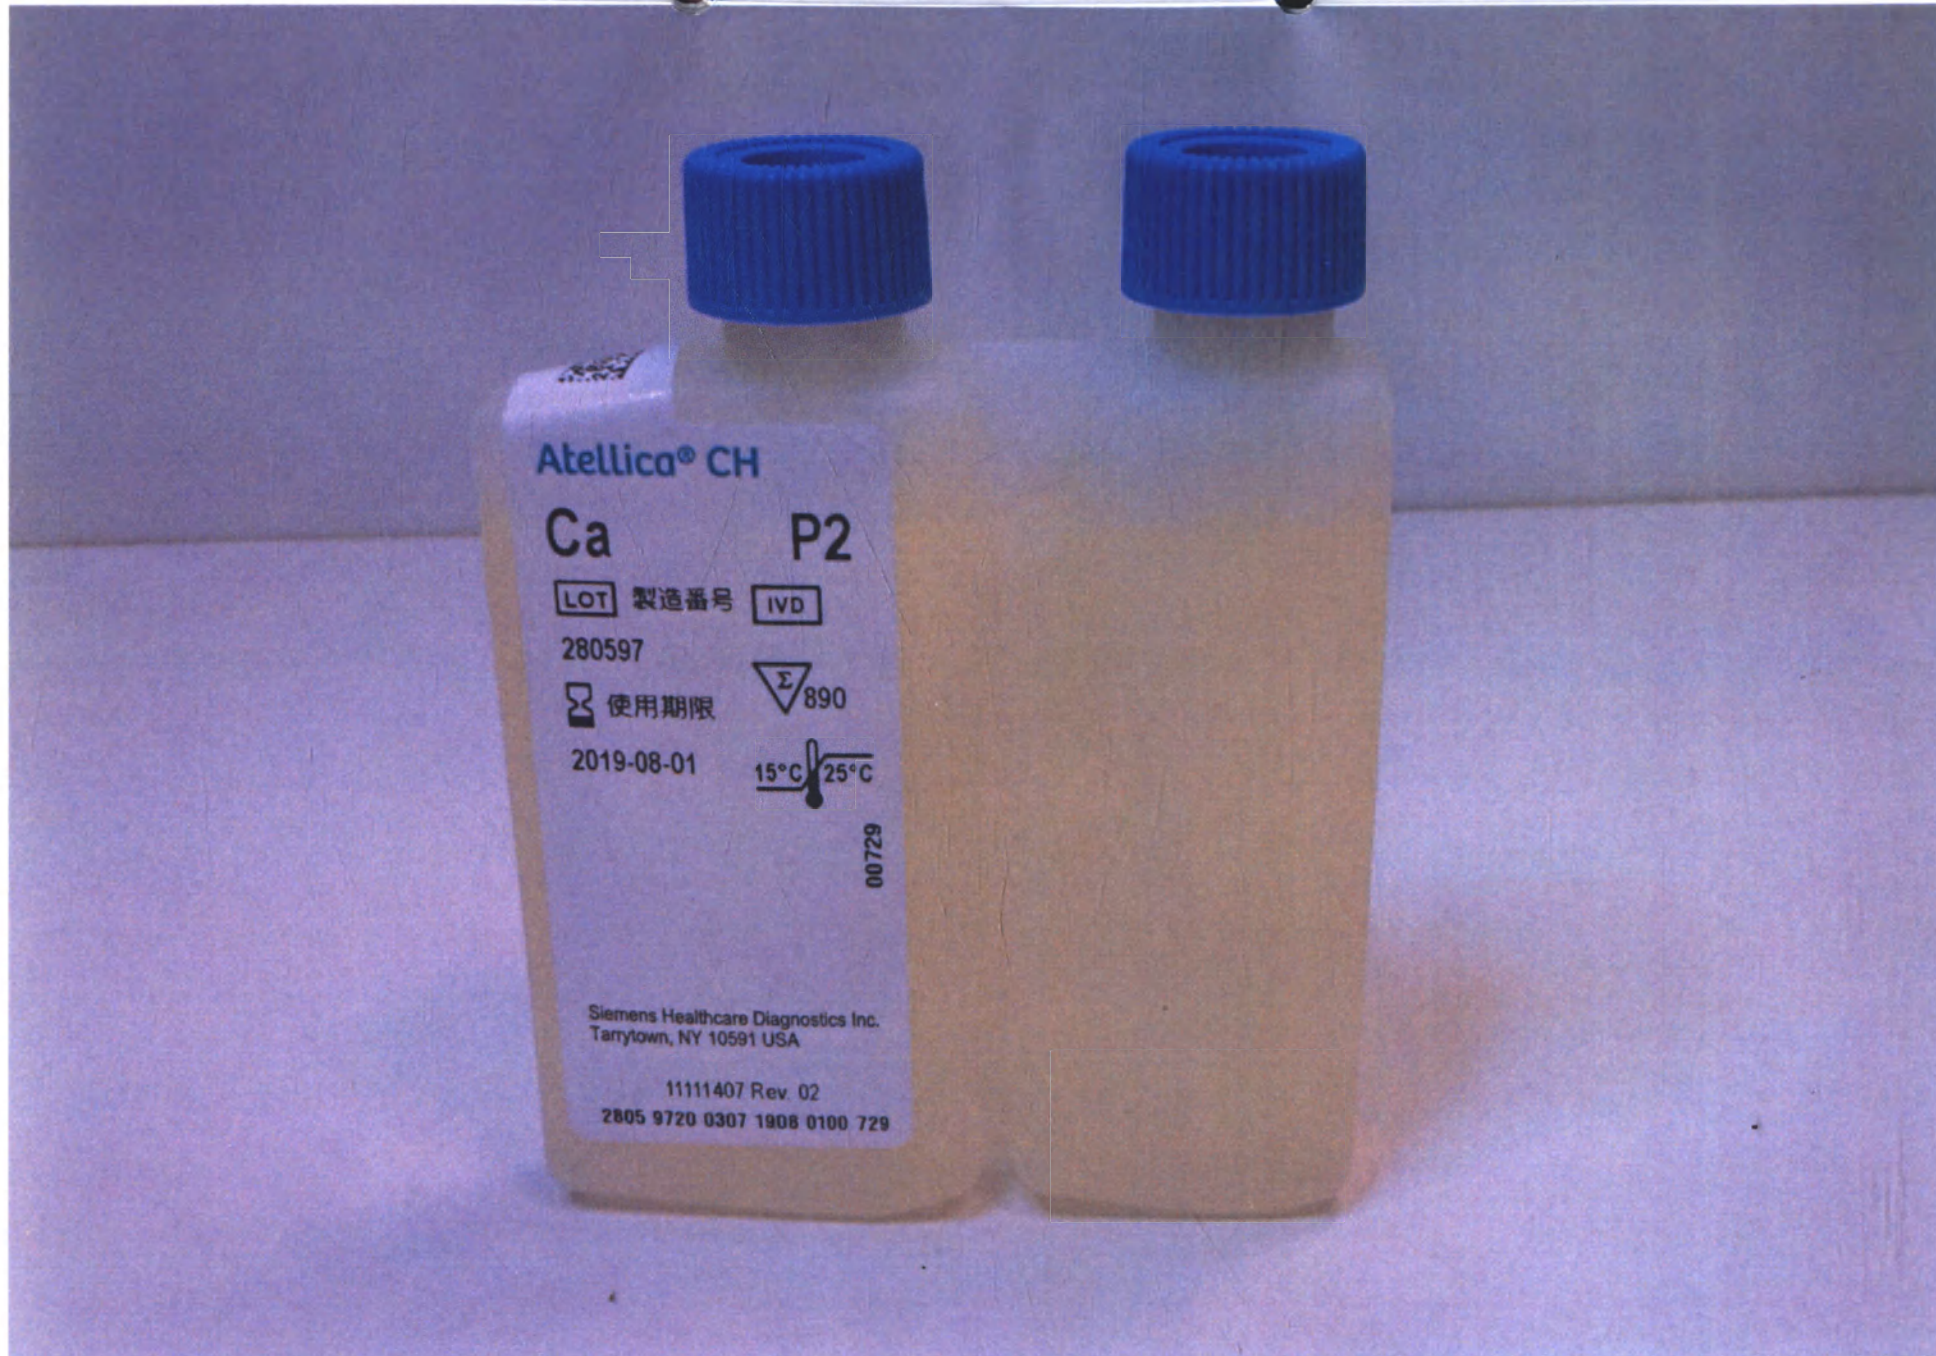


Рисунок 3 Набор реагентов для определения кальция на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica CH Calcium (Atellica CH Ca)): флаконы с реагентами, общий вид, упаковка 2.



Всего прошито и пронумеровано 4 листа (ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»