

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО "ТПО "Медио Лаб"


Косырев А.Б.

М.П.




Фотографии медицинского изделия


**«Коагулометр полуавтоматический для диагностики *in vitro* в вариантах исполнения:
одноканальный ECL 105 и четырехканальный ECL 412 с принадлежностями»**

производства «Эрба Лахема» с.р.о /Erba Lachema s.r.o


1. Коагулометр полуавтоматический четырехканальный ECL 412

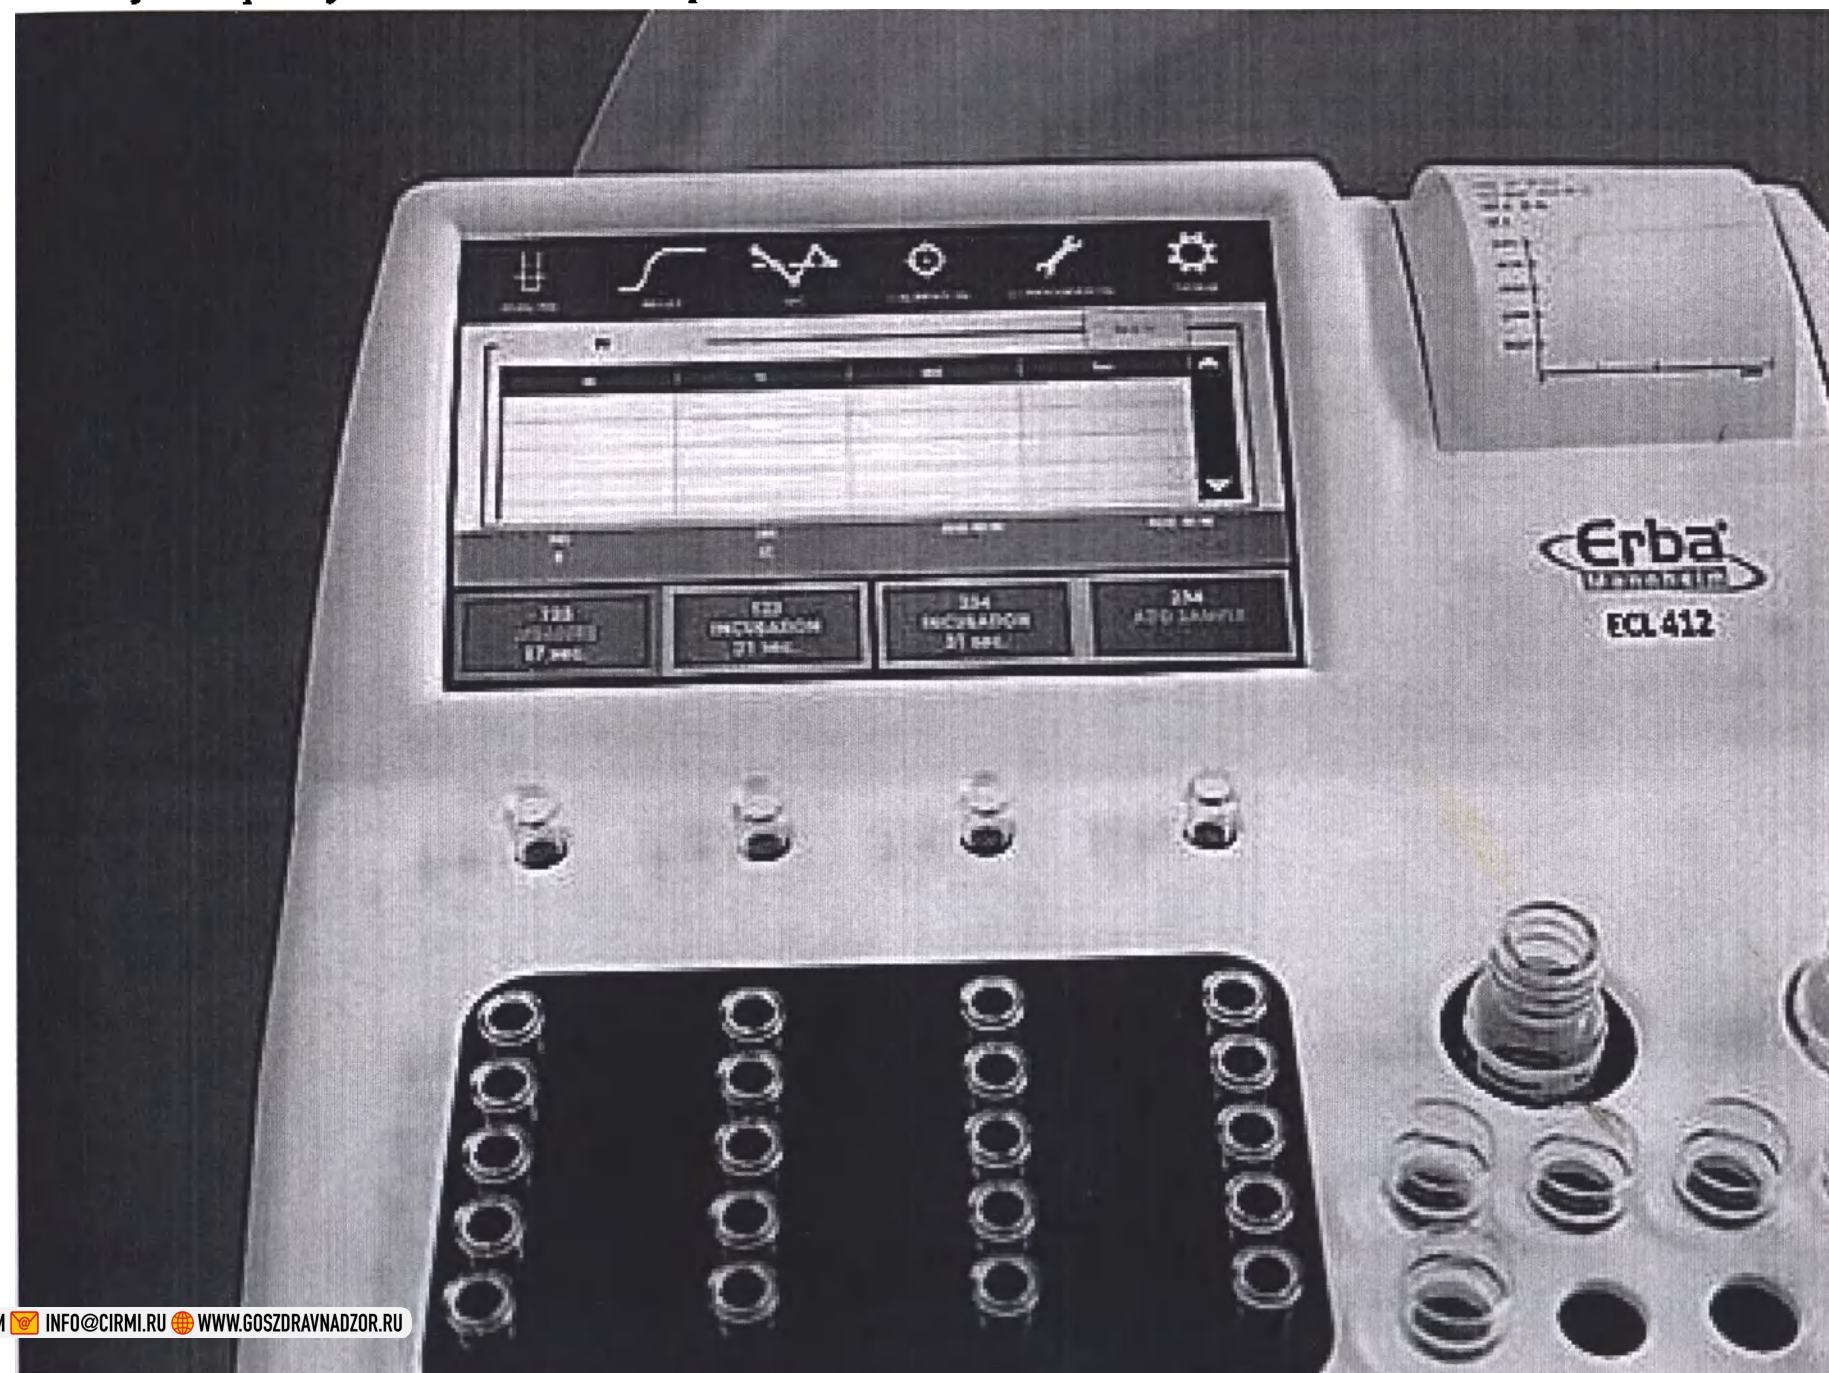


2. Коагулометр полуавтоматический одноканальный ECL 105

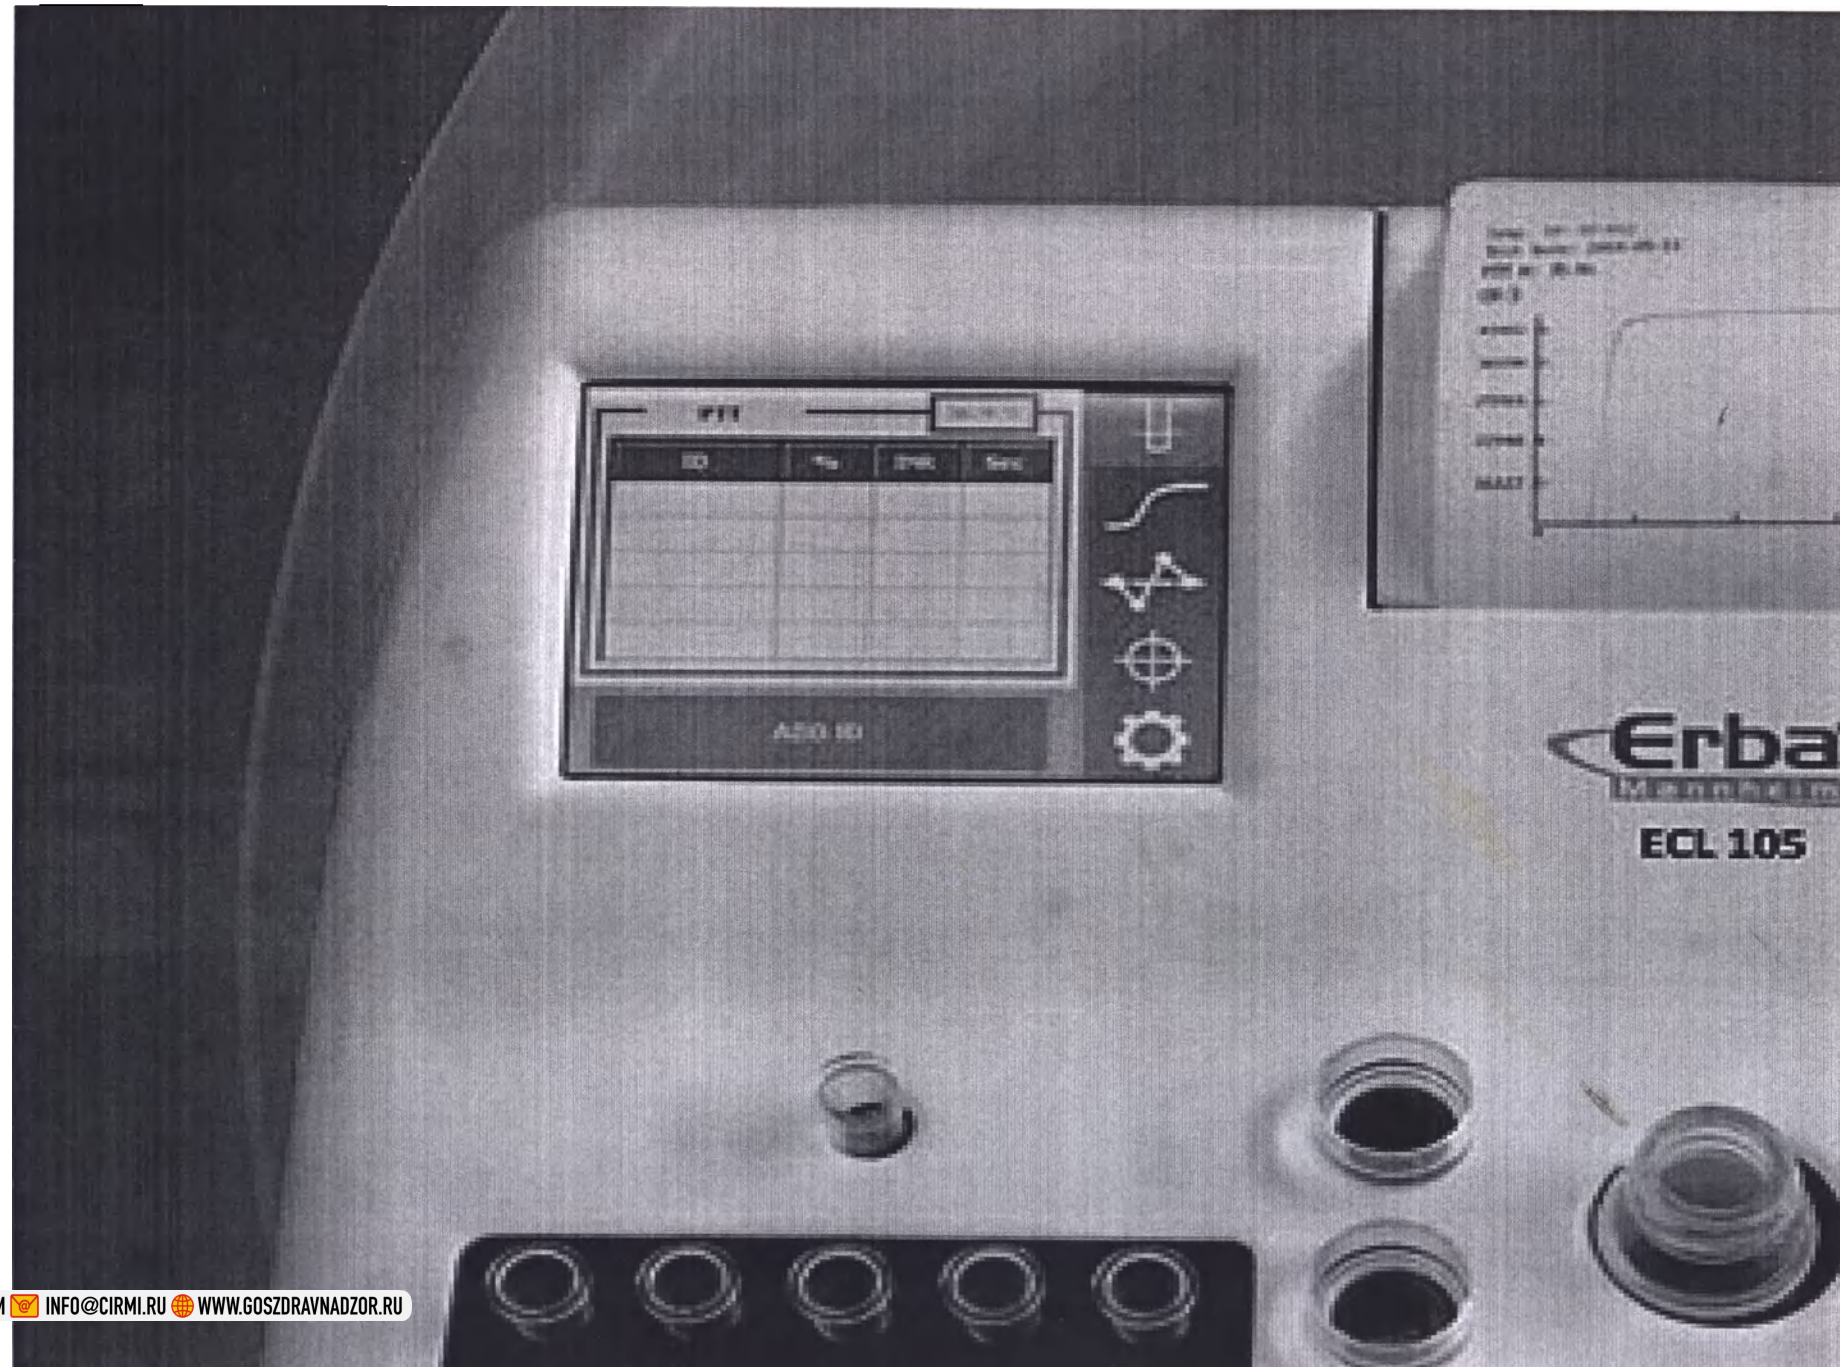


3. Внешний универсальный блок питания с кабелем внешнего блока питания;

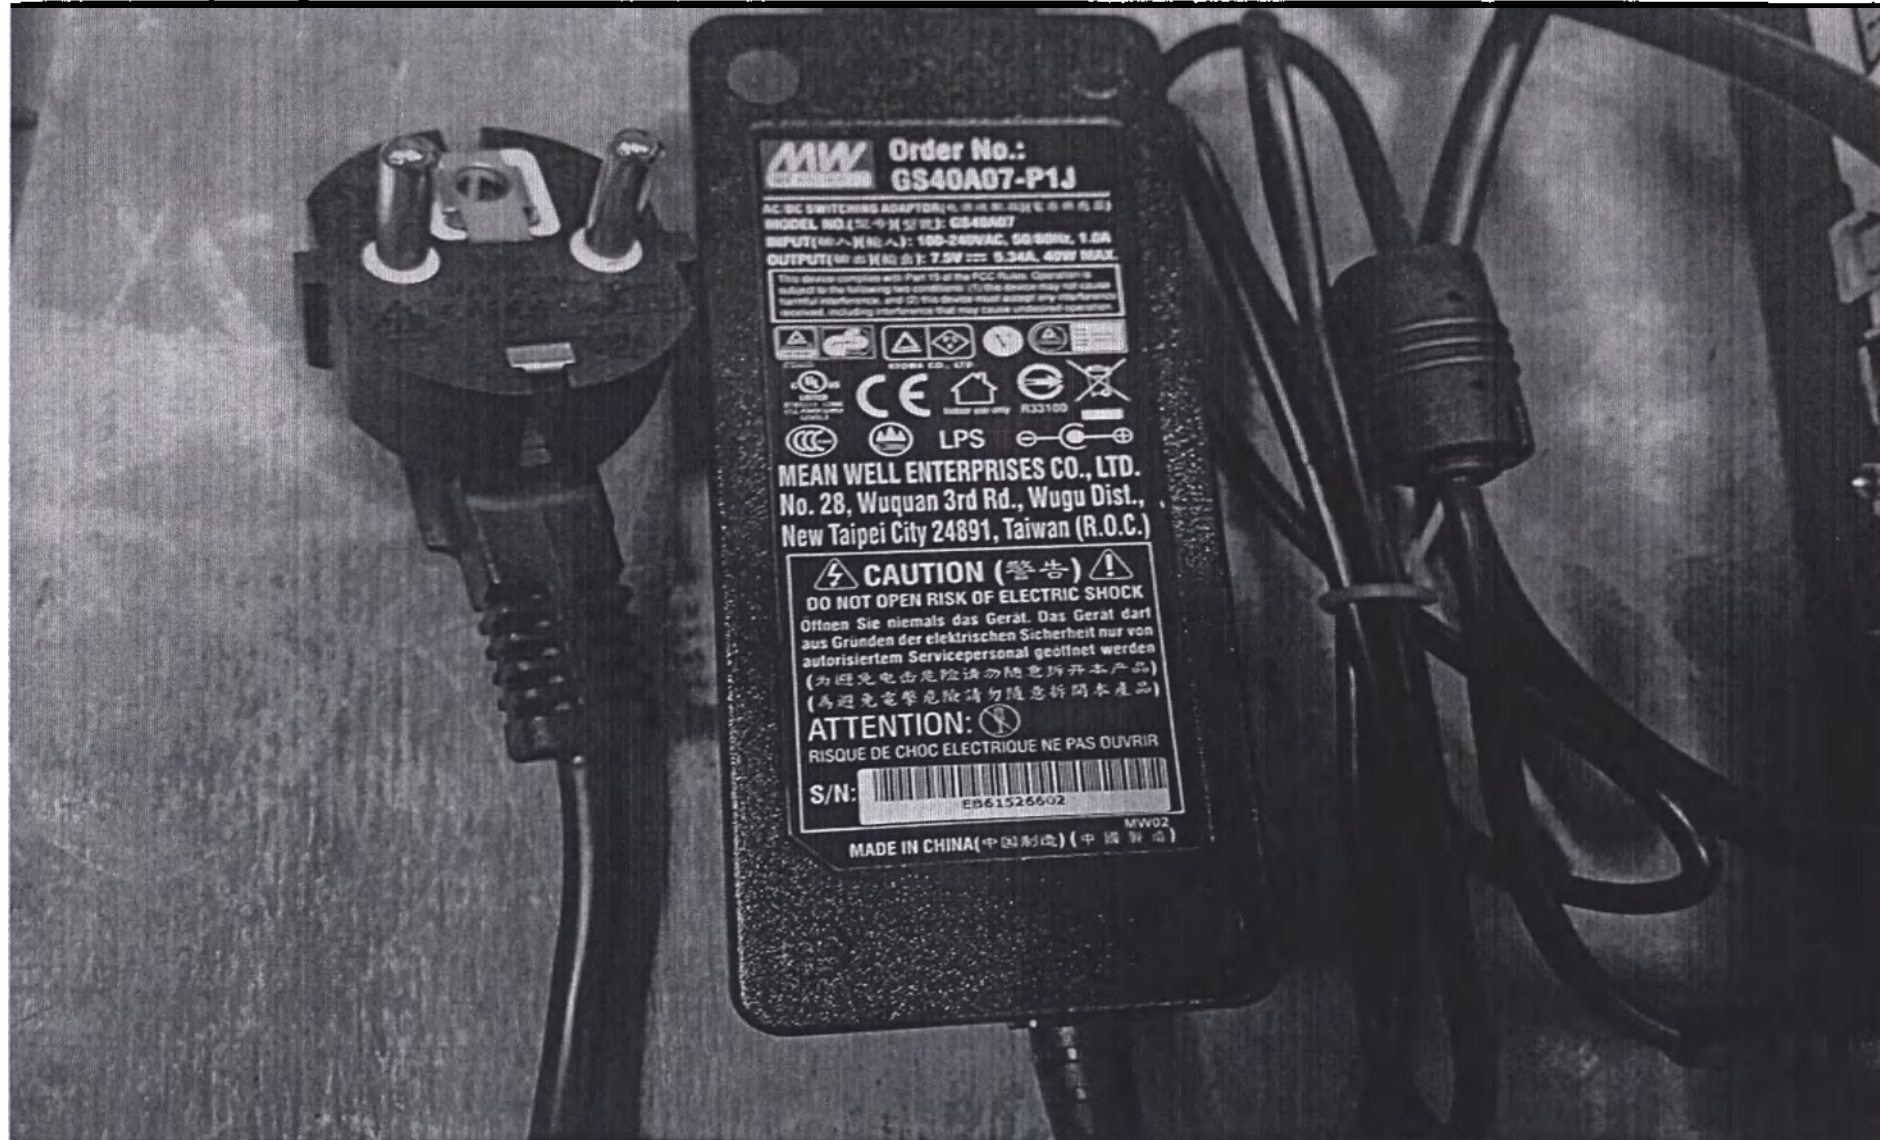


4. Дозатор пипеточный, одноканальный ДПОП-1-10-100

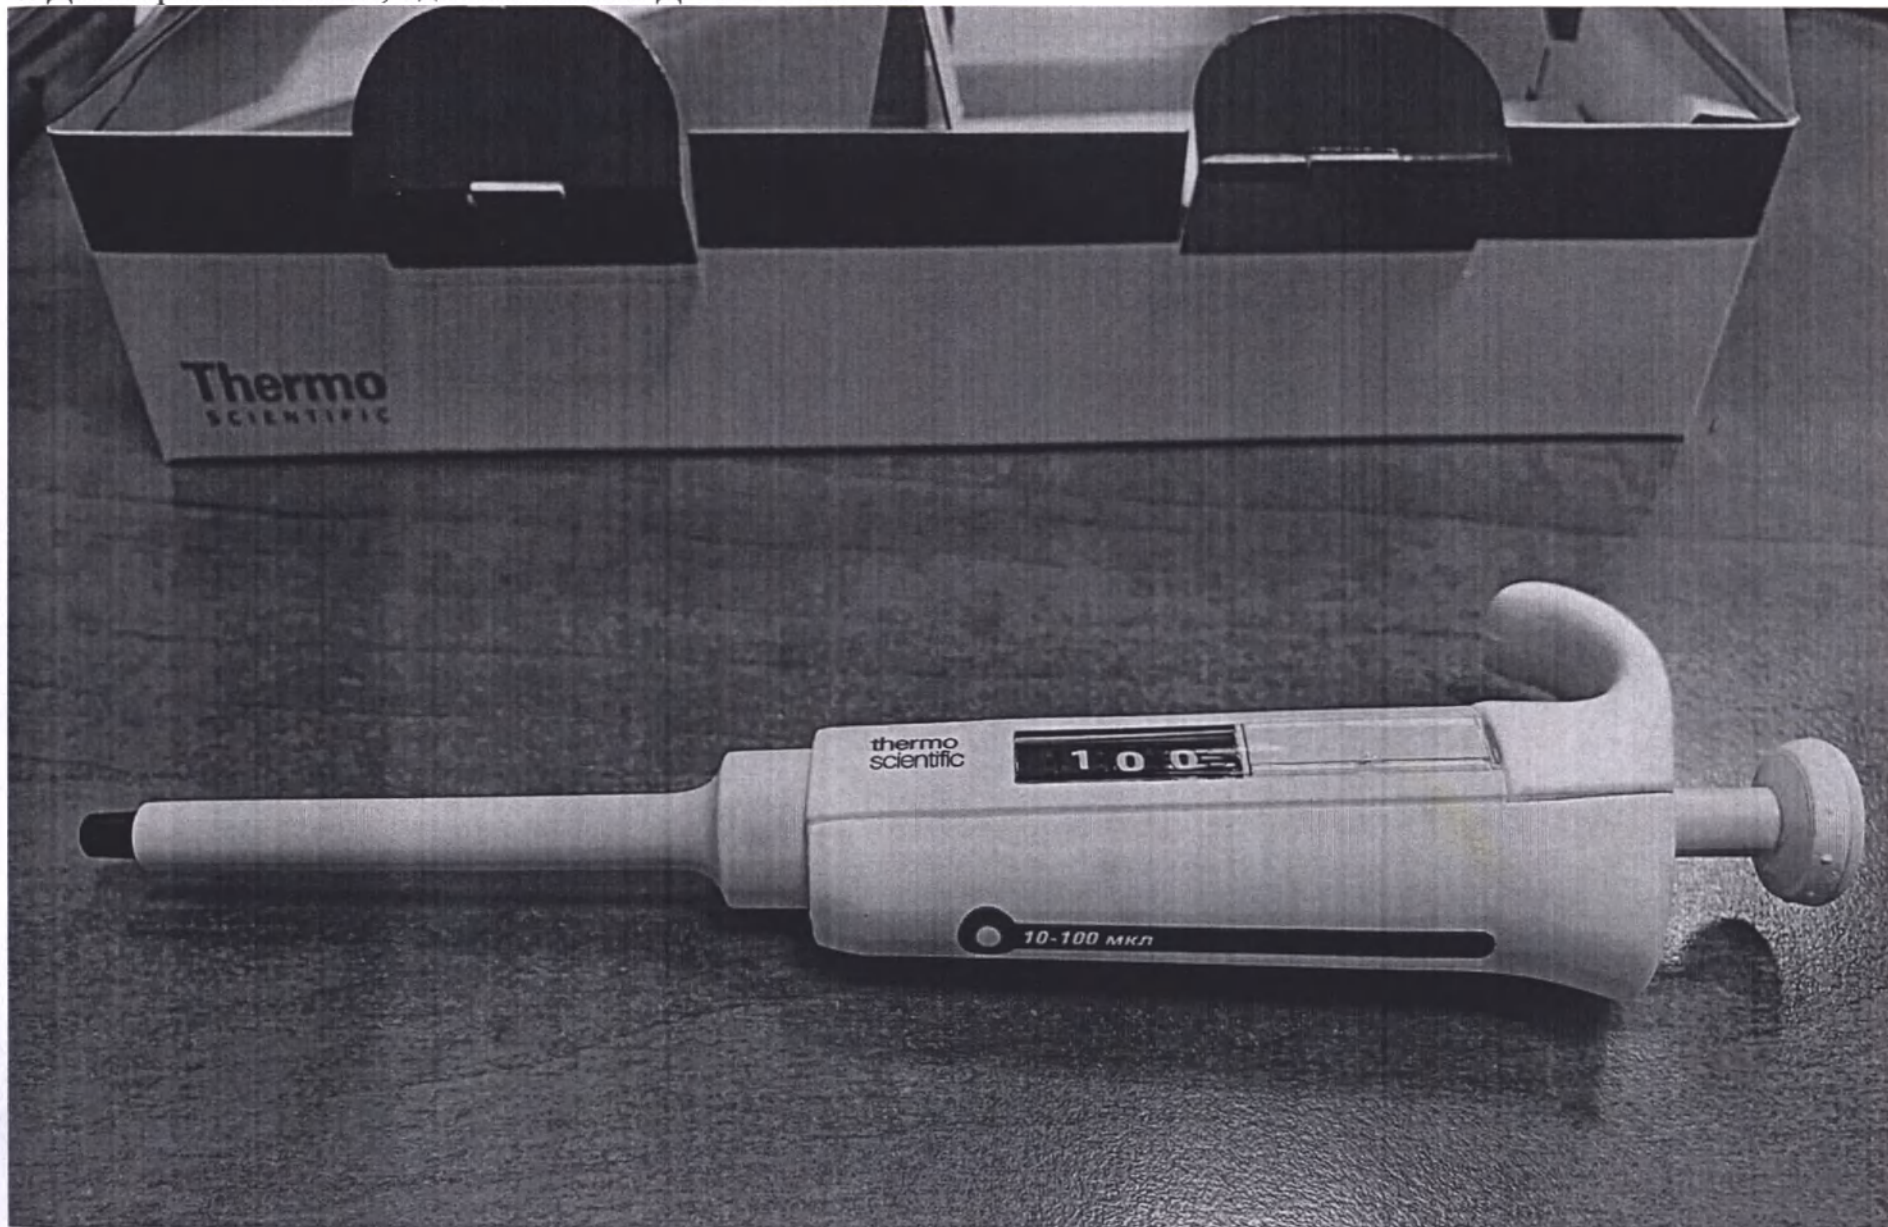


5. Рулон термографической бумаги шириной 57 мм (3 шт/уп)

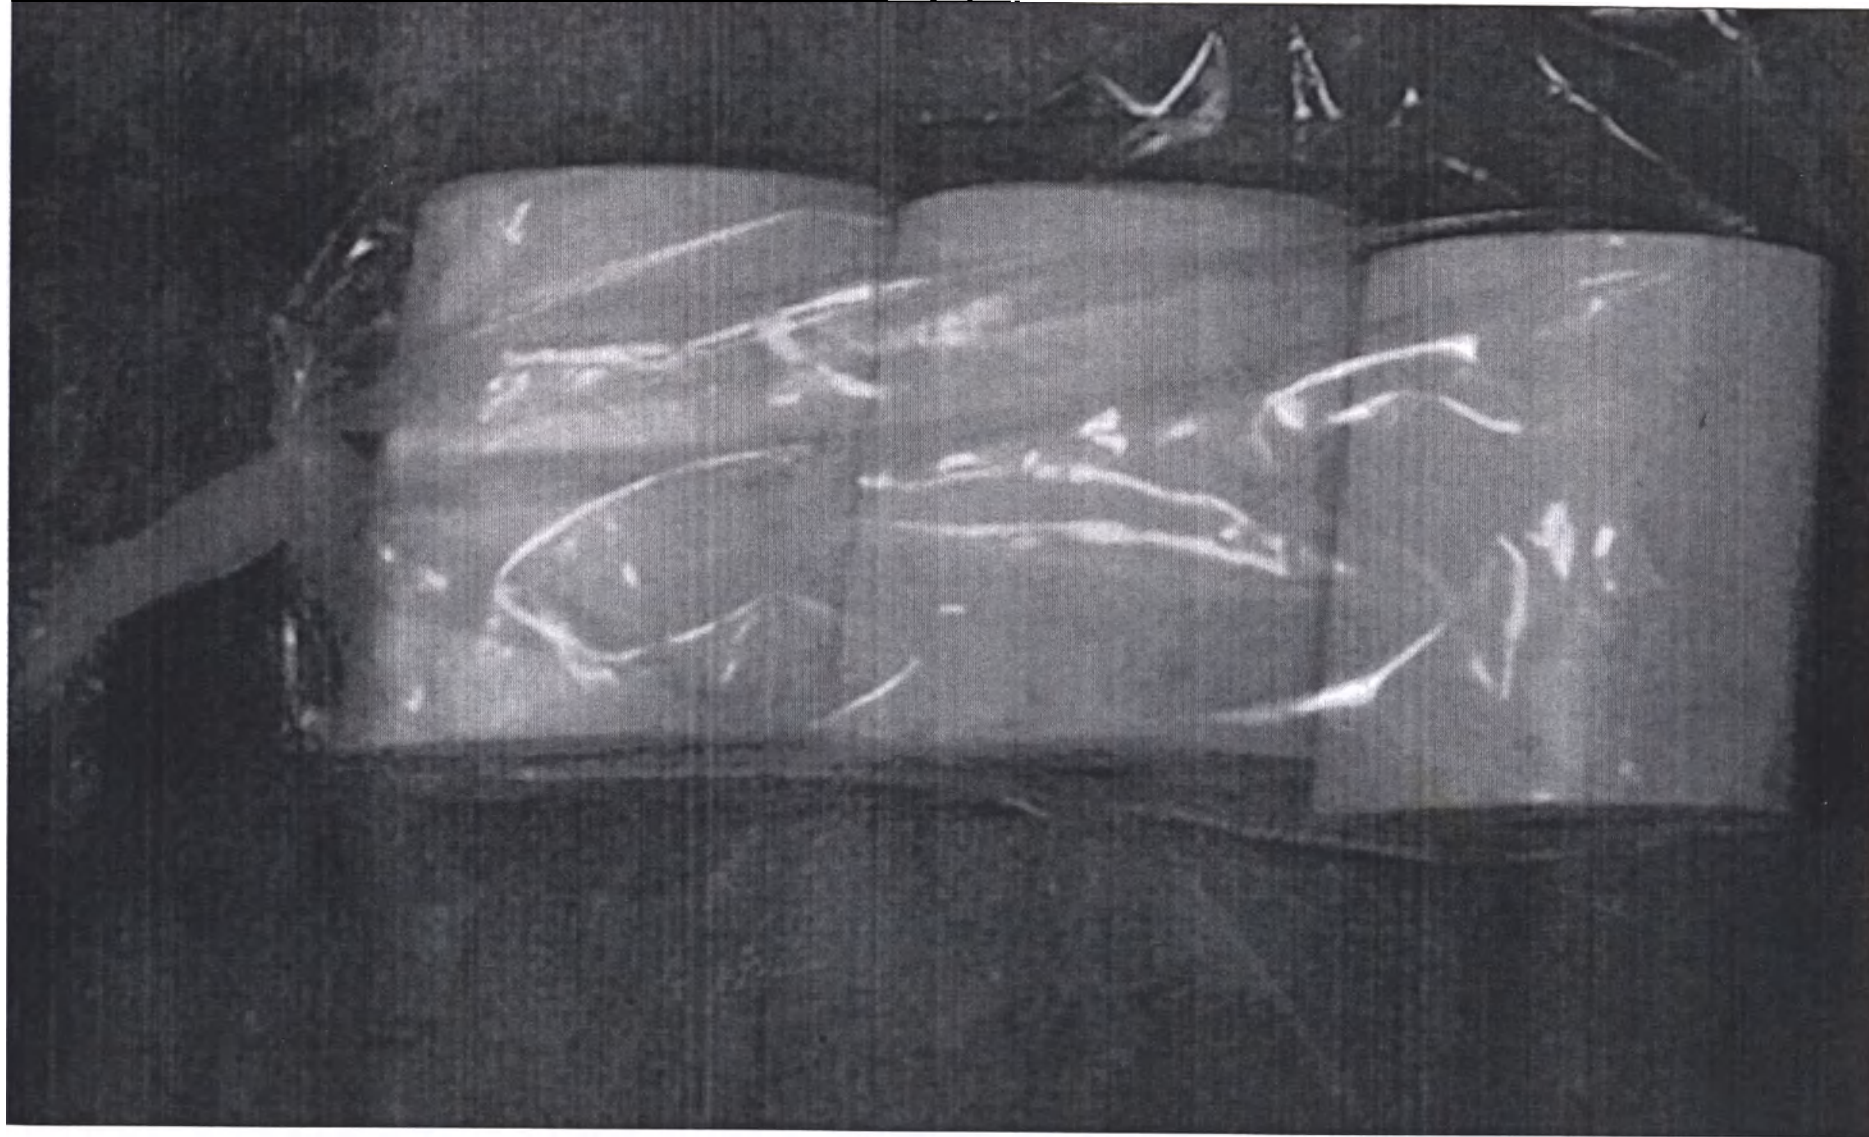


6. Одиночные реакционные кюветы, SRC-10 (500 шт/уп);

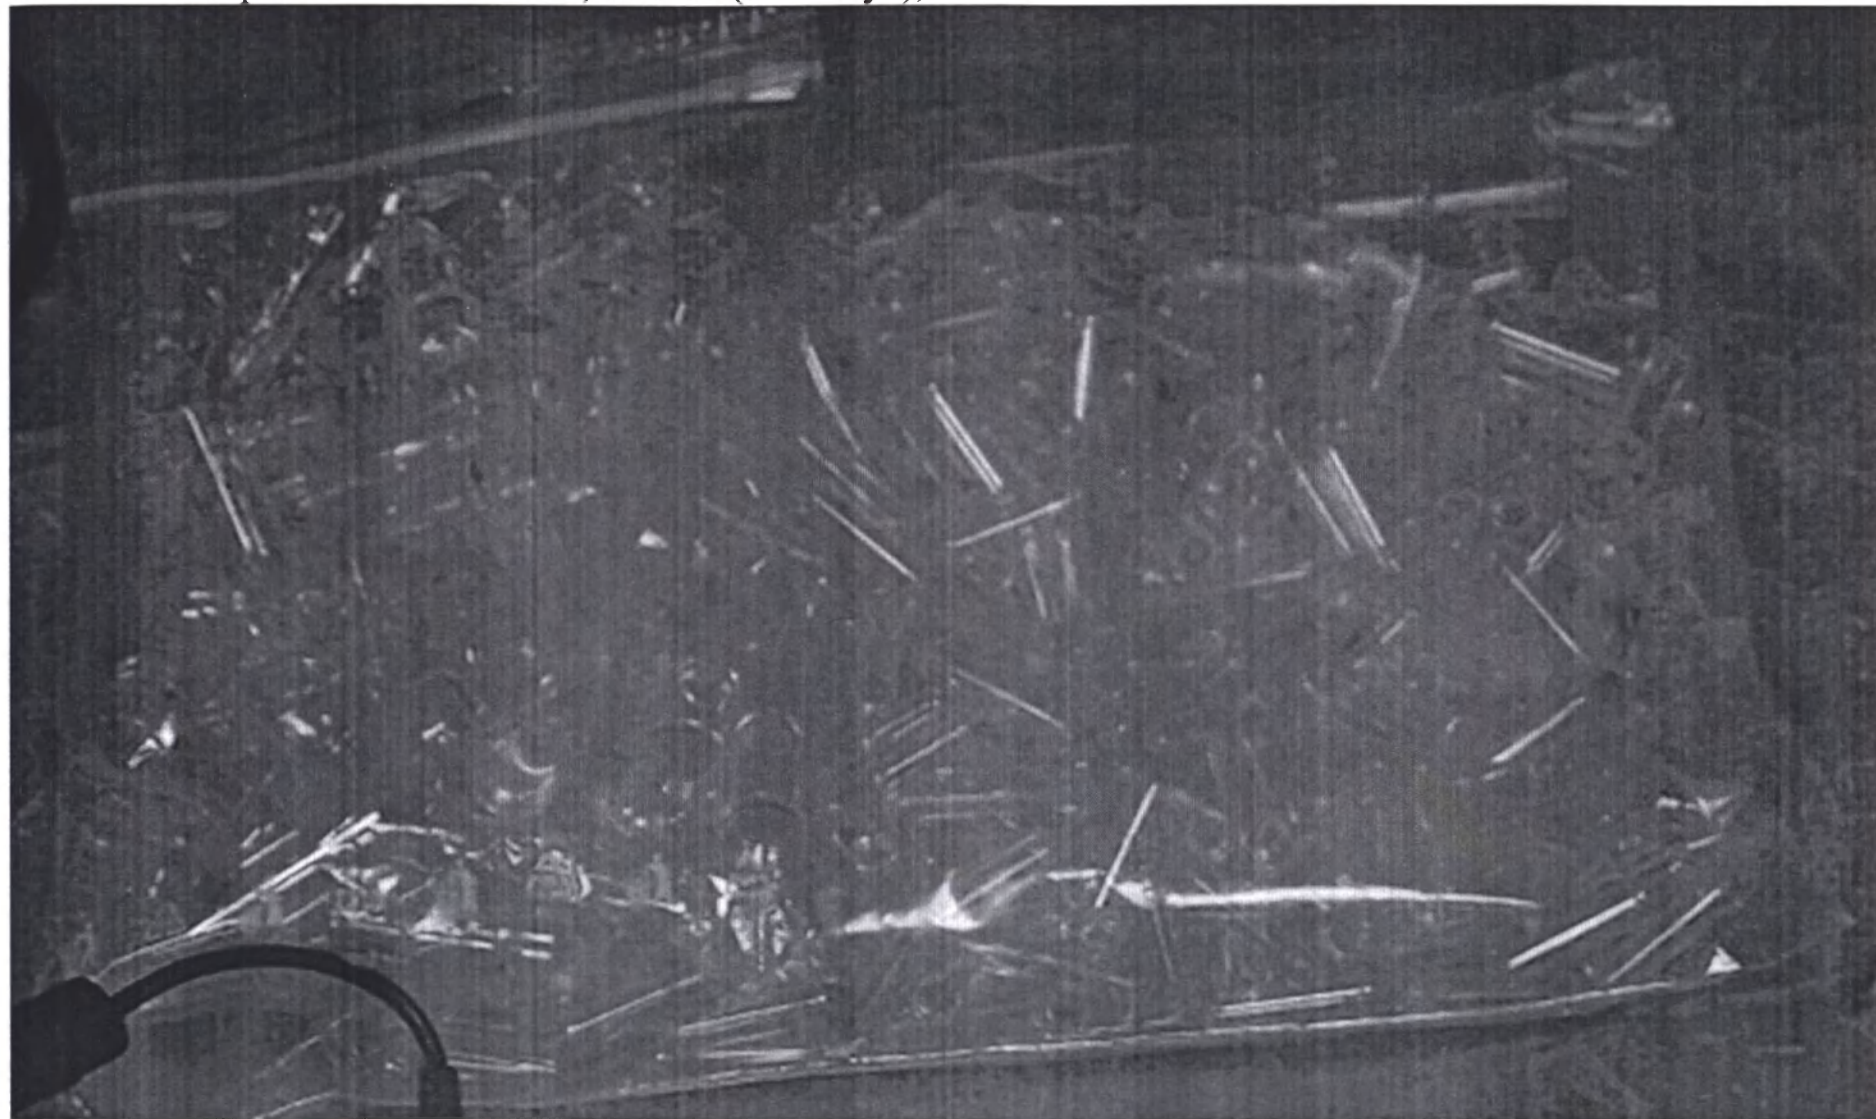


7. Одиночная реакционная кювета, SRC-10

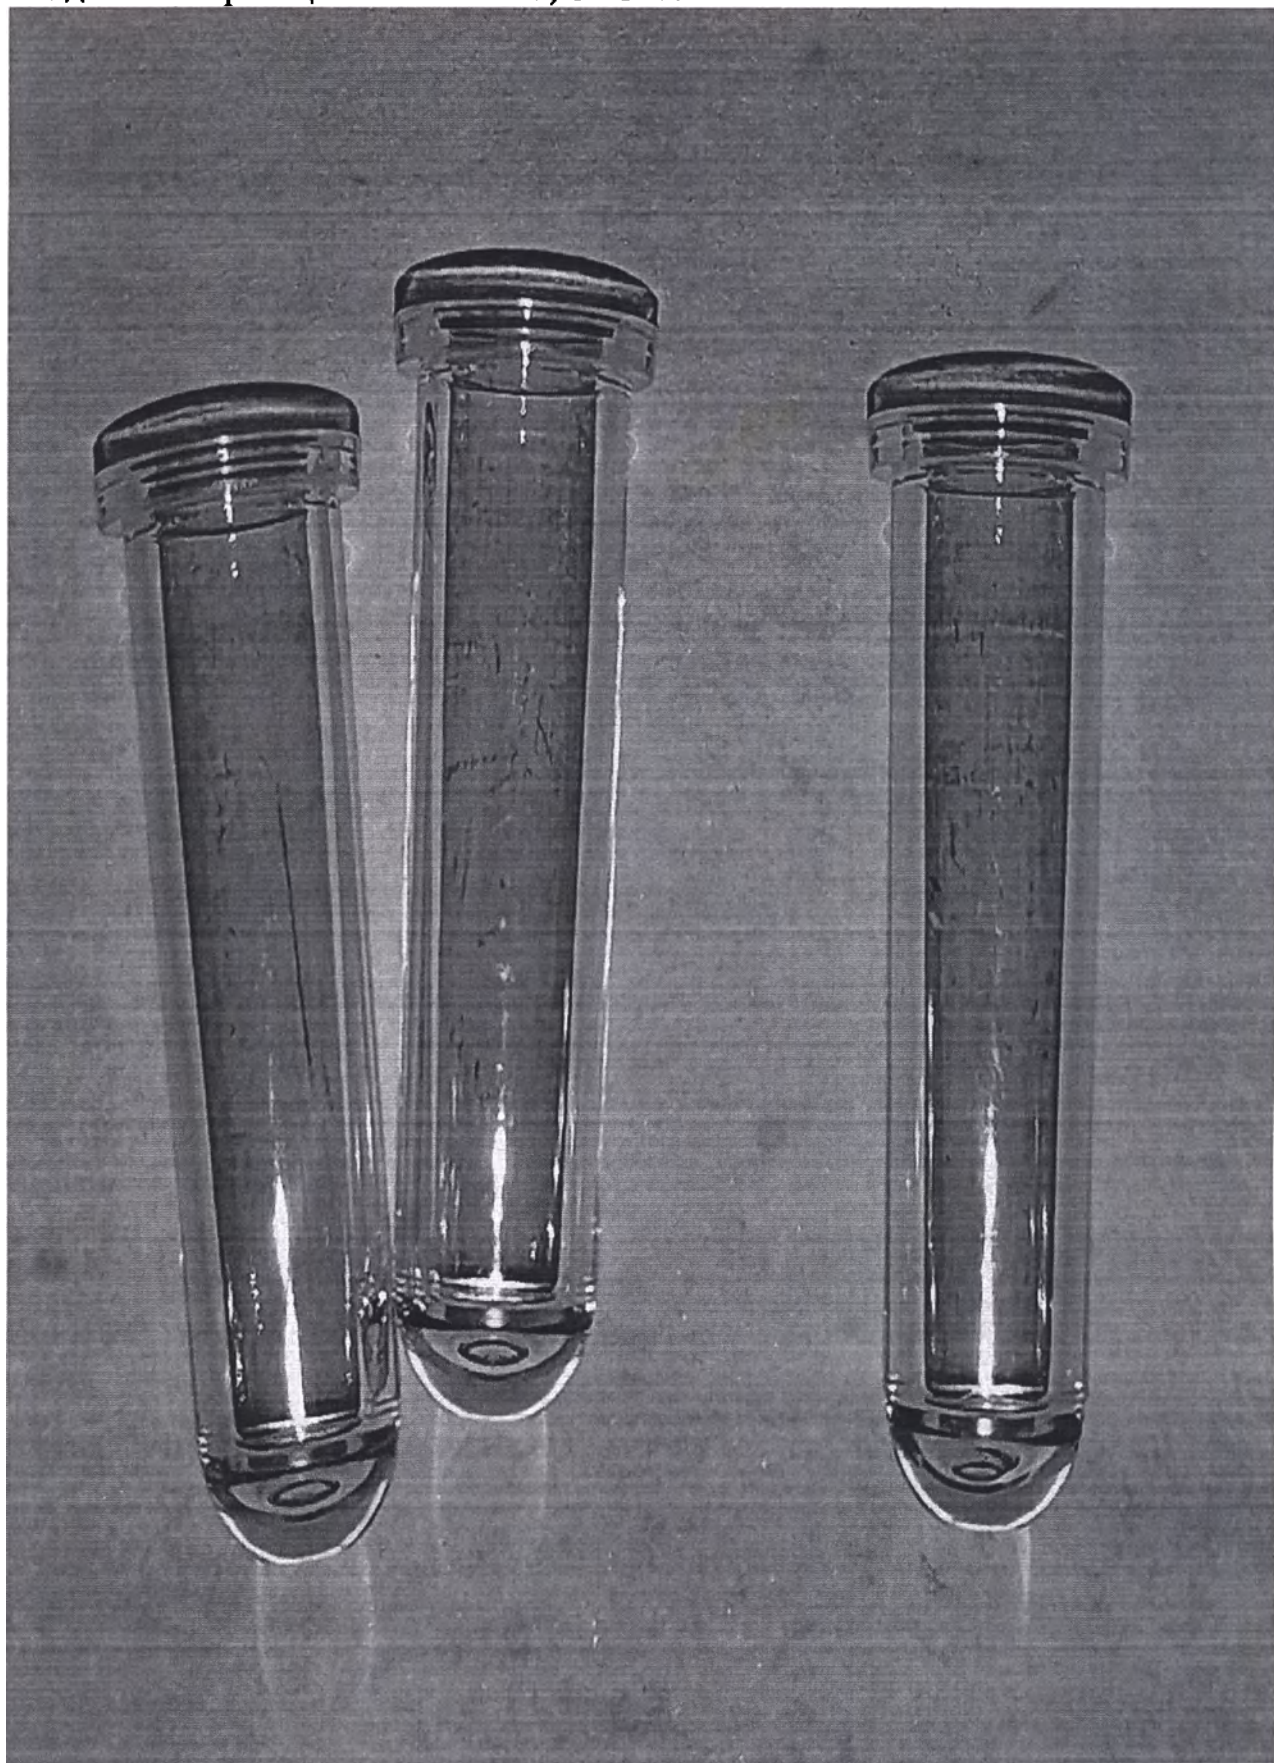

8. Флакон для реагента диаметром 24 мм

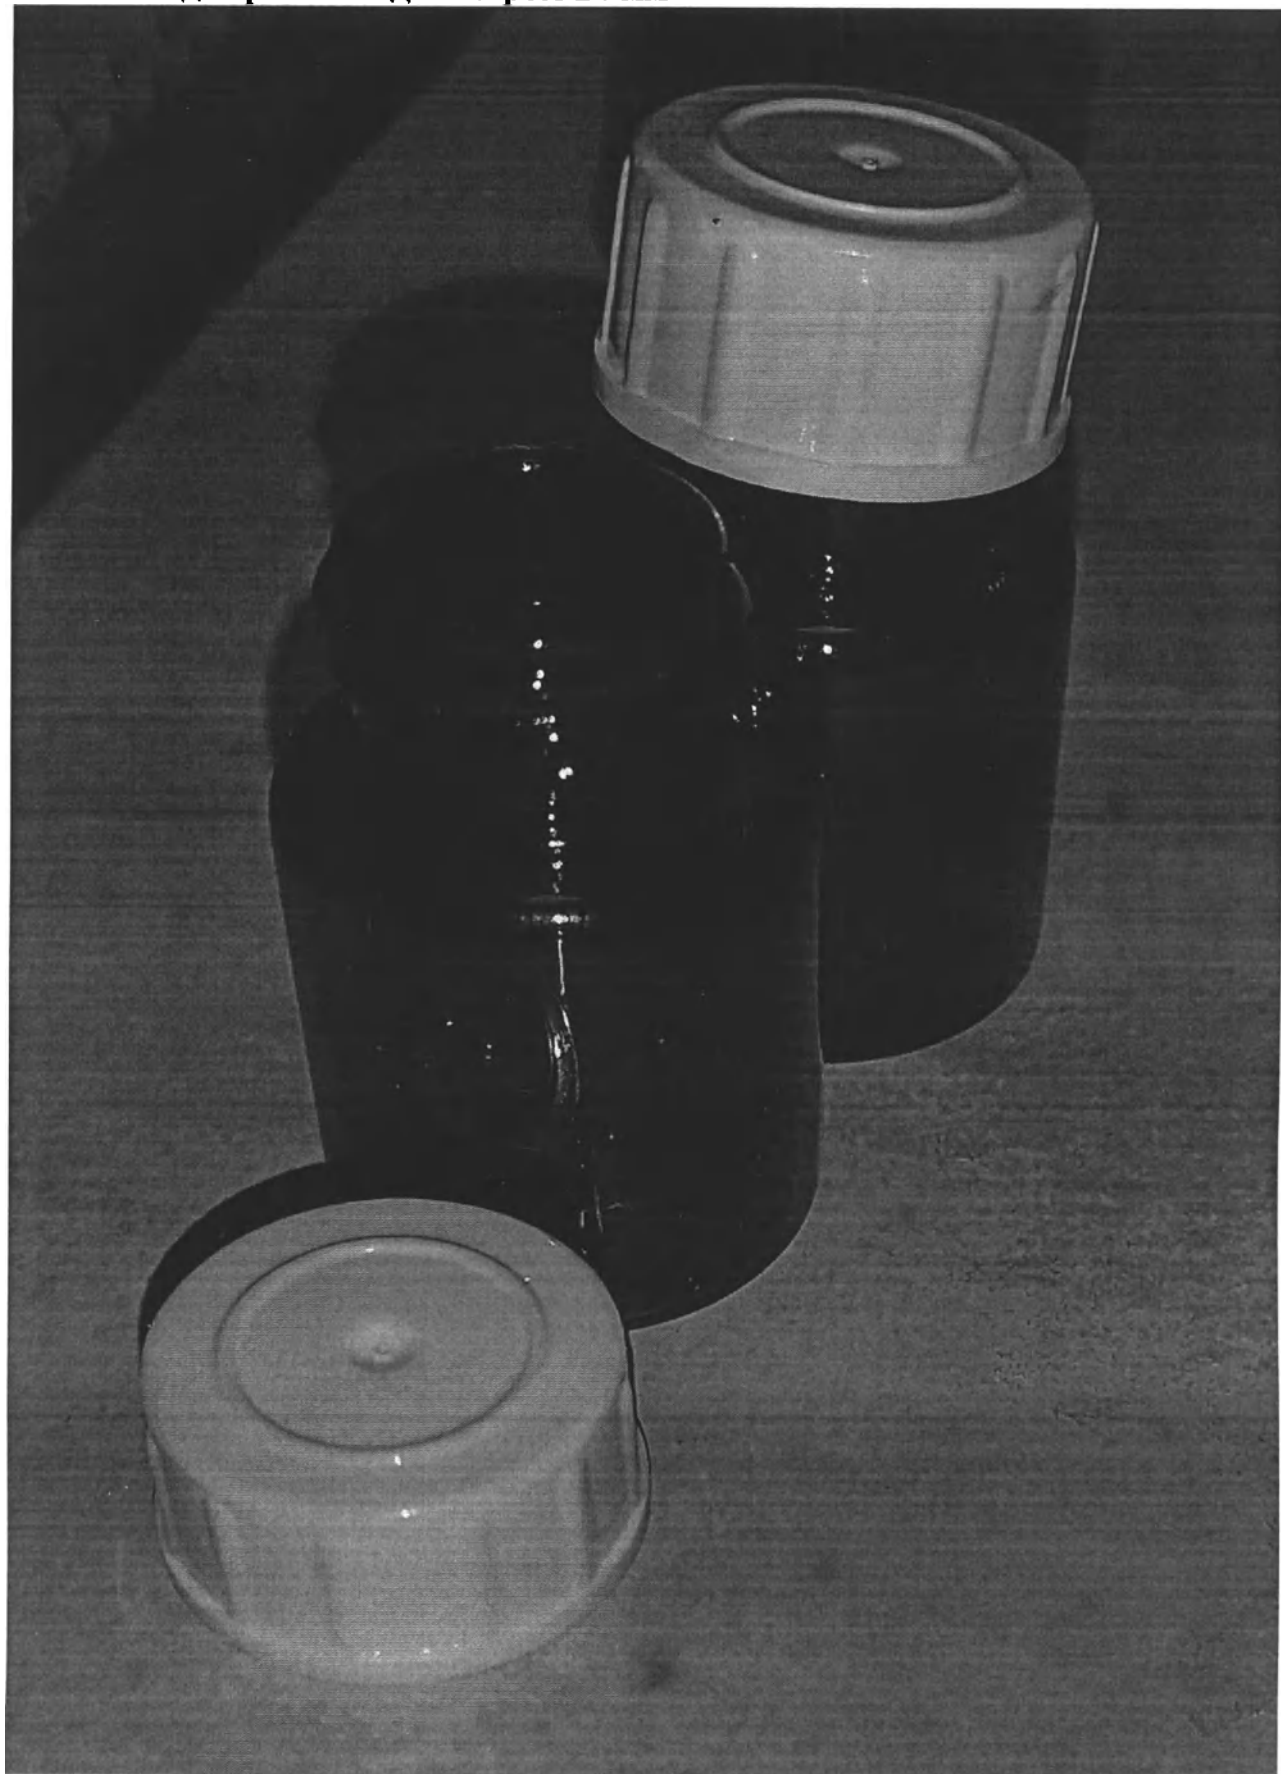


9. Ванночки для реагентов

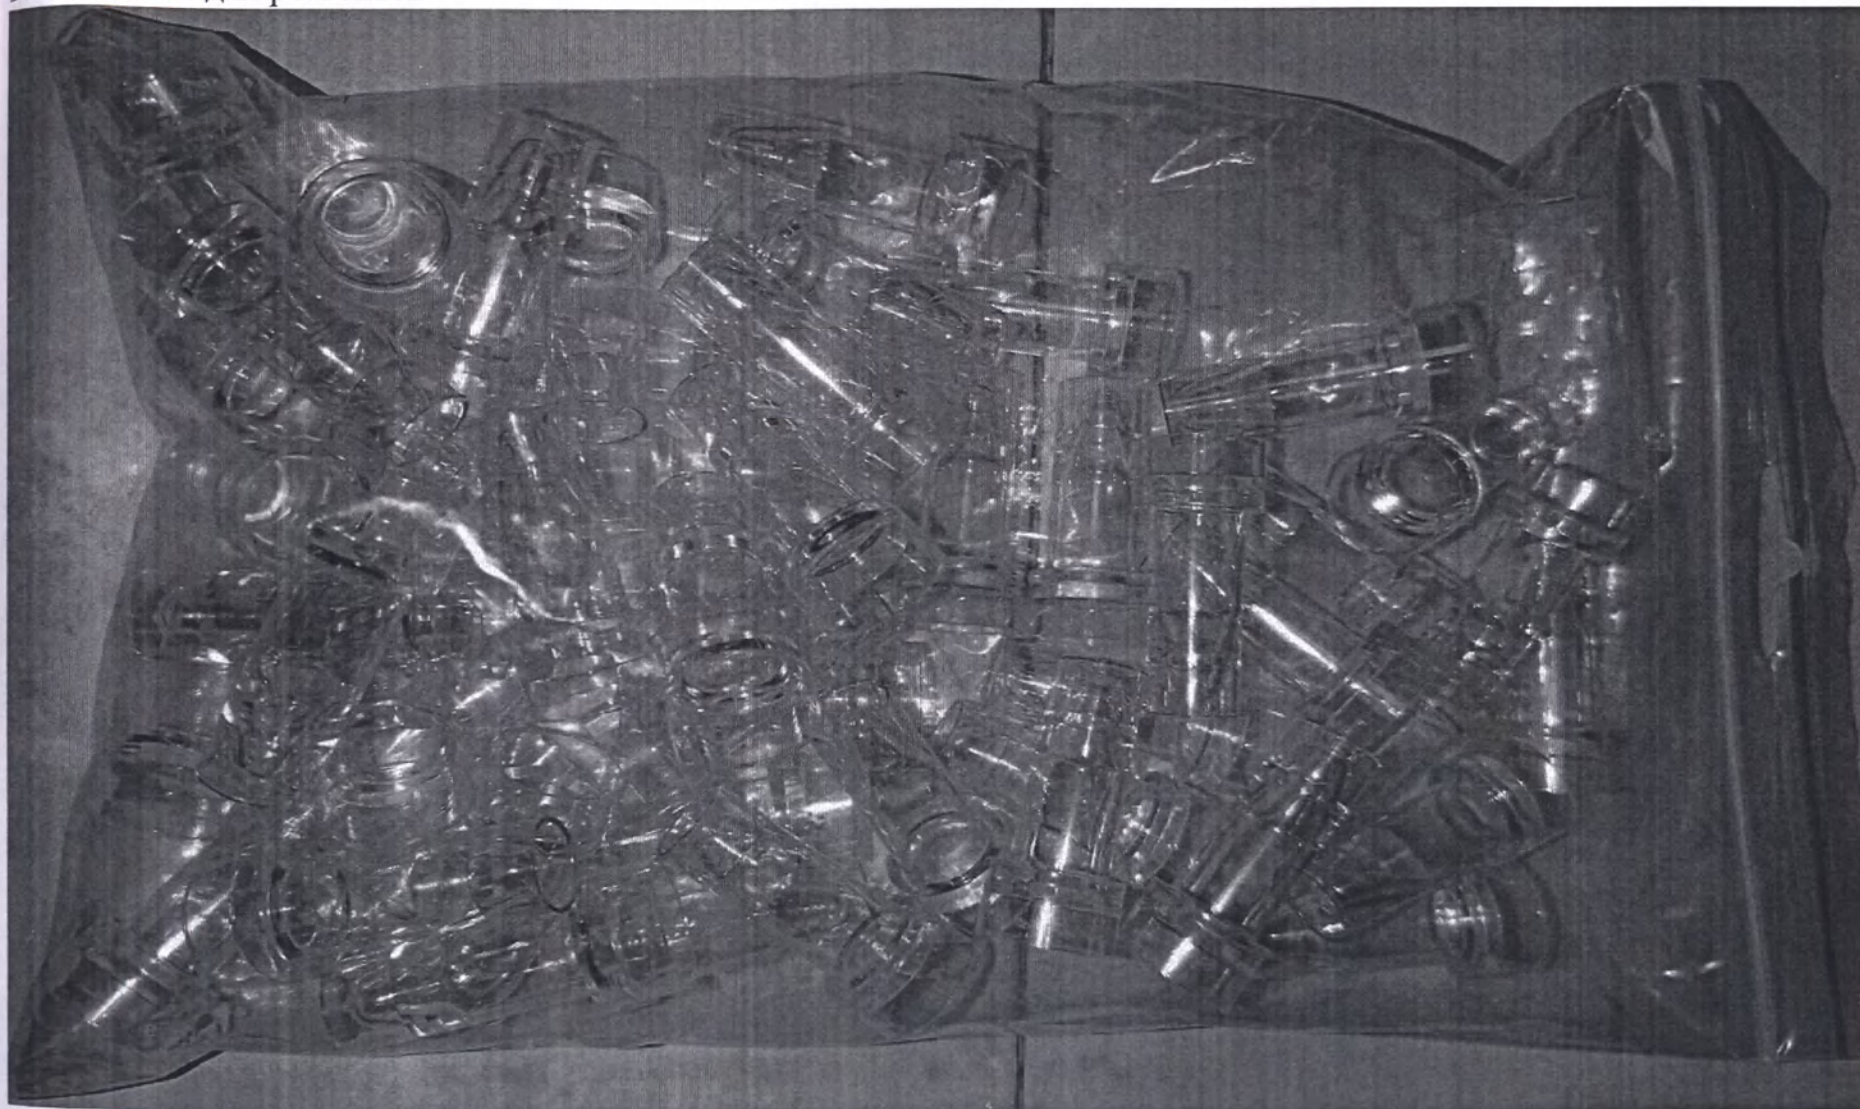


10. Ванночка для реагентов




11. Стилус

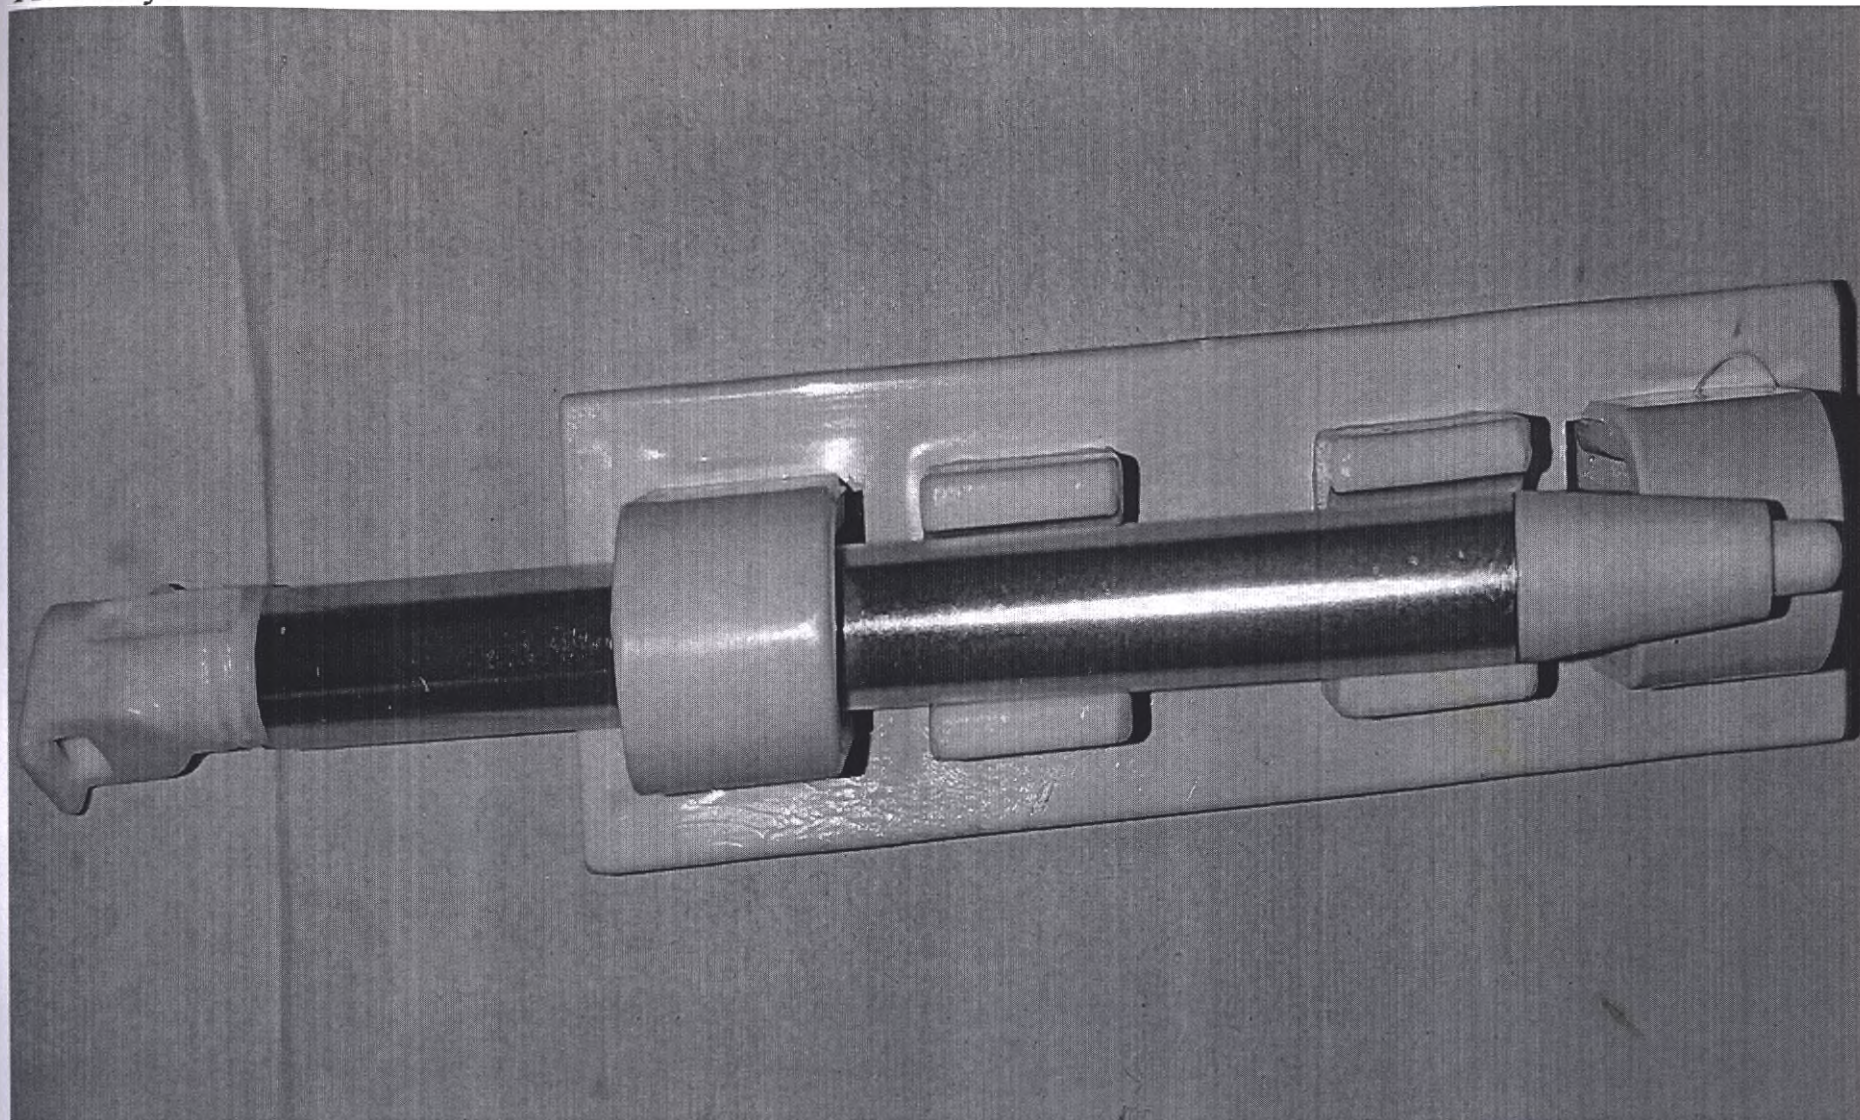

12. Магнитный стержень для мешалки

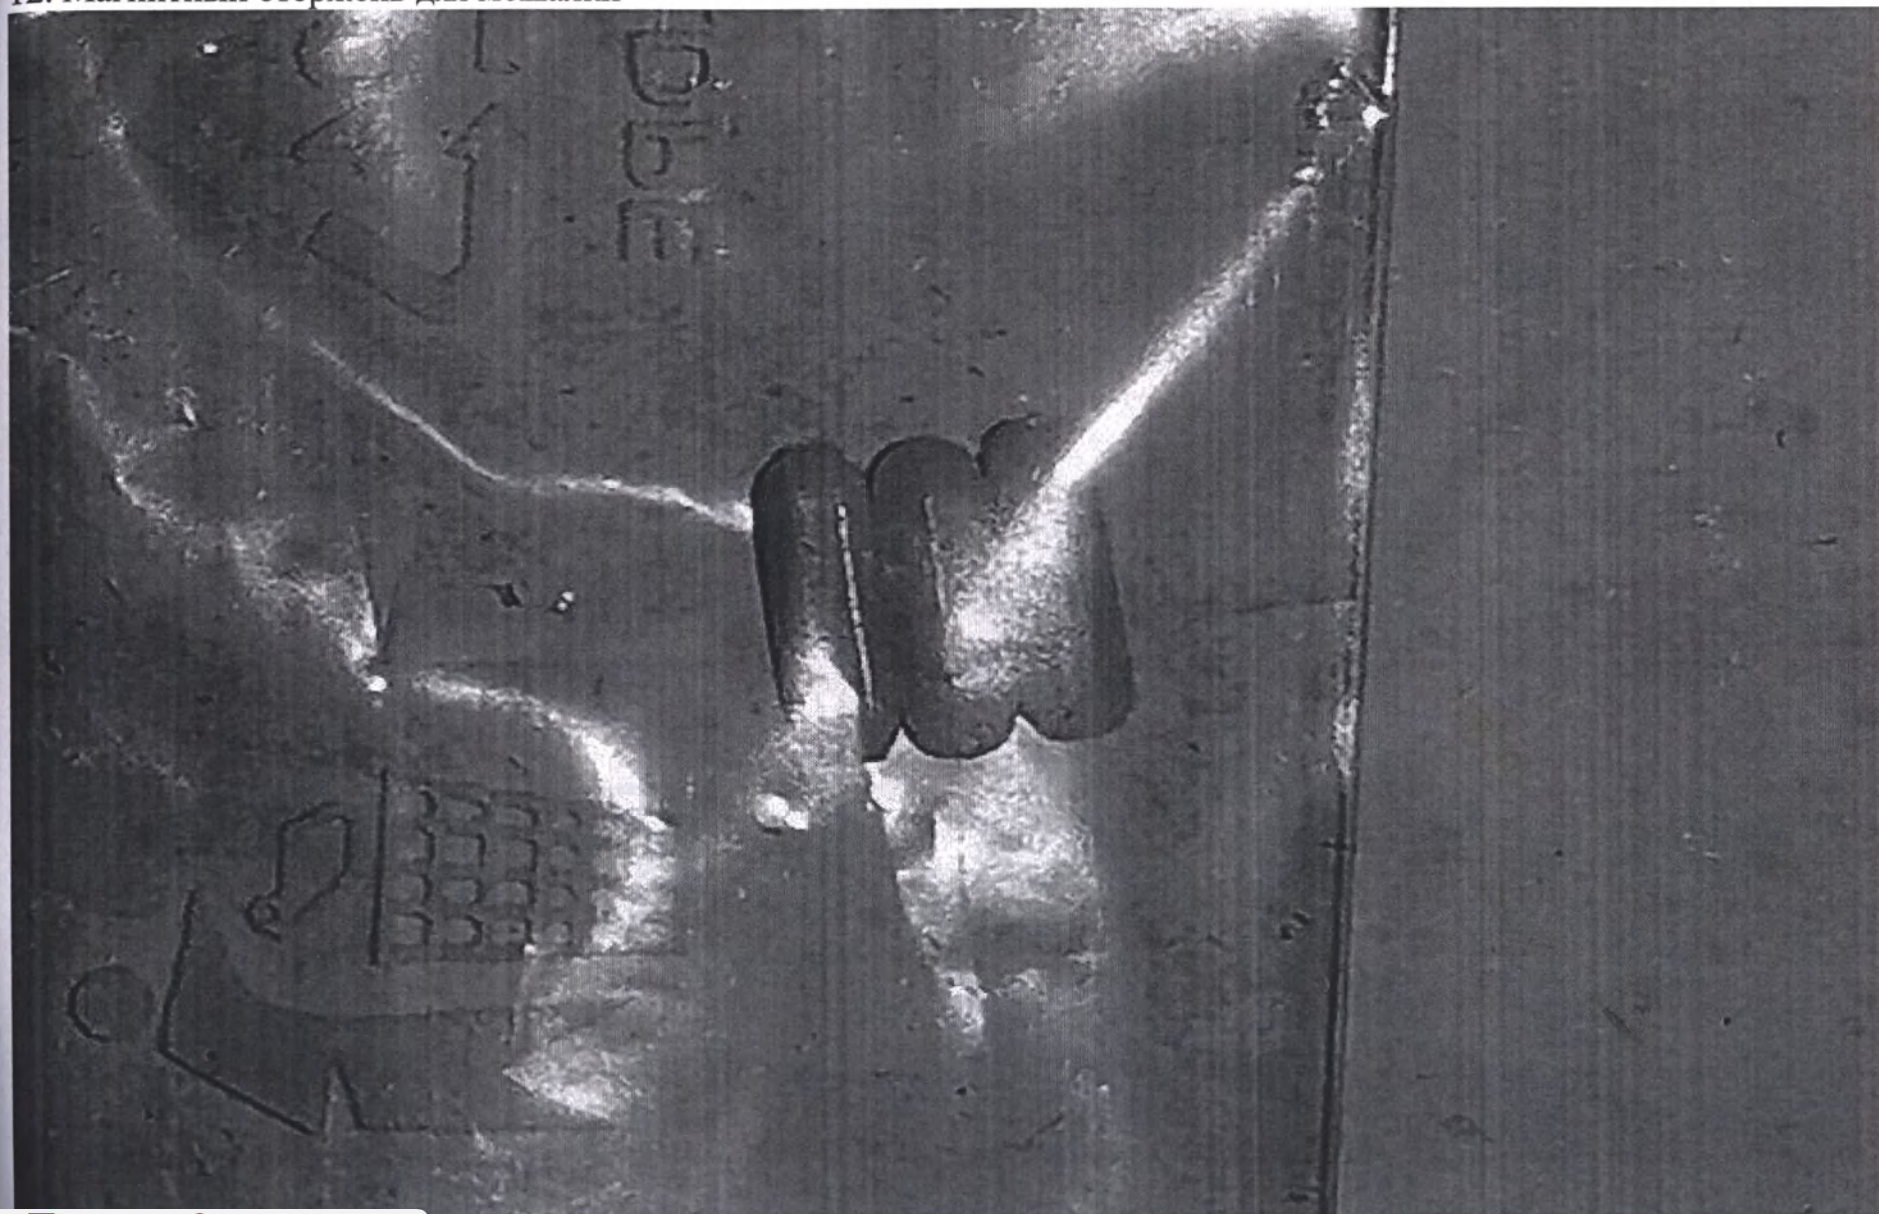

13. Металлический / пластиковый кольцевой переходник 30 мм

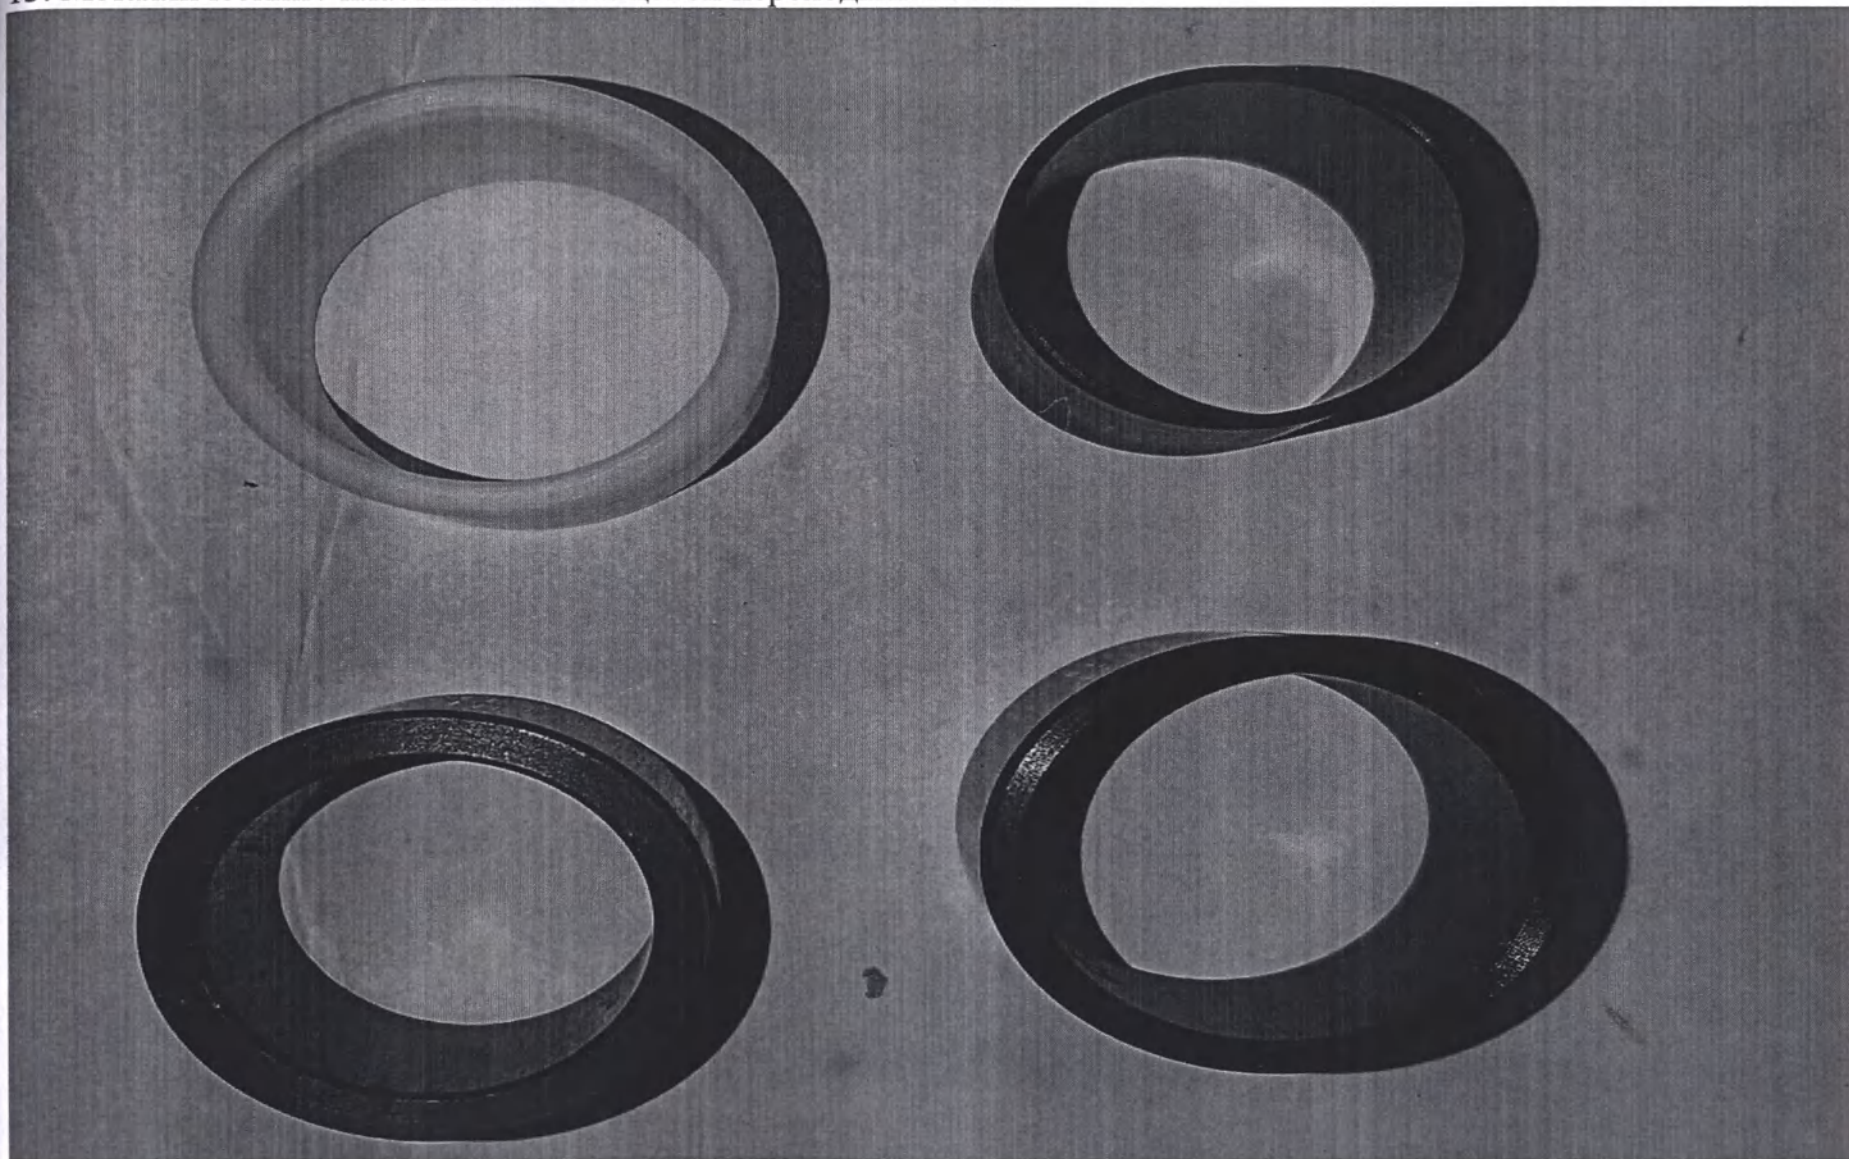


14. Одиночные реакционные кюветы, SRC-10 (2x500шт/уп)




15. USB-накопитель



16. Чехол для прибора

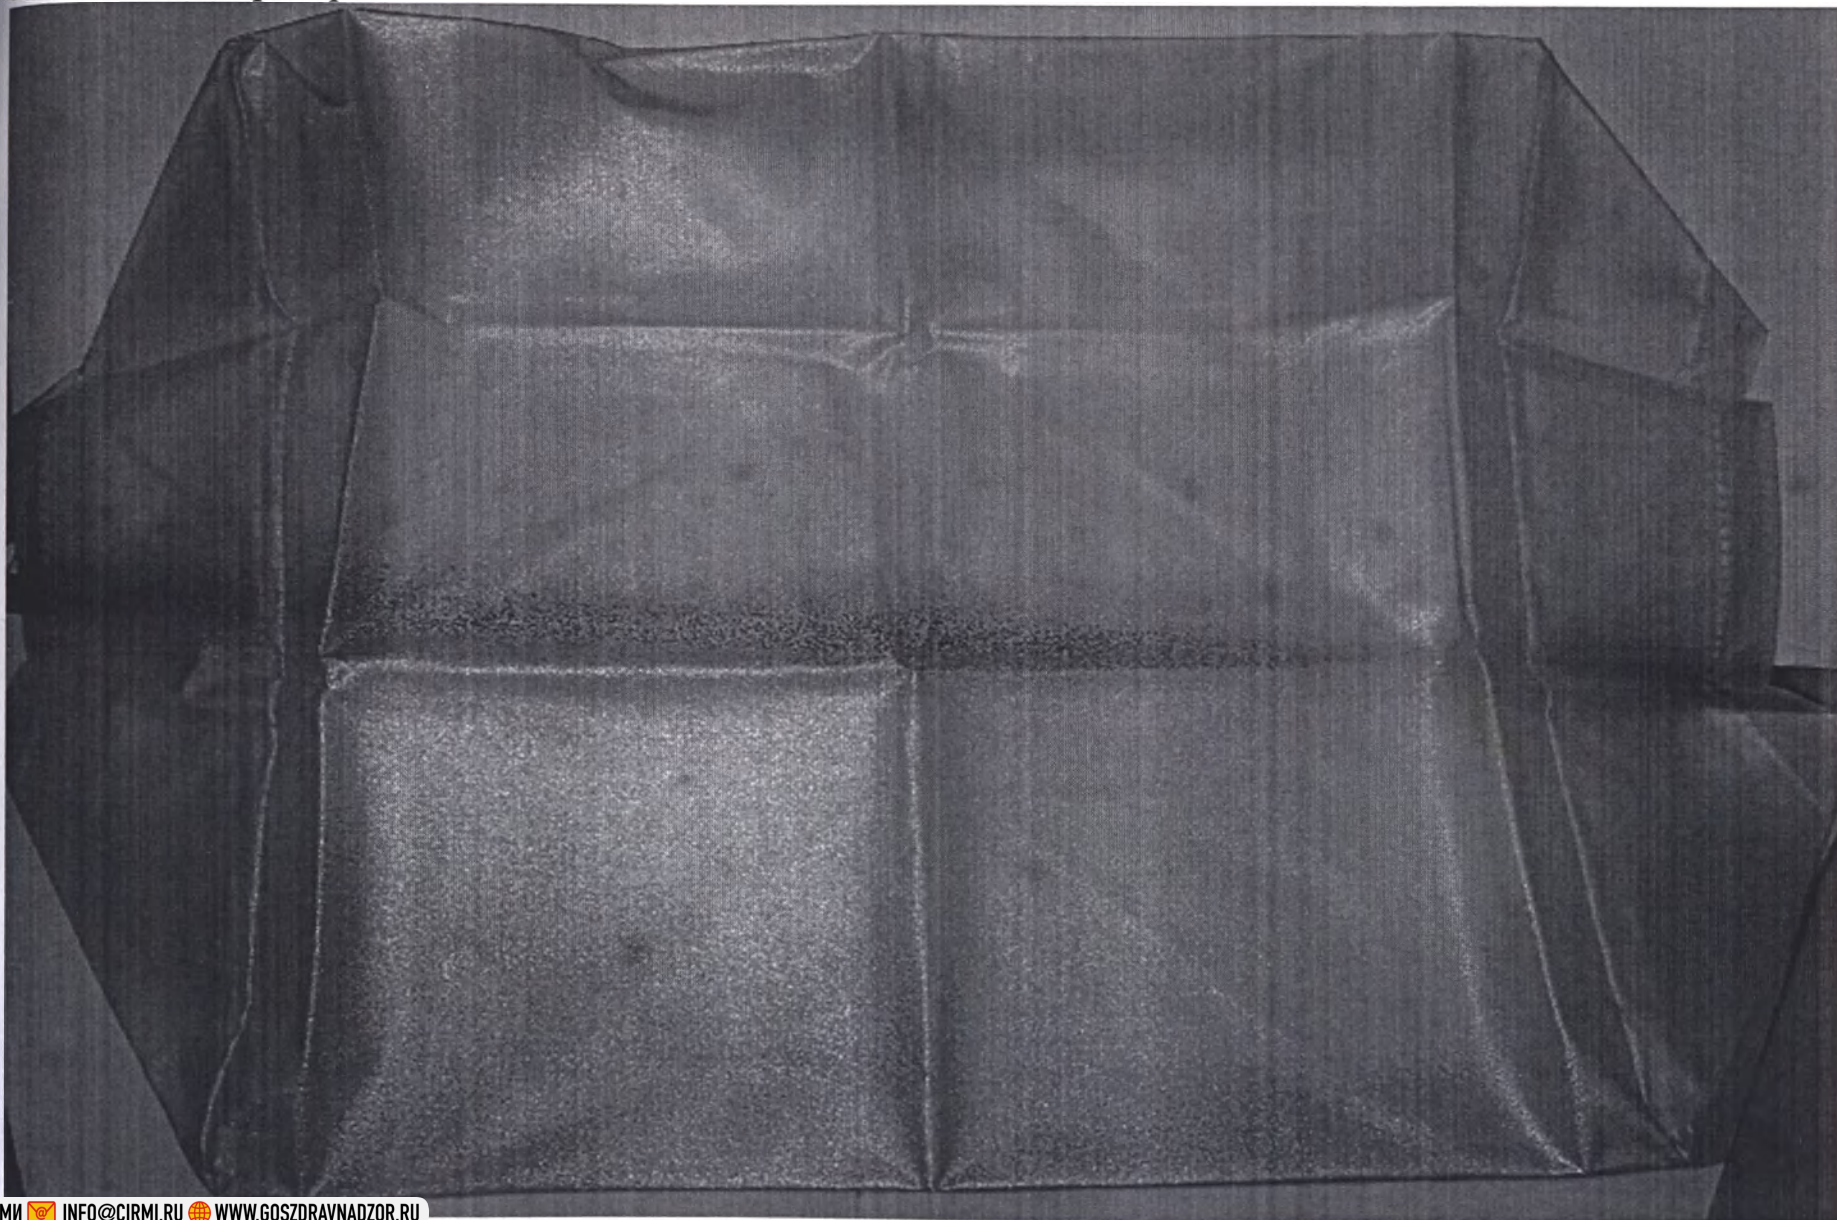

17. Чехол для прибора

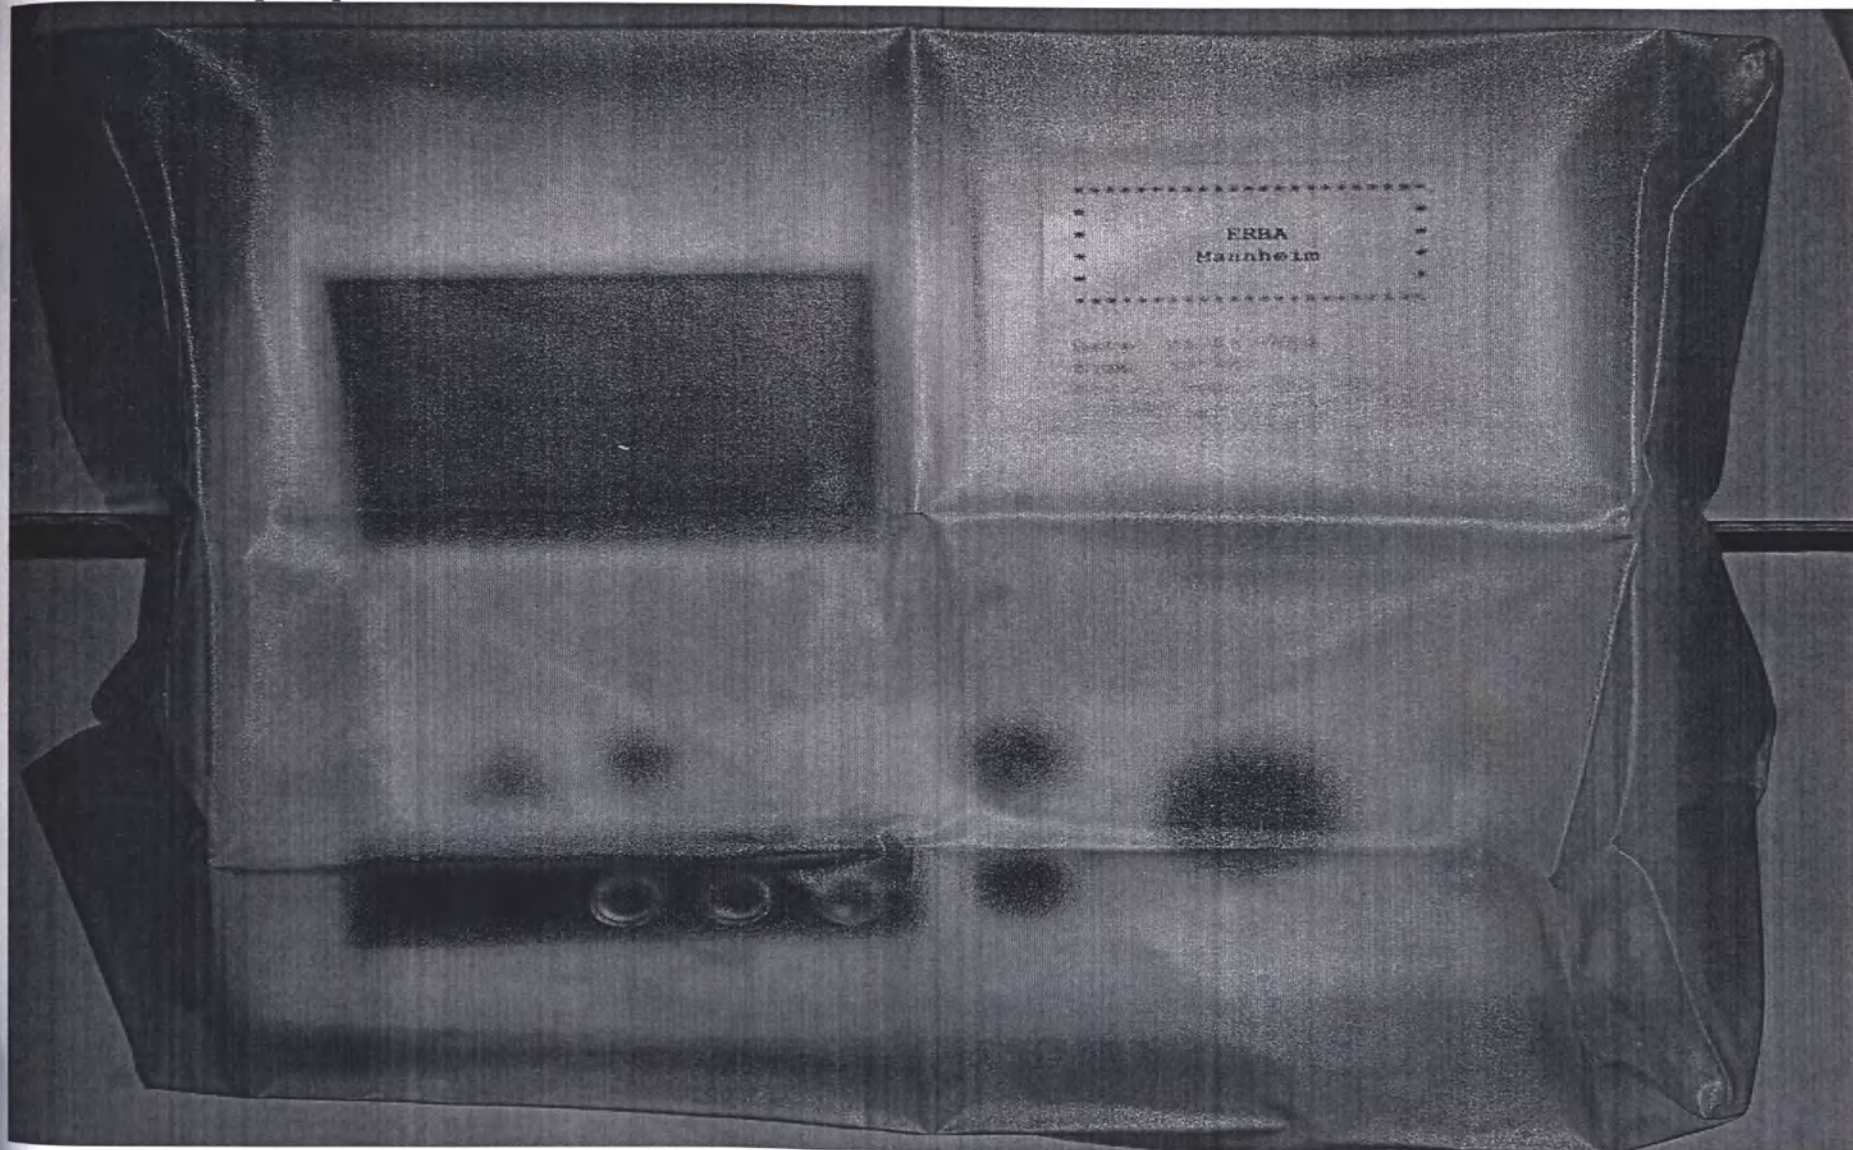

18. Маркировка на нижней части прибора

Erba
Mannheim

ECL 412

CE

SN

E0054-41-220816

IVD

7,5V DC 5.34A




08/2016




Erba Lachema s.r.o., Karásek 1d, 621 00 Brno, CZ
Made in European Union

19 Транспортировочная упаковка

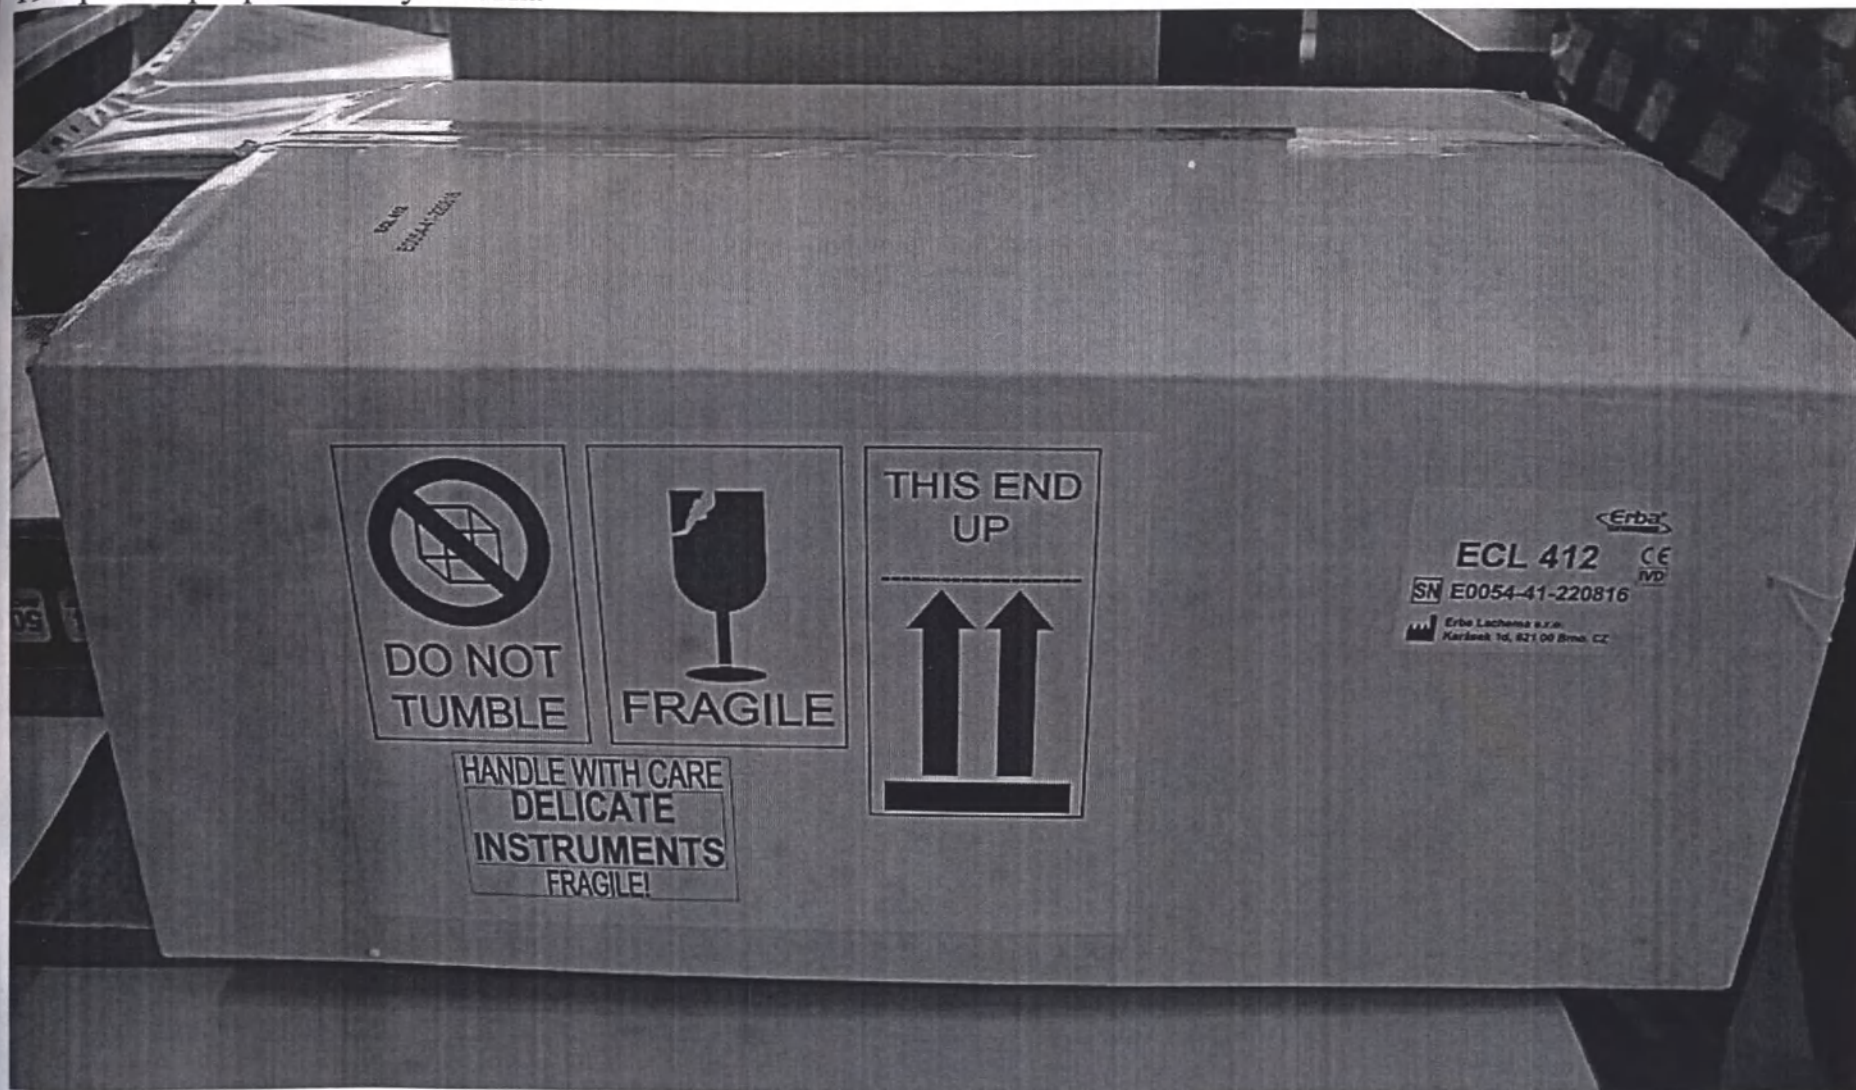

Прошито, прошнуровано и
пронумеровано 20 листов
ООО «ТПО «Медио Лаб»
Генеральный директор


Косырев А.Б.

