

ПОДТВЕРЖДАЮ
Руководитель направления по регистрации продукции
для in vitro диагностики, иммунохимия,
гематология и гемостаз
«ООО «Сименс Здравоохранение»

Чигринец Е.А.
2023 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Набор реагентов для определения пролактина на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Prolactin (Atellica IM PRL))»

производства «Сименс Хелскеа Диагностикс Инк.», Siemens Healthcare Diagnostics Inc., США

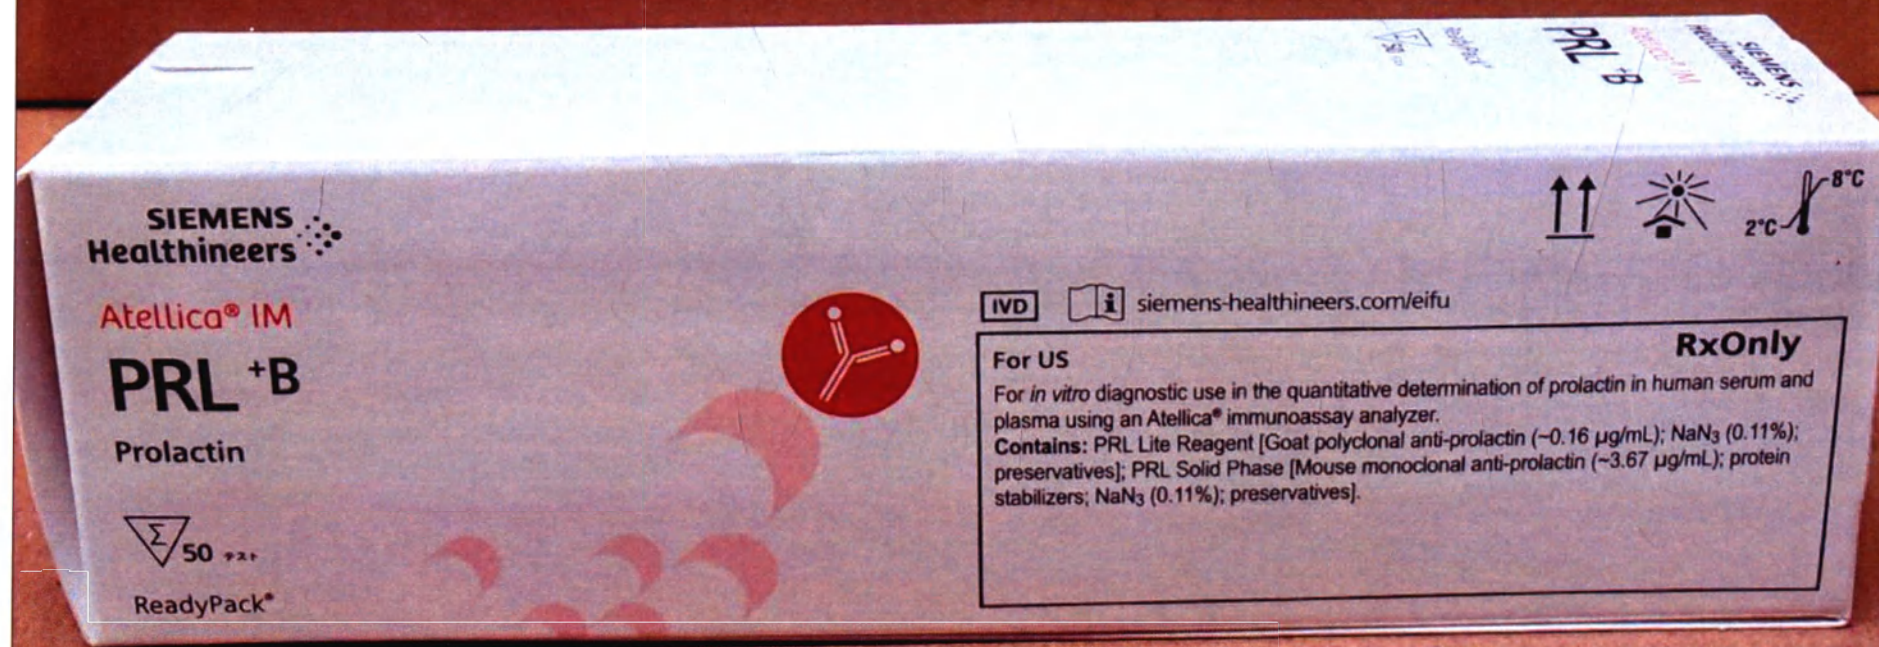


Рисунок 1. Набор реагентов для определения пролактина на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Prolactin (Atellica IM PRL)): I. Фасовка 50

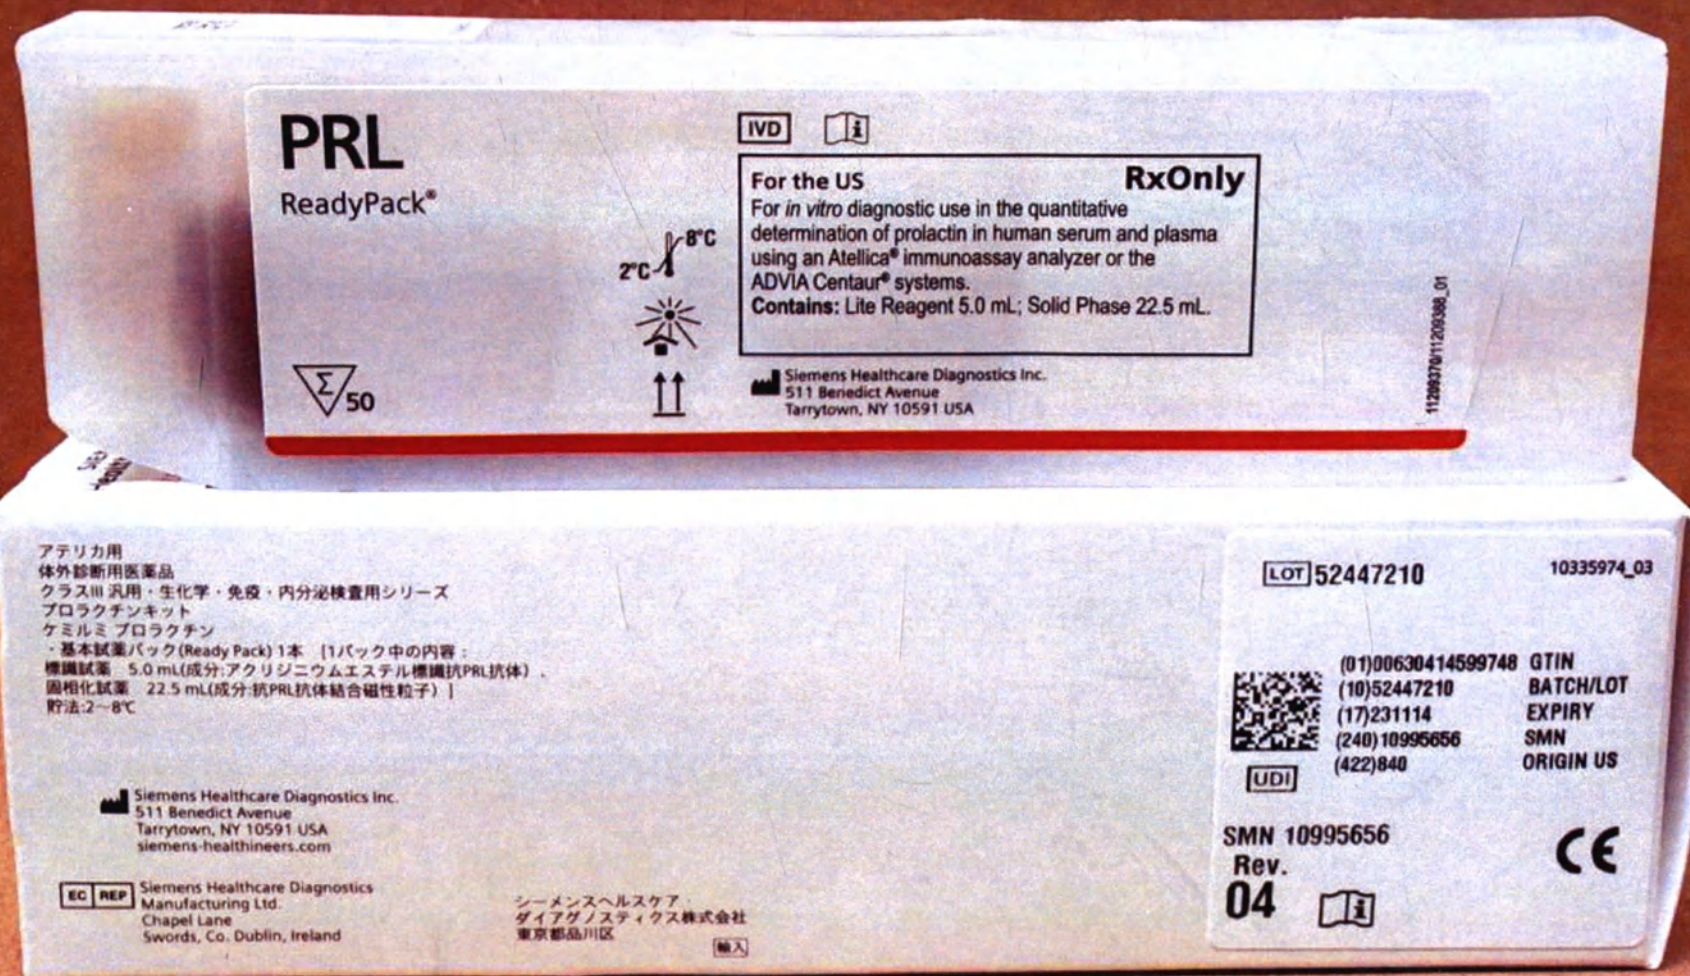


Рисунок 2. Набор реагентов для определения пролактина на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Prolactin (Atellica IM PRL)): I. Фасовка 50



SIEMENS
Healthineers

Atellica® IM

PRL⁺B

Σ 250

ReadyPack®



2°C 8°C

IVD



siemens.com/eifu

For US

RxOnly

For in vitro diagnostic use in the quantitative determination of prolactin in human serum and plasma using the Atellica® IM Analyzer.

Contains: PRL Lite Reagent [Goat polyclonal anti-prolactin (~0.16 µg/mL); NaN₃ (0.11%); preservatives]; PRL Solid Phase [Mouse monoclonal anti-prolactin (~3.67 µg/mL); protein stabilizers; NaN₃ (0.11%); preservatives].

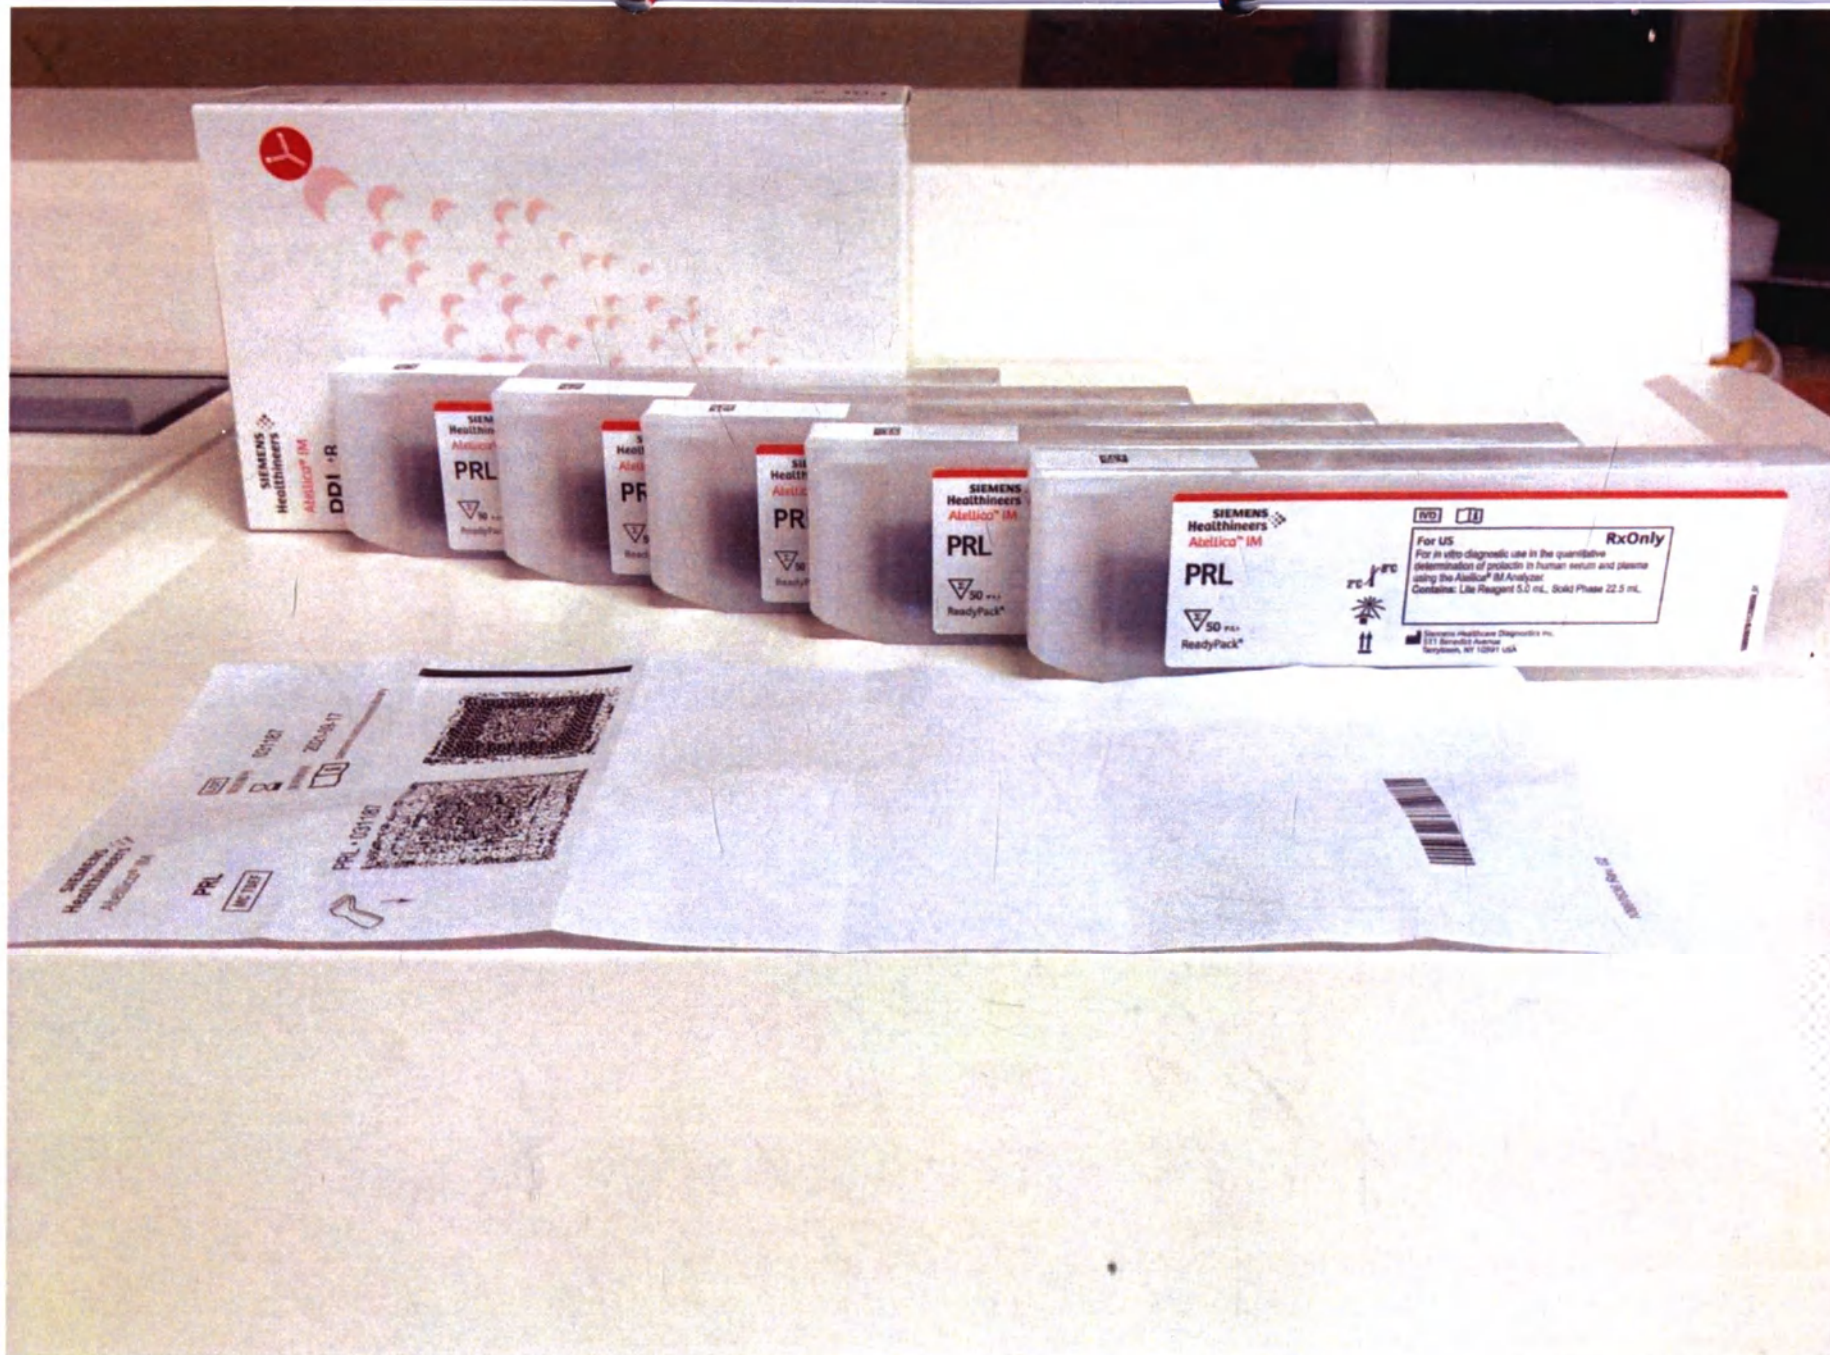


Рисунок 4. Набор реагентов для определения пролактина на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Prolactin (Atellica IM PRL)): II. Фасовка 250



Рисунок 5. Набор реагентов для определения пролактина на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Prolactin (Atellica IM PRL)): 1. Основной

SIEMENS
Healthineers
Atellica® IM

PRL

MC TDEF

LOT

製造番号

031187

使用期限

2021-09-17



[siemens.com/document-library](https://www.siemens.com/document-library)

PRL • 031187



10997836 Rev. 02

Рисунок 6. Набор реагентов для определения пролактина на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Prolactin (Atellica IM PRL)): 2. Вкладыш со штрих-кодом MC TDEF для Atellica IM PRL

10995656

Набор реагентов для определения пролактина на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Prolactin (Atellica IM PRL))

Информация о производителе и стране производства:
см. на упаковке

Регистрационное удостоверение:

№ РЗН 2020/11710 от 17.08.2020

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на оригинальной упаковке

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению

Авторизованный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96

Рисунок 7. Макет маркировки для Российской Федерации, который будет наноситься на внешнюю упаковку медицинского изделия «Набор реагентов для

10995655

Набор реагентов для определения пролактина на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Prolactin (Atellica IM PRL))

Информация о производителе и стране производства:
см. на упаковке

Регистрационное удостоверение:
№ РЗН 2020/11710 от 17.08.2020

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на оригинальной упаковке

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению

Авторизованный представитель производителя на территории Российской Федерации:
ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96

Рисунок 8. Макет маркировки для Российской Федерации, который будет наноситься на внешнюю упаковку медицинского изделия «Набор реагентов для

Всего прошито и пронумеровано
9 листа (ов).

ООО «Сиенс Здоровоохранение»

