

Руководитель группы регистрации
ООО «Сименс Здравоохранение»



Н.А. Горшкова
«22» июня 2021 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO**

**«Набор калибраторов Q для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM
Calibrator Q (Atellica IM CAL Q))»**

производства «Сименс Хелскеа Диагностика Инк.», Siemens Healthcare Diagnostics Inc., США

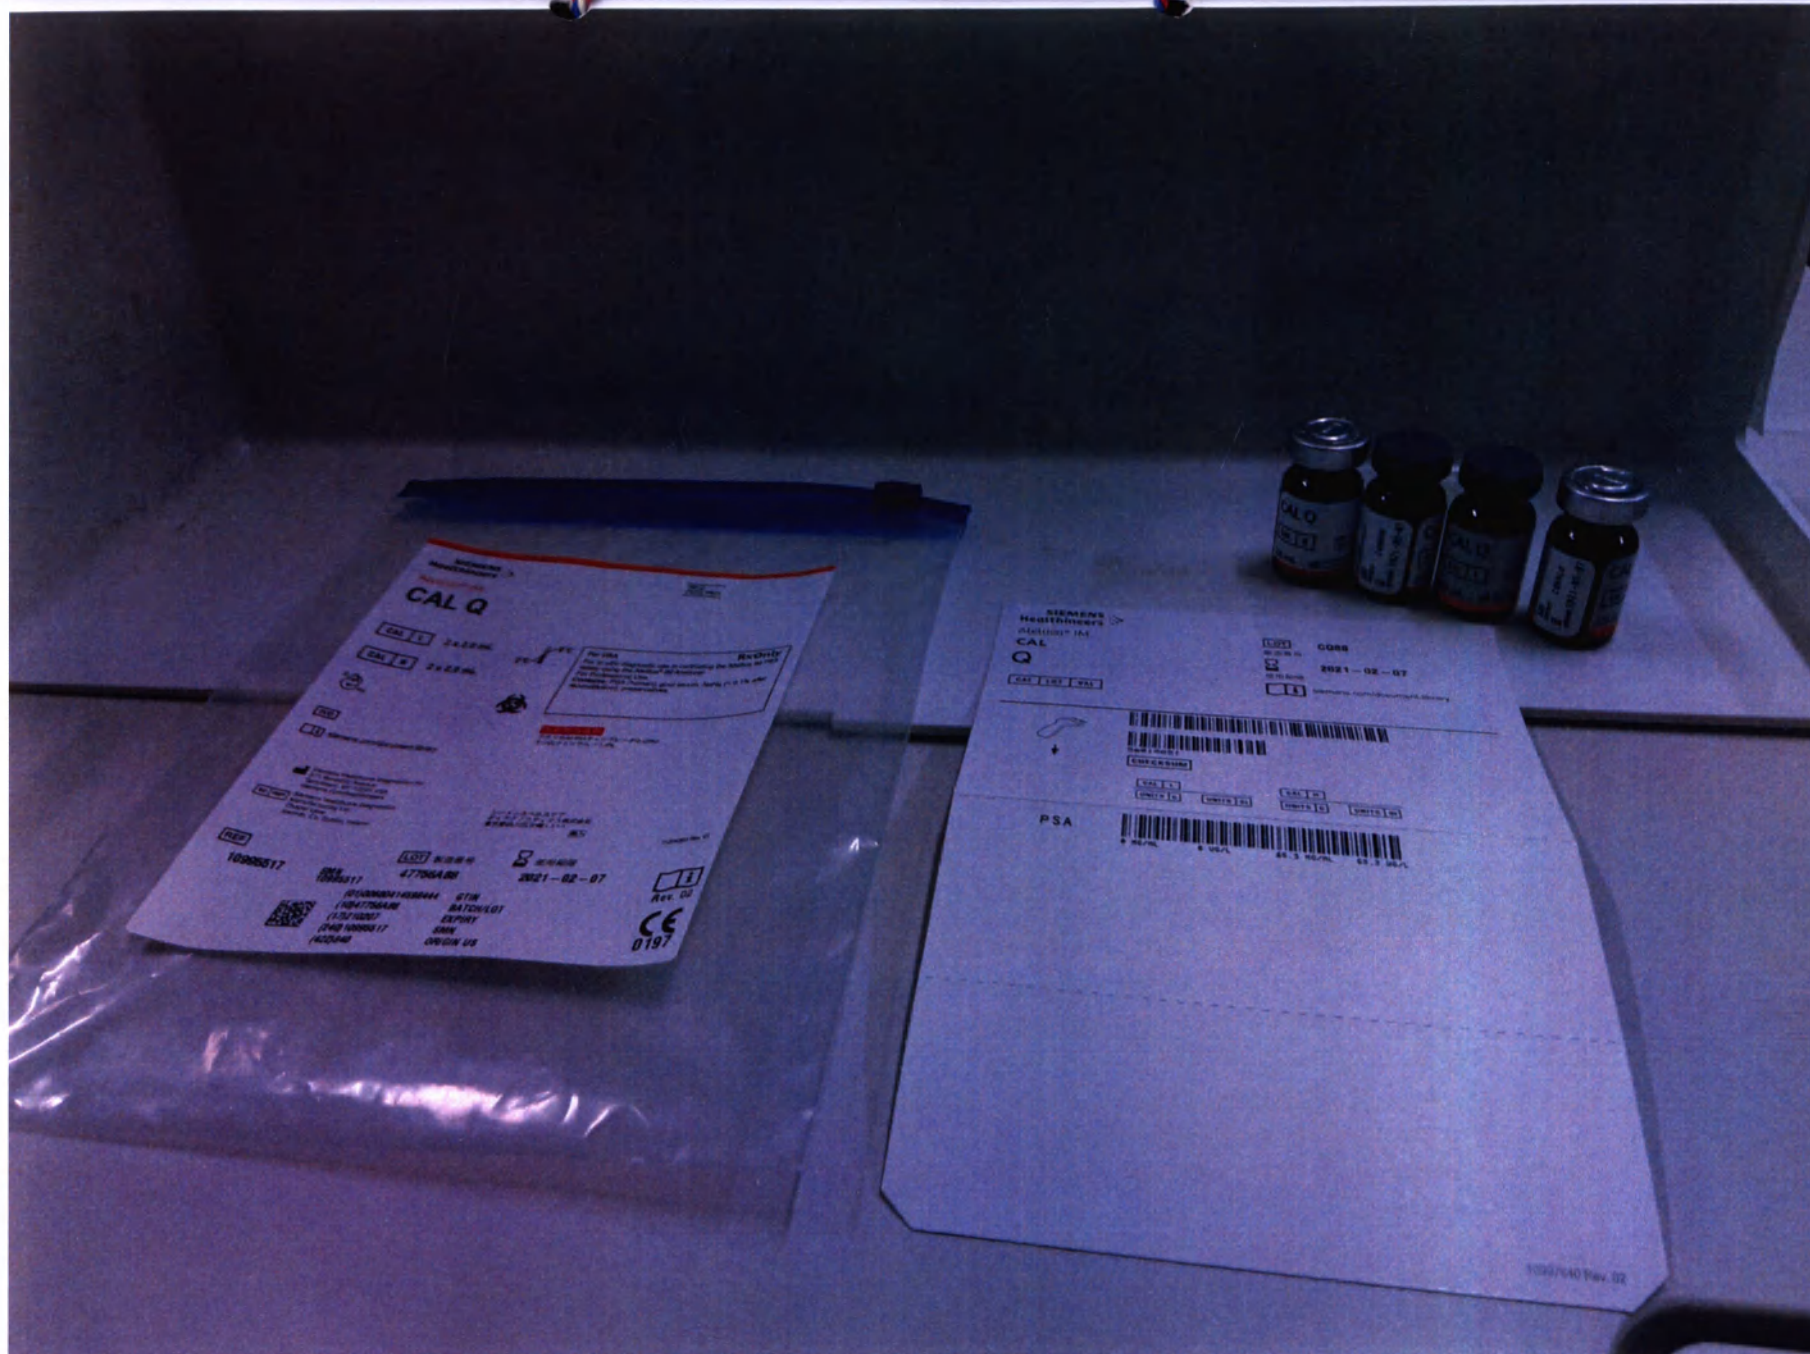


Рисунок 1. Набор калибраторов Q для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Calibrator Q (Atellica IM CAL Q)). Фасовка 2 упаковки. Общий вид

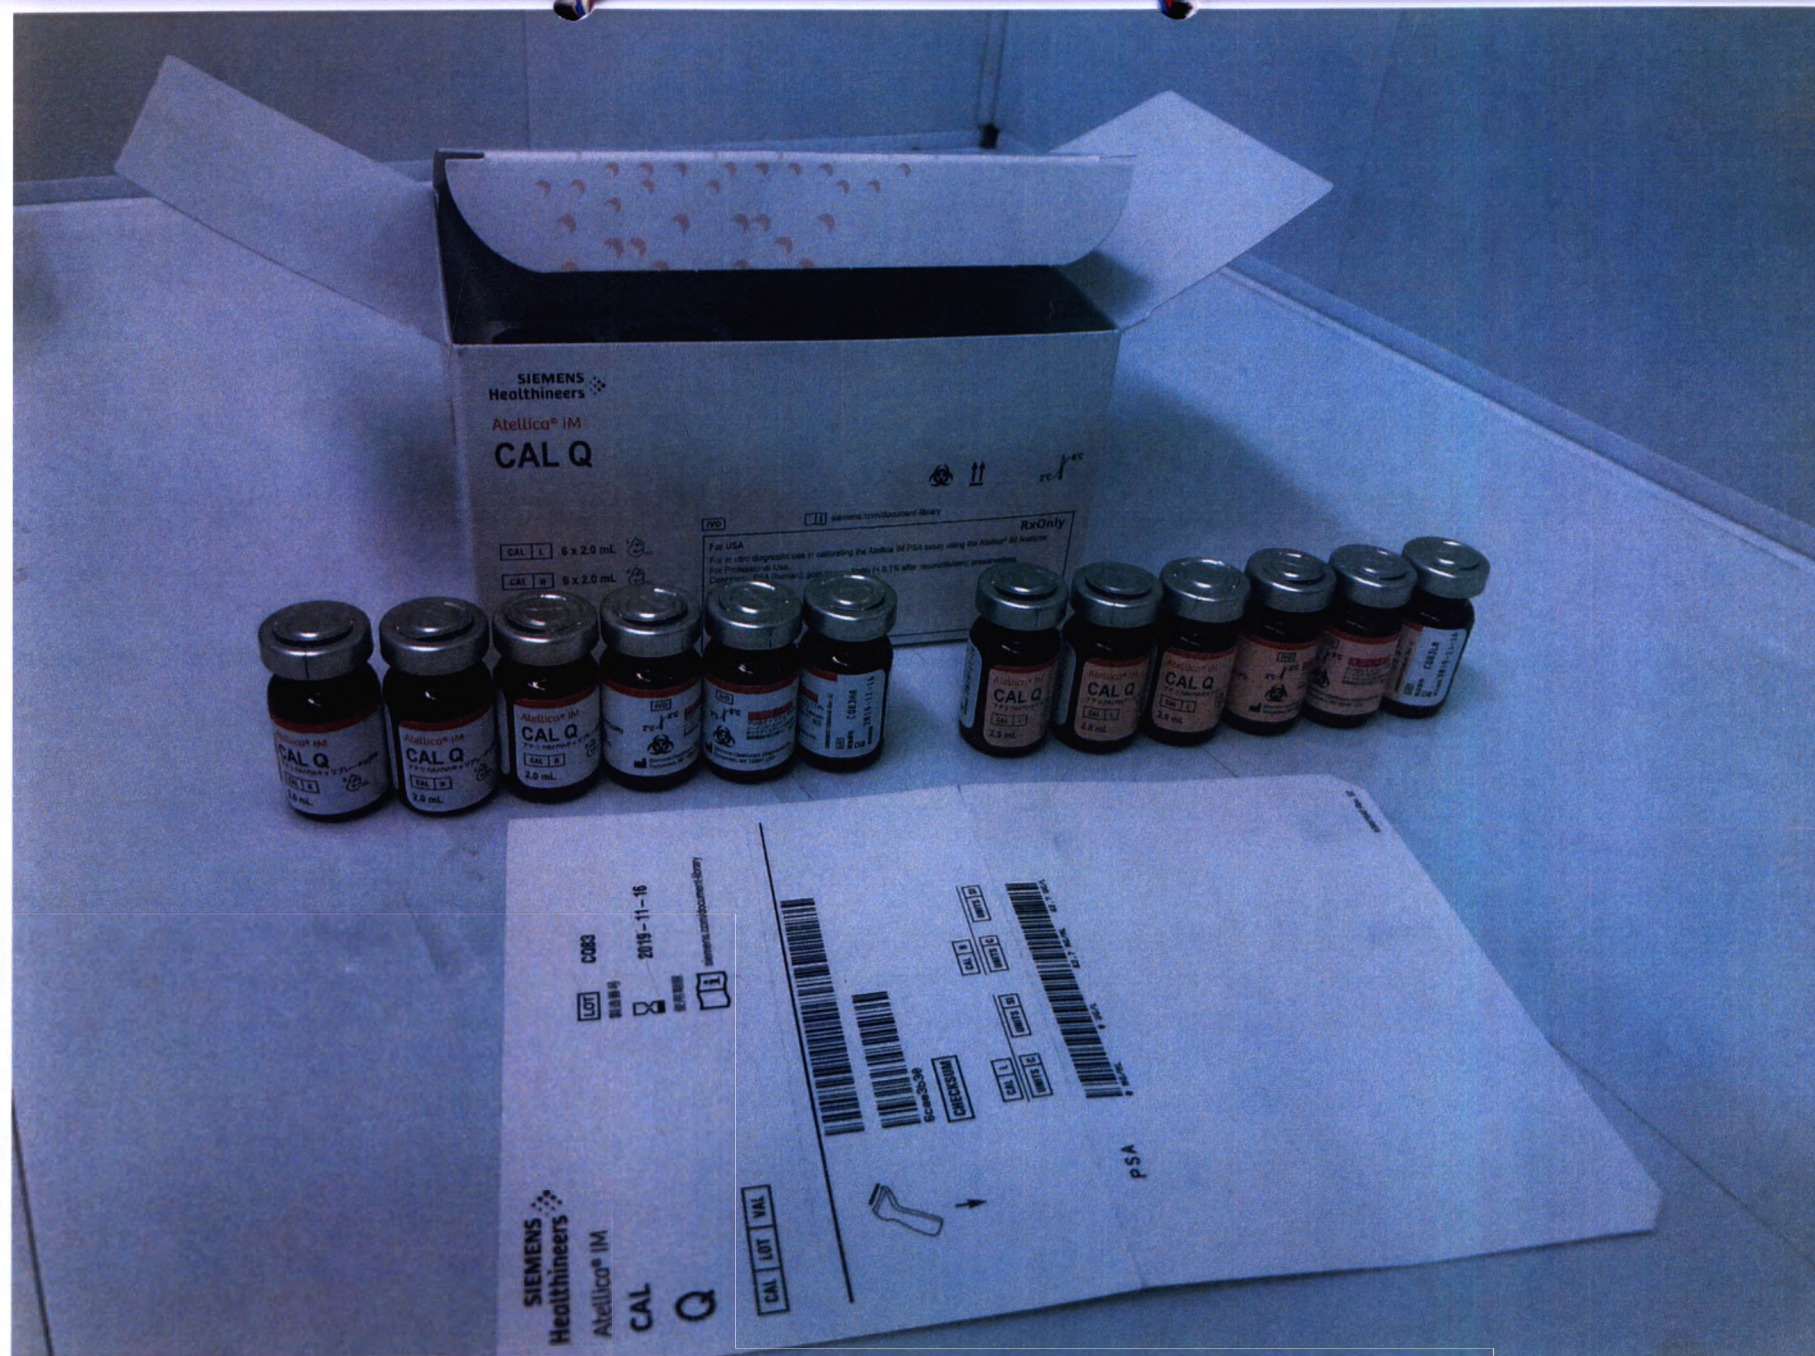


Рисунок 2. Набор калибраторов Q для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Calibrator Q (Atellica IM CAL Q)). Фасовка 6 упаковок. Общий вид

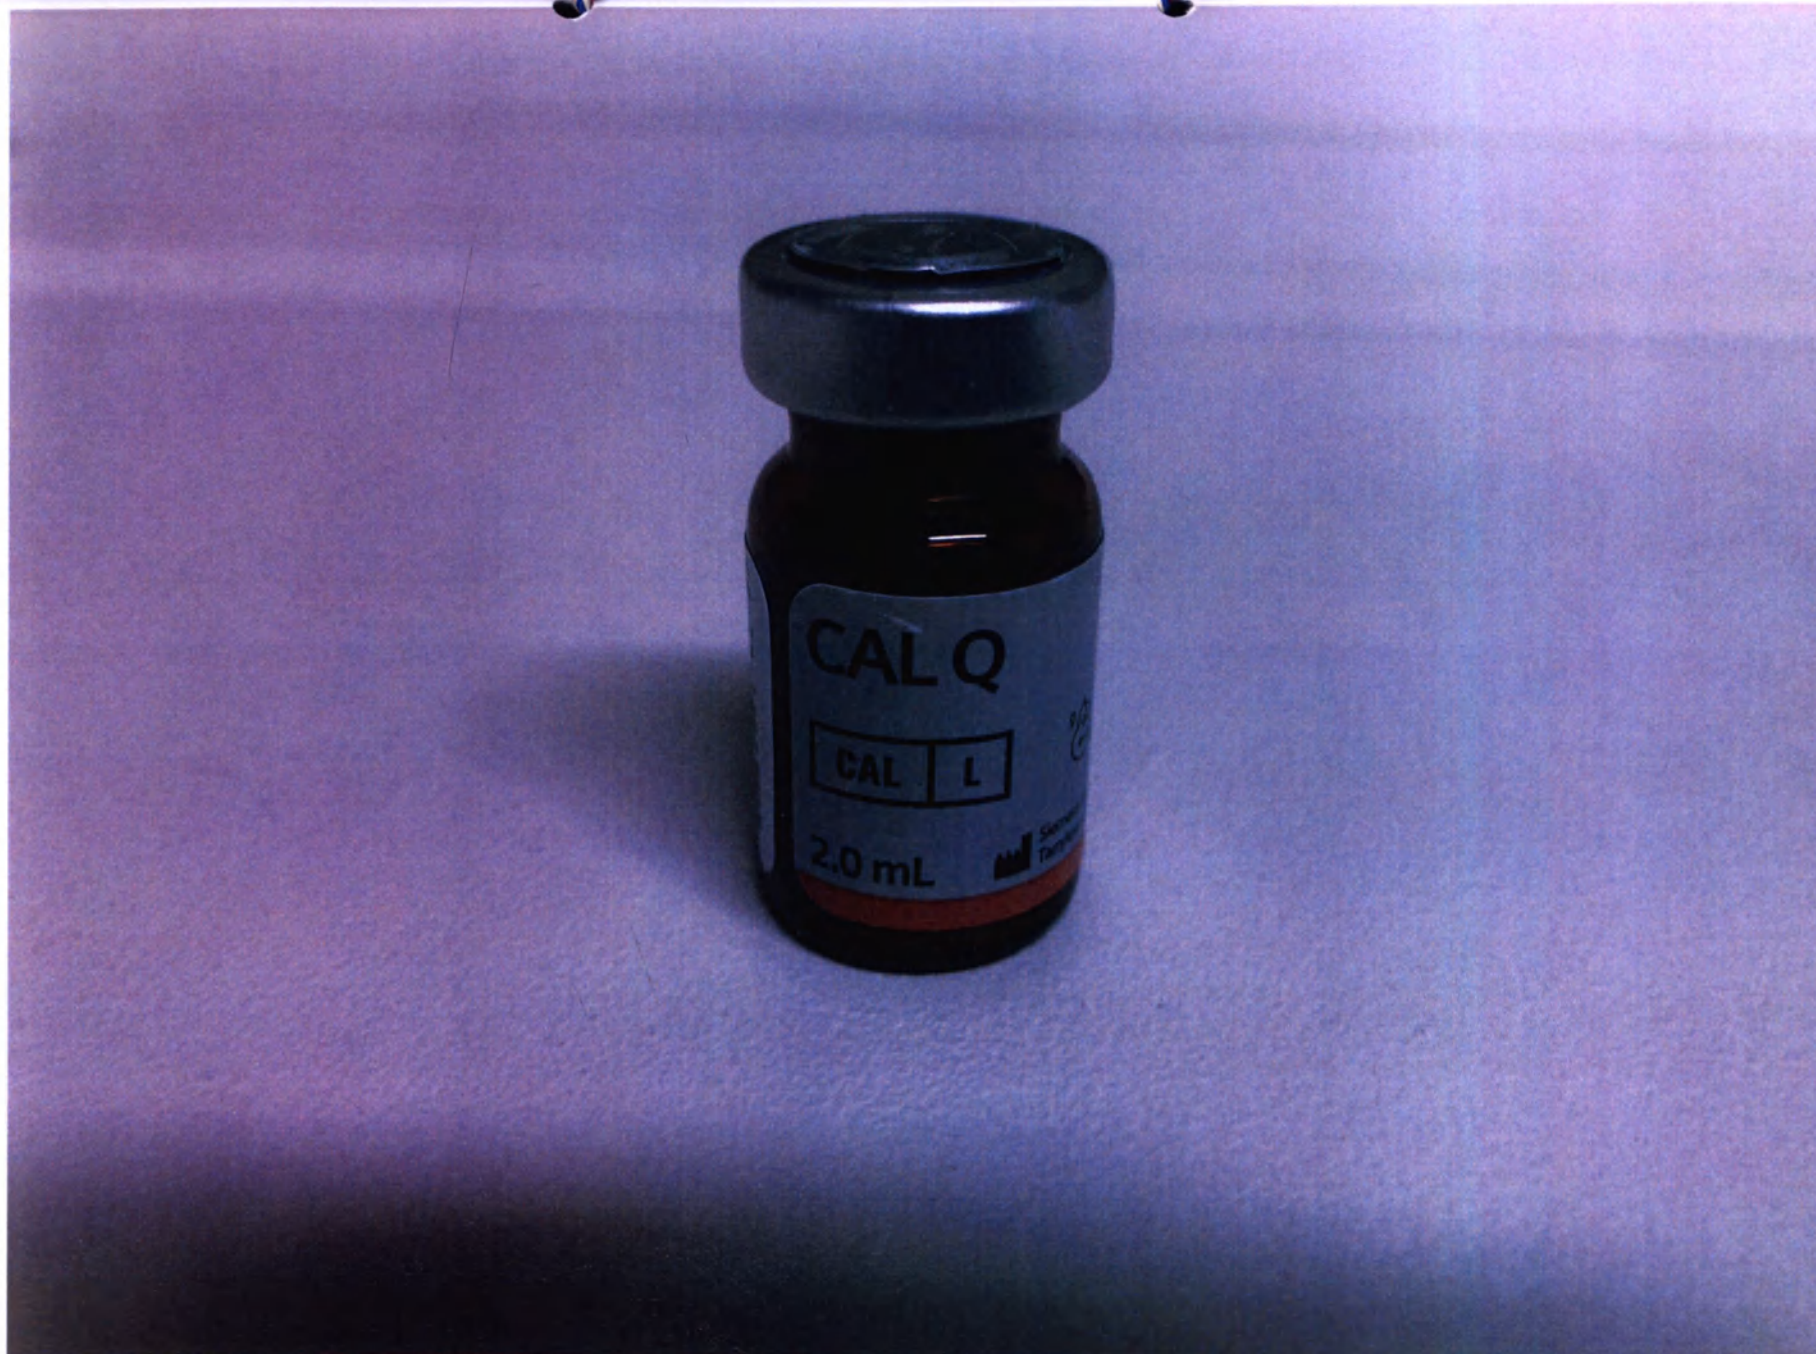
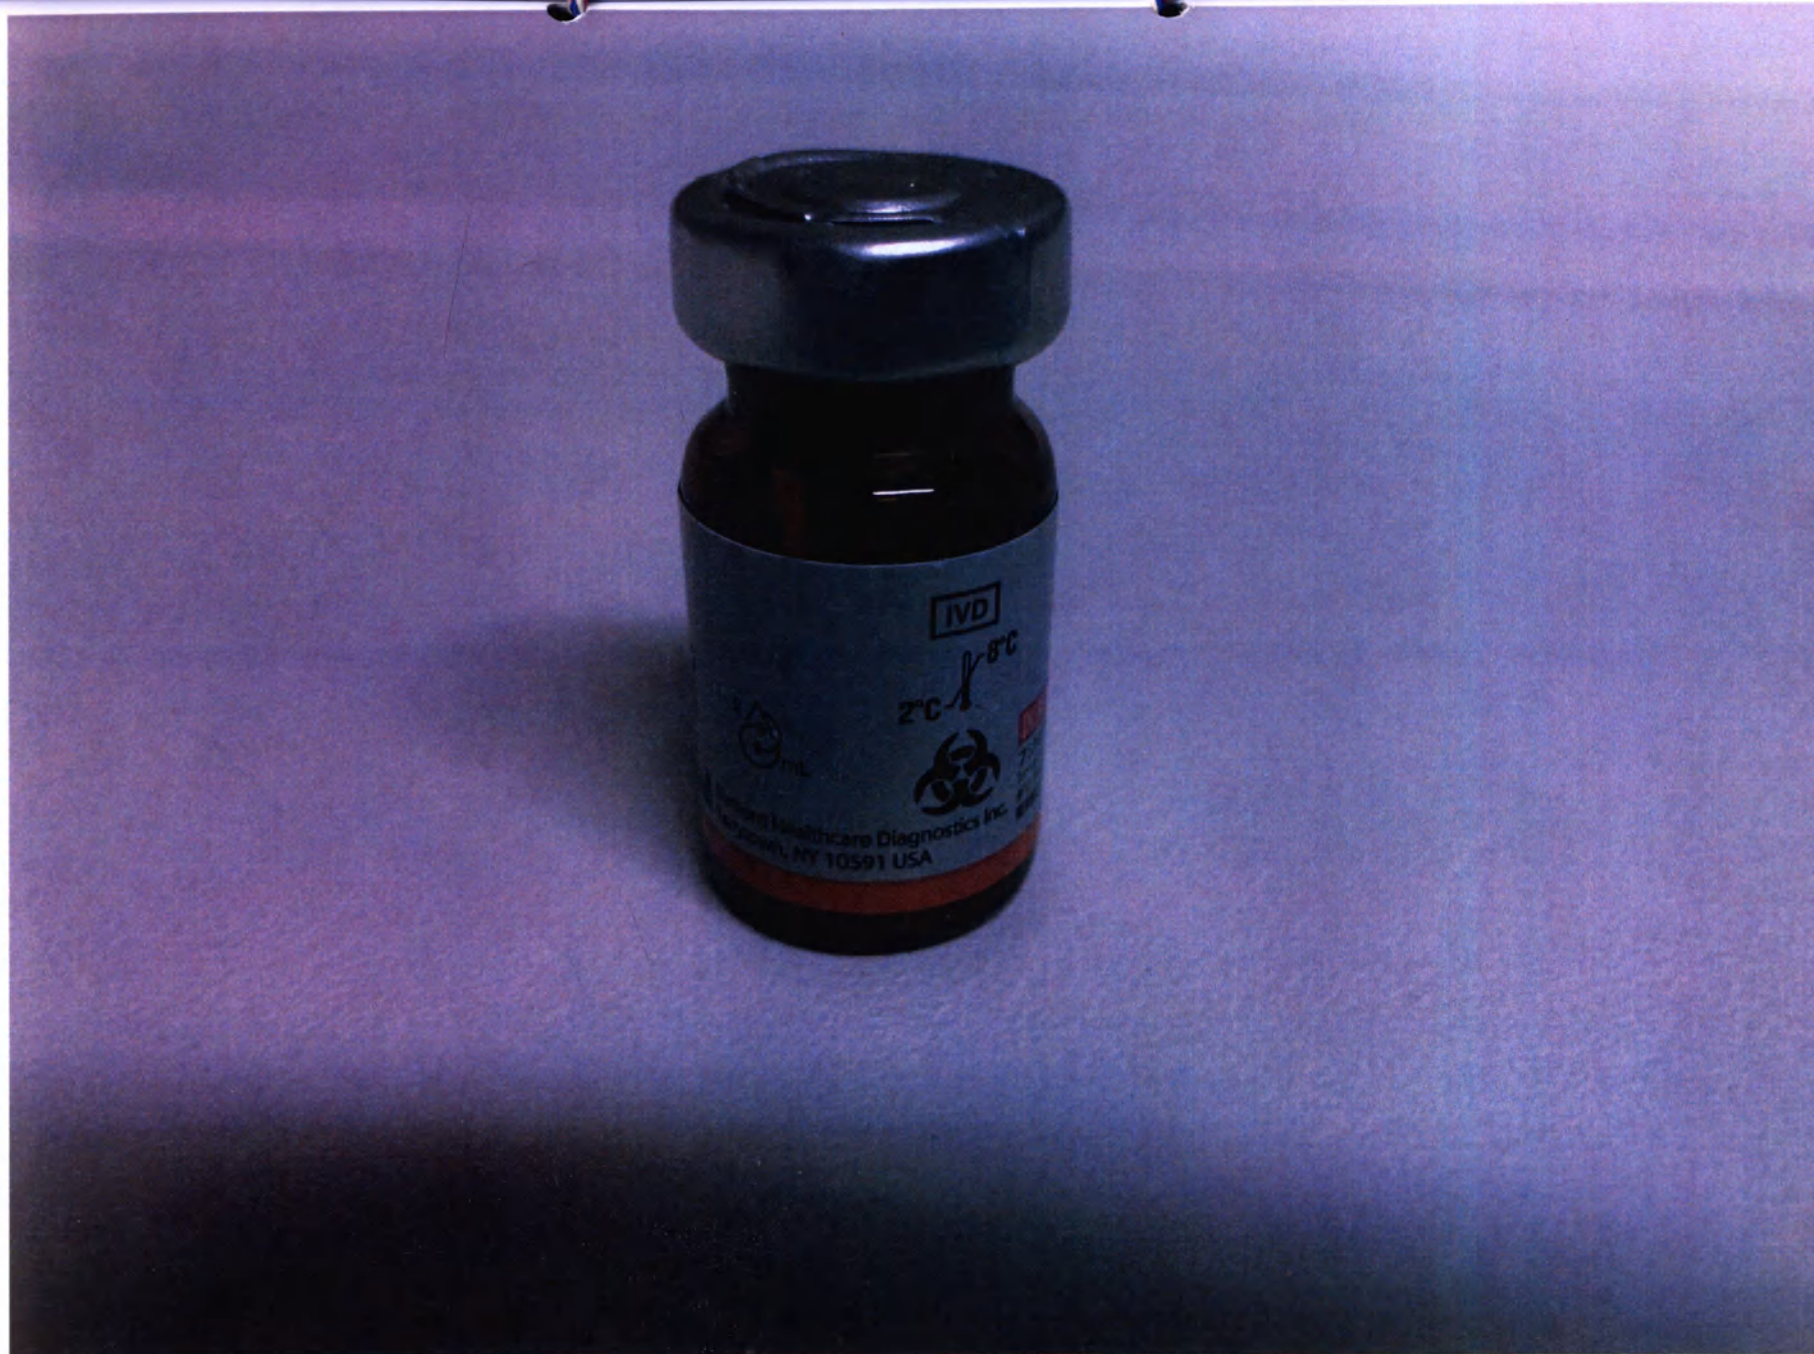


Рисунок 3. Набор калибраторов Q для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Calibrator Q (Atellica IM CAL Q)): Калибратор с низкой концентрацией



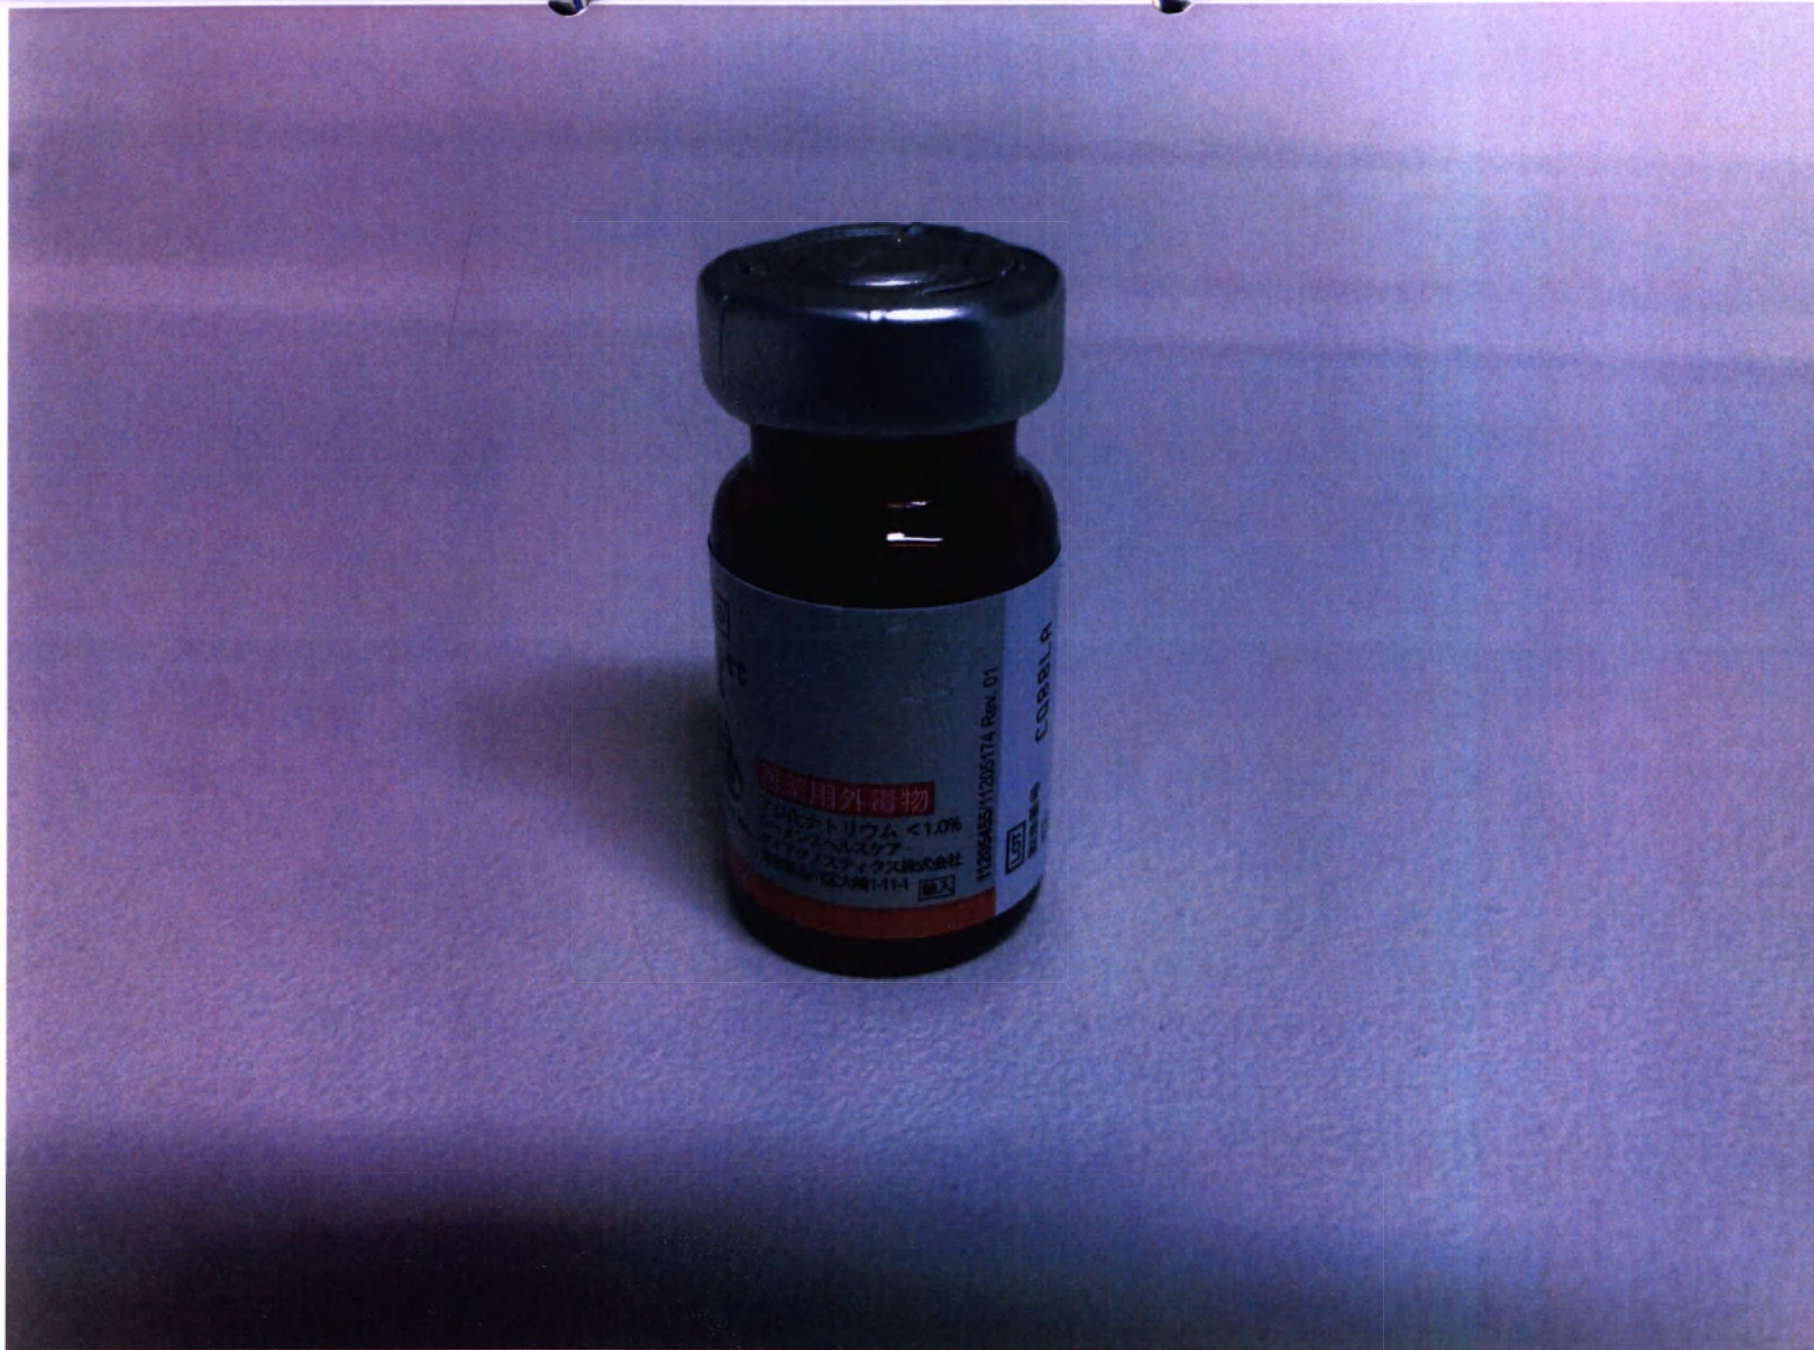


Рисунок 5. Набор калибраторов Q для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Calibrator Q (Atellica IM CAL Q)): Калибратор с низкой концентрацией

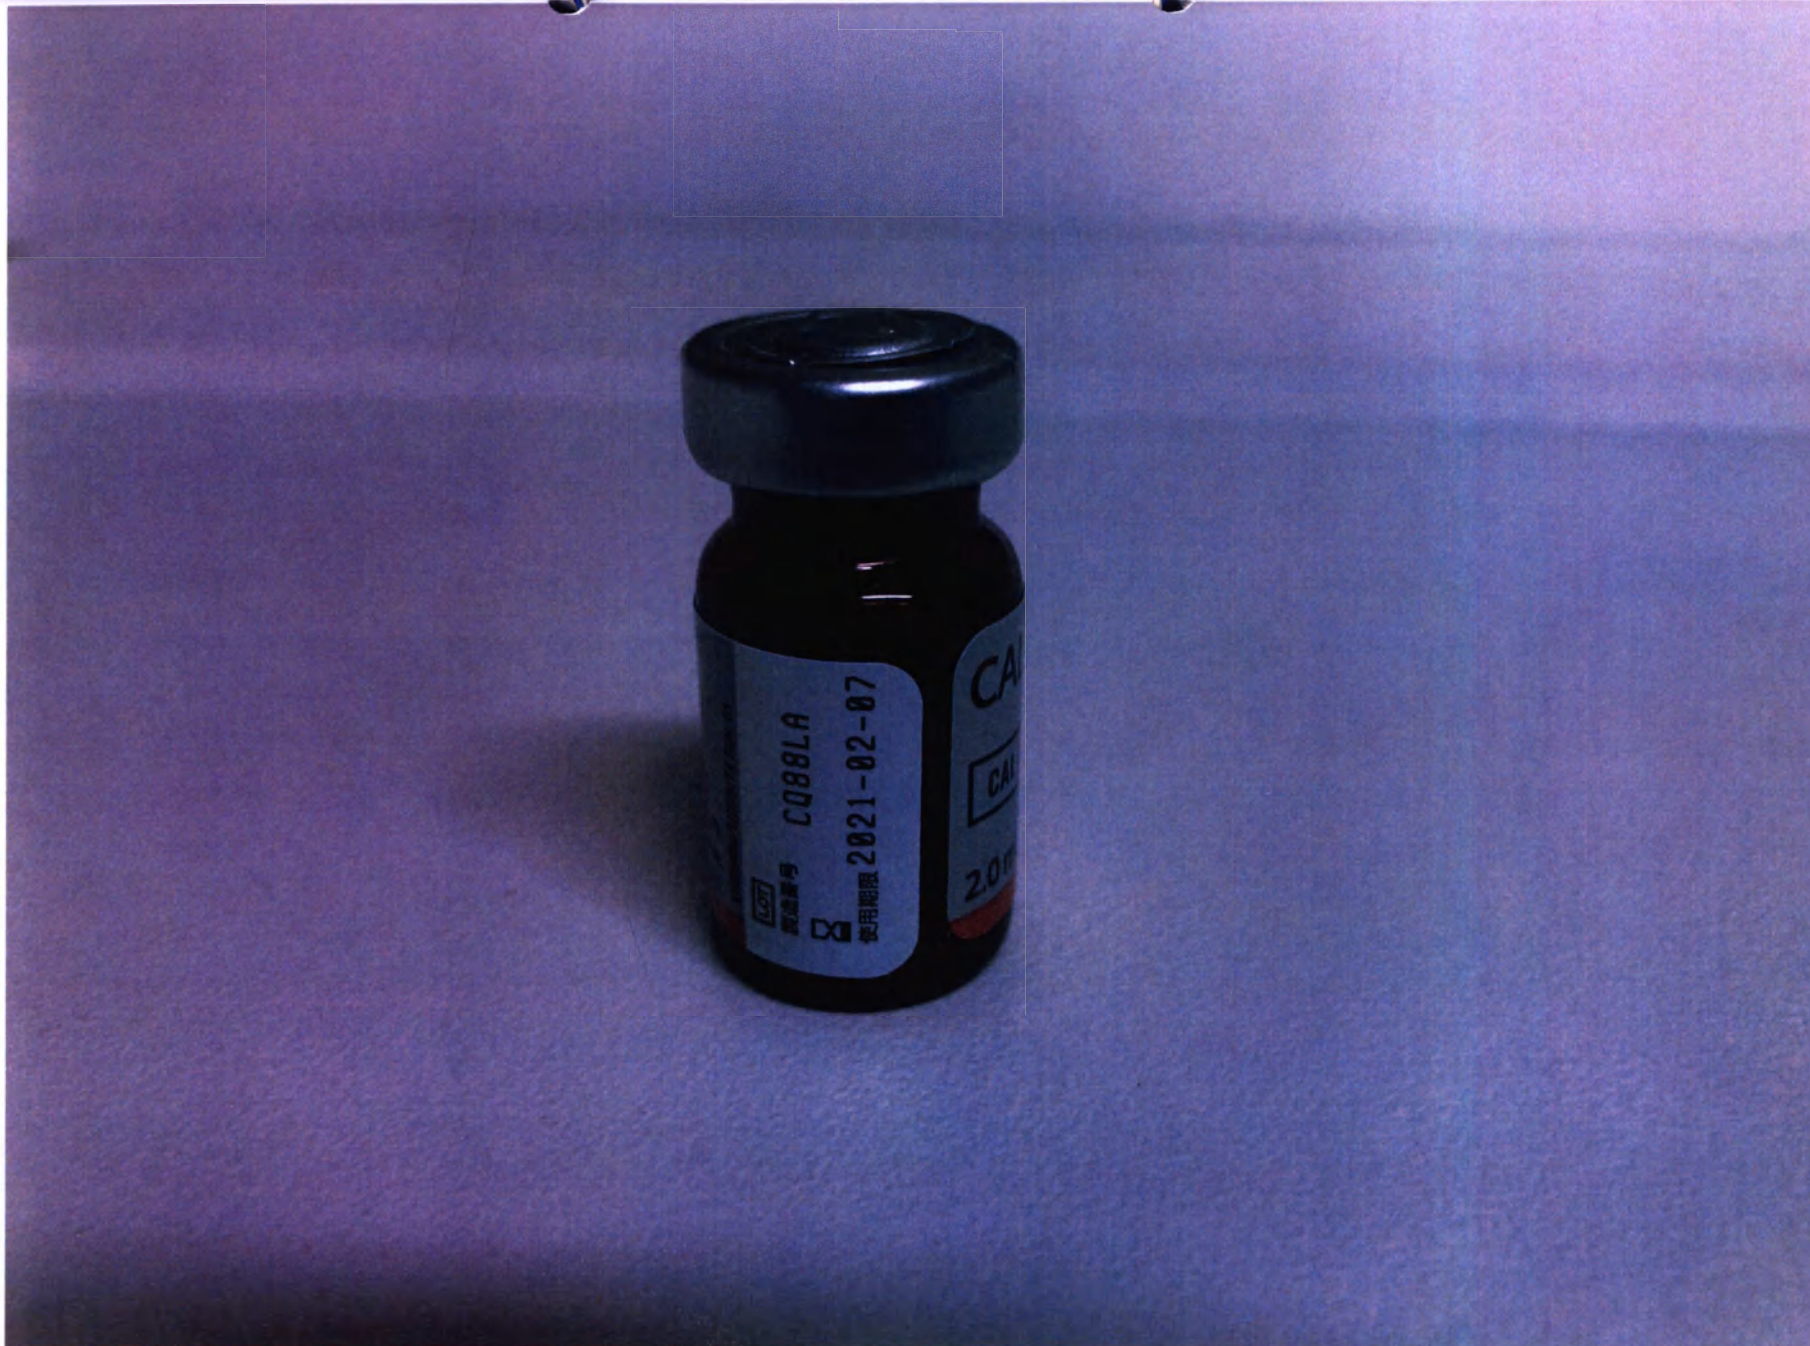


Рисунок 6. Набор калибраторов Q для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Calibrator Q (Atellica IM CAL Q)): Калибратор с низкой концентрацией

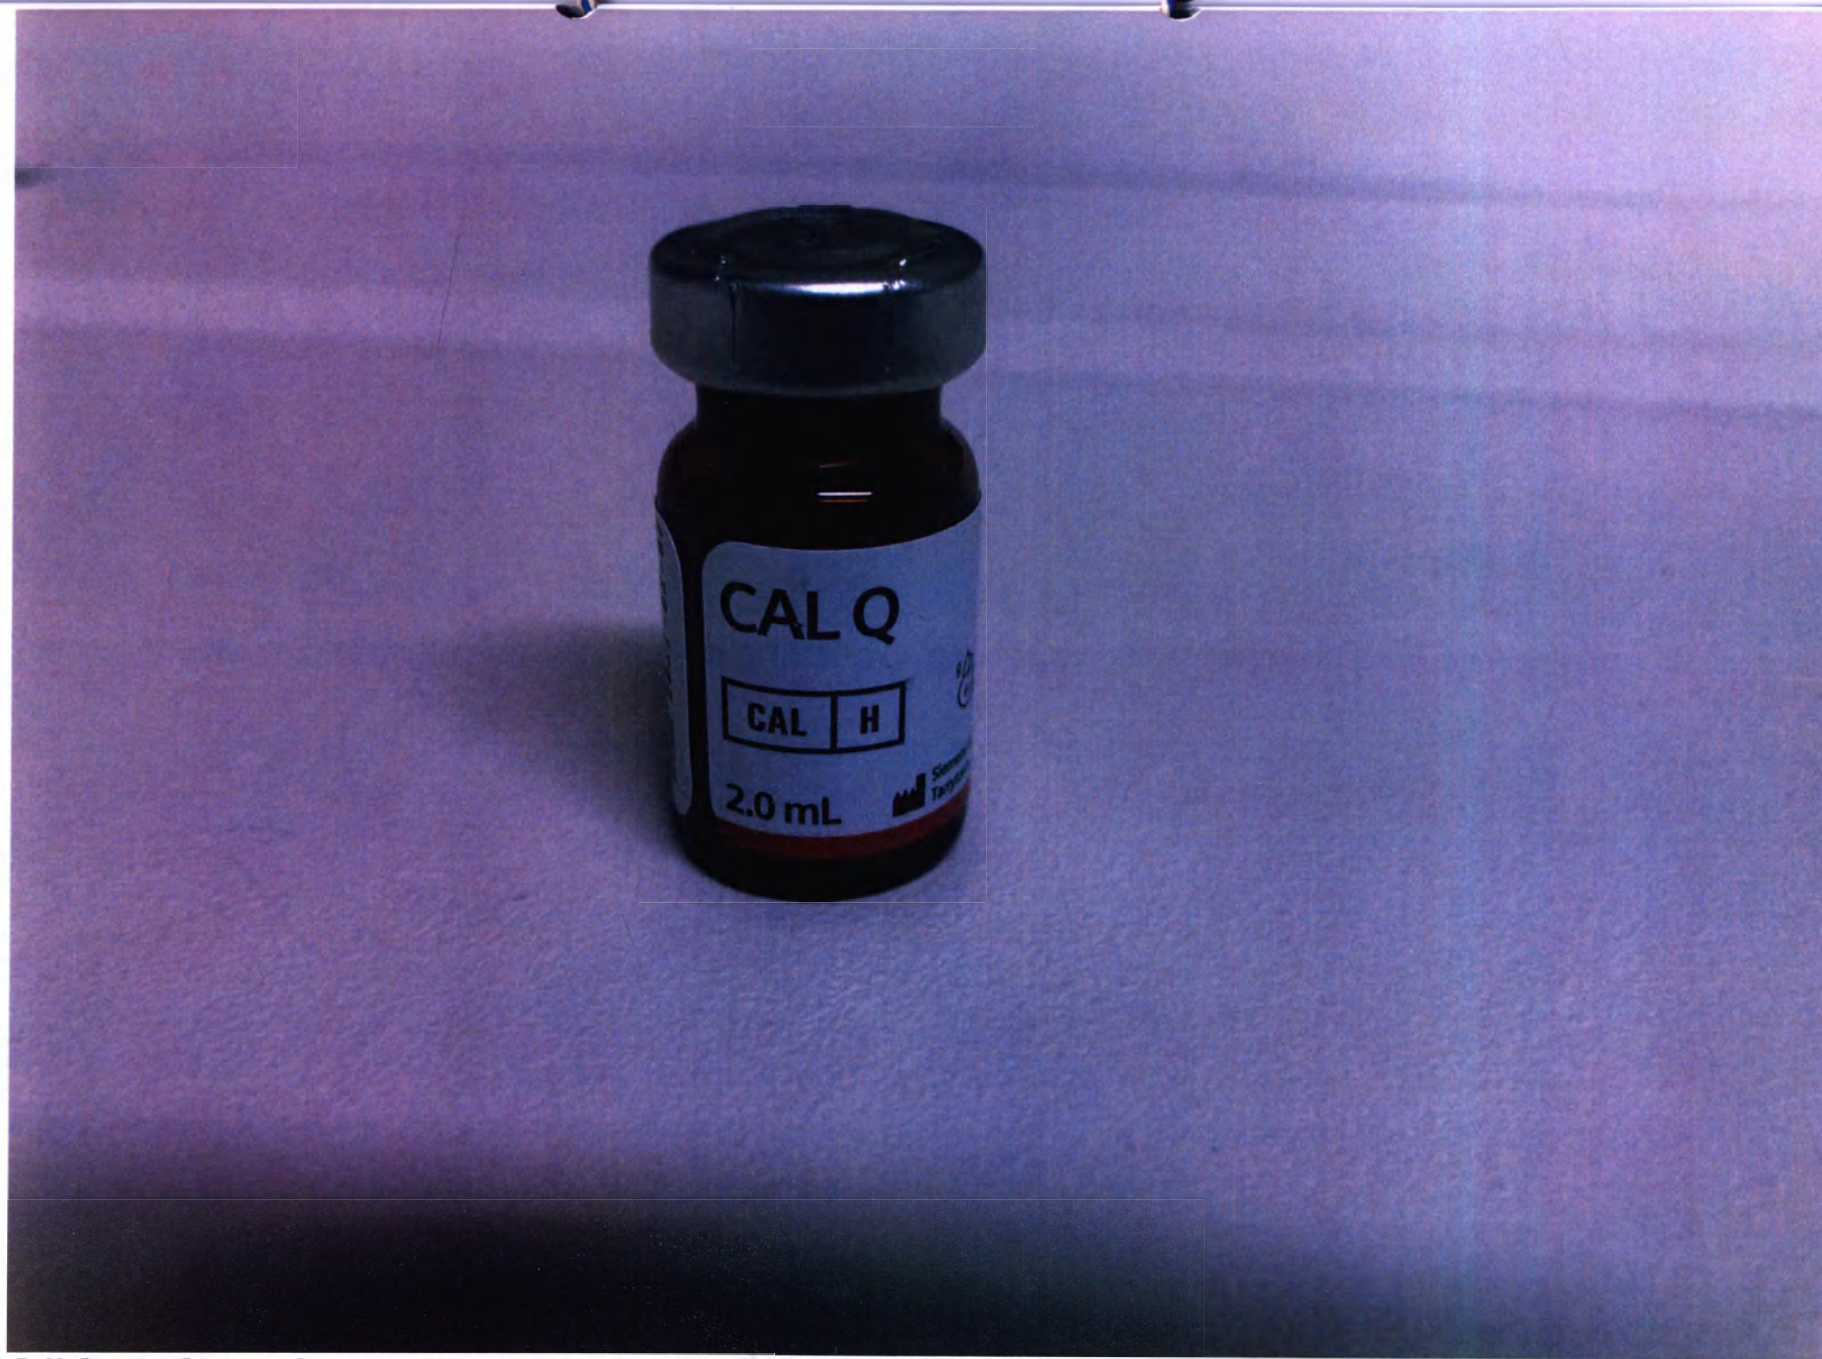


Рисунок 7. Набор калибраторов Q для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Calibrator Q (Atellica IM CAL Q)): Калибратор с высокой концентрацией

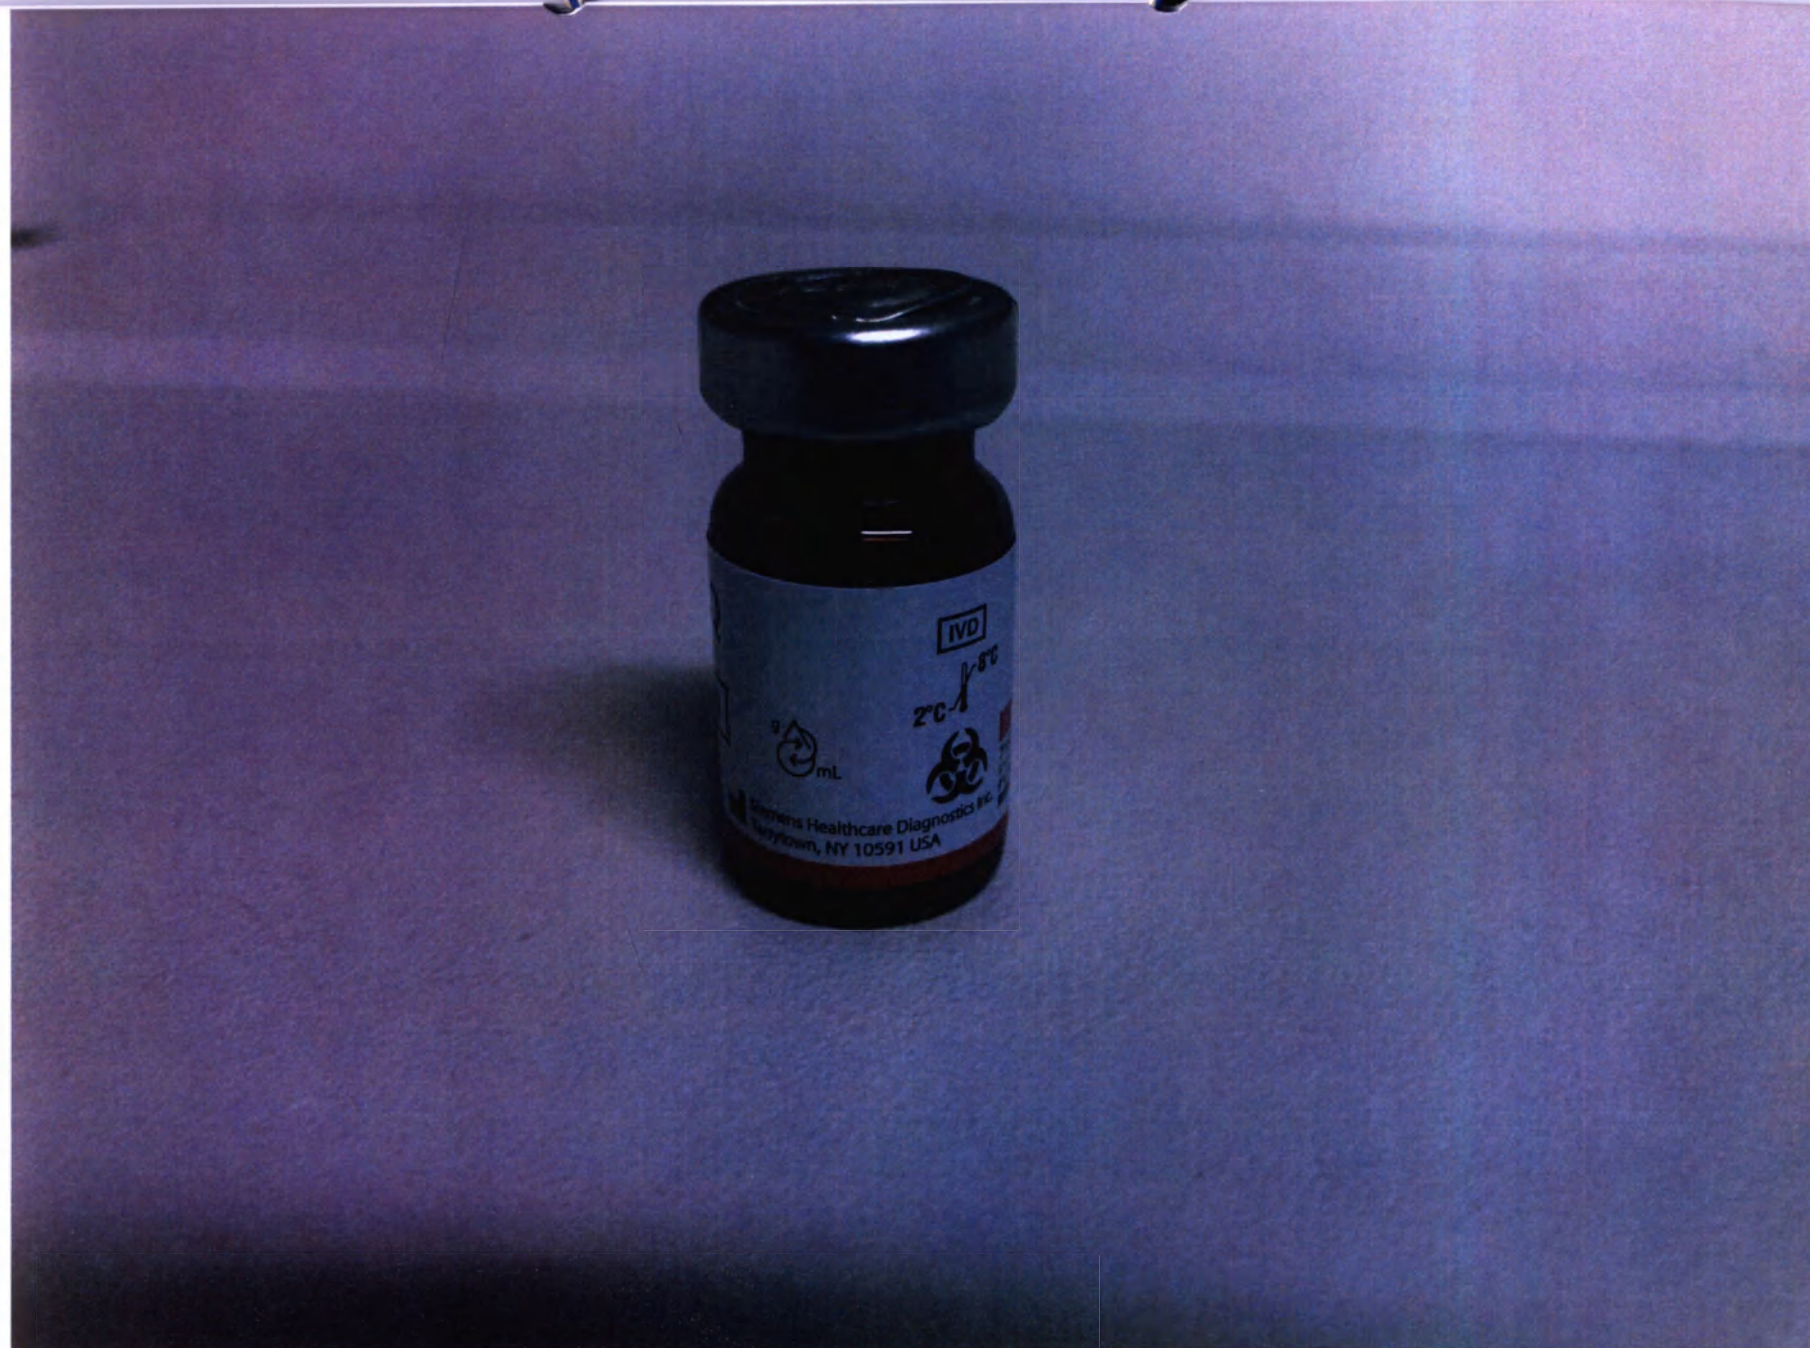


Рисунок 8. Набор калибраторов Q для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Calibrator Q (Atellica IM CAL Q)): Калибратор с высокой концентрацией
Atellica IM CAL Q H 20 мл

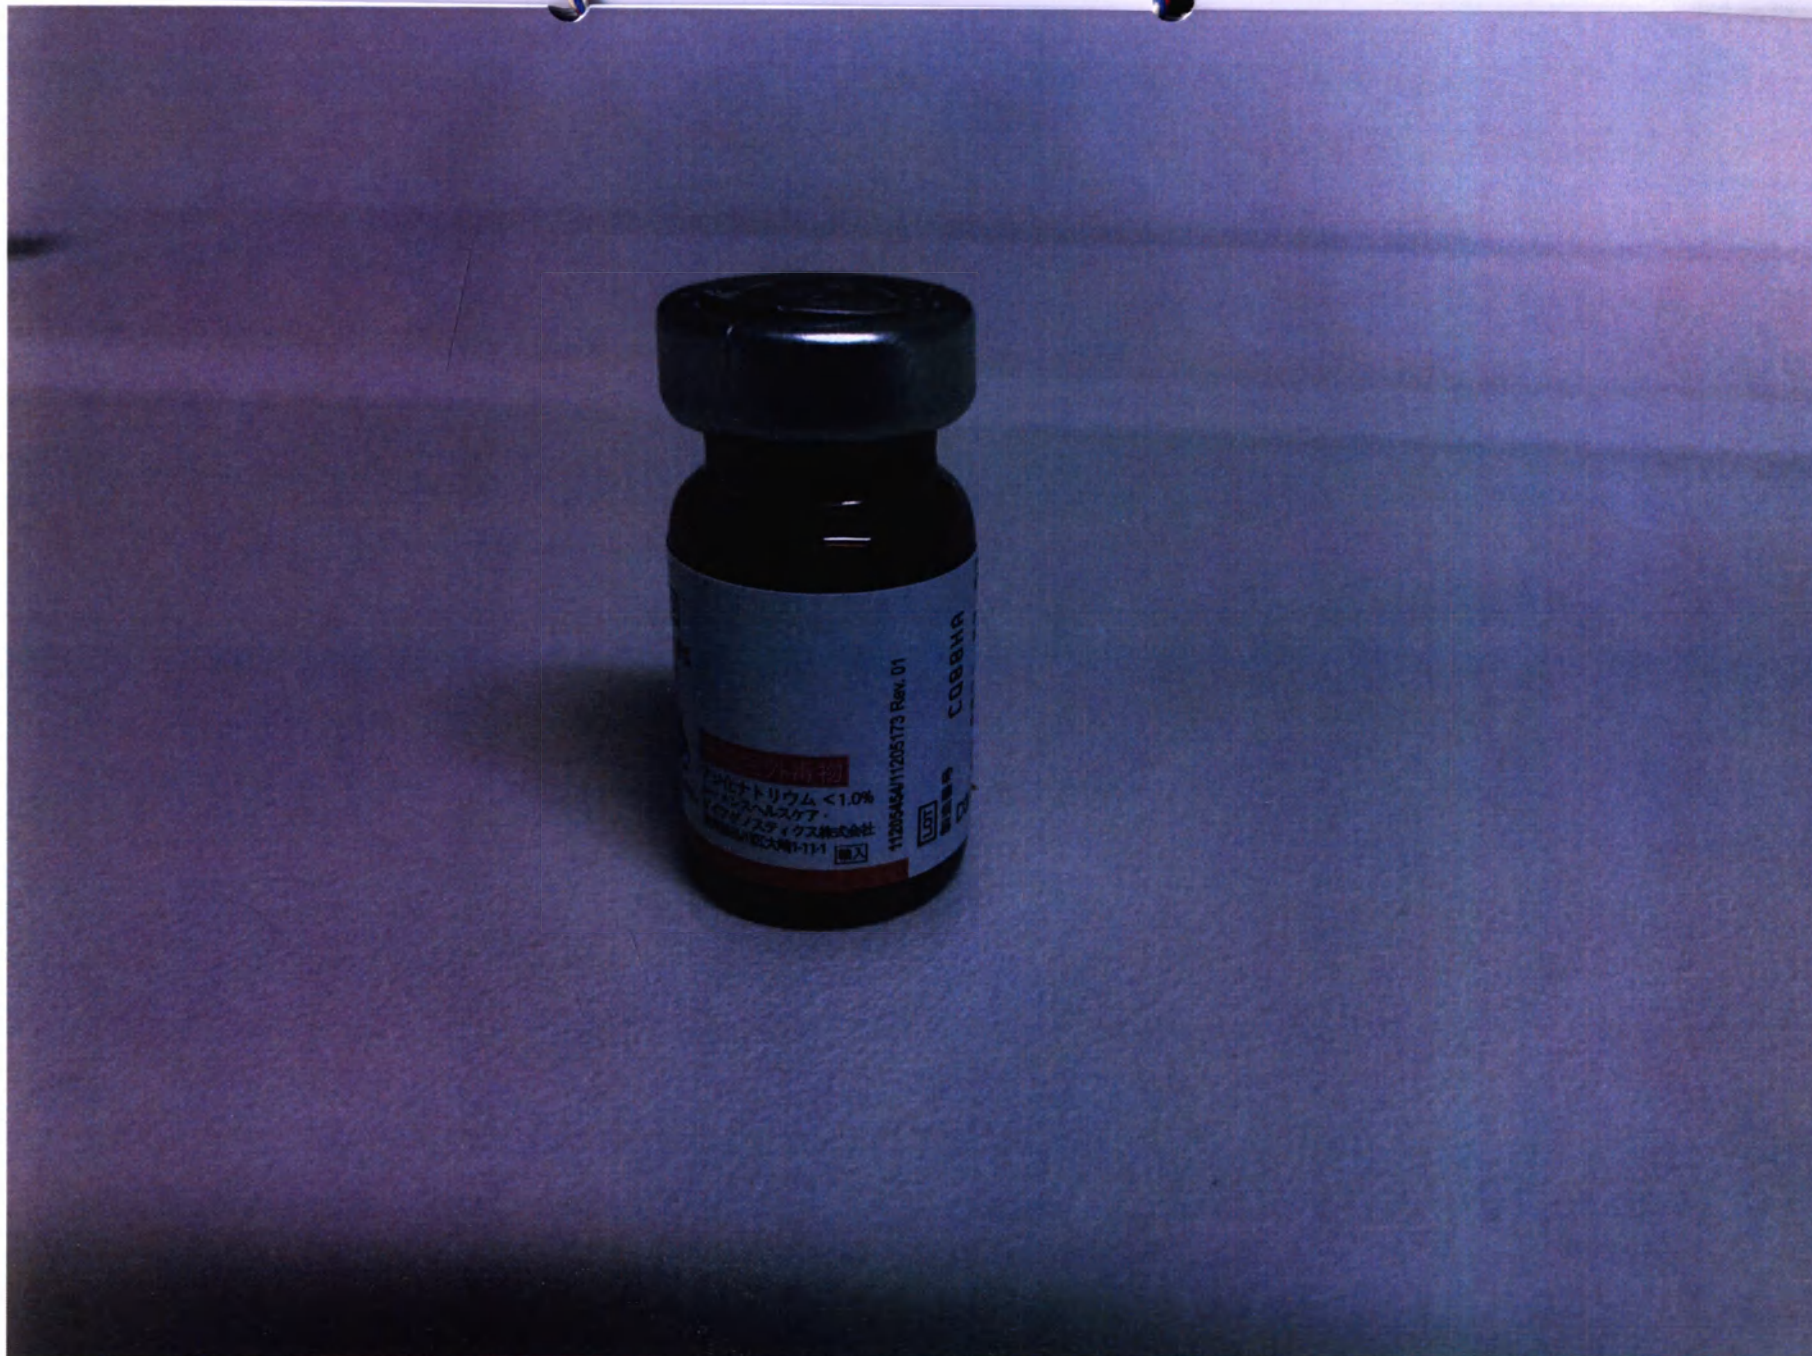


Рисунок 9. Набор калибраторов Q для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Calibrator Q (Atellica IM CAL Q)): Калибратор с высокой концентрацией

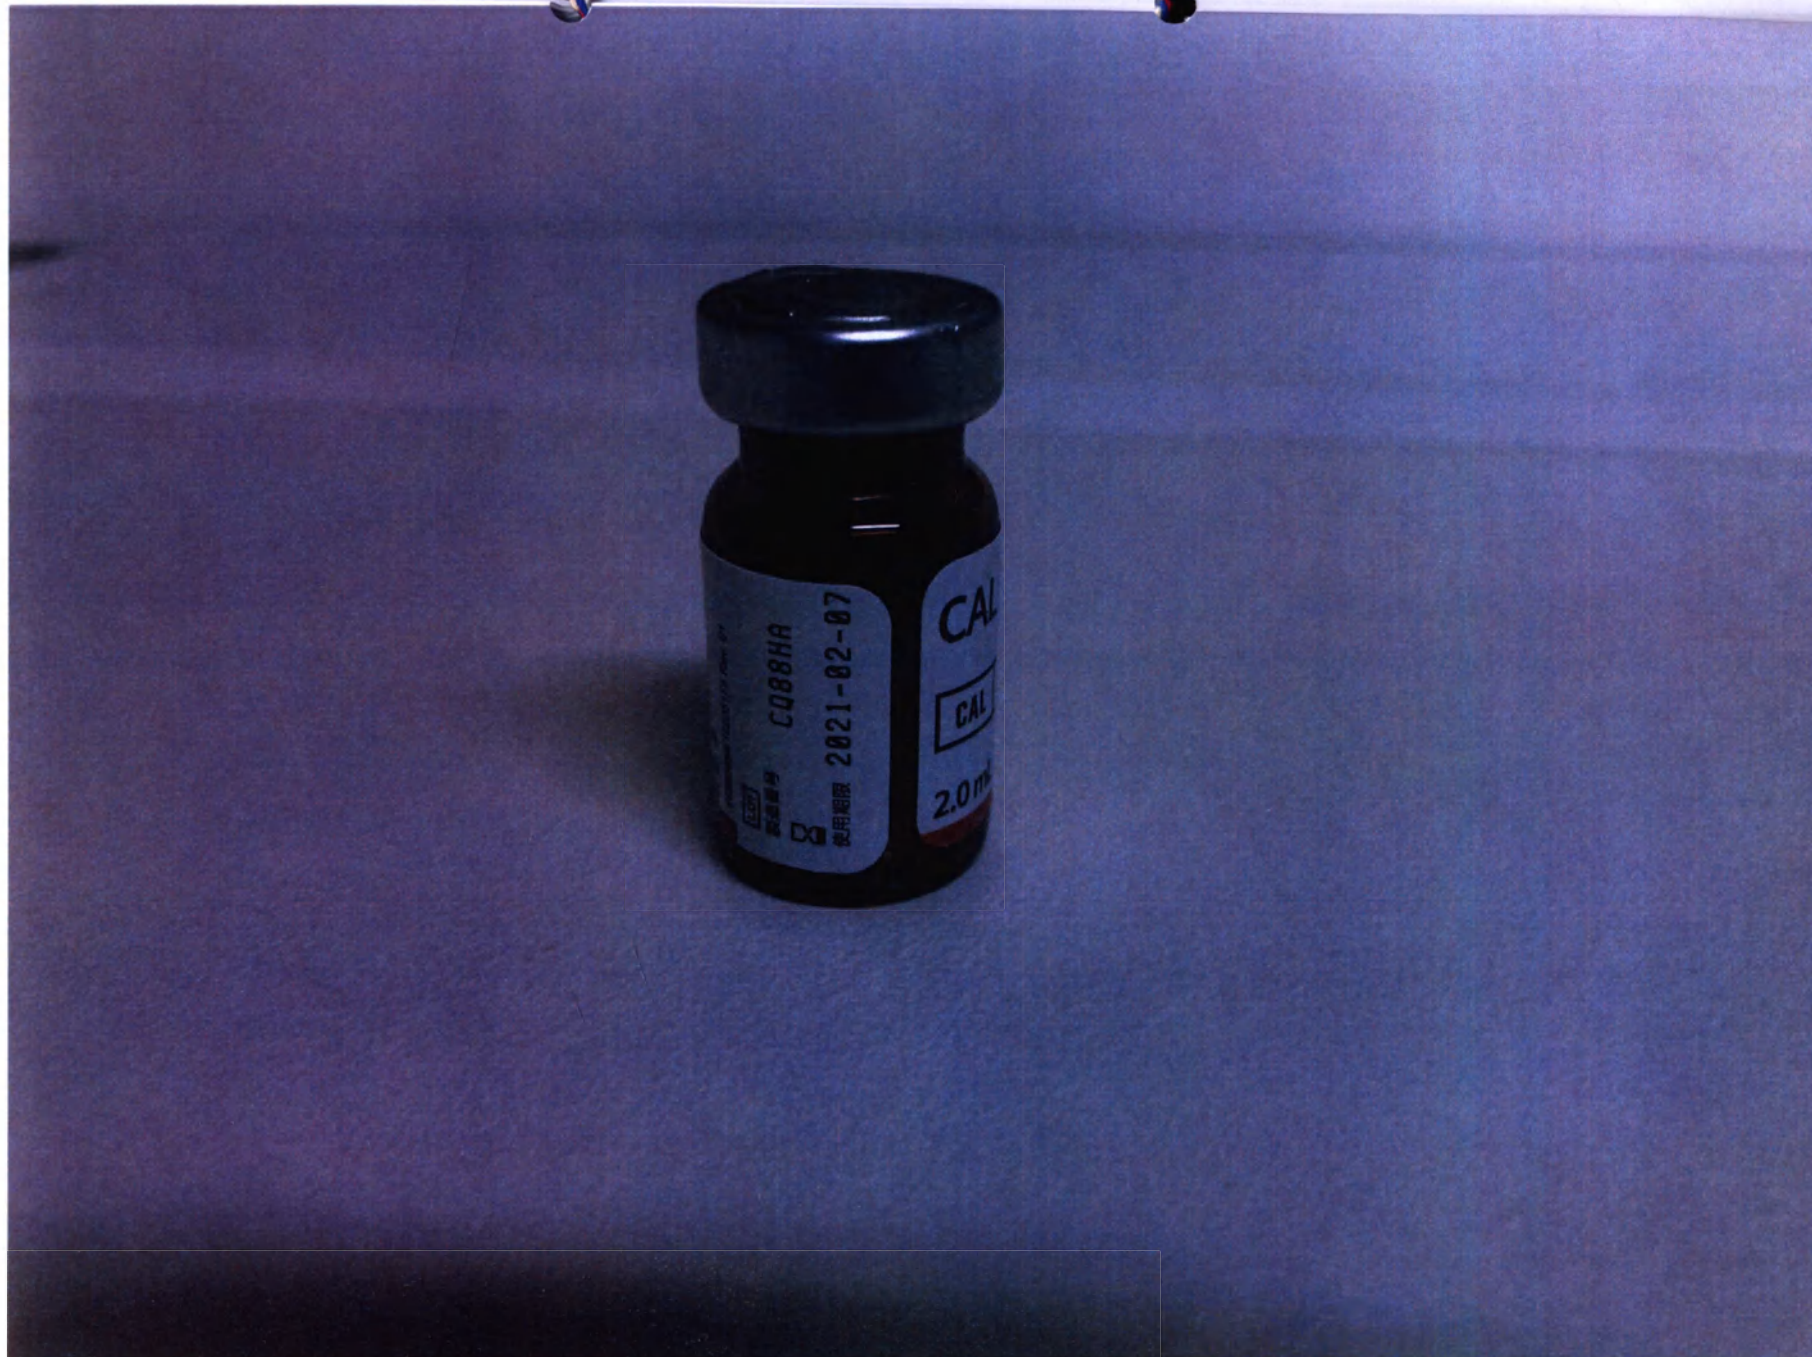


Рисунок 10. Набор калибраторов Q для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Calibrator Q (Atellica IM CAL Q)): Калибратор с высокой концентрацией Atellica IM CAL Q H 2.0 мл

SIEMENS
Healthineers

Atellica® IM

CAL

Q

CAL LOT VAL

LOT

CQ88

製造番号



2021-02-07

使用期限



[siemens.com/document-library](https://www.siemens.com/document-library)



5e01065f

CHECKSUM

CAL L

UNITS C

UNITS SI

CAL H

UNITS C

UNITS SI

PSA



0 NG/mL

0 UG/L

65.3 NG/mL

65.3 UG/L

Рисунок 11. Набор калибраторов Q для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Calibrator Q (Atellica IM CAL Q)): Лист значений параметров лота калибратора

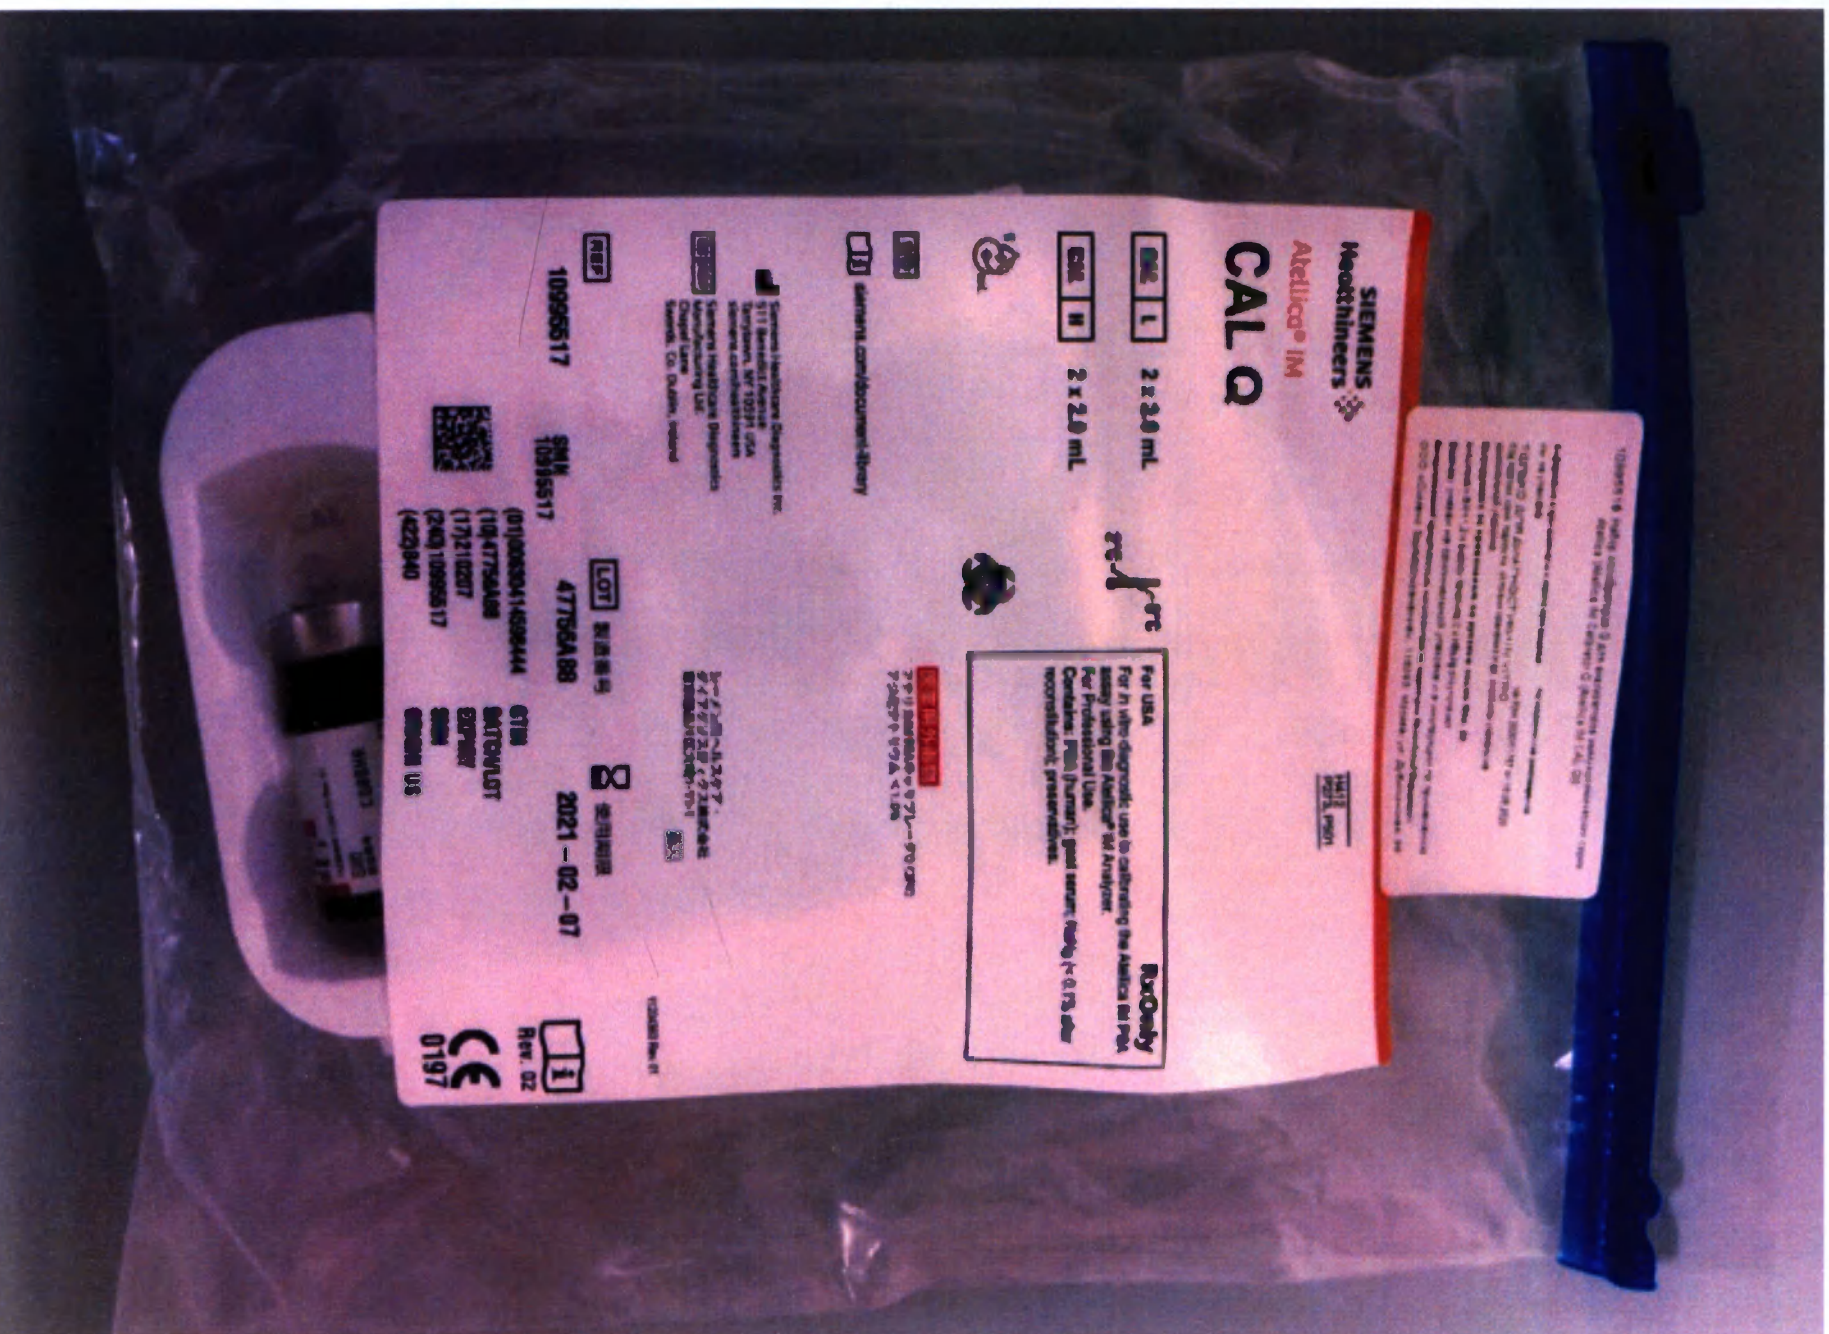


Рисунок 12. Фотографическое изображение упаковки и макета маркировки медицинского изделия, содержащего информацию на русском языке.

10995518 Набор калибраторов Q для анализаторов иммунохимических серии
Atellica (Atellica IM Calibrator Q (Atellica IM CAL Q))

Информация о производителе и стране происхождения
см. на упаковке

Регистрационное удостоверение

№ РЗН 2020/11757 от 18.08.2020

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на
оригинальной упаковке

Инструкция по применению на русском языке Rev. 02

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению

Авторизованный представитель изготовителя на территории Российской Федерации

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96

MENS

H412

0070 0504

Рисунок 13. Фотографическое изображение макета маркировки медицинского изделия, содержащего информацию на русском языке.



Всего прошито и пронумеровано
14 листа (ов).

ООО «Сименс Здоровоохранение»

