

Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

**Набор реагентов для количественного определения лютеинизирующего гормона
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на
иммунохимических анализаторах Alinity i «ЛГ Реагенты (Alinity i LH Reagent Kit)»**

(размером не менее 18 x 24 сантиметра)



INVERSIONS PERFORMED

Alinity i LH Reagent Kit

Abbott

REF 07P9120



2 x 100



www.abbottdiagnostics.com/IFU

R02




Exp. 2020-07-29

LOT

04290UI00



G70038R02



MICROPARTICLES

2 x 6.6 mL

CONJUGATE

2 x 31.6 mL




Abbott Ireland
Diagnostics Division
Lisnamuck, Longford
Co. Longford
Ireland
+353-43-3331000



PRODUCT OF IRELAND

(01) 00380740121532 (17) 200729
(10) 04290UI00 (240) 07P9120

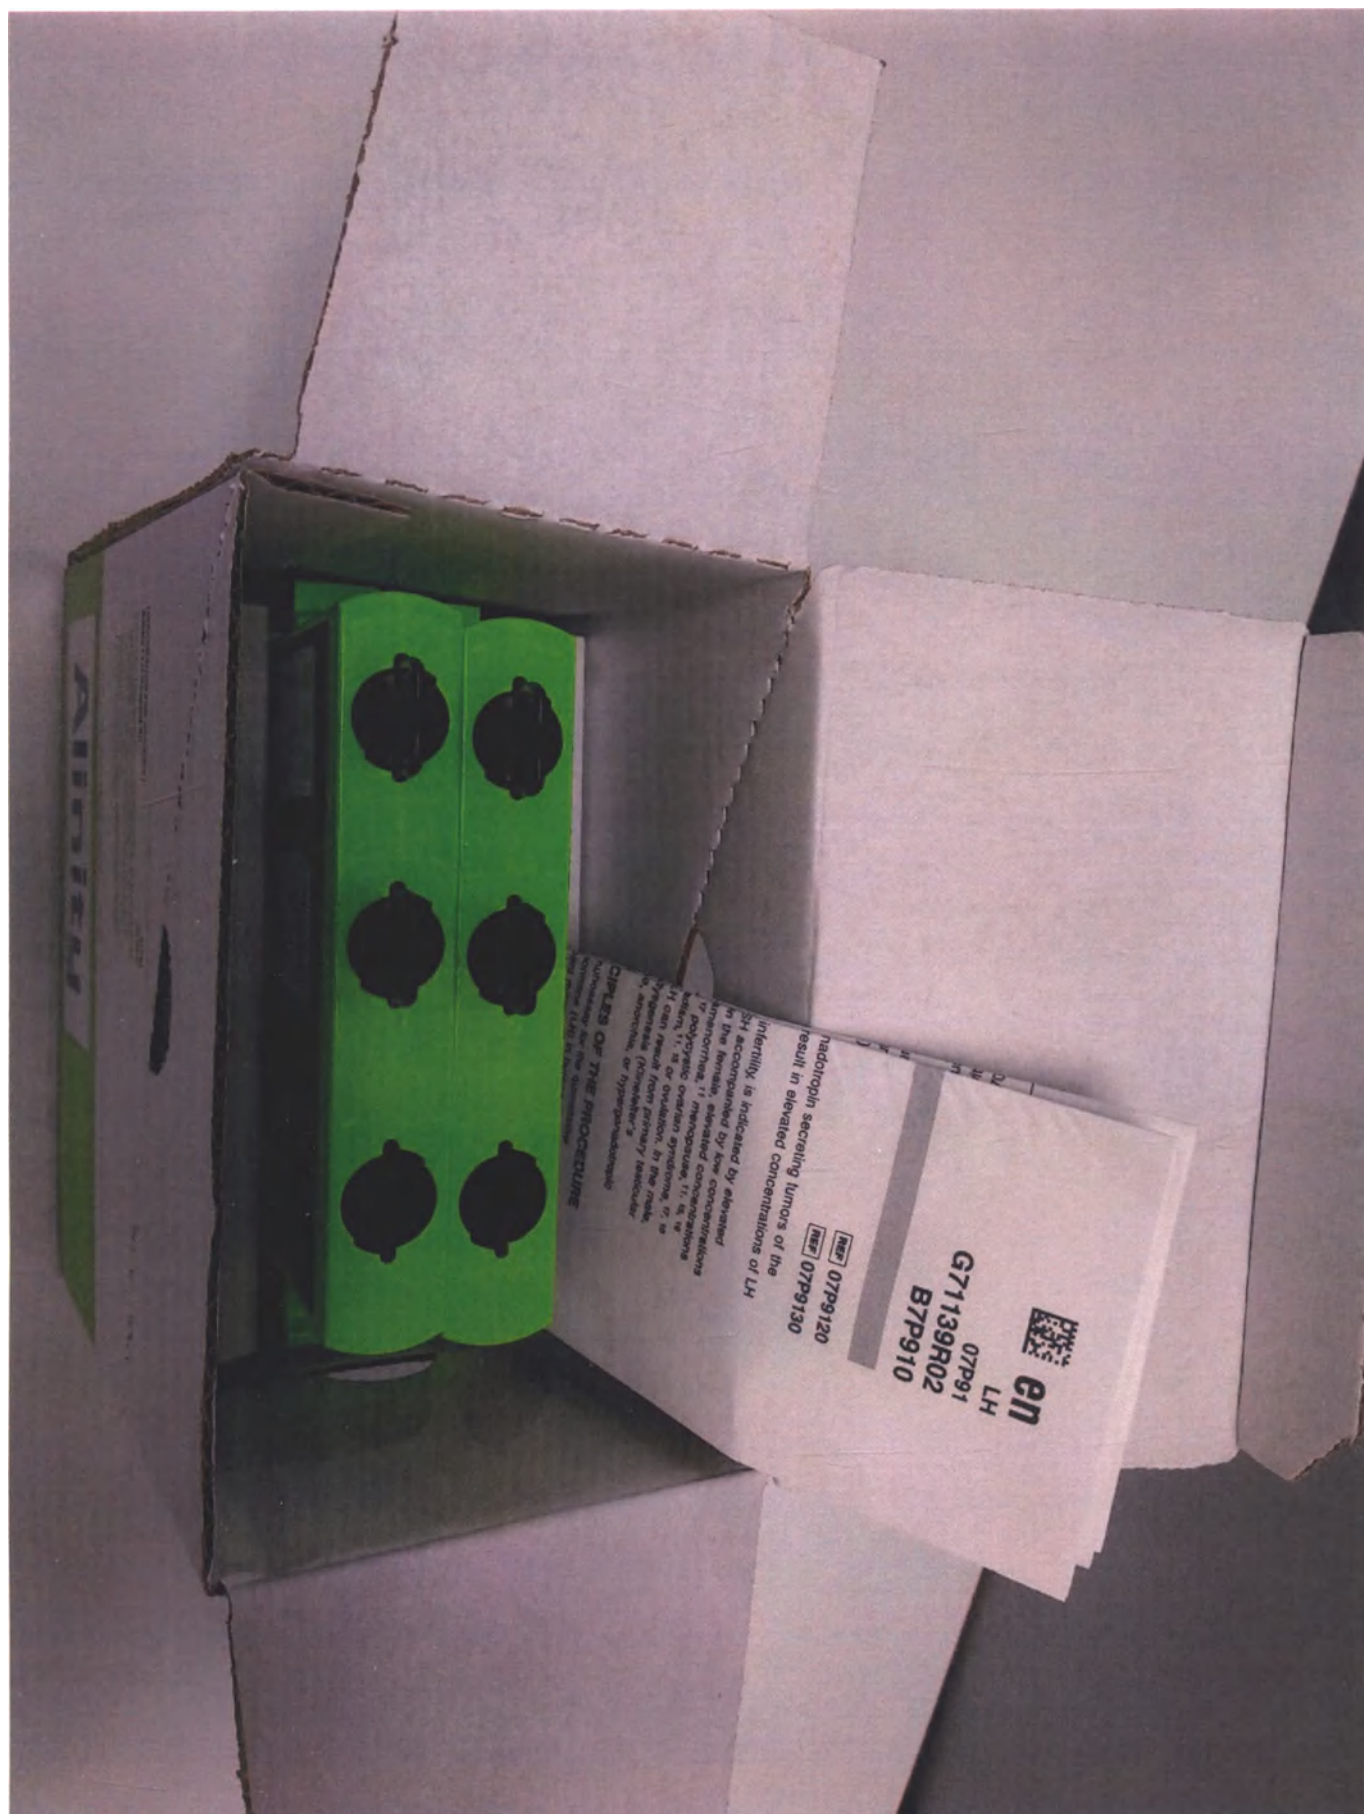



Alinity i LH Reagent Kit

Read Highlighted Changes: Revised, April 2018.

Instructions must be carefully followed. Reliability of assay results cannot be guaranteed if there are any deviations from these instructions.

NAME

Alinity i LH Reagent Kit

luminescent microparticle
competitive determination of

this disorder. In contrast, gonadotropin-secreting tumors of the hypothalamus and pituitary result in elevated concentrations of LH and FSH.¹⁵

Gonadal failure, a cause of hypogonadism, is indicated by elevated concentrations of LH and FSH, as well as by low concentrations of gonadal steroids.^{11, 14, 15} In premenopausal women, elevated concentrations of LH can indicate primary ovarian failure.¹⁵ In postmenopausal women, elevated concentrations of LH can indicate primary ovarian failure.¹⁵ In men, elevated concentrations of LH can indicate primary hypogonadism.¹⁵ or reduction in the male.



INVERSIONS PERFORMED

Alinity i LH Reagent Kit


Abbott



07P9130



2 x 600



MICROPARTICLES

2 x 32.1 mL

CONJUGATE

2 x 31.6 mL



www.abbottdiagnostics.com/iFU

R02



Exp. 2020-12-12



LOT 123456789



G70039R01



Abbott Ireland
Diagnostics Division
Lisnamuck, Longford
Co. Longford
Ireland
+353-43-3331000


IVD



PRODUCT OF IRELAND

(01) 00380740121549 (17) 201212

(10) 123456789 (240) 07P9130

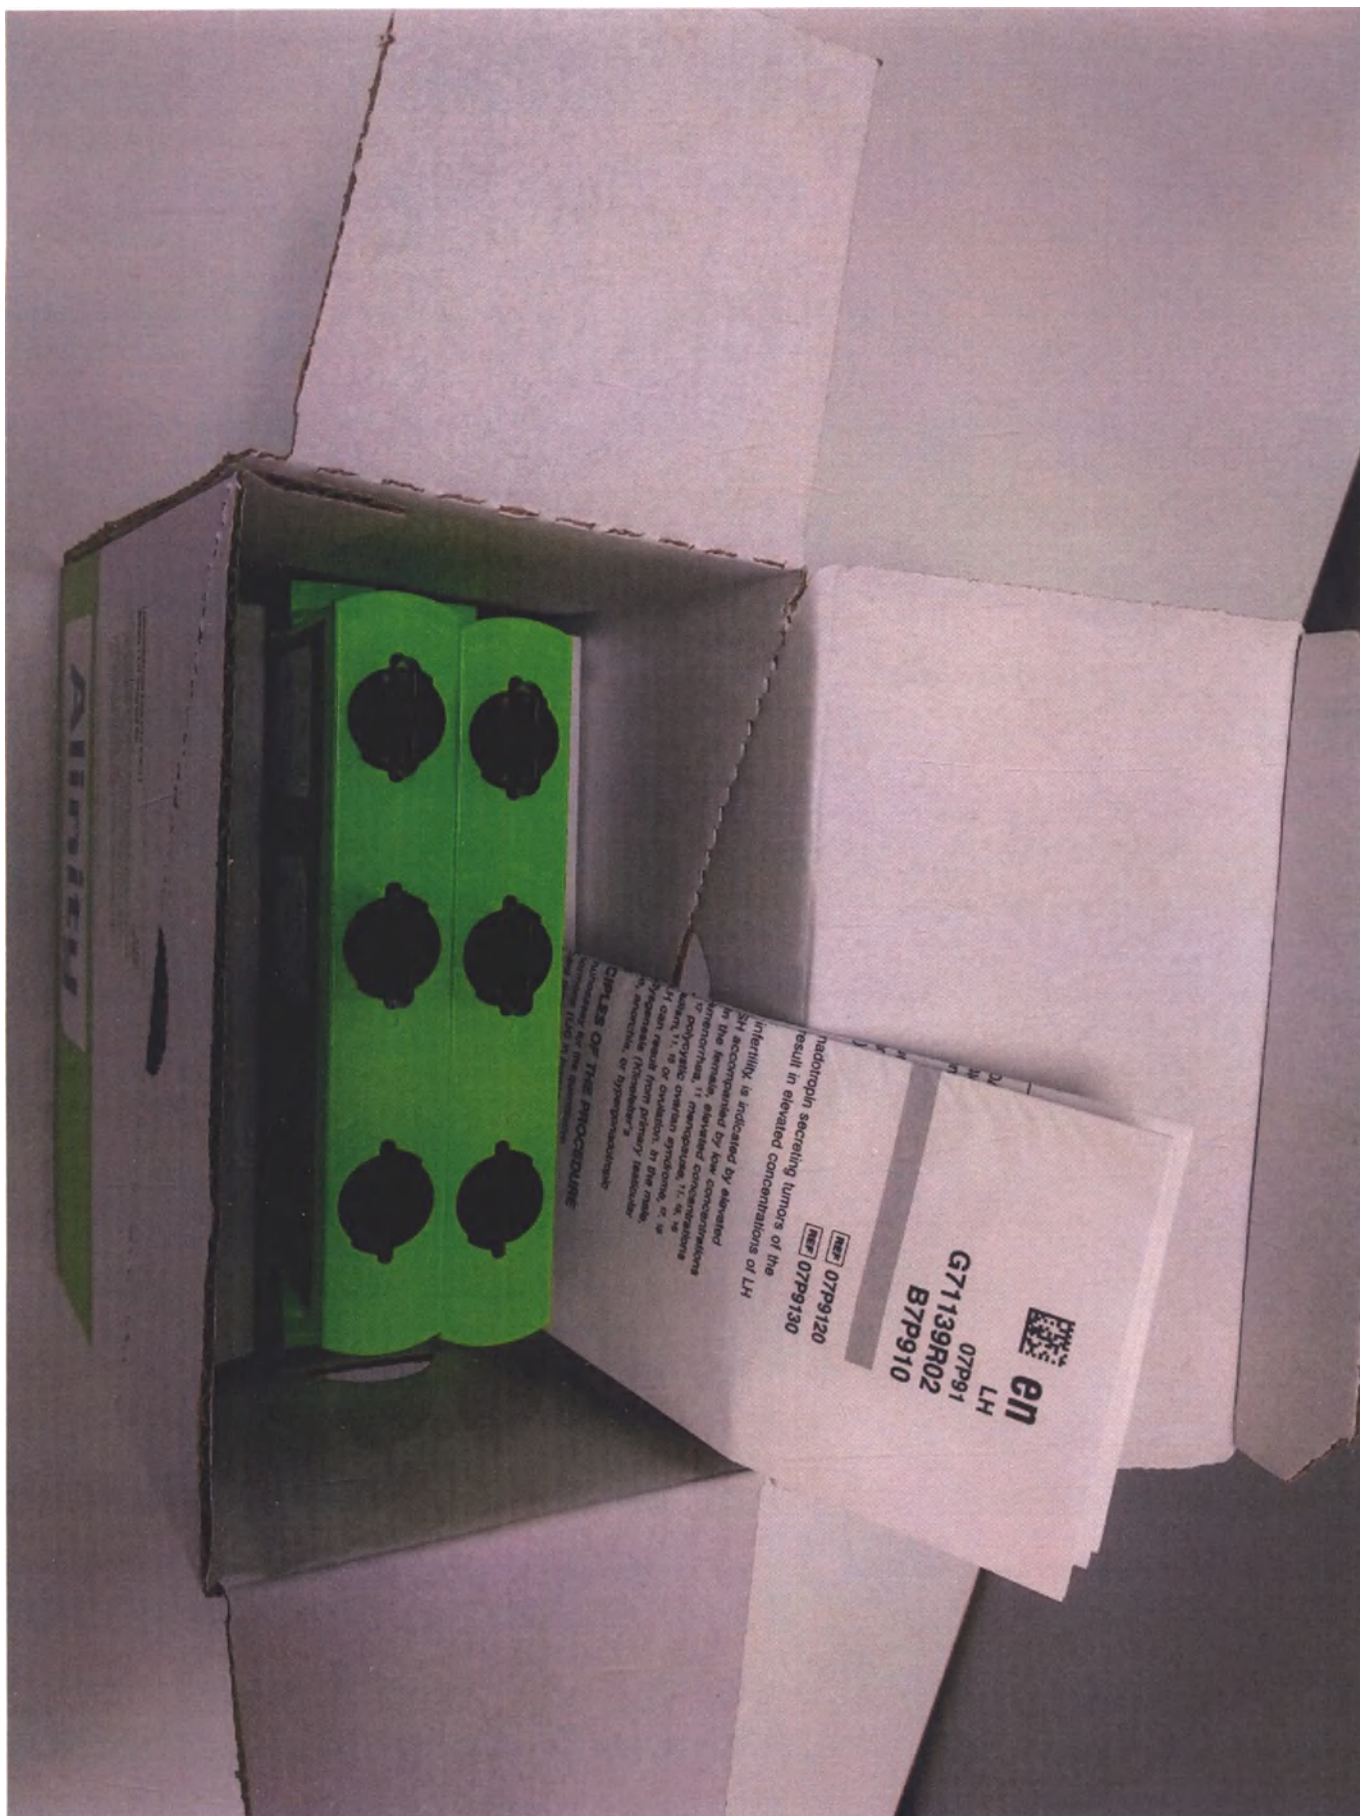



Пронумеровано, прошито

скреплено печатью на _____

7 _____ листах



Макет маркировки на медицинское изделие

**Набор реагентов для количественного определения лютеинизирующего
гормона иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови
человека на иммунохимических анализаторах Alinity i «ЛГ Реагенты (Alinity i
LH Reagent Kit)»**

ЛГ Реагенты (Alinity i LH Reagent Kit), Кат. №07P9120



REF 07P91-20

IVD



Набор реагентов для количественного определения лютеинизирующего гормона иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i

«ЛГ Реагенты (Alinity i LH Reagent Kit)»

2 картриджа по 100 тестов в составе:

- Микрочастицы (Alinity i LH Microparticles) – 2 x 6,6 мл
- Конъюгат (Alinity i LH Conjugate) – 2 x 31,6 мл

Инструкция по применению

Производитель: Abbott Ireland Diagnostics Division, Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland (Ирландия) / РУ № ____ / ____ от ____ / Инструкция по применению на русском языке: www.abbottdiagnostics.com/IFU/

Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах.

Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171,

Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,


Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

Макет оригинальной маркировки медицинского изделия ЛГ Реагенты (Alinity i LH Reagent Kit), Кат. №07P9120

LH


Alinity i LH Reagent Kit

Abbott



REF 07P9120 2 x 100

www.abbottdiagnostics.com/IFU



MICROPARTICLES
CONJUGATE

2 x 6.6 mL
2 x 31.6 mL

G70038R02



Abbott Ireland
Diagnostics Division
Lisnamuck, Longford
Co. Longford
Ireland
+353-43-3331000



PRODUCT OF IRELAND

Макет маркировки блока компонентов медицинского изделия ЛГ Реагенты (Alinity i LH Reagent Kit), Кат. №07P9120



Alinity i

LH

MICROPARTICLES

6.6 mL



G70040R01

CONJUGATE

31.6 mL



G70043R01

07P91

IVD

G70044R01



LOT

SN



ABBOTT
AIDD Longford, Ireland

Abbott



07P91-30



Набор реагентов для количественного определения лютеинизирующего гормона иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i

«ЛГ Реагенты (Alinity i LH Reagent Kit)»

2 картриджа по 600 тестов в составе:

- Микрочастицы (Alinity i LH Microparticles) – 2 x 32,1 мл
- Конъюгат (Alinity i LH Conjugate) – 2 x 31,6 мл

Инструкция по применению

Производитель: Abbott Ireland Diagnostics Division, Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland (Ирландия) / РУ № ____ / ____ от ____ / Инструкция по применению на русском языке: www.abbottdiagnostics.com/IFU /

Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах.


Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,
Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

LH


Alinity i LH Reagent Kit



07P9130



2 x 600



MICROPARTICLES

2 x 32.1 mL

CONJUGATE

2 x 31.6 mL



www.abbottdiagnostics.com/IFU



LOT

G70039R01



Abbott Ireland
Diagnostics Division
Lisnamuck, Longford
Co. Longford
Ireland
+353-43-3331000



PRODUCT OF IRELAND

Макет маркировки блока компонентов медицинского изделия ЛГ Реагенты (Alinity i LH Reagent Kit),
Кат. №07P9130



Сведения о стандартах, применяемых к этикетке на МИ:

Стандарт	Наименование стандарта
ГОСТ Р ИСО 18113-1 – 2015	Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> . Информация, предоставляемая изготовителем (маркировка). Часть 1. Термины, определения и общие требования.
ГОСТ Р ИСО 18113-2 – 2015	Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> – Информация, предоставляемая производителем (маркировка) – Часть 2: Реагенты для диагностики <i>in vitro</i> для профессионального применения.
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования.

Расшифровка символов представлена в инструкции.

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на _____
5 _____ листах

