



3M Россия
108811, г. Москва, п. Московский,
Киевское ш., 22-й км, домовл. 6, стр. 1
Тел.: 8 800 250 84 74
www.3MRussia.ru

3M Russia
108811, Moscow, p. Moskovskiy,
Kievskoe shosse, 22 km, 6, bld. 1
Phone: 8 800 250 84 74
www.3MRussia.ru

Фотографическое изображение медицинского изделия

**Ложки оттисковые стоматологические одноразовые Impression
Tray различных размеров в вариантах исполнения**

Специалист по сертификации

Отдела Здравоохранения

АО «3М Россия»



Герасимова В.А.

М.П.

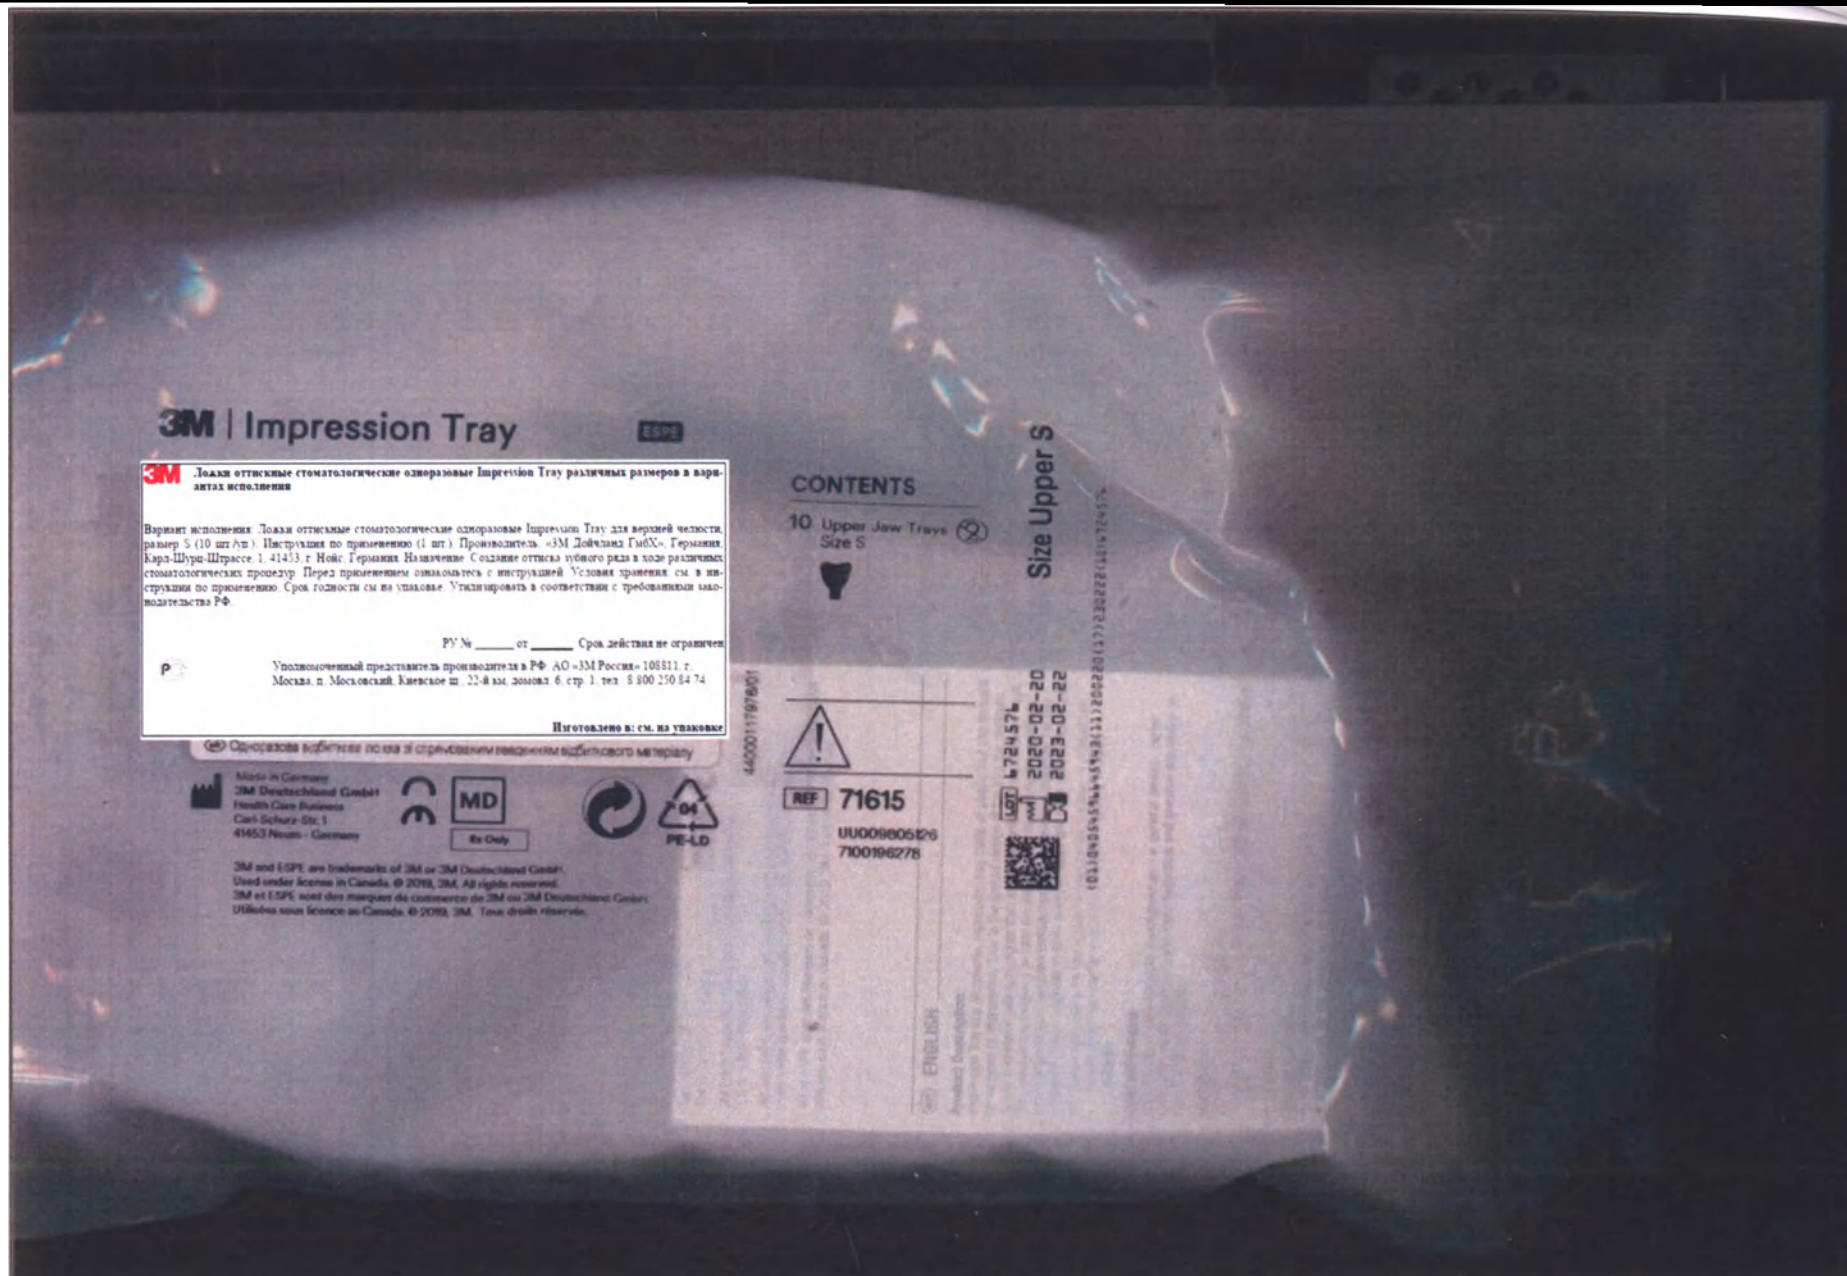


Рис. 1. Ложки оттисковые стоматологические одноразовые Impression Tray для верхней челюсти, размер S (10 шт./уп.); Инструкция по применению (1 шт.)

Передняя сторона упаковки



Рис. 2. Ложки оттисковые стоматологические одноразовые Impression Tray для верхней челюсти, размер S (10 шт./уп.); Инструкция по применению (1 шт.)

Задняя сторона упаковки

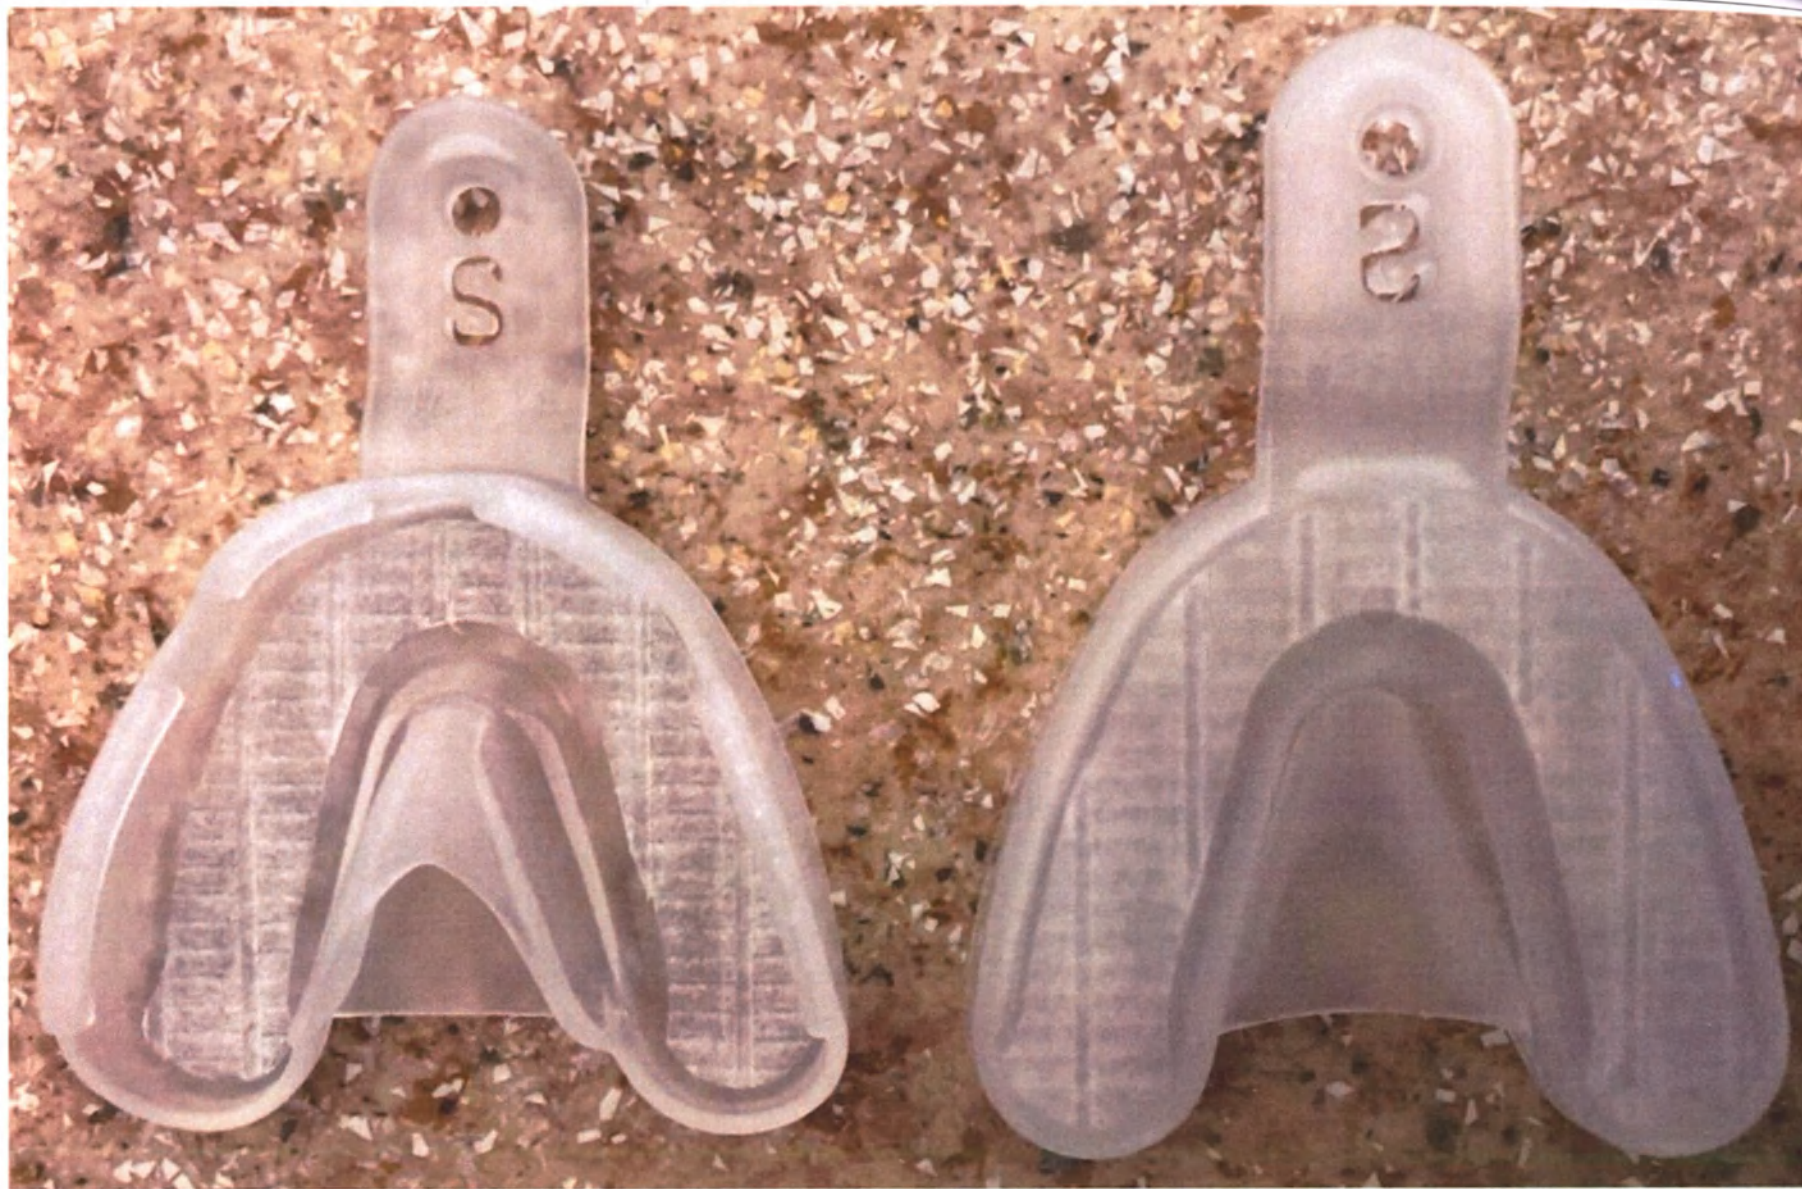


Рис. 3. Ложки оттисковые стоматологические одноразовые Impression Tray для верхней челюсти, размер S (10 шт./уп.); Инструкция по применению (1 шт.)

Общий вид изделия (лицевая и оборотная сторона)

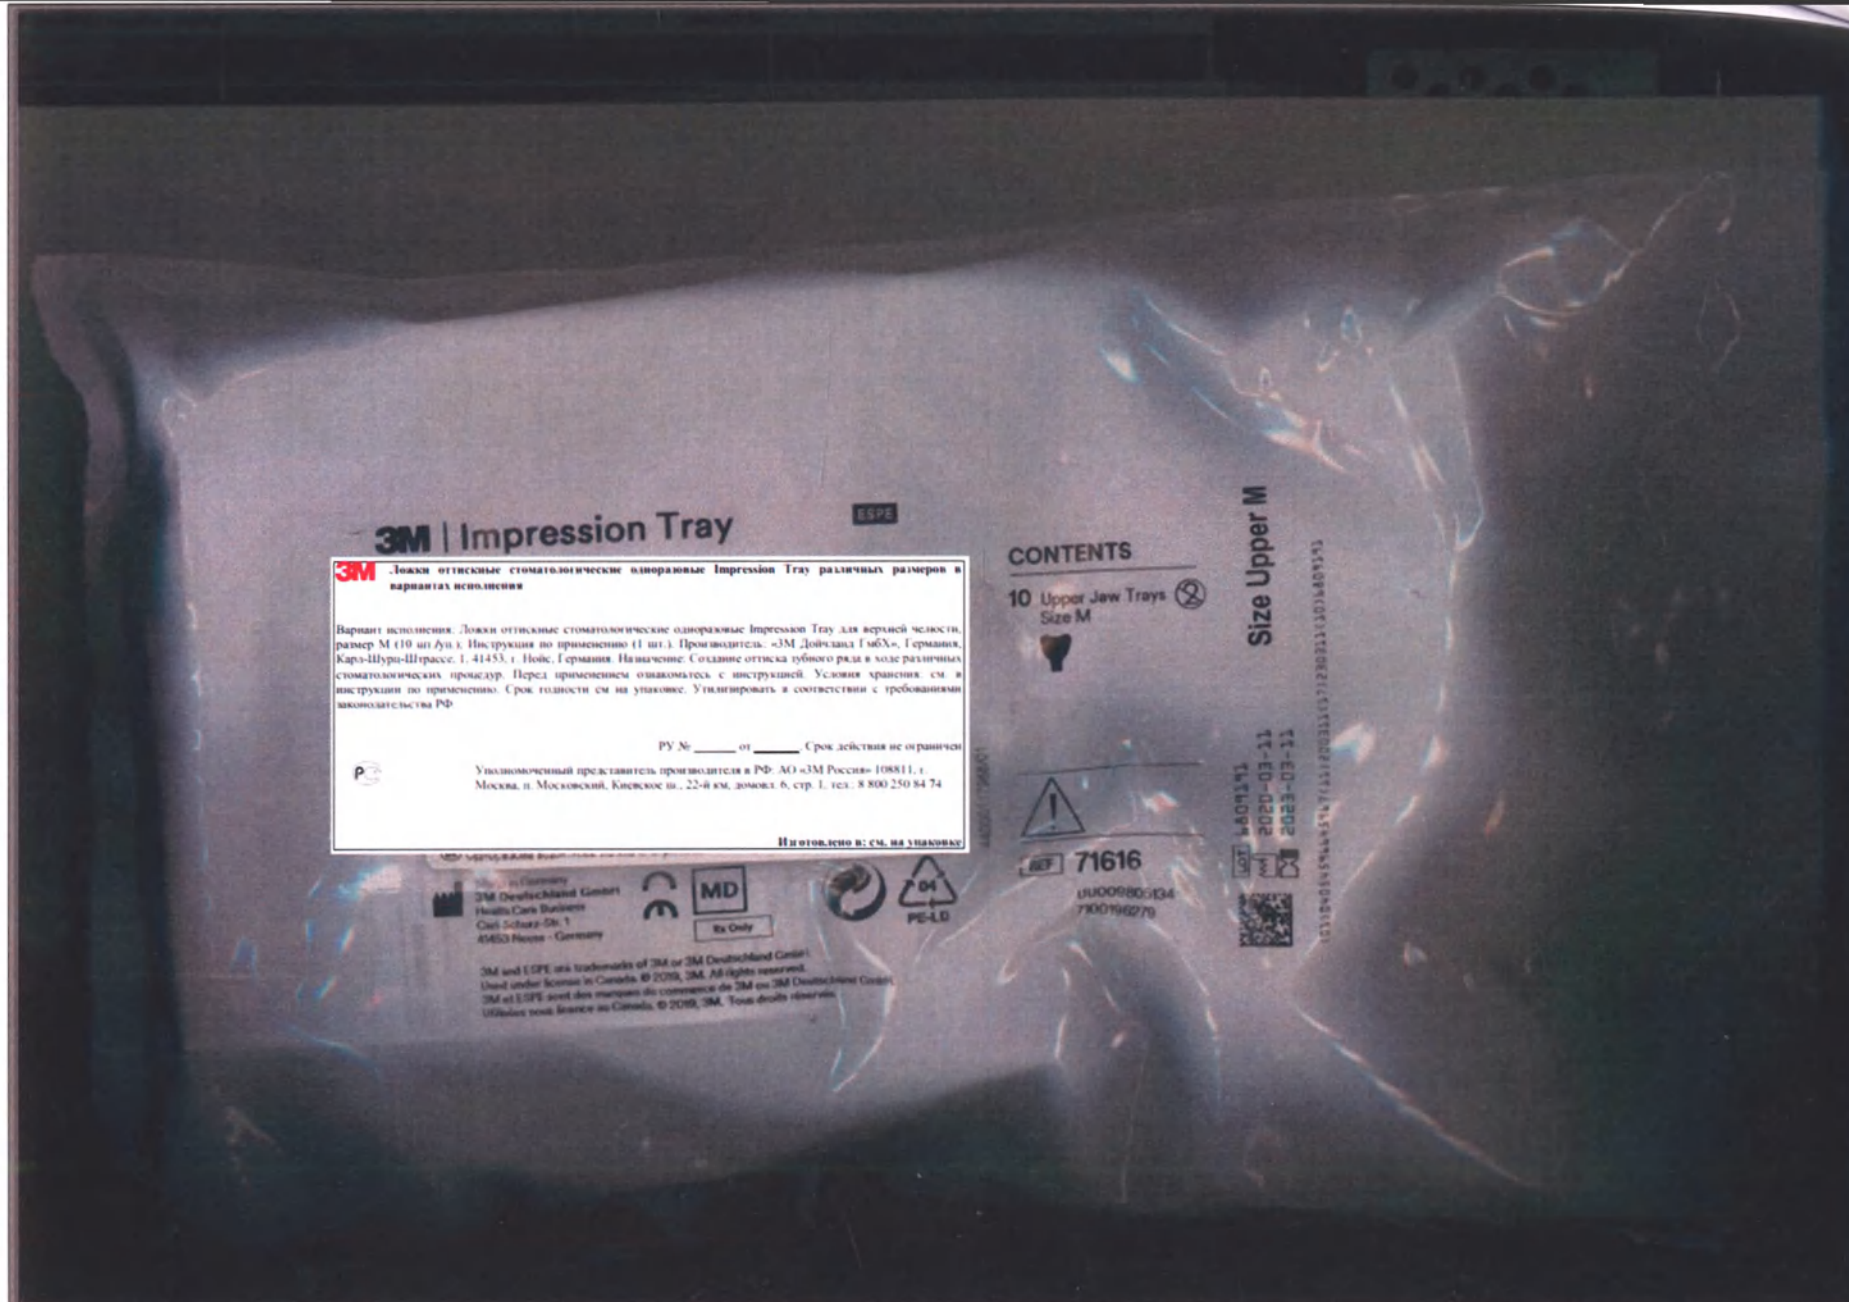


Рис. 4. Ложки отпечатные стоматологические одноразовые Impression Tray для верхней челюсти, размер М (10 шт./уп.); Инструкция по применению (1 шт.)

Передняя сторона упаковки



Рис. 5. Ложки оттисковые стоматологические одноразовые Impression Tray для верхней челюсти, размер М (10 шт./уп.); Инструкция по применению (1 шт.)

Задняя сторона упаковки

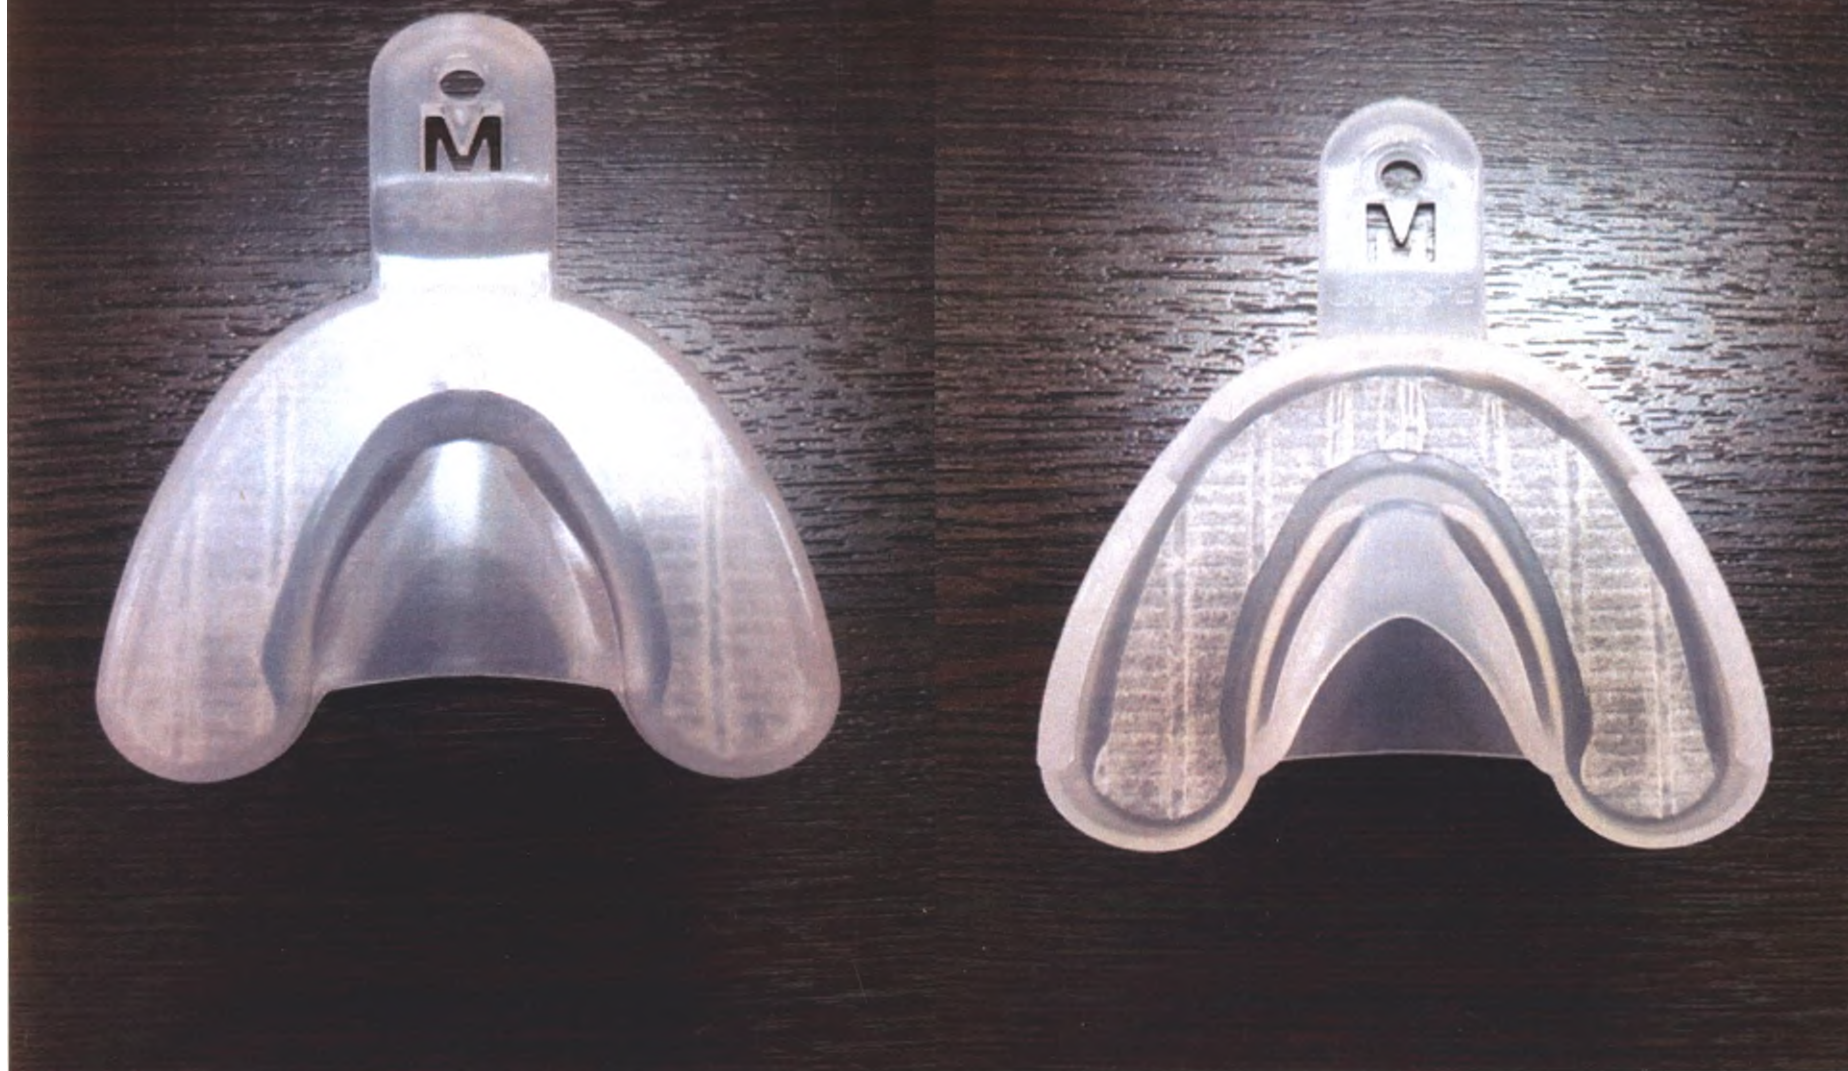


Рис. 6. Ложки оттисковые стоматологические одноразовые Impression Tray для верхней челюсти, размер М (10 шт./уп.): Инструкция по применению (1 шт.)

Общий вид изделия (лицевая и оборотная сторона)



Рис. 7. Ложки оттисковые стоматологические одноразовые Impression Tray для верхней челюсти, размер L (10 шт./уп.); Инструкция по применению (1 шт.)

Передняя сторона упаковки



Рис. 8. Ложки отпечатные стоматологические одноразовые Impression Tray для верхней челюсти, размер L (10 шт./уп.); Инструкция по применению (1 шт.)

Задняя сторона упаковки

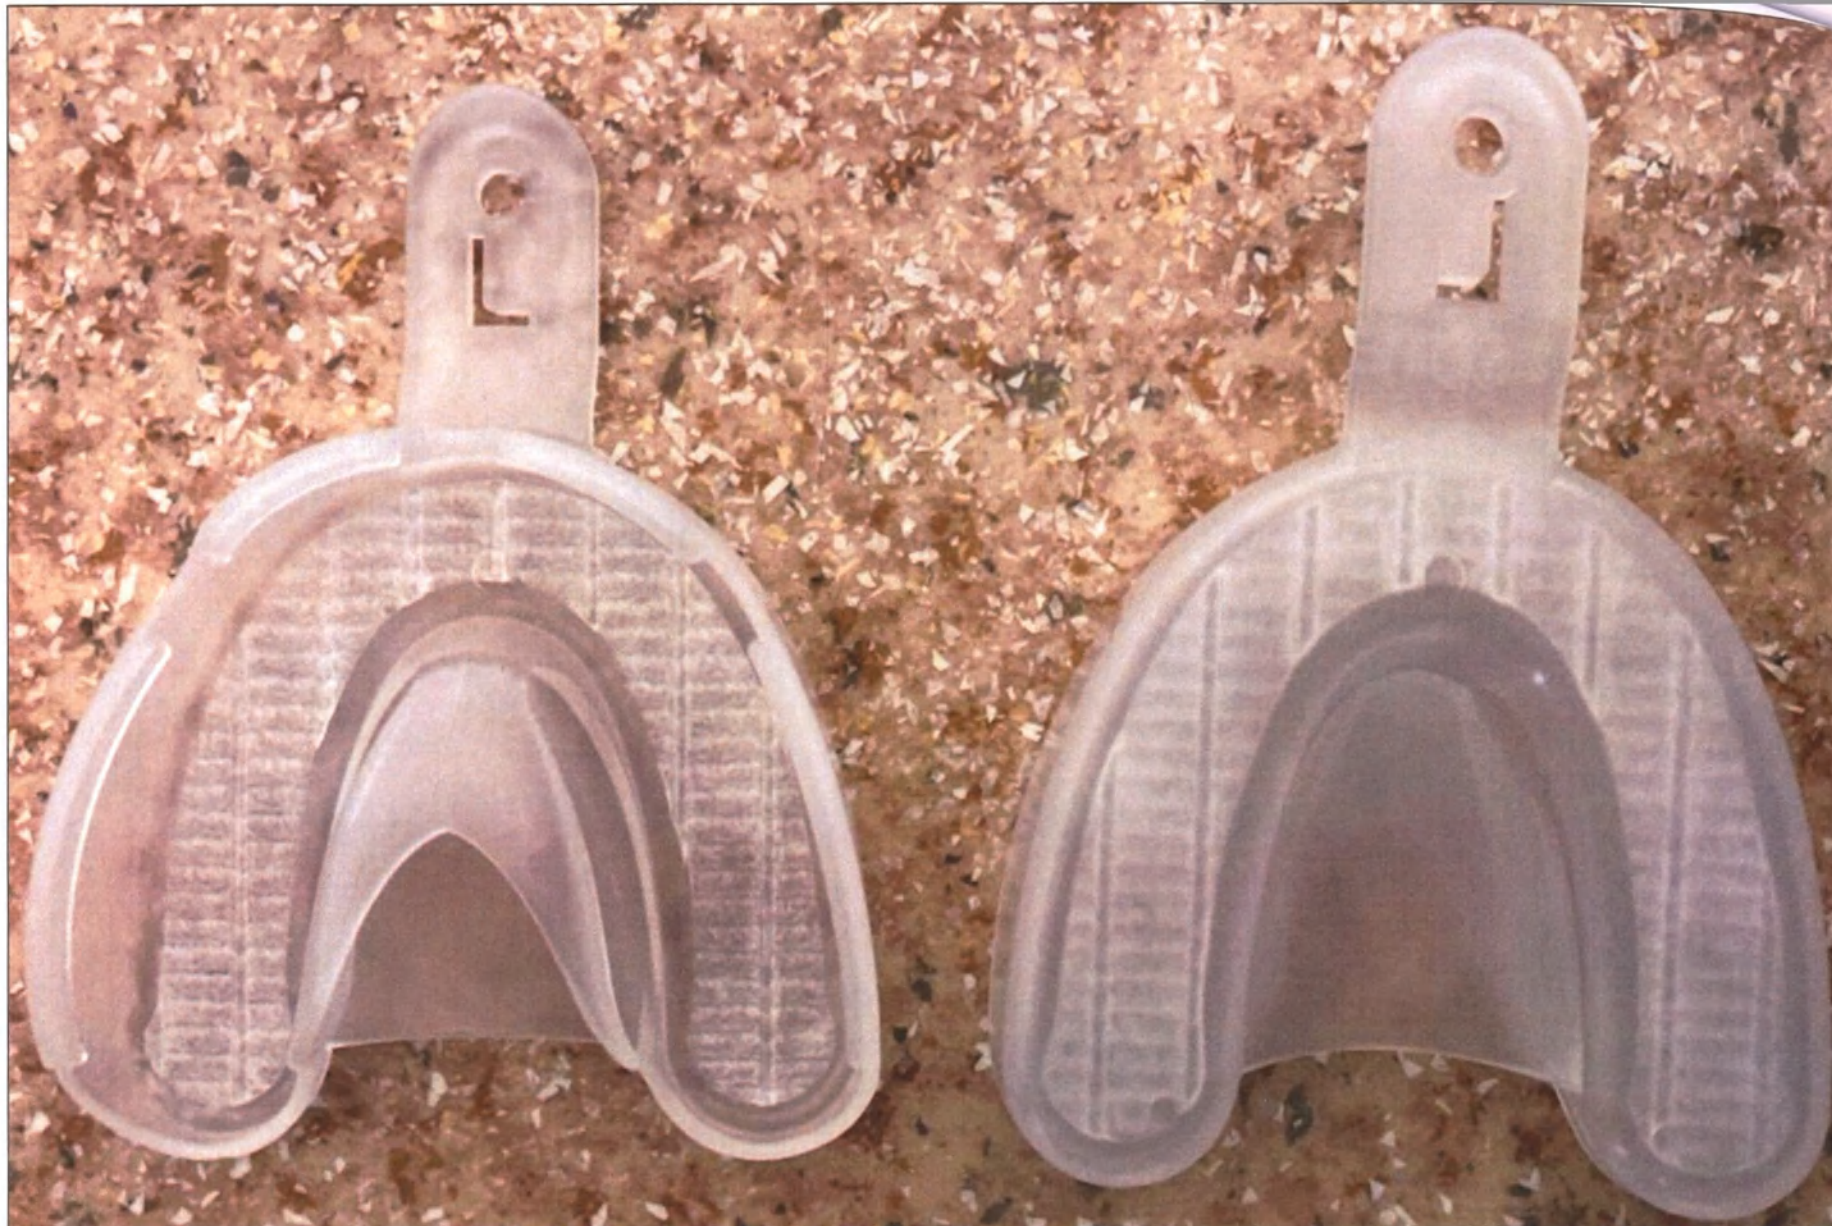


Рис. 9. Ложки оттисковые стоматологические одноразовые Impression Tray для верхней челюсти, размер L (10 шт./уп.);
Инструкция по применению (1 шт.)

Общий вид изделия (лицевая и оборотная сторона)

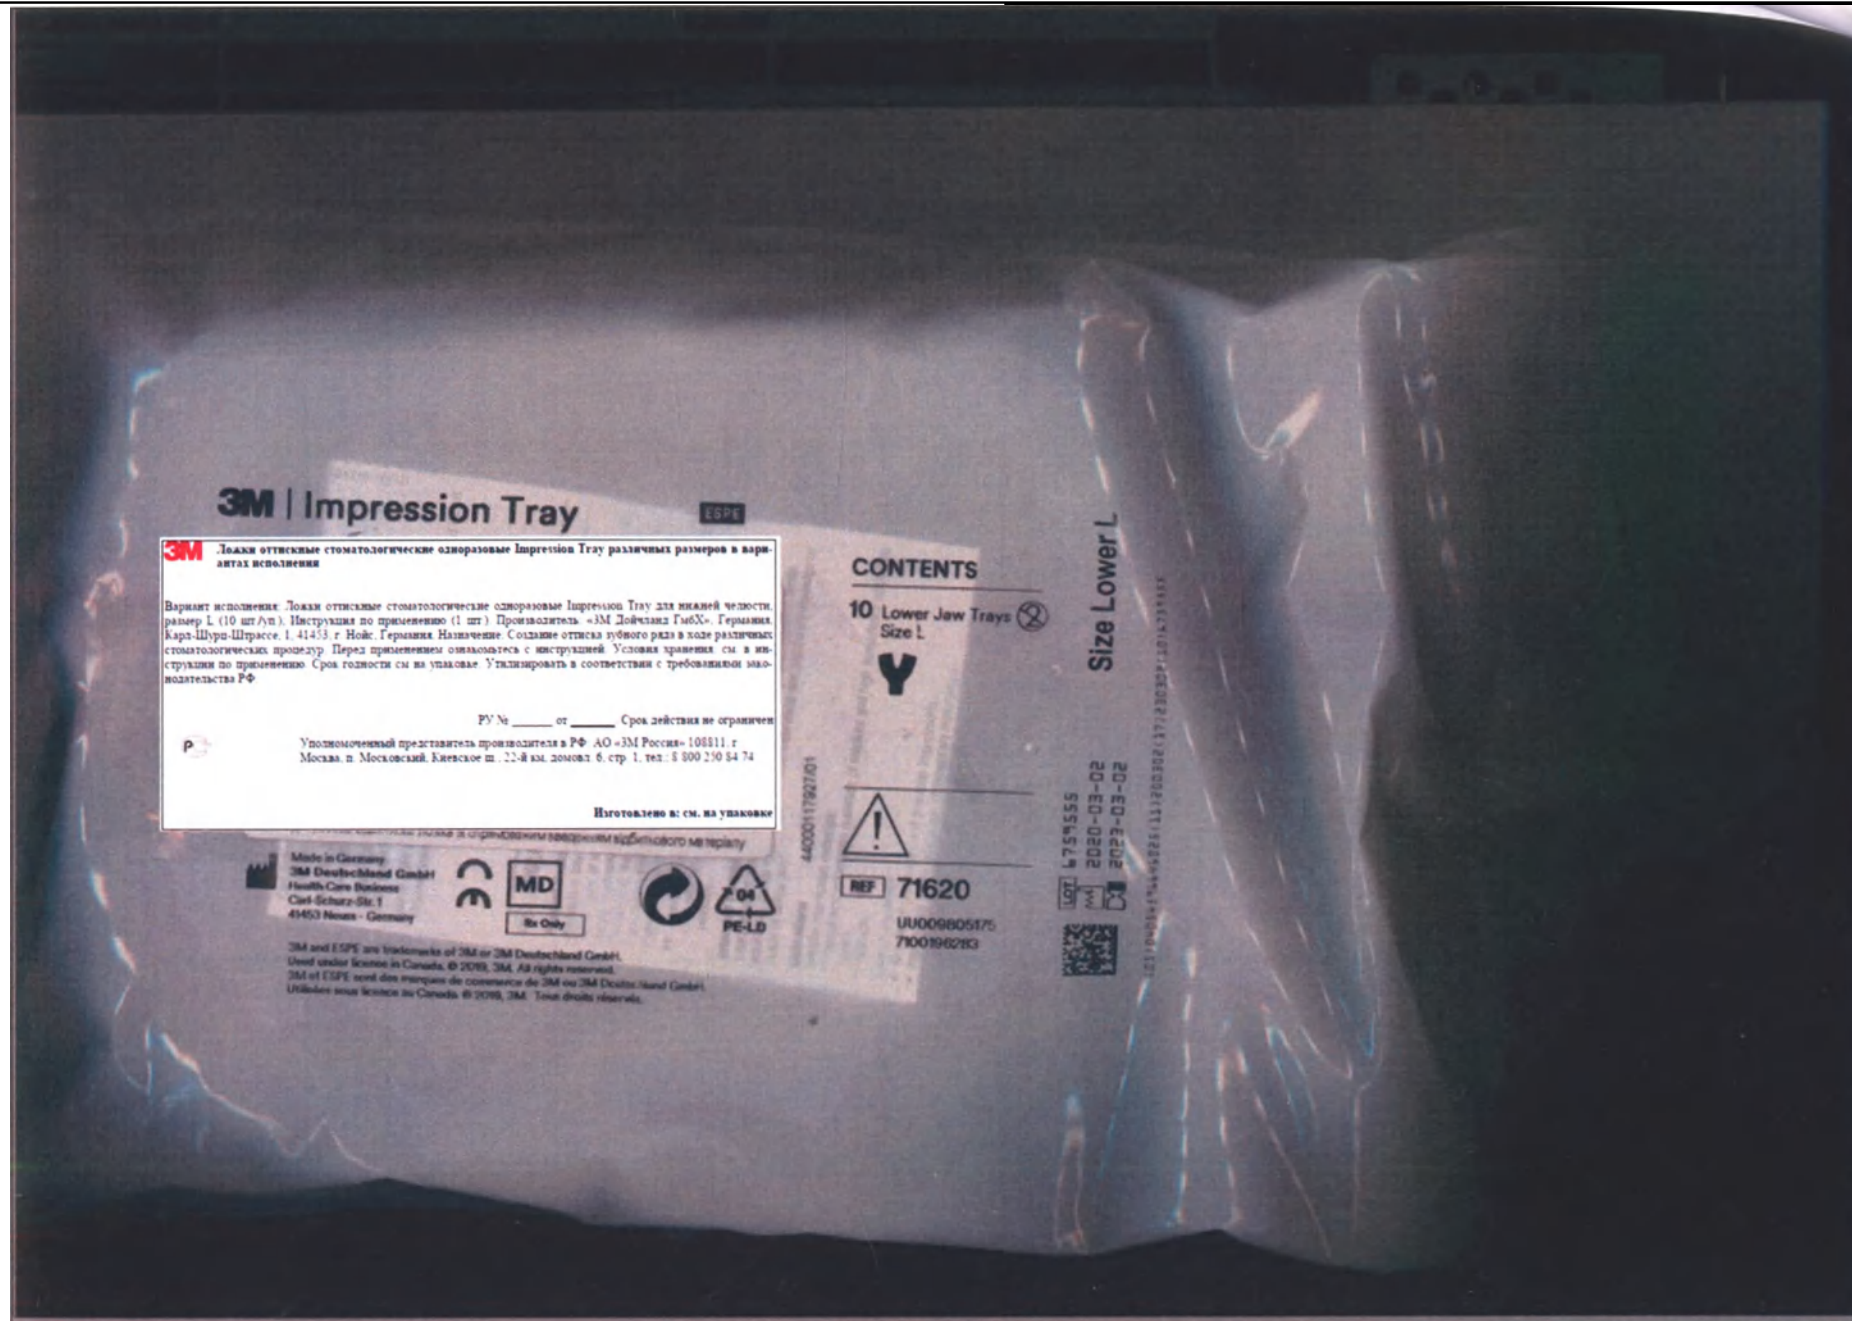


Рис. 10. Ложки оттисковые стоматологические одноразовые Impression Tray для нижней челюсти, размер L (10 шт./уп.); Инструкция по применению (1 шт.)



Рис. 11. Ложки оттисковые стоматологические одноразовые Impression Tray для нижней челюсти, размер L (10 шт./уп.); Инструкция по применению (1 шт.)

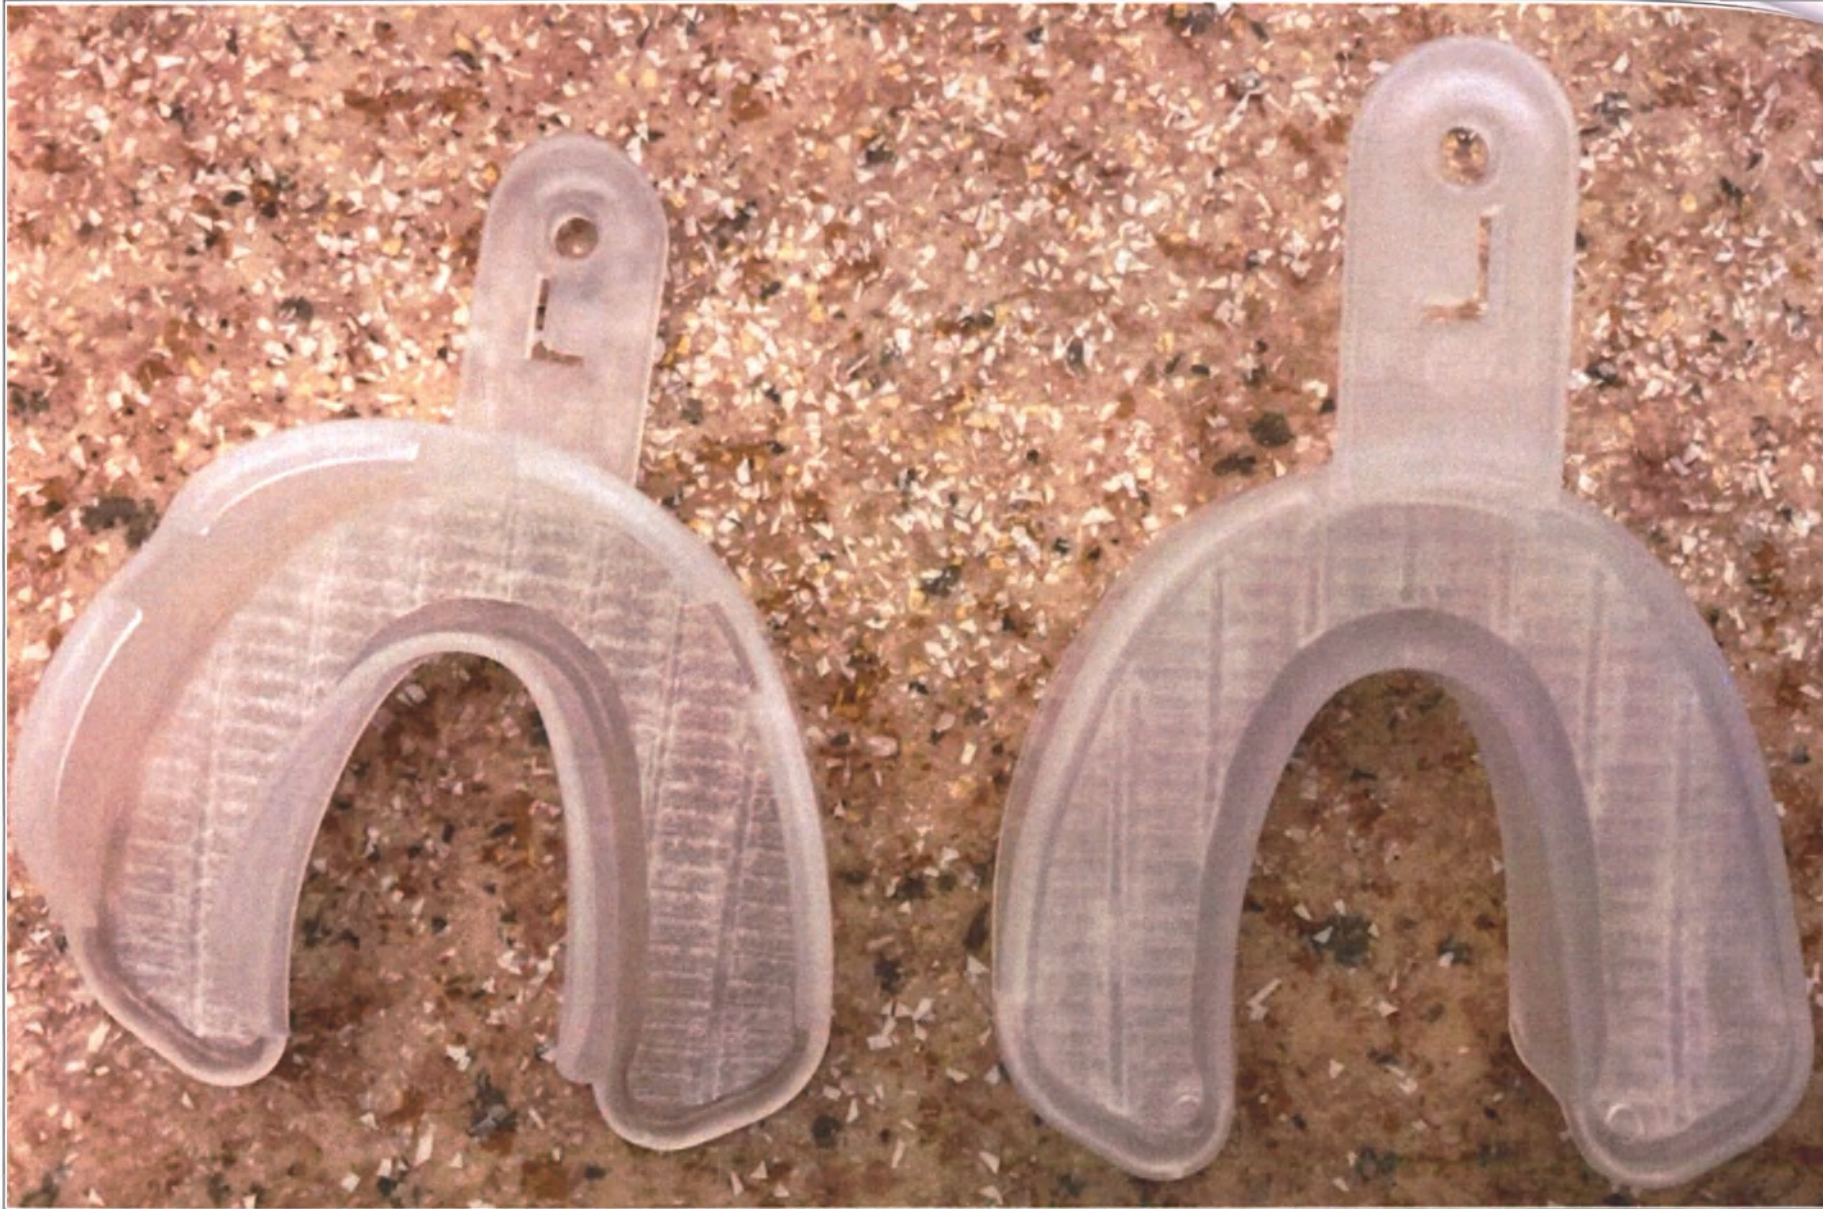


Рис. 12. Ложки оттисковые стоматологические одноразовые Impression Tray для нижней челюсти, размер L (10 шт./уп.); Инструкция по применению (1 шт.)

Общий вид изделия (лицевая и обратная сторона)


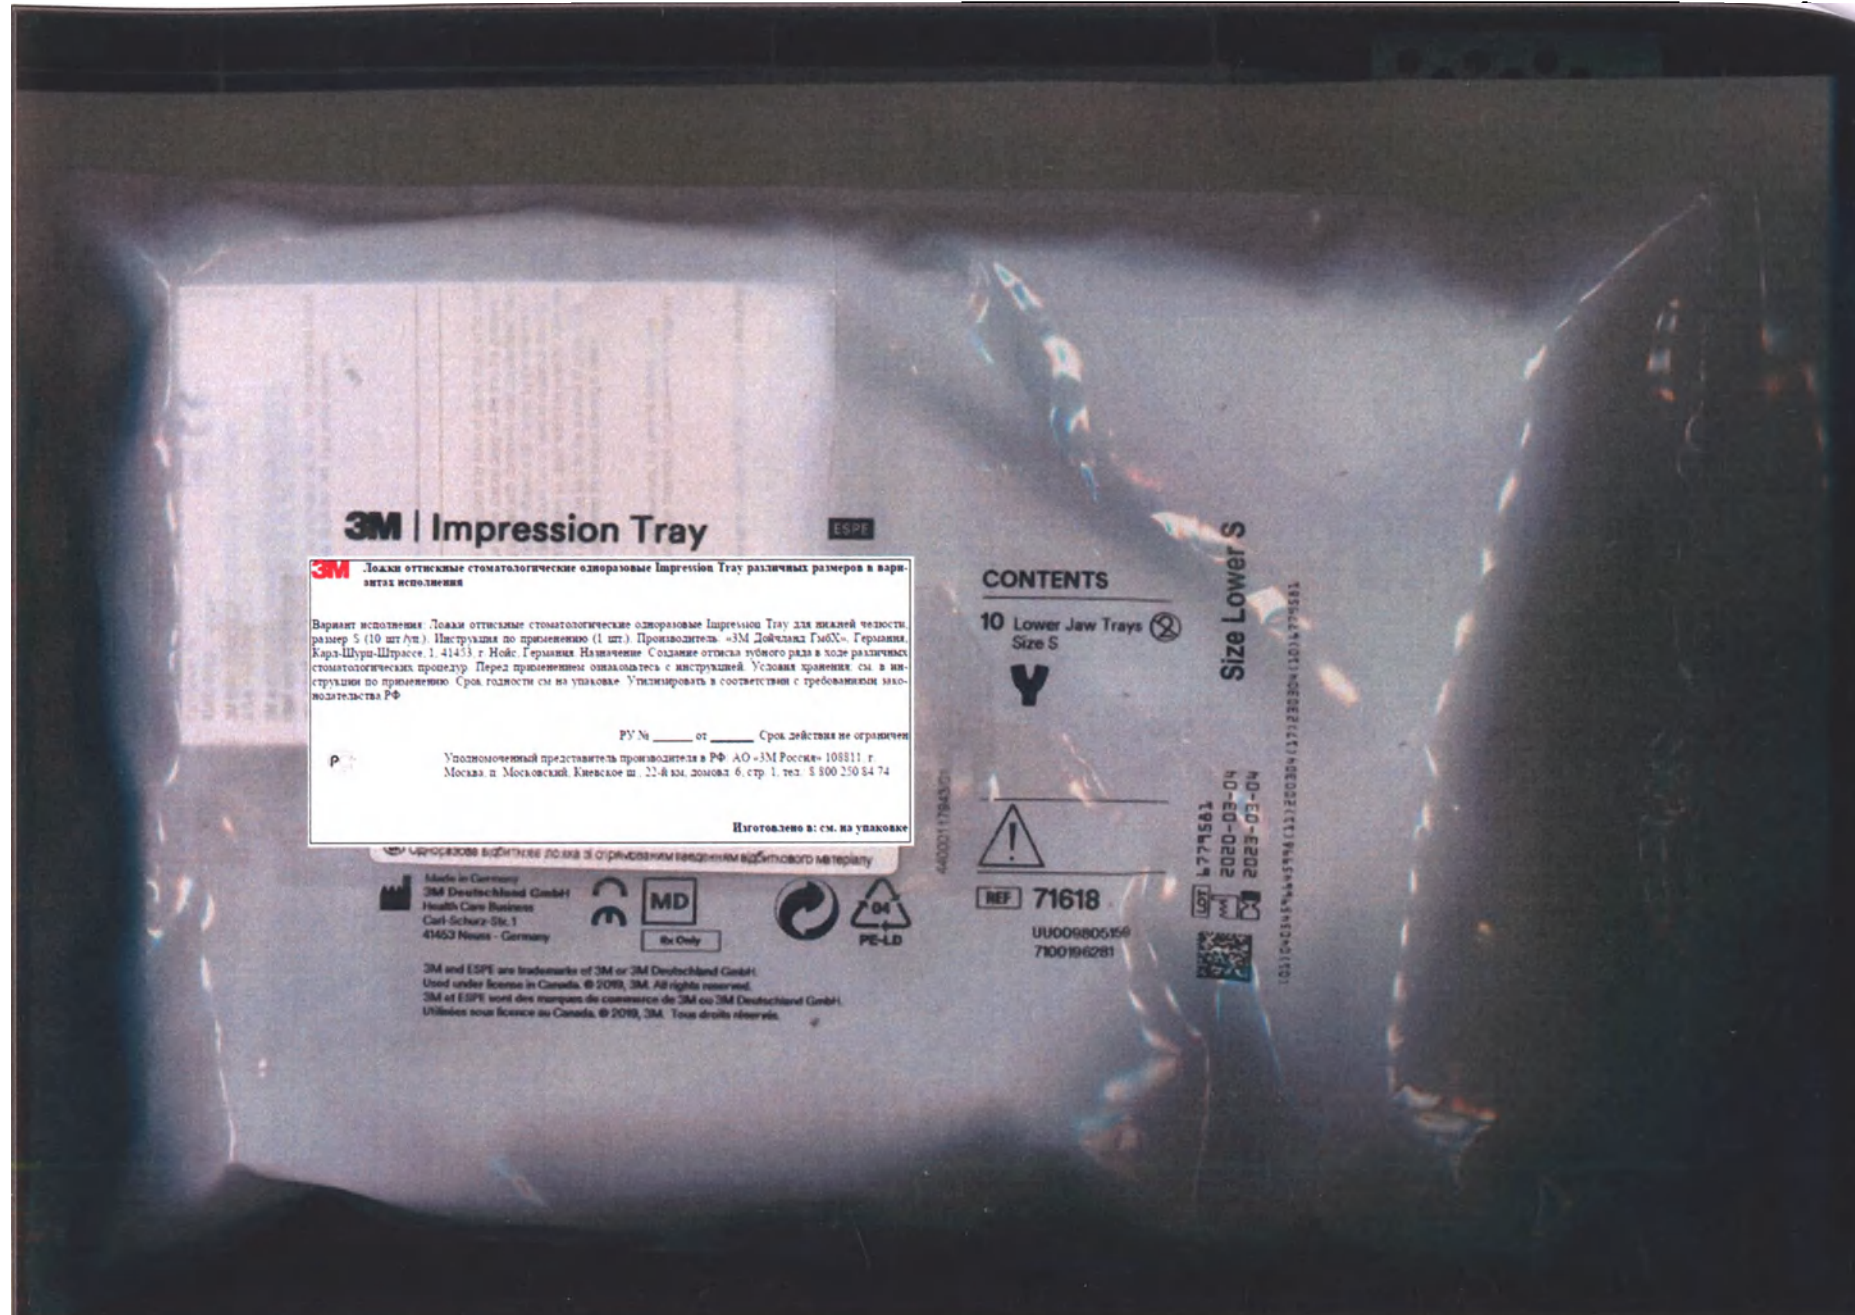


Рис. 13. Ложки оттисные стоматологические одноразовые Impression Tray для нижней челюсти, размер S (10 шт./уп.); Инструкция по применению (1 шт.)

Передняя сторона упаковки

Рис. 14. Ложки отпечатные стоматологические одноразовые
применению (1 шт.)

Задняя сторона упаковки

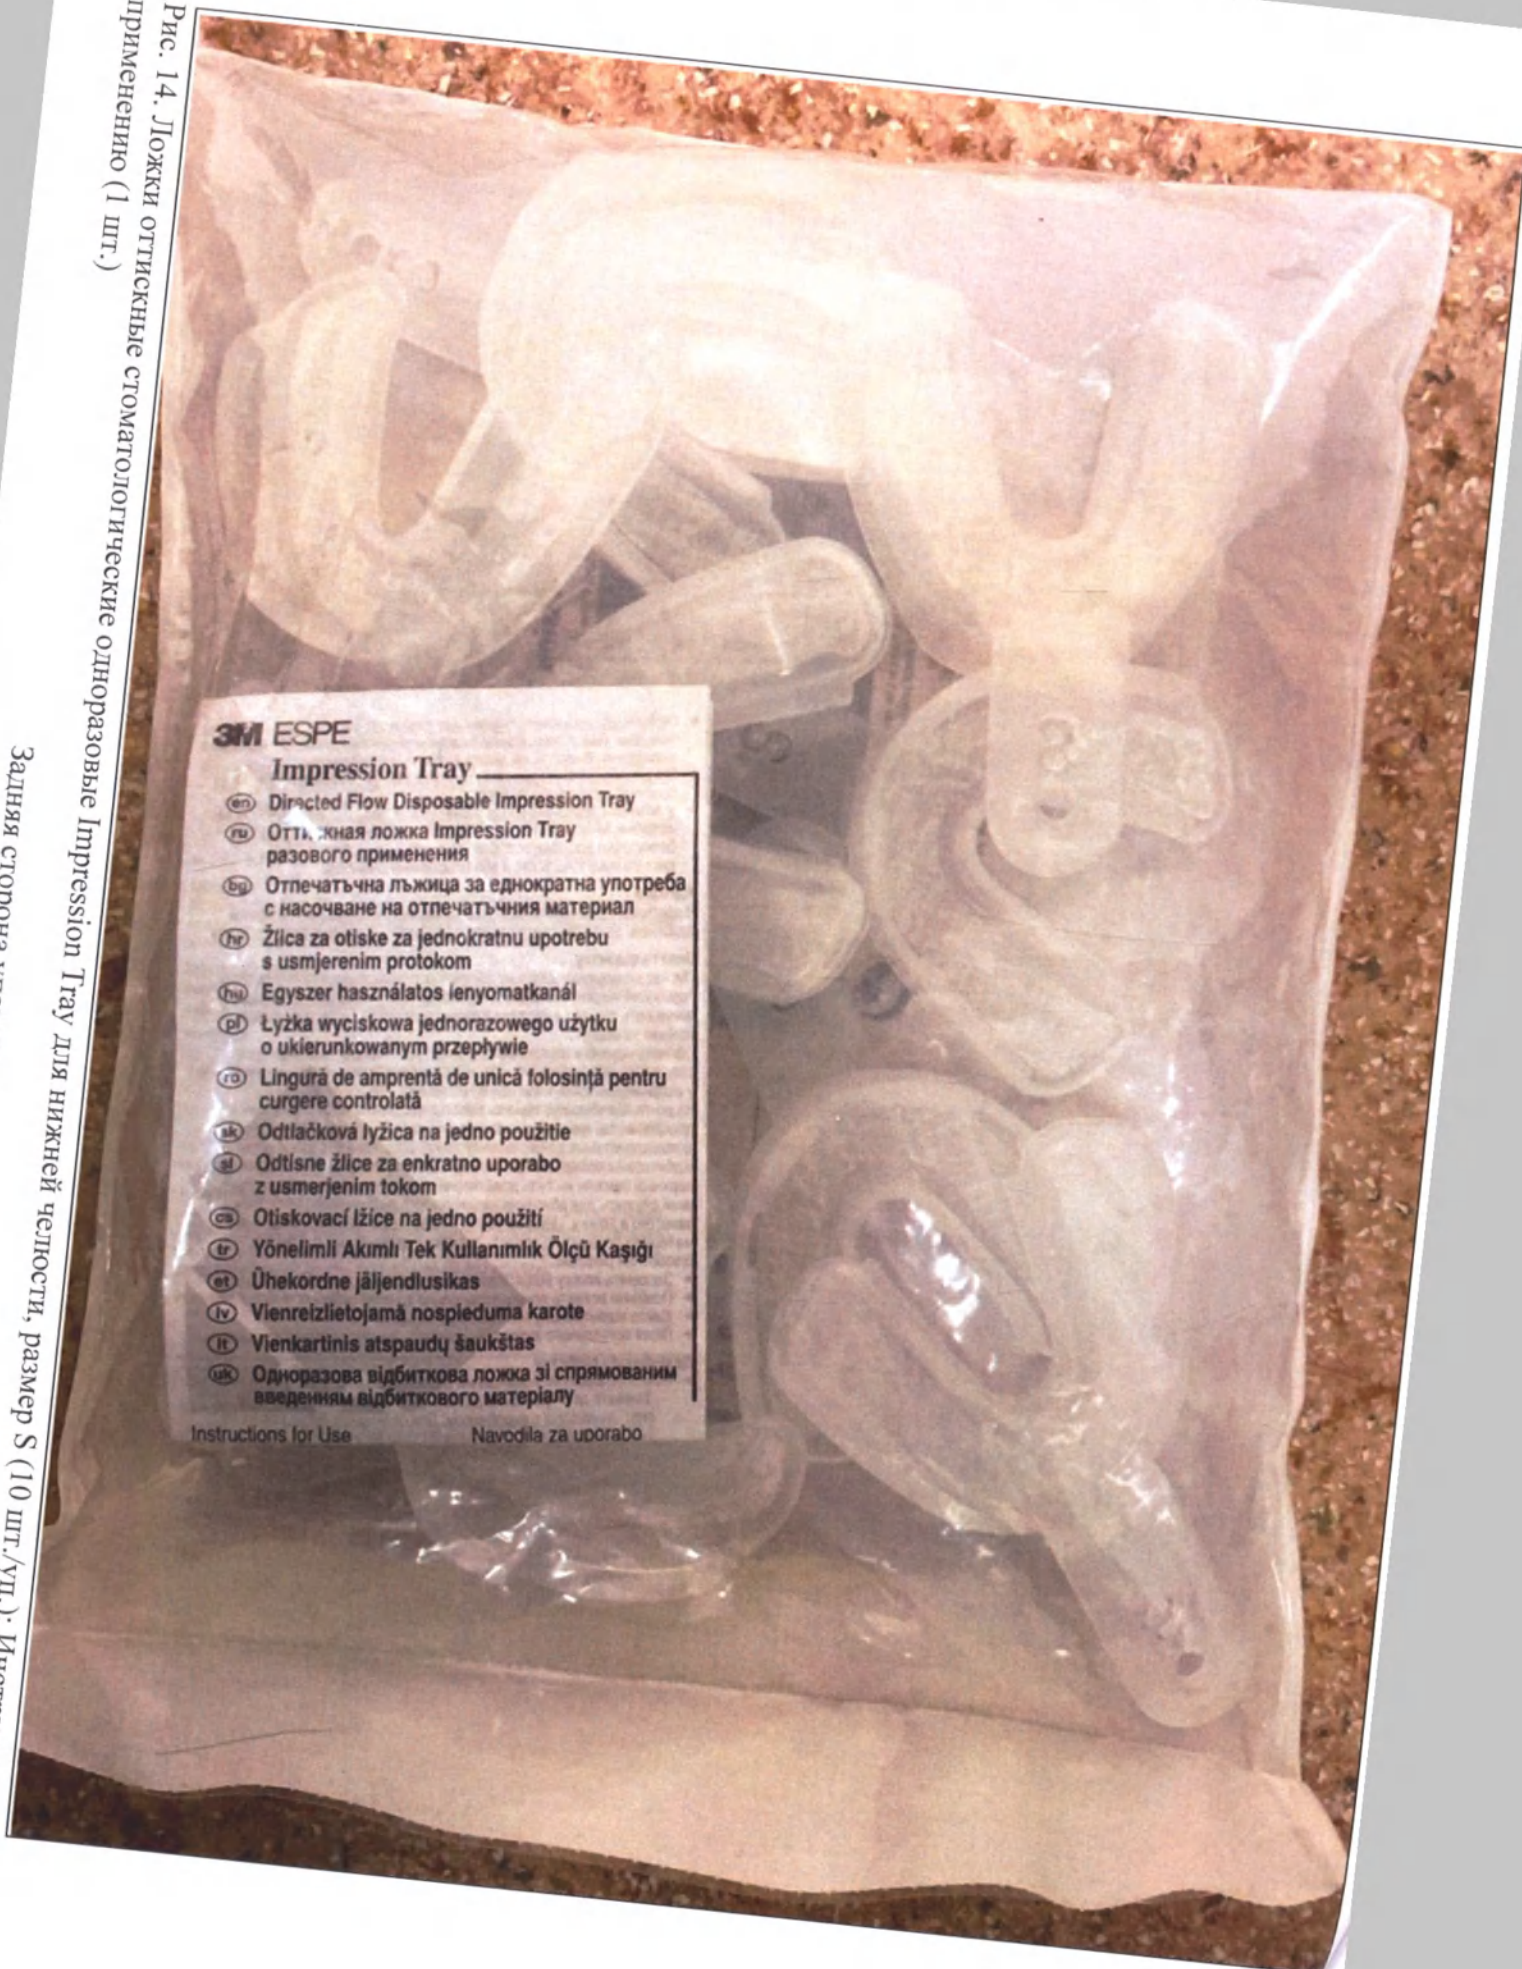

3M ESPE

Impression Tray

- (en) Directed Flow Disposable Impression Tray
- (ru) Оттисная ложка Impression Tray
разового применения
- (bg) Отпечатъчна лъжица за еднократна употреба
с насочване на отпечатъчния материал
- (hr) Žlica za otiske za jednokratnu upotrebu
s usmjerenim protokom
- (hu) Egyszer használatos lenyomatkanál
- (pl) Łyżka wyciskowa jednorazowego użytku
o ukierunkowanym przepływie
- (ro) Lingură de amprentă de unică folosință pentru
curgere controlată
- (sk) Odtlačková lyžica na jedno použitie
- (sl) Odtisne žlice za enkratno uporabo
z usmerjenim tokom
- (sr) Otiskovaci ližice na jedno korišćenje
- (tr) Yönelimli Akımlı Tek Kullanımlık Ölçü Kaşığı
- (et) Ühekordne jäljendlusikas
- (lv) Vienreizlietojamā nospieduma karote
- (lt) Vienkartinis atspaudų šaukštas
- (uk) Одноразова відбиткова ложка зі спрямованим
введенням відбиткового матеріалу

Instructions for Use

Navodila za uporabo

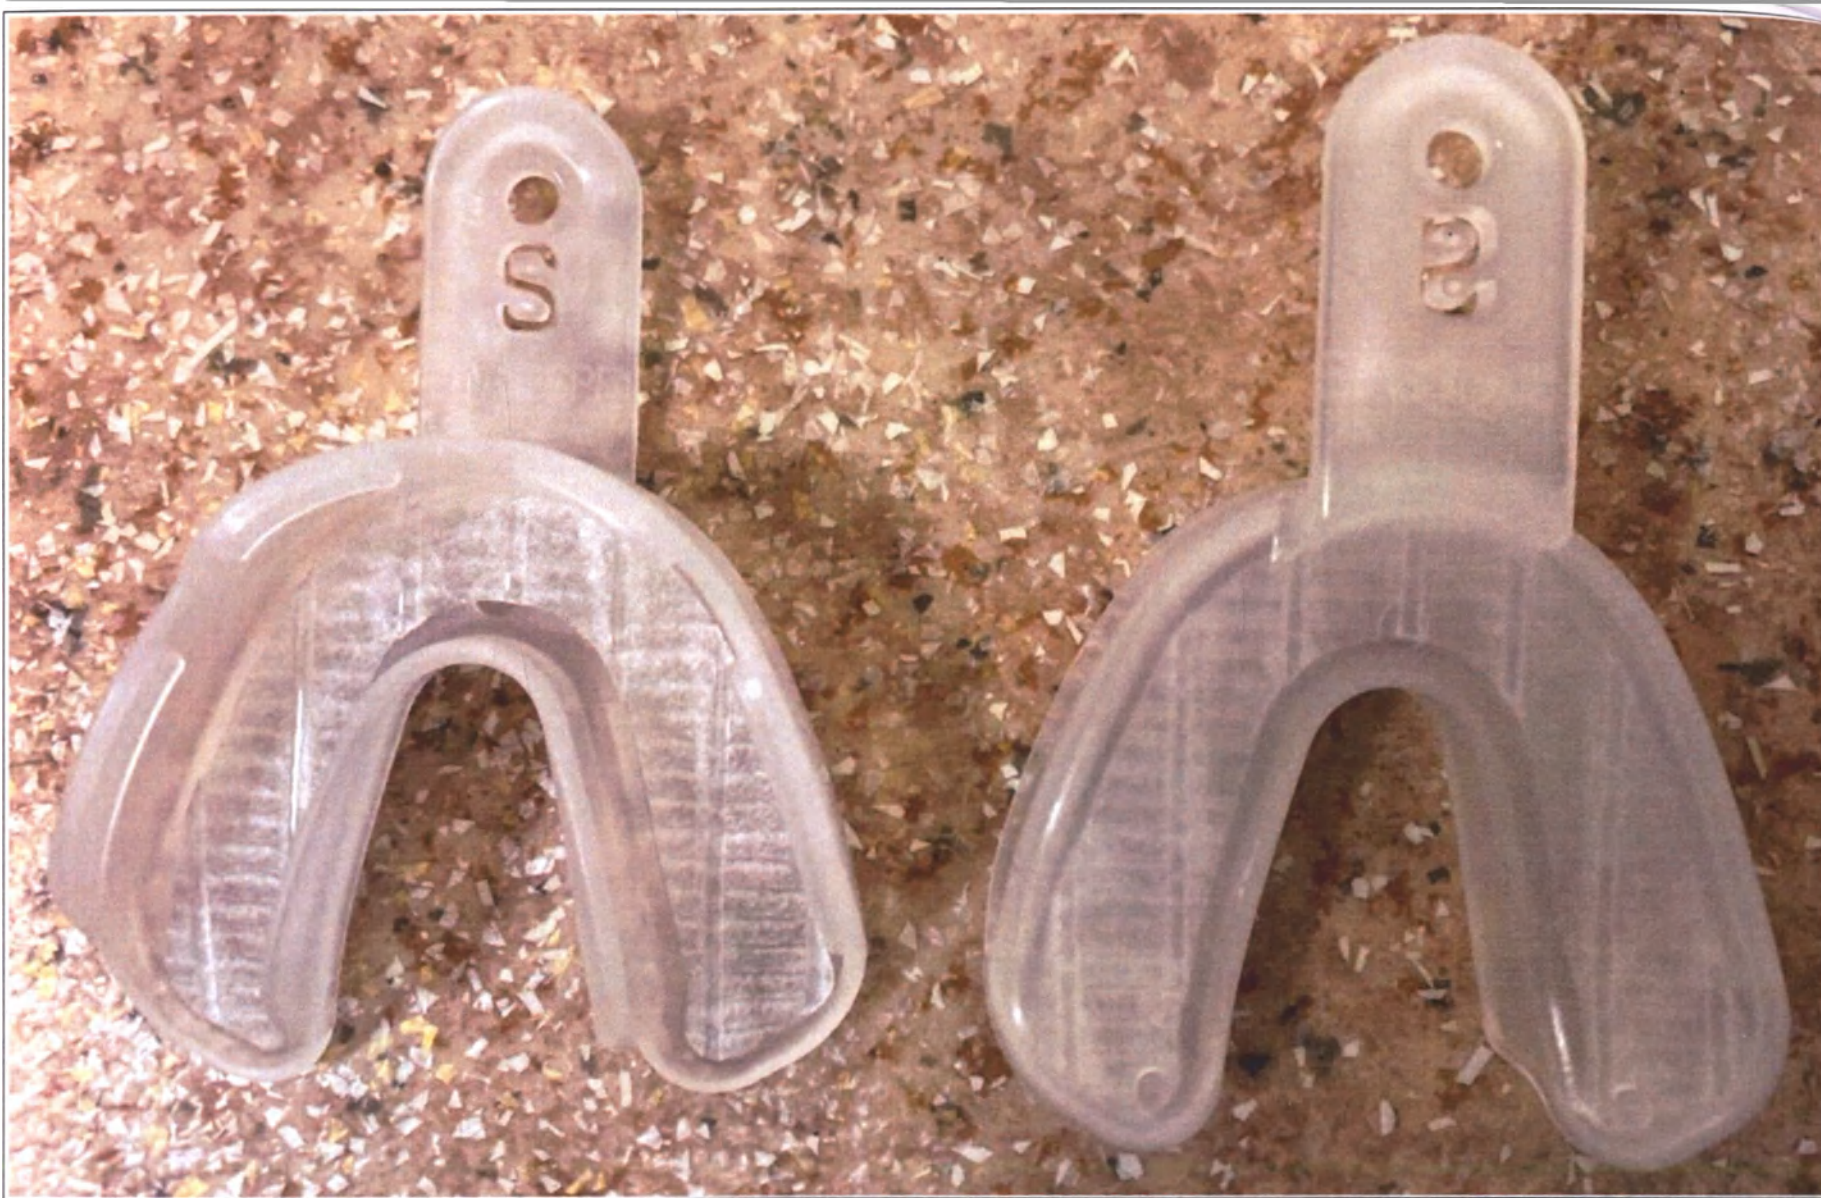


Рис. 15. Ложки оттискные стоматологические одноразовые Impression Tray для нижней челюсти, размер S (10 шт./уп.);
Инструкция по применению (1 шт.)

Общий вид изделия (лицевая и оборотная сторона)

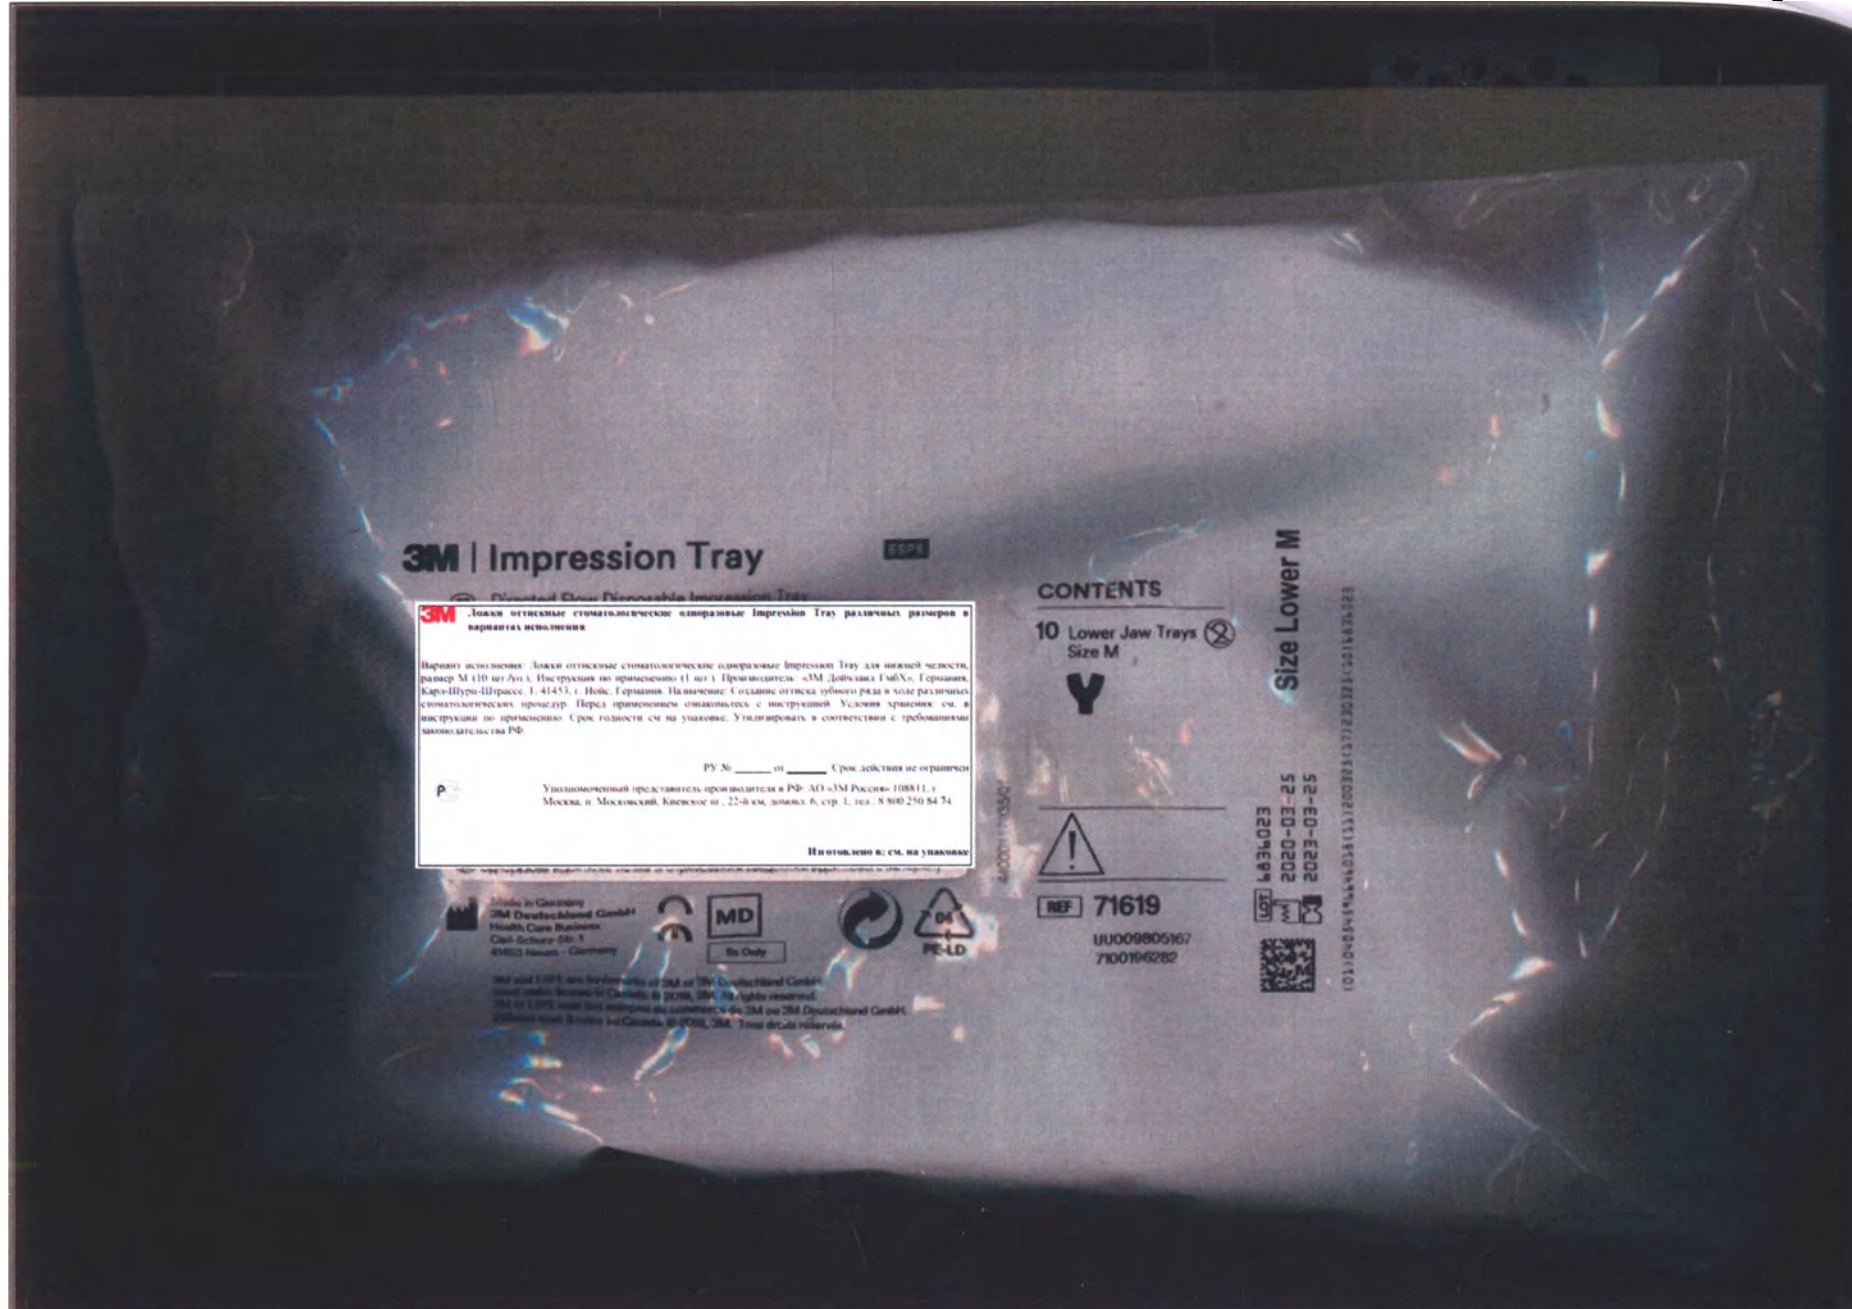


Рис. 16. Ложки оттисковые стоматологические одноразовые Impression Tray для нижней челюсти, размер М (10 шт./уп.); Инструкция по применению (1 шт.)

Передняя сторона упаковки



Рис. 17. Ложки оттисные стоматологические одноразовые Impression Tray для нижней челюсти, размер М (10 шт./уп.); Инструкция по применению (1 шт.)

Задняя сторона упаковки

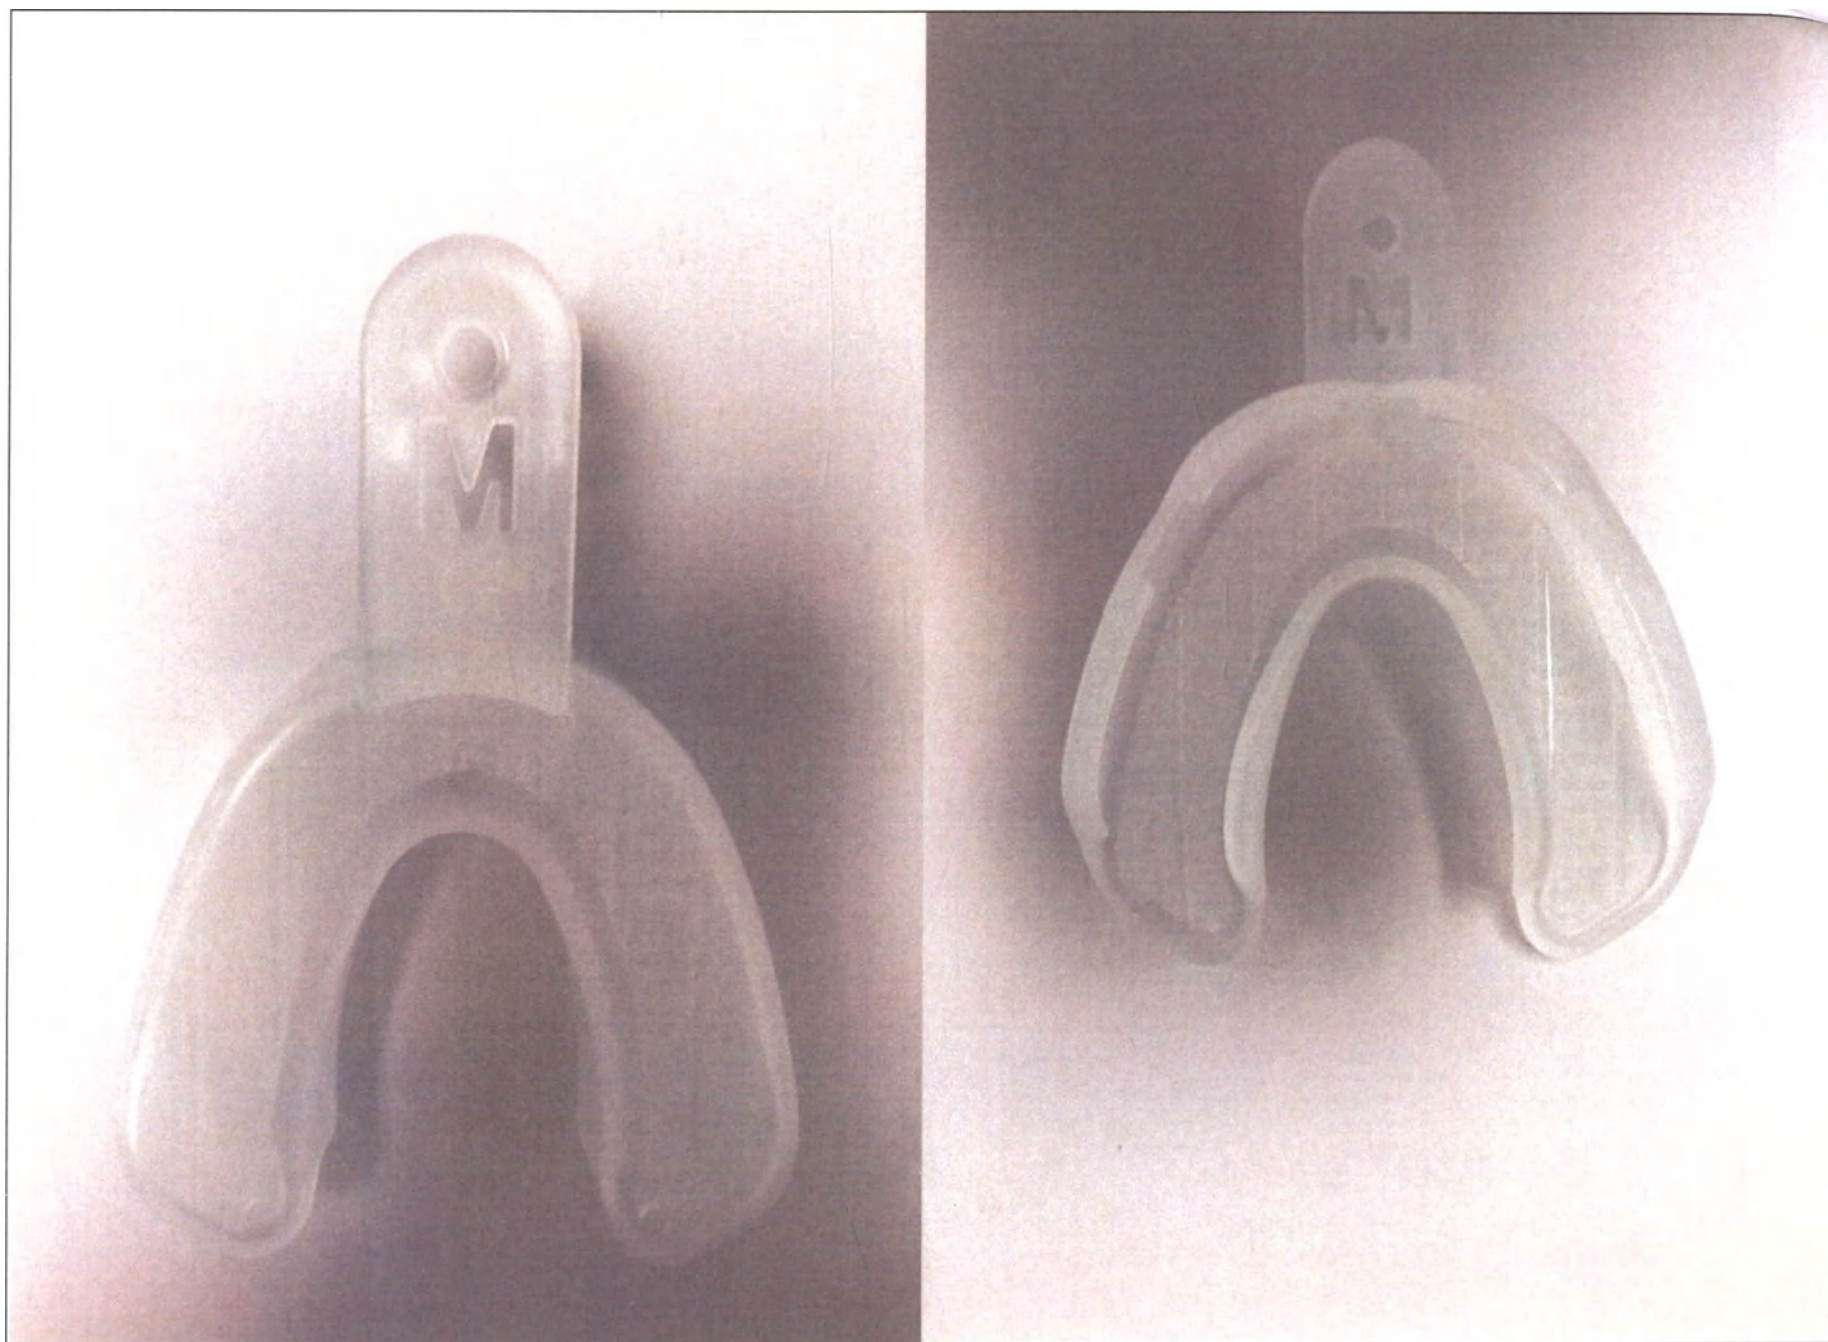
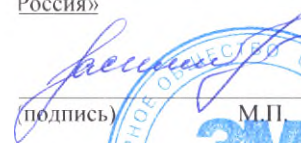


Рис. 18. Ложки оттисковые стоматологические одноразовые Impression Tray для нижней челюсти, размер М (10 шт./уп.); Инструкция по применению (1 шт.)

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
19 листа(ов).

Должность, Специалист по сертификации
Департамента Здравоохранения АО «ЗМ
Россия»


(подпись) М.П. Герасимова В.А.
