



102

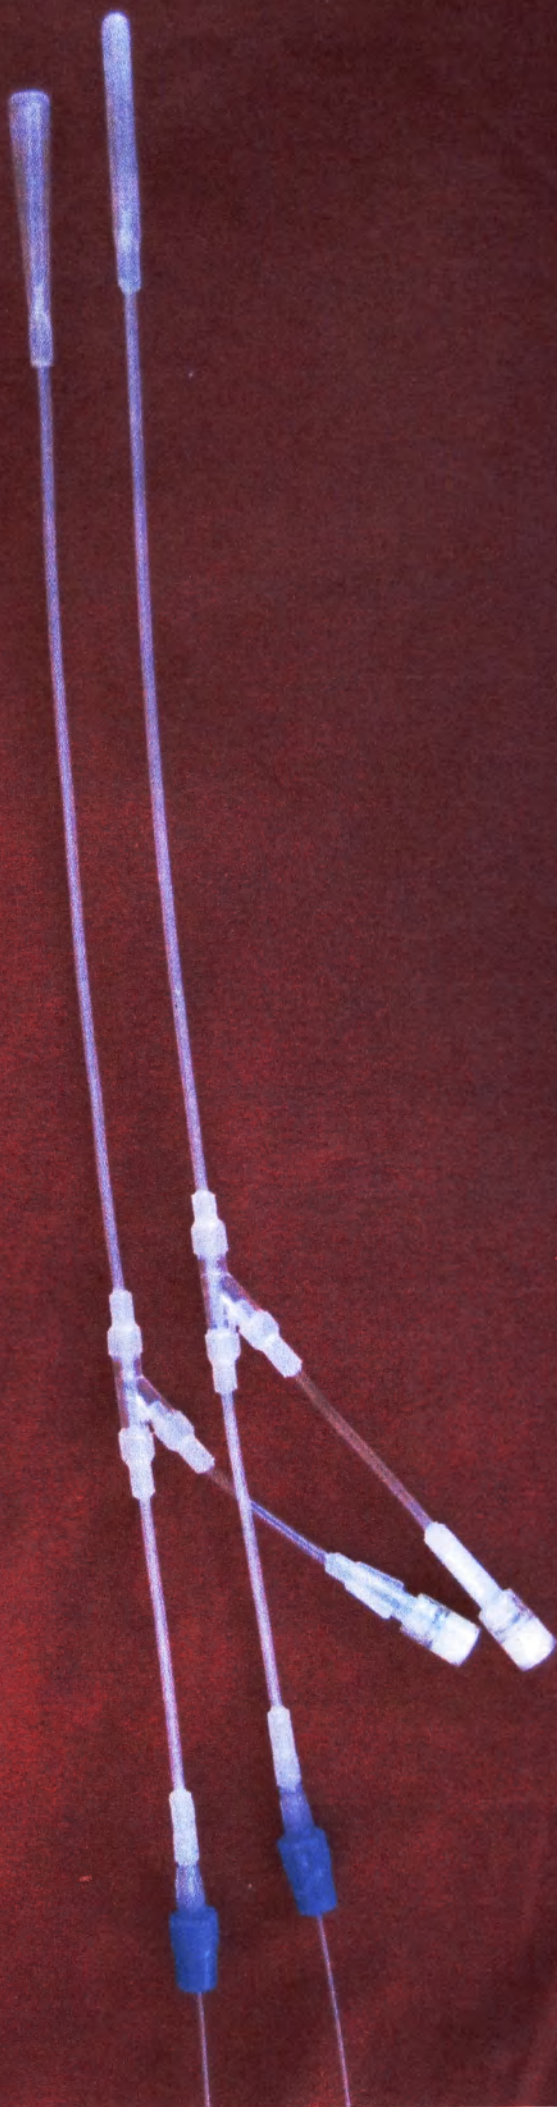


Фотографическое изображение
катетера КОВБ-660 стерильного
исполнение 1 цилиндрический
исполнение 2 конический

103

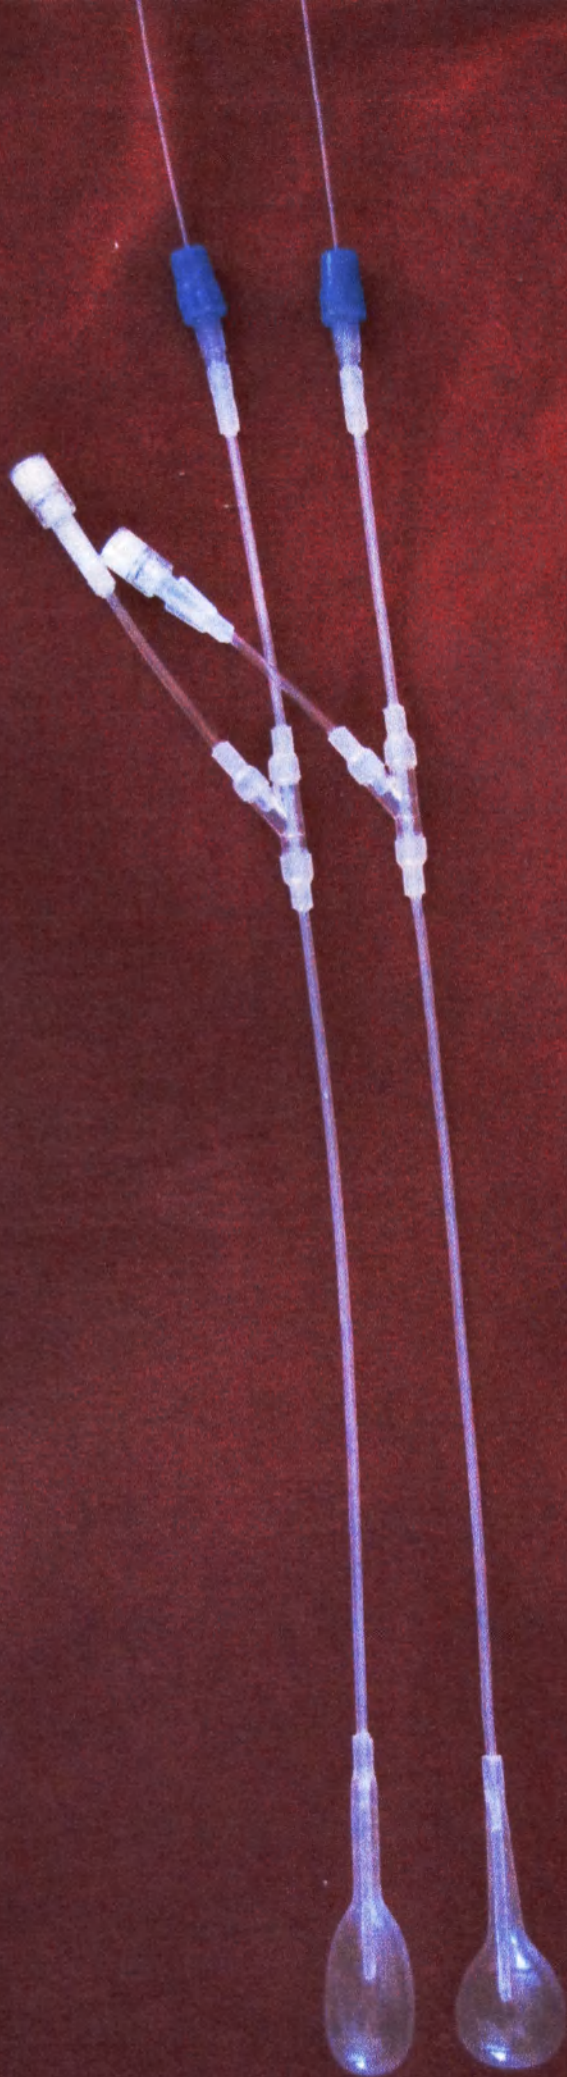

Фотографическое изображение катетра
КОВБ-660 стерильного
исполнение 1 хирургический
исполнение 2 конический

NRV

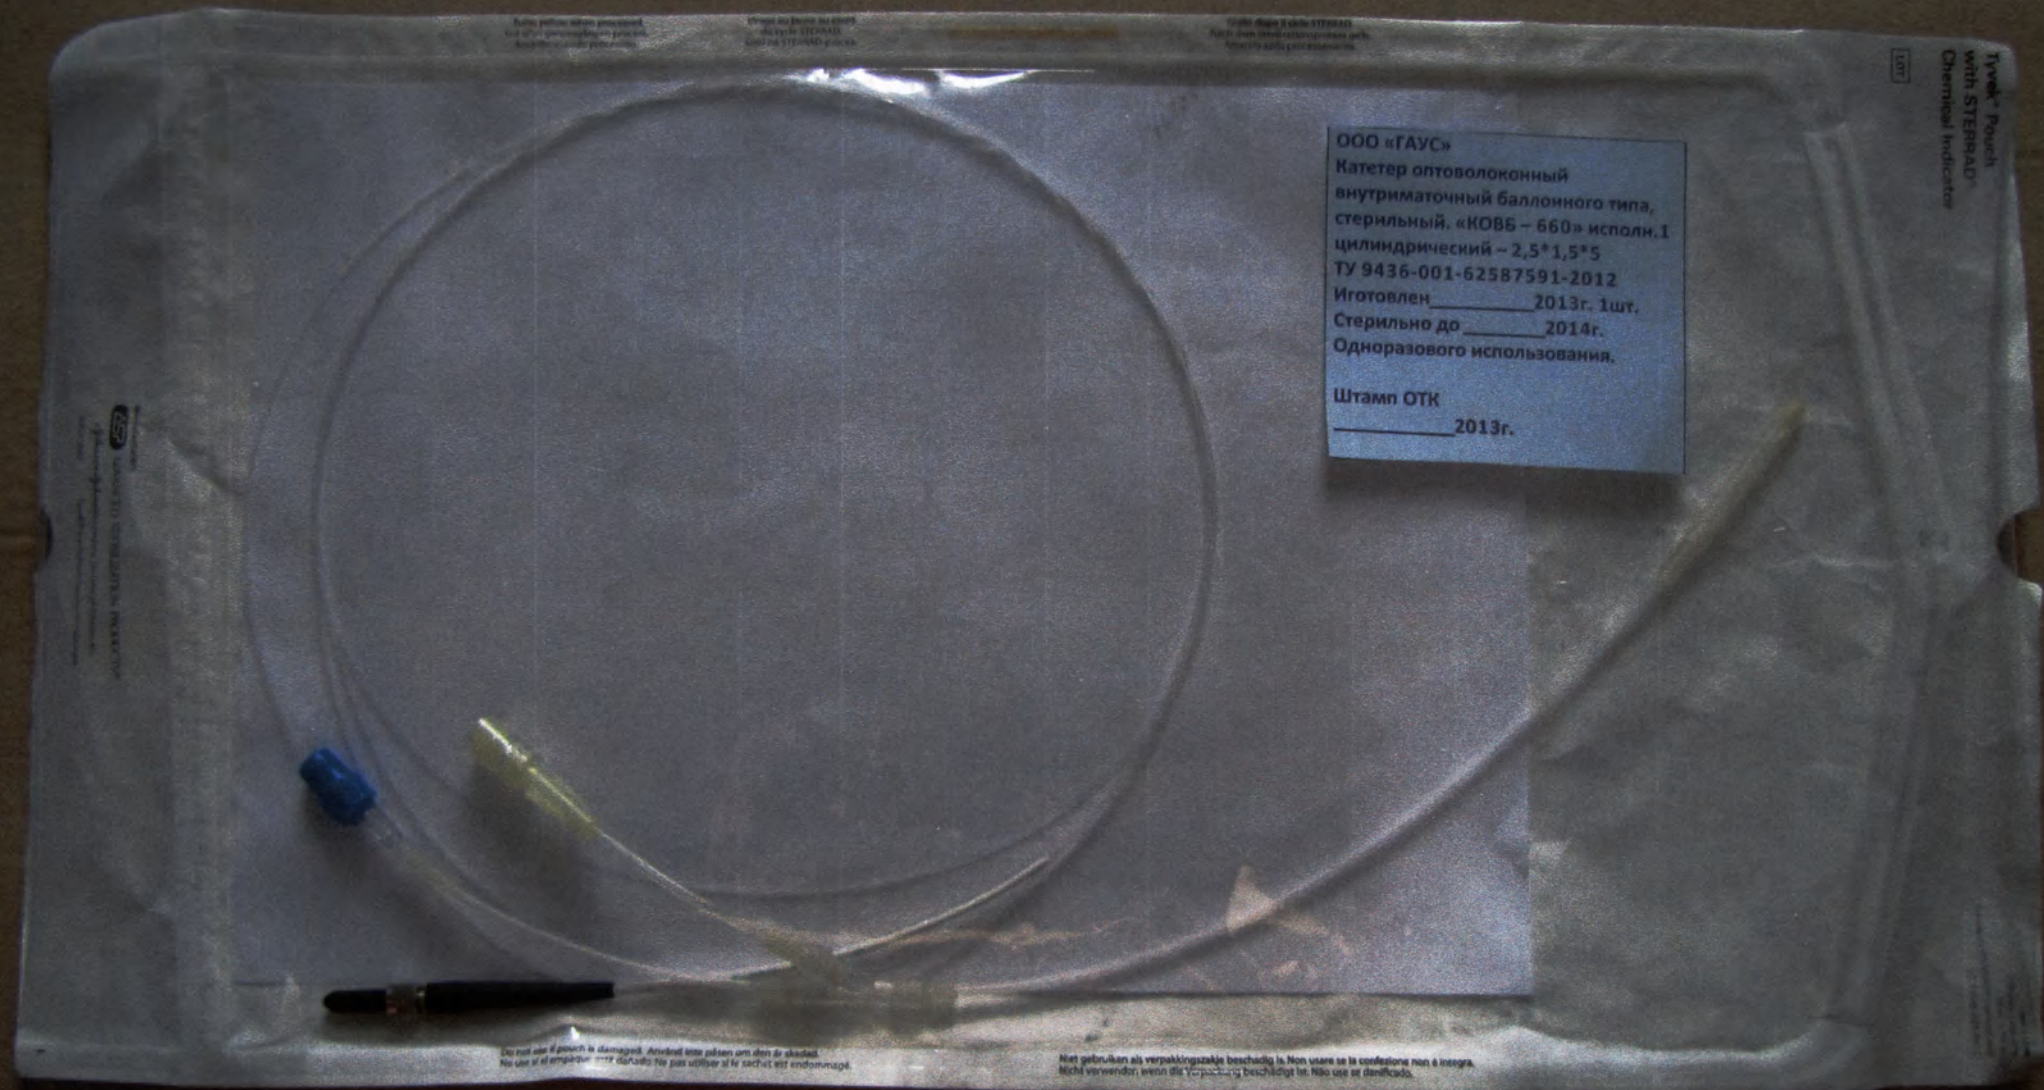

ООО «ГАУС»
Катетер оптоволоконный
внутриматочный баллонного типа,
стерильный. «КОВБ – 660» исполн. 1
цилиндрический – 2,5*1,5*5
ТУ 9436-001-62587591-2012
Иготовлен _____ 2013г. 1шт.
Стерильно до _____ 2014г.
Одноразового использования.
Штамп ОТК
_____ 2013г.

Tyvek® Pouch
with STEWARD®
Chemical Indicators

Do not use if pouch is damaged. Avoid use unless you are sure the pouch is intact.
Ne pas utiliser si le sachet est endommagé. Ne pas utiliser si le sachet n'est pas intact.

Niet gebruiken als verpakkingsschade beschadigd is. Niet usare se la confezione non è integra.
Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist. Não use se a embalagem estiver danificada.

Фотографическое изображение
катетера КОВБ-660 стерильного
исполнение 1 цилиндрический
в стерильной упаковке

Do not use if pouch is damaged. Avoided from puncture, cut, tear or other damage. Do not use if pouch is damaged. Do not use if pouch is damaged. Do not use if pouch is damaged.

Do not use if pouch is damaged. Avoided from puncture, cut, tear or other damage. Do not use if pouch is damaged. Do not use if pouch is damaged. Do not use if pouch is damaged.

Do not use if pouch is damaged. Avoided from puncture, cut, tear or other damage. Do not use if pouch is damaged. Do not use if pouch is damaged. Do not use if pouch is damaged.

ООО «ГЛУС»
Катетер оптоволоконный
внутрикатетерный биопсийного типа,
стерильный, «КОБ» – 660» импорт, 2
конических – 2,5°/2,5°
ТУ 9436-001-62587591-2012
Изготовлен _____ 2013г. Изг.
Стерильно до _____ 2014г.
Одноразового использования.
Штамп ОТК _____ 2013г

LOT#
Twinkl® Brand
Chemical Indicator
With STERIBAD

Фотографическое изображение
капстера КОВБ-660 стерильного
исполнения 2 контурный
в стерильной упаковке