

Руководитель отдела качества
и корпоративных технологий
ООО «Сименс Здравоохранение»



Медведева И.Б.

2020 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO**

Дилуэнт для СА 19-9 для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM CA 19-9 Diluent (Atellica IM CA 19-9 DIL))

производства «Сименс Хелскеа Диагностикс Инк.», Siemens Healthcare Diagnostics Inc., США

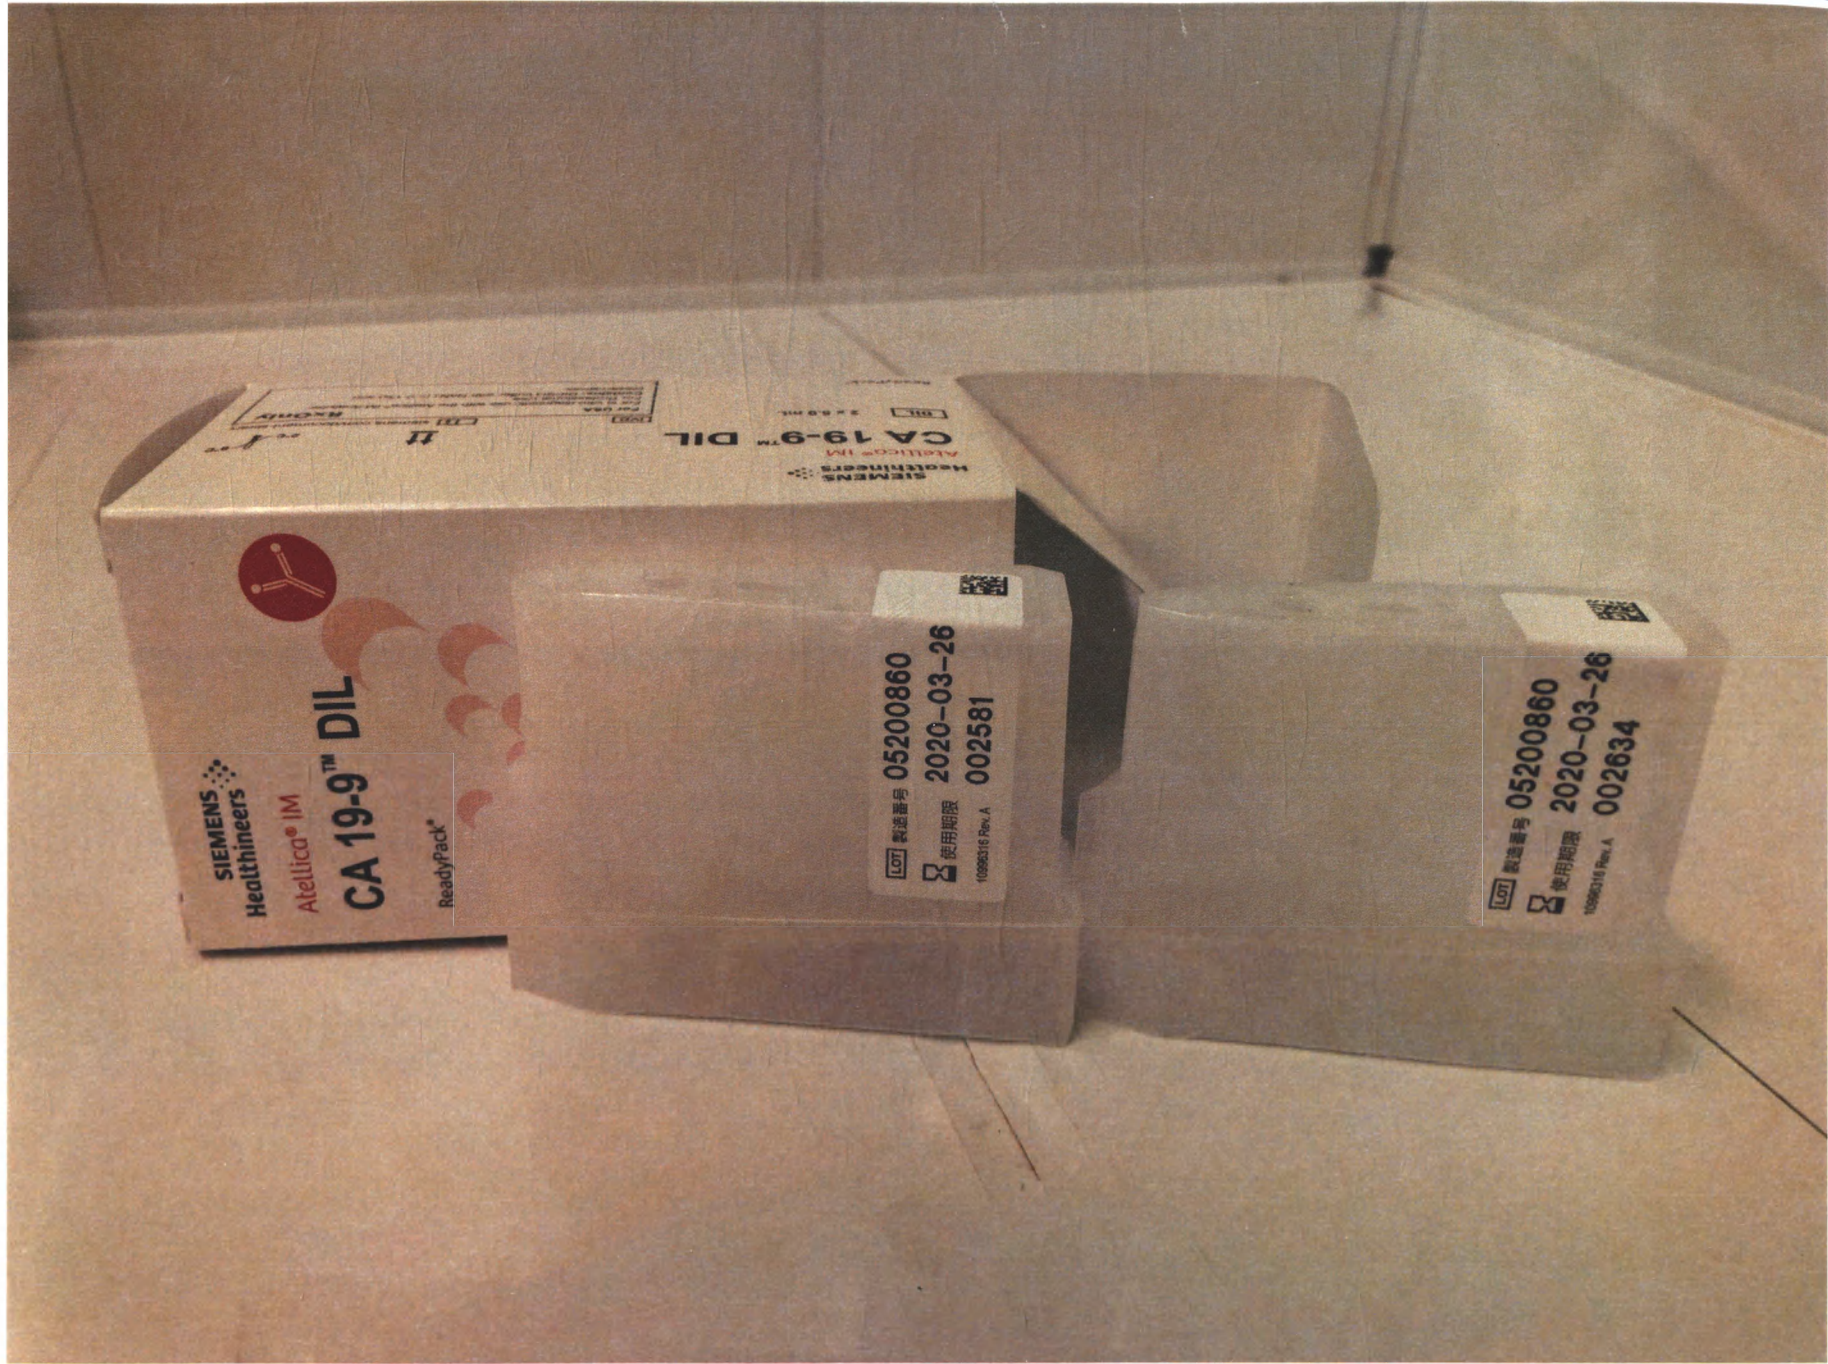


Рисунок 1. Дилуэнт для CA 19-9 для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM CA 19-9 Diluent (Atellica IM CA 19-9 DIL)). Общий вид

Всего прошито и пронумеровано _____
ООО «Сименс Здравоохранение» _____

