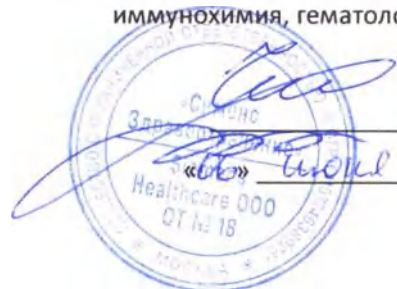


Руководитель направления по регистрации
продукции для in vitro диагностики,
иммунохимия, гематология и гемостаз

 Чигринец Е.А.
2023 г.


Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики in vitro

Реагенты in vitro для исследования гемостаза в наборах и отдельных упаковках

2023



Рисунок 1 Разбавитель образцов «Вероналовый Буфер Оурена Дейд» (Dade Owren's Veronal Buffer) – общий вид

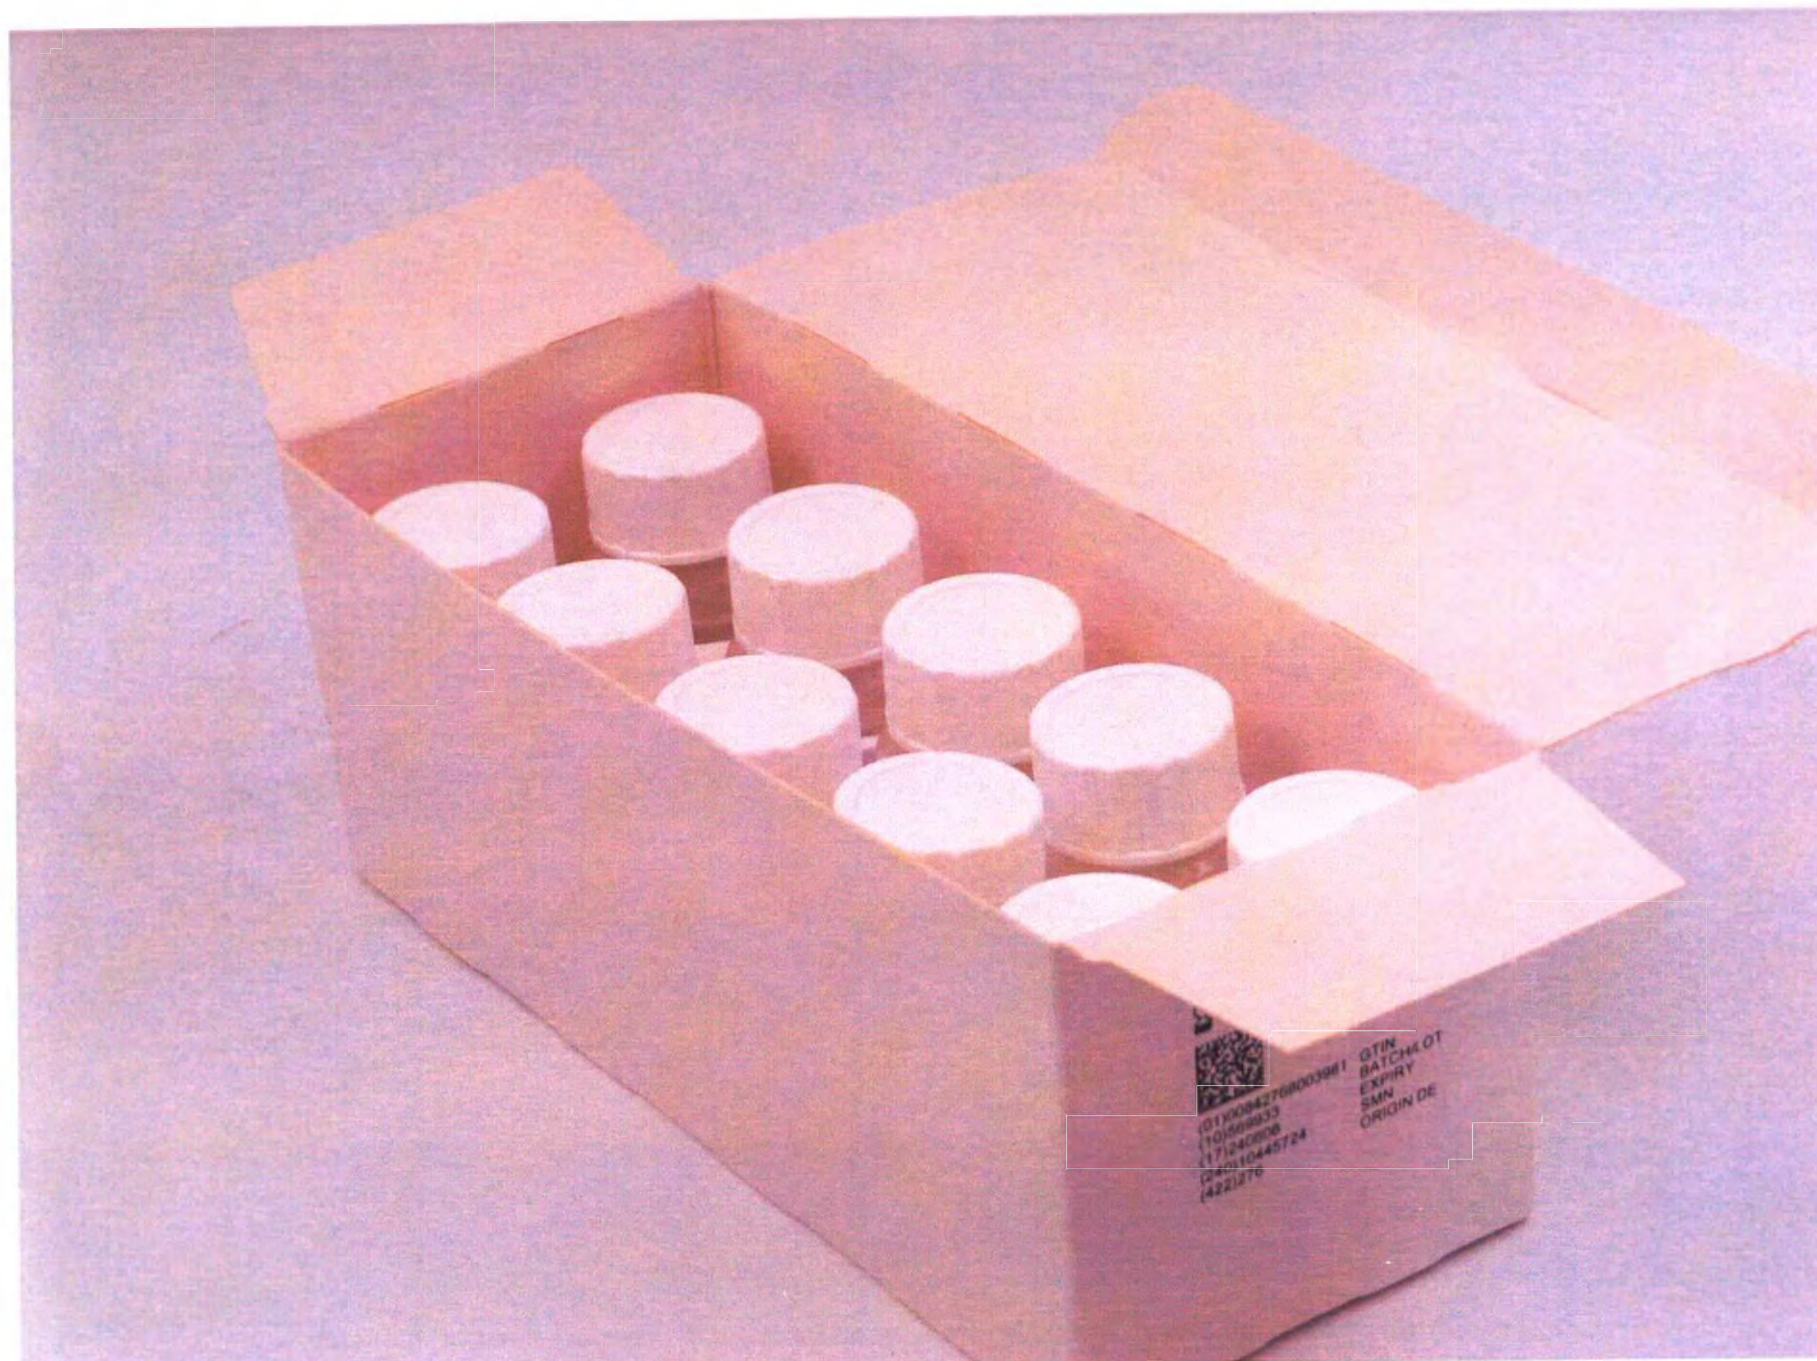

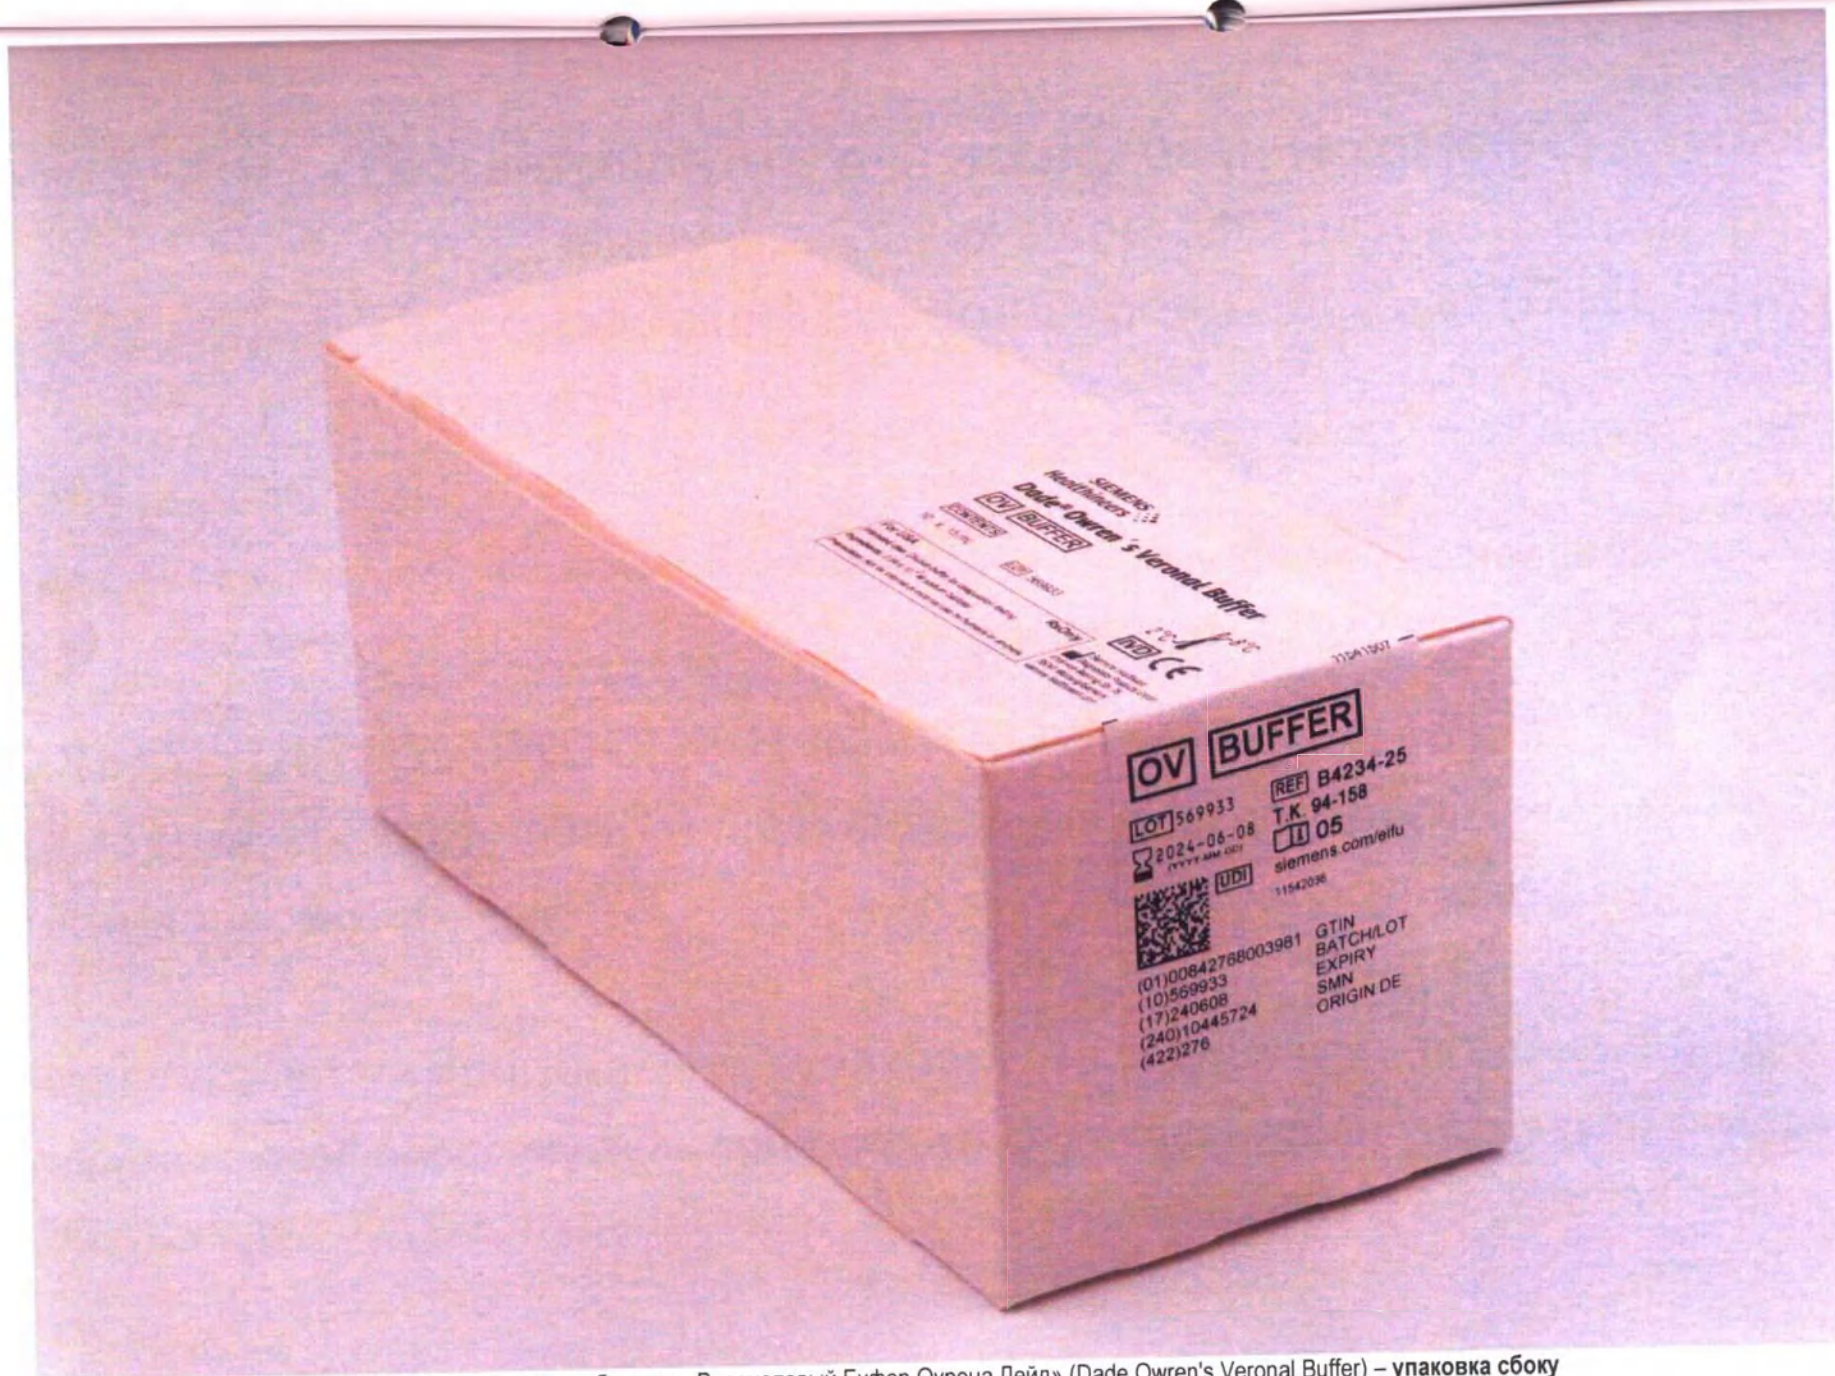


Рисунок 3 Разбавитель образцов «Вероналовый Буфер Оурена Дейд» (Dade Owren's Veronal Buffer) – упаковка сбоку

10445724 Реагенты in vitro для исследования гемостаза в наборах и отдельных упаковках в составе: разбавитель образцов «Вероналовый Буфер Оурена Дейд» (Dade Owren's Veronal Buffer)

Информация о производителе и стране производства:
см. на упаковке

Регистрационное удостоверение:
№ ФСЗ 2012/13274 от 17.11.2020

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на оригинальной упаковке

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению
Авторизованный представитель производителя на территории Российской Федерации:
ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96

Рисунок 4 Разбавитель образцов «Вероналовый Буфер Оурена Дейд» (Dade Owren's Veronal Buffer): макет русскоязычной маркировки



Рисунок 5 Набор реагентов для определения эндогенного потенциала тромбина «Иннованс» (INNOVANCE ETP)

10446023 Реагенты in vitro для исследования гемостаза в наборах и отдельных упаковках: Набор реагентов для определения эндогенного потенциала тромбина «Иннованс» (INNOVANCE ETP)

Информация о производителе и стране производства:
см. на упаковке

Регистрационное удостоверение:
№ ФСЗ 2012/13274 от 17.11.2020

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на оригинальной упаковке

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96

Тел.: 8(800) 550-50-22

Рисунок 6 Набор реагентов для определения эндогенного потенциала тромбина «Иннованс» (INNOVANCE ETP): макет русскоязычной маркировки

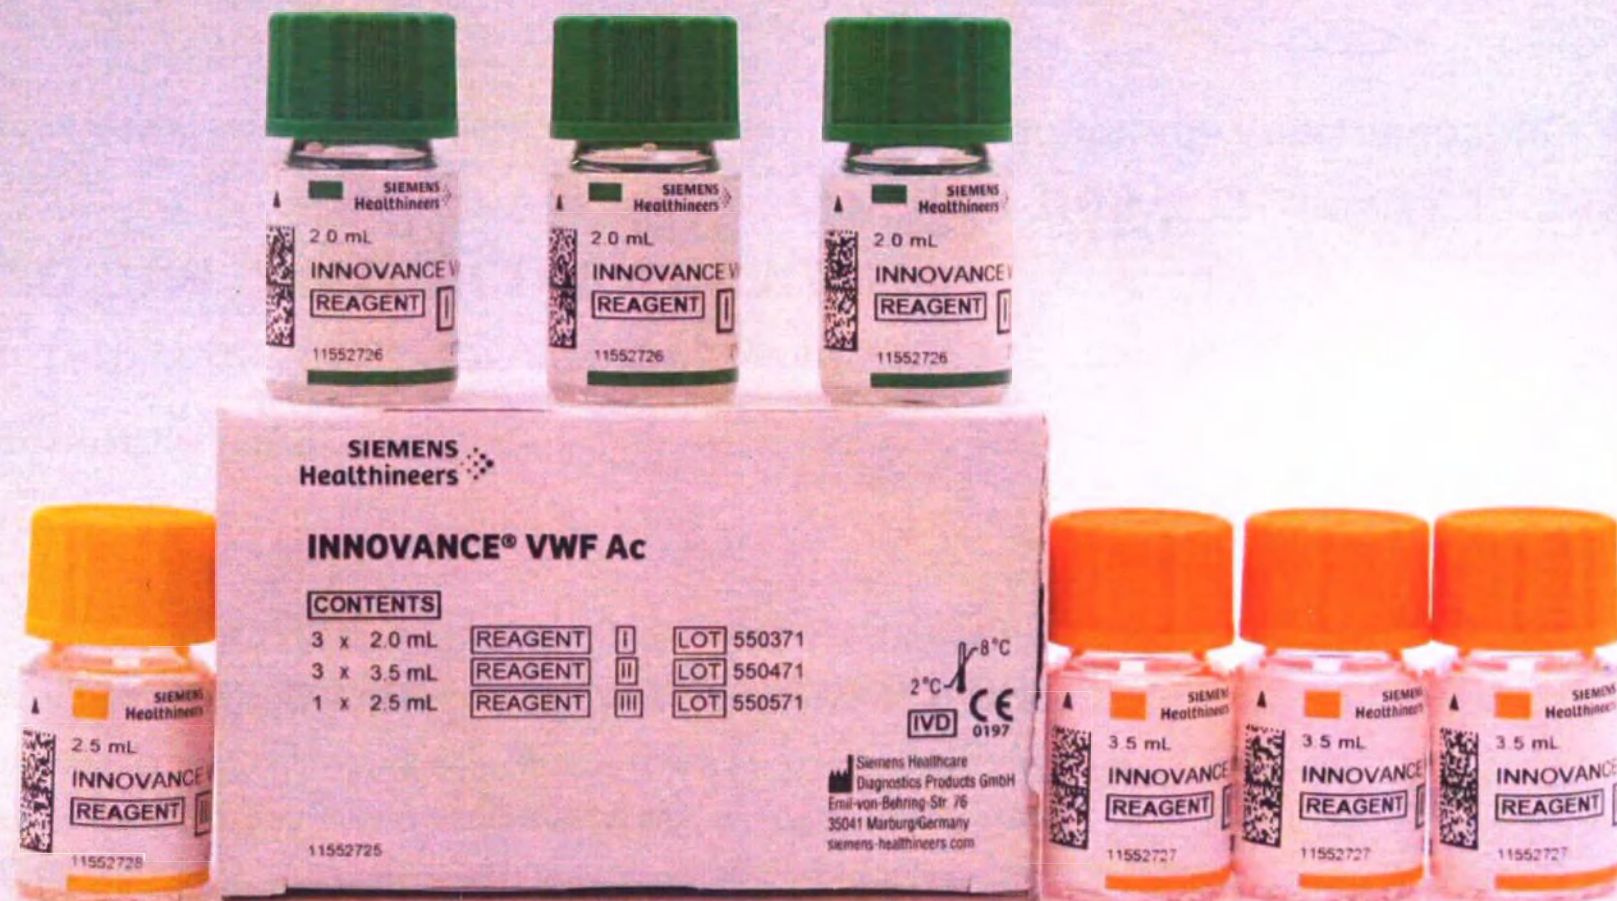


Рисунок 7 Набор реагентов для определения активности фактора Виллебранда Ас «Иннованс» (INNOVANCE VWF Ac)

10446023 Реагенты in vitro для исследования гемостаза в наборах и отдельных упаковках: Набор реагентов для определения активности фактора Виллебранда Ас «Иннованс» (INNOVANCE VWF Ac)

Информация о производителе и стране производства:
см. на упаковке

Регистрационное удостоверение:

№ ФСЗ 2012/13274 от 17.11.2020

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на оригинальной упаковке

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96

Тел.: 8(800) 550-50-22

Рисунок 8 Набор реагентов для определения активности фактора Виллебранда Ас «Иннованс» (INNOVANCE VWF Ac): макет русскоязычной маркировки

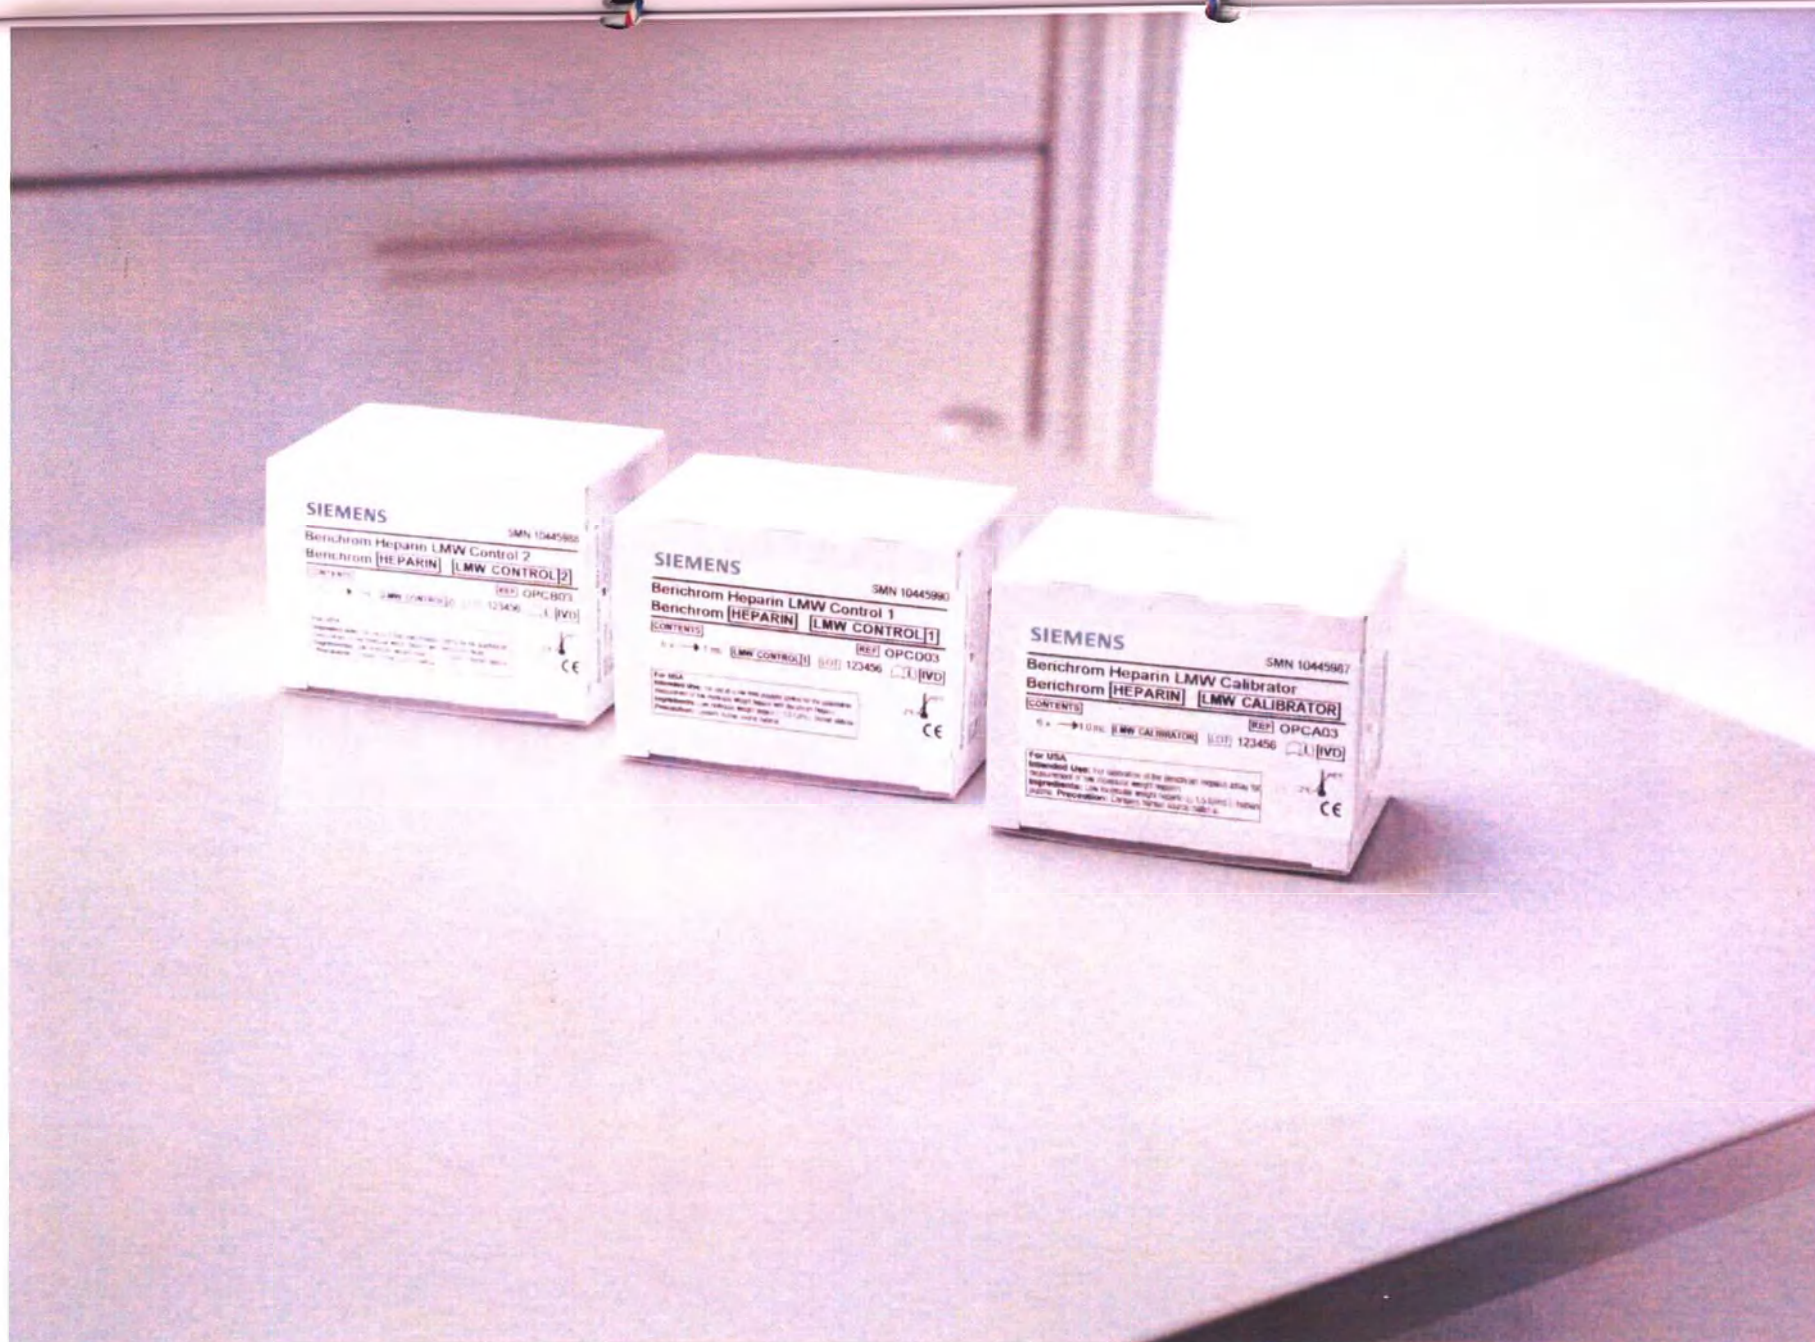


Рисунок 9 Калибратор низкомолекулярного гепарина «Берихром» (Berichrom Heparin LMW Calibrator)
 Контроль низкомолекулярного гепарина, уровень 1 «Берихром» (Berichrom Heparin LMW Control 1)
 Контроль низкомолекулярного гепарина, уровень 2 «Берихром» (Berichrom Heparin LMW Control 2)



Рисунок 10 Флаконы: Калибратор низкомолекулярного гепарина «Берихром» (Berichrom Heparin LMW Calibrator)

Контроль низкомолекулярного гепарина, уровень 1 «Берихром» (Berichrom Heparin LMW Control 1)

Контроль низкомолекулярного гепарина, уровень 2 «Берихром» (Berichrom Heparin LMW Control 2)

10445987 Реагенты in vitro для исследования гемостаза в наборах и отдельных упаковках: Калибратор низкомолекулярного гепарина «Берихром» (Berichrom Heparin LMW Calibrator)

Информация о производителе и стране производства:
см. на упаковке

Регистрационное удостоверение:

№ ФСЗ 2012/13274 от 17.11.2020

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на оригинальной упаковке

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96

Тел.: 8(800) 550-50-22

Рисунок 11 Калибратор низкомолекулярного гепарина «Берихром» (Berichrom Heparin LMW Calibrator): макет русскоязычной маркировки

10445990 Реагенты in vitro для исследования гемостаза в наборах и отдельных упаковках: Контроль низкомолекулярного гепарина, уровень 1 «Берихром» (Berichrom Heparin LMW Control 1)

Информация о производителе и стране производства:
см. на упаковке

Регистрационное удостоверение:
№ ФСЗ 2012/13274 от 17.11.2020

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на оригинальной упаковке

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96

Тел.: 8(800) 550-50-22

Рисунок 12 Контроль низкомолекулярного гепарина, уровень 1 «Берихром» (Berichrom Heparin LMW Control 1): макет русскоязычной маркировки

10445988 Реагенты in vitro для исследования гемостаза в наборах и отдельных упаковках: Контроль низкомолекулярного гепарина, уровень 2 «Берихром» (Berichrom Heparin LMW Control 2)

Информация о производителе и стране производства:
см. на упаковке

Регистрационное удостоверение:

№ ФСЗ 2012/13274 от 17.11.2020

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на оригинальной упаковке

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96

Тел.: 8(800) 550-50-22

Рисунок 13 Контроль низкомолекулярного гепарина, уровень 2 «Берихром» (Berichrom Heparin LMW Control 2): макет русскоязычной маркировки

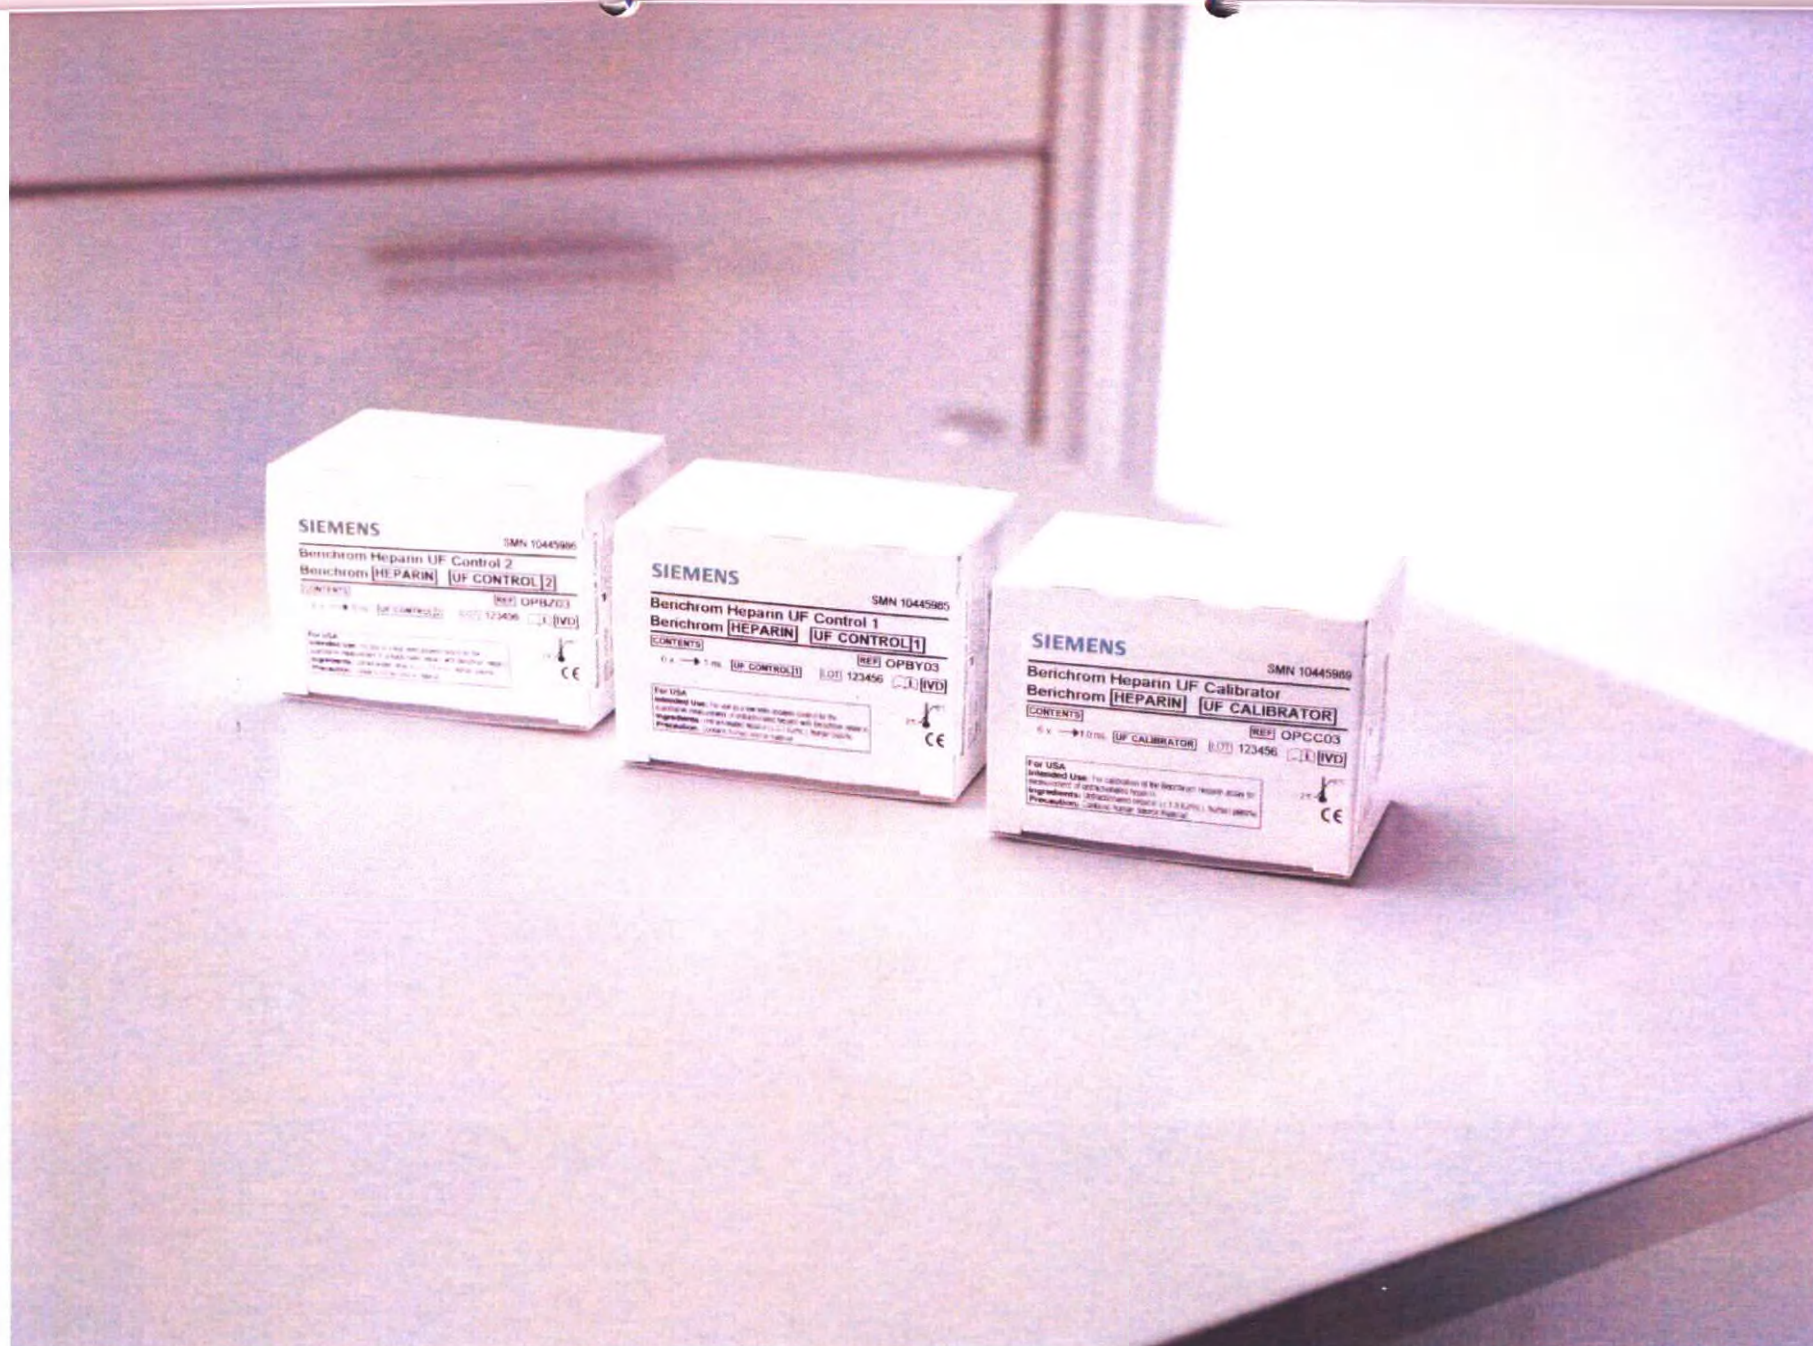


Рисунок 14 Калибратор не фракционированного гепарина «Берихром» (Berichrom Heparin UF Calibrator)
 Контроль нефракционированного гепарина, уровень 1 «Берихром» (Berichrom Heparin UF Control 1)
 Контроль нефракционированного гепарина, уровень 2 «Берихром» (Berichrom Heparin UF Control 2)



Рисунок 15 Флаконы: Калибратор не фракционированного гепарина «Берихром» (Berichrom Heparin UF Calibrator)

Контроль нефракционированного гепарина, уровень 1 «Берихром» (Berichrom Heparin UF Control 1)

Контроль нефракционированного гепарина, уровень 2 «Берихром» (Berichrom Heparin UF Control 2)

10445989 Реагенты in vitro для исследования гемостаза в наборах и отдельных упаковках: Калибратор не фракционированного гепарина «Берихром» (Berichrom Heparin UF Calibrator)

Информация о производителе и стране производства:
см. на упаковке

Регистрационное удостоверение:

№ ФСЗ 2012/13274 от 17.11.2020

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на оригинальной упаковке

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96

Тел.: 8(800) 550-50-22

Рисунок 16 Калибратор не фракционированного гепарина «Берихром» (Berichrom Heparin UF Calibrator): макет русскоязычной маркировки

10445985 Реагенты in vitro для исследования гемостаза в наборах и отдельных упаковках: Контроль нефракционированного гепарина, уровень 1 «Берихром» (Berichrom Heparin UF Control 1)

Информация о производителе и стране производства:
см. на упаковке

Регистрационное удостоверение:
№ ФСЗ 2012/13274 от 17.11.2020

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на оригинальной упаковке

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96

Тел.: 8(800) 550-50-22

Рисунок 17 Контроль нефракционированного гепарина, уровень 1 «Берихром» (Berichrom Heparin UF Control 1): макет русскоязычной маркировки

10445986 Реагенты in vitro для исследования гемостаза в наборах и отдельных упаковках: Контроль нефракционированного гепарина, уровень 2 «Берихром» (Berichrom Heparin UF Control 2)

Информация о производителе и стране производства:
см. на упаковке

Регистрационное удостоверение:
№ ФСЗ 2012/13274 от 17.11.2020

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на оригинальной упаковке

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96

Тел.: 8(800) 550-50-22

Рисунок 18 Контроль нефракционированного гепарина, уровень 2 «Берихром» (Berichrom Heparin UF Control 2): макет русскоязычной маркировки



Рисунок 19 Разбавитель образцов «Иннованс Д-димер дилуент» (INNOVANCE D-Dimer sample Diluent)

10487039 Реагенты in vitro для исследования гемостаза в наборах и отдельных упаковках: Разбавитель образцов «Иннованс Д-димер дилуент» (INNOVANCE D-Dimer sample Diluent)

Информация о производителе и стране производства:
см. на упаковке

Регистрационное удостоверение:
№ ФСЗ 2012/13274 от 17.11.2020

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на оригинальной упаковке


Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96

Тел.: 8(800) 550-50-22

Рисунок 20 Разбавитель образцов «Иннованс Д-димер дилуент» (INNOVANCE D-Dimer sample Diluent): макет русскоязычной маркировки

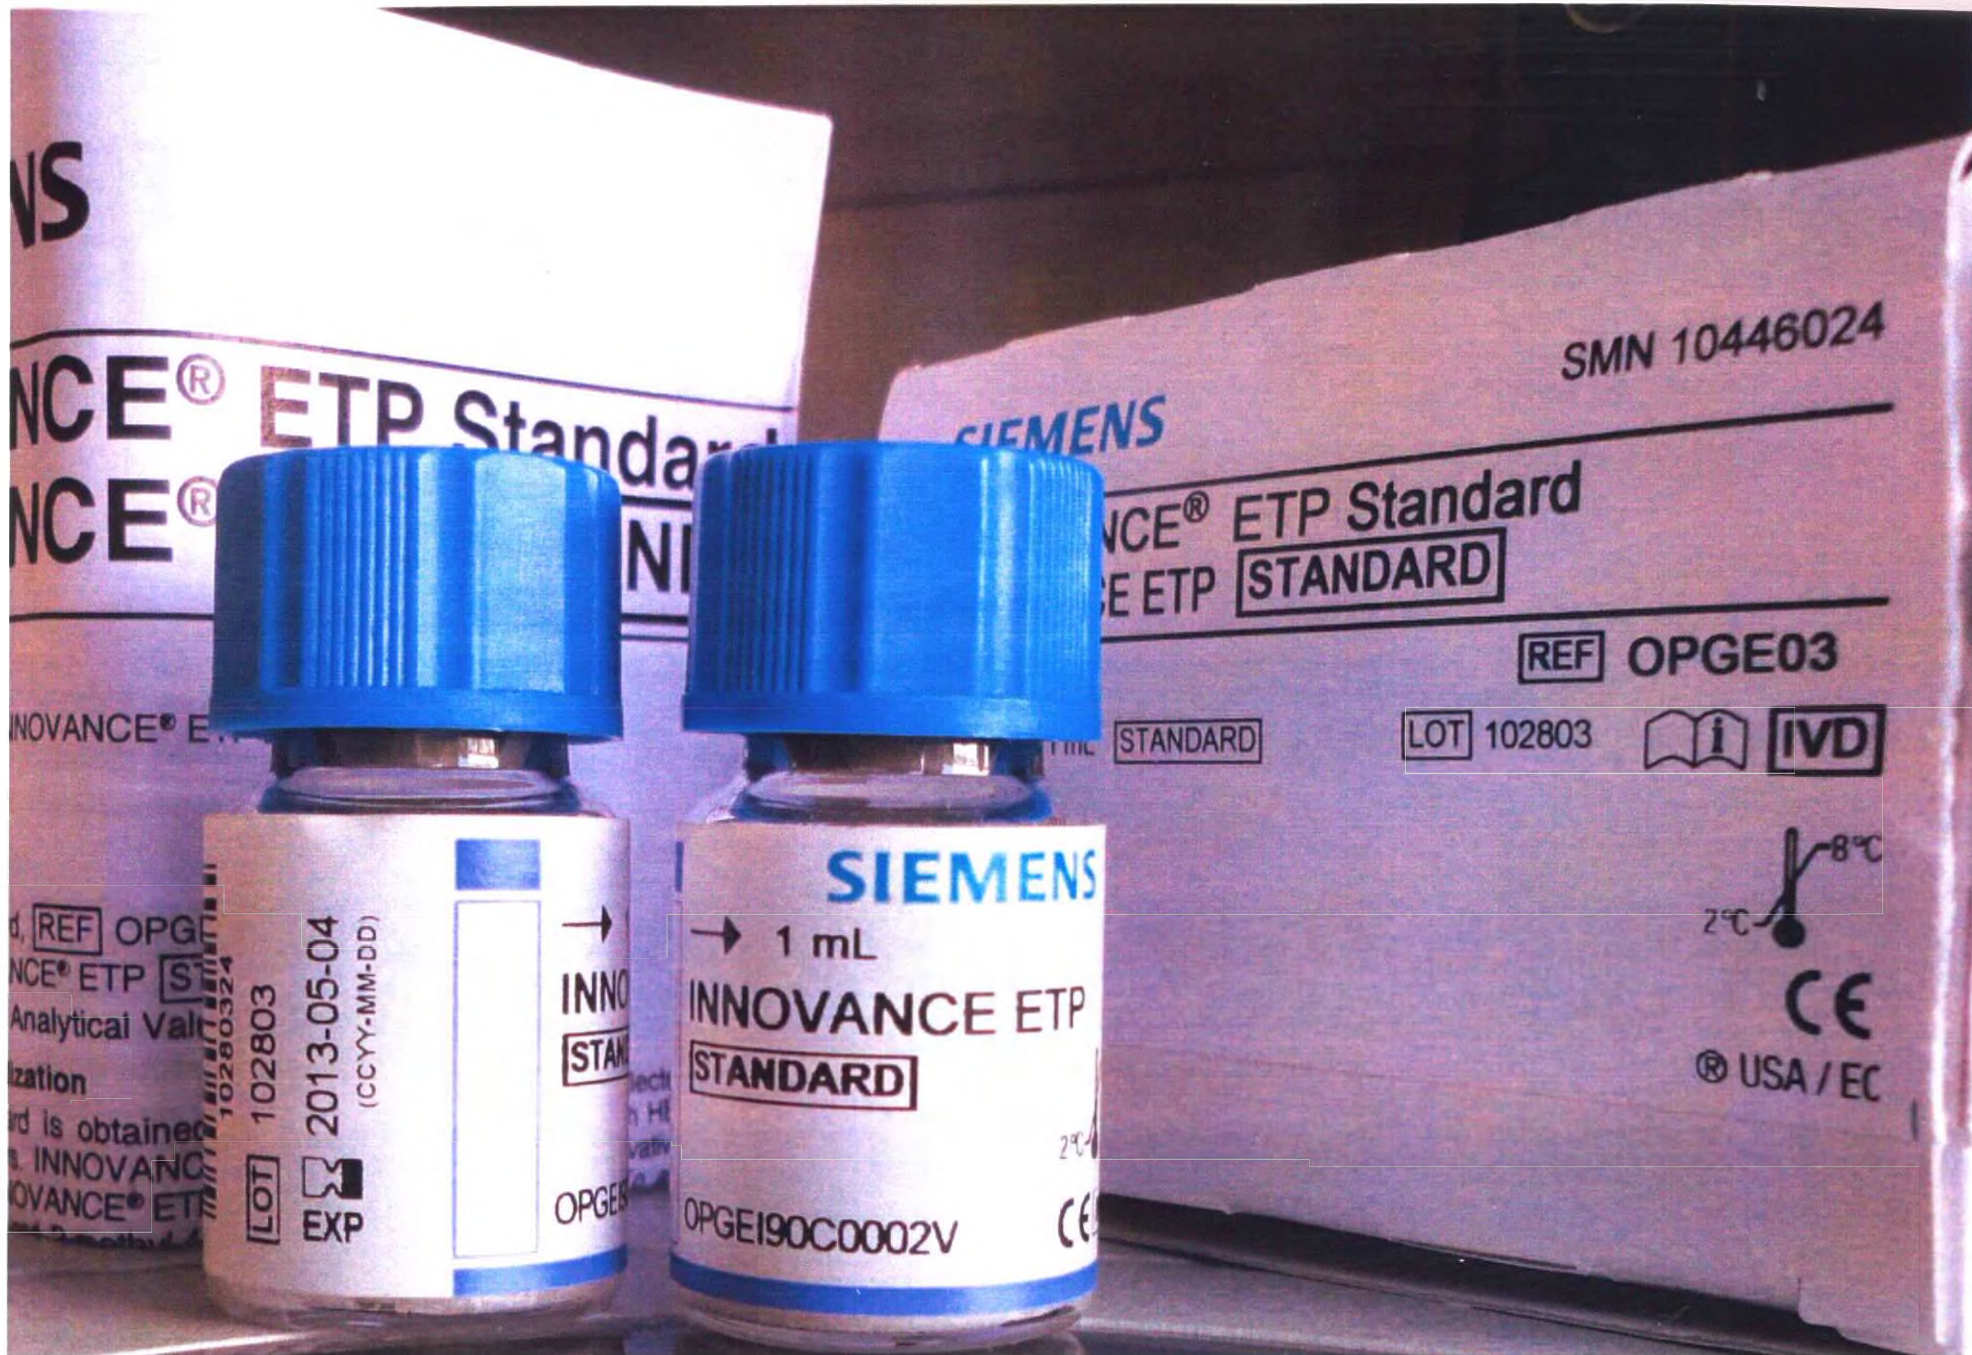

10446024 Реагенты in vitro для исследования гемостаза в наборах и отдельных упаковках: Стандарт эндогенного потенциала тромбина «Иннованс» (INNOVANCE ETP standard)

Информация о производителе и стране производства:
см. на упаковке

Регистрационное удостоверение:
№ ФСЗ 2012/13274 от 17.11.2020

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на оригинальной упаковке

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96

Тел.: 8(800) 550-50-22

Рисунок 22 Стандарт эндогенного потенциала тромбина «Иннованс» (INNOVANCE ETP standard): макет русскоязычной маркировки



Всего прошито и пронумеровано
23 листа (ов).

ООО «Сиенс Здравоохранение»

