

Руководитель группы регистрации
ООО «Сименс Здравоохранение»



Пачугова Н.А.

«

2021 г.

Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики in vitro

Набор реагентов для определения общего билирубина на анализаторах
биохимических серии Atellica (Atellica CH Total Bilirubin_2 (Atellica CH TBil_2))

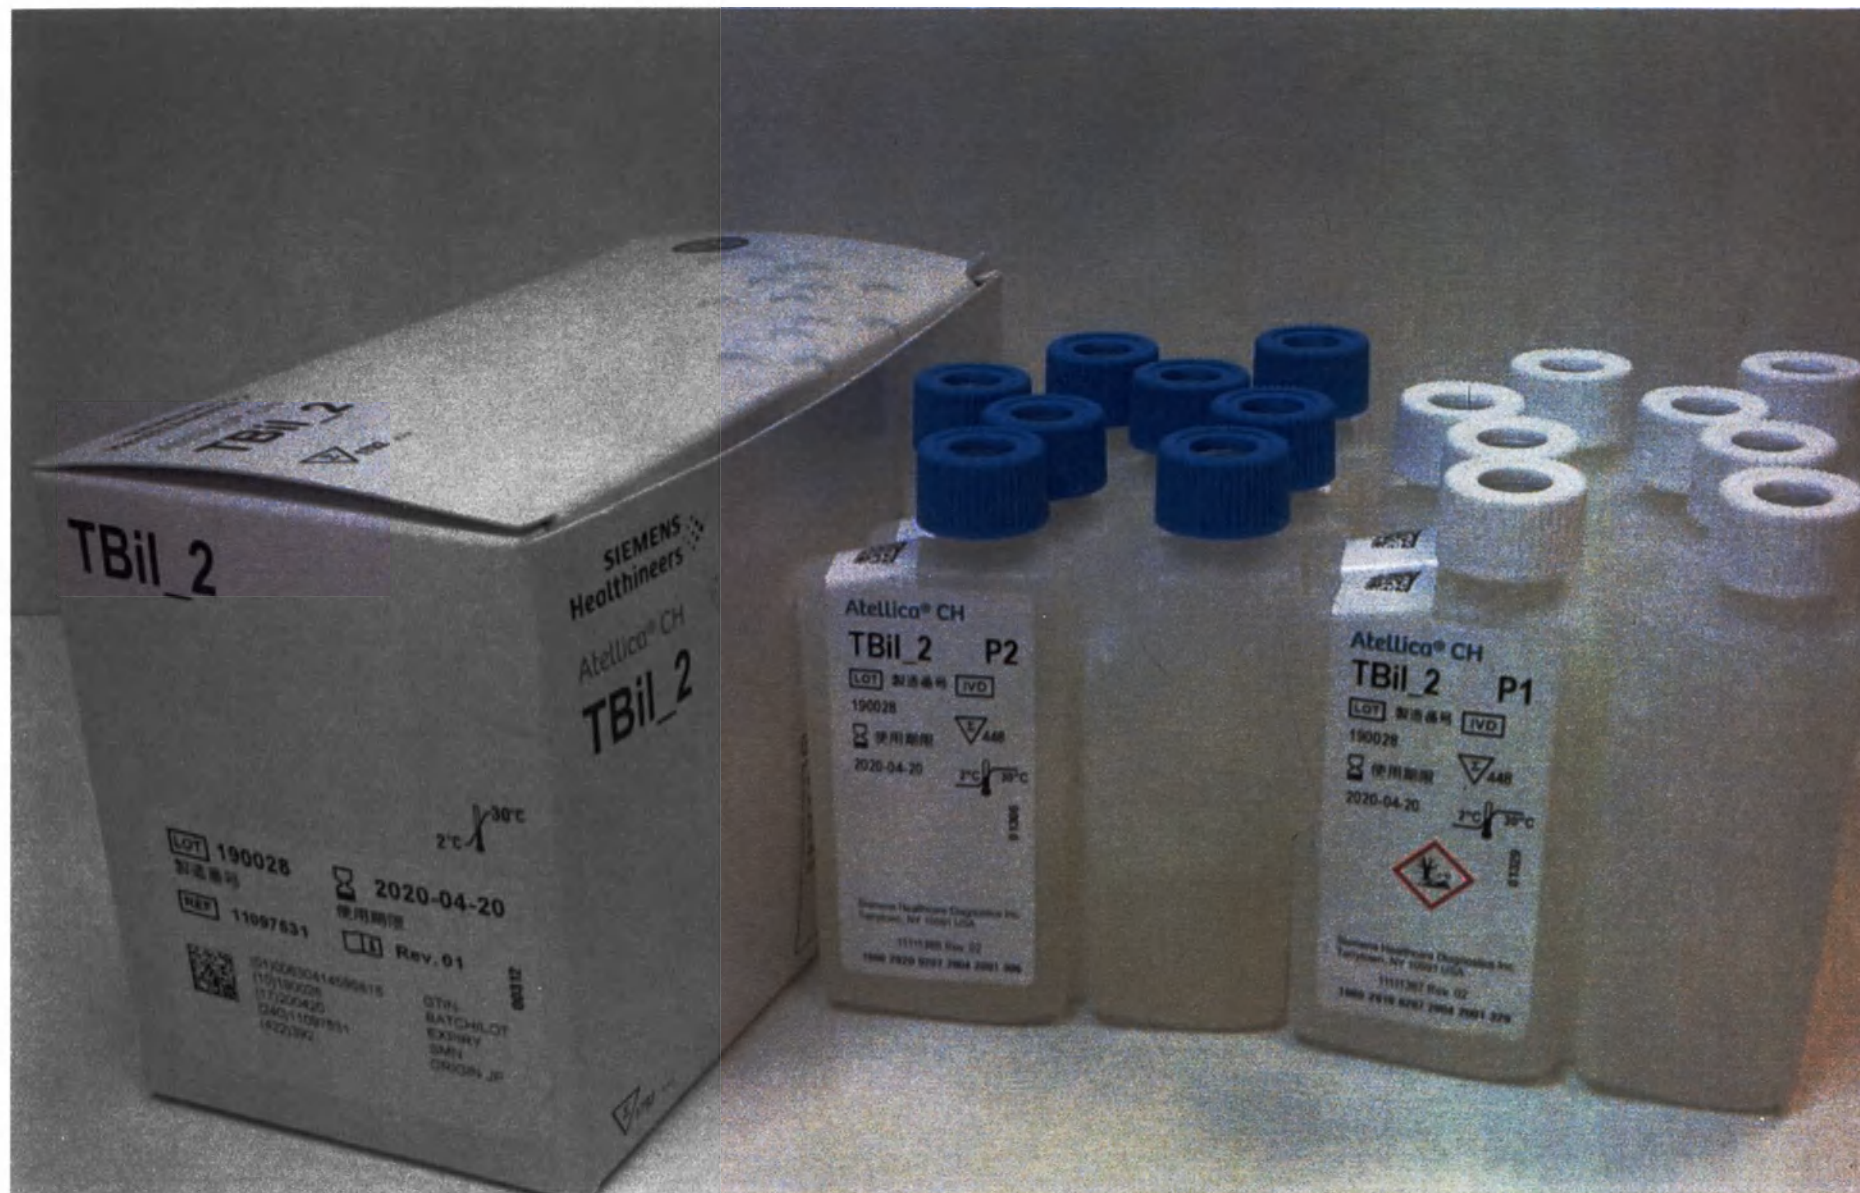


Рисунок 1 Набор реагентов для определения общего билирубина на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica CH Total Bilirubin_2 (Atellica CH TBil_2)): общий вид изделия

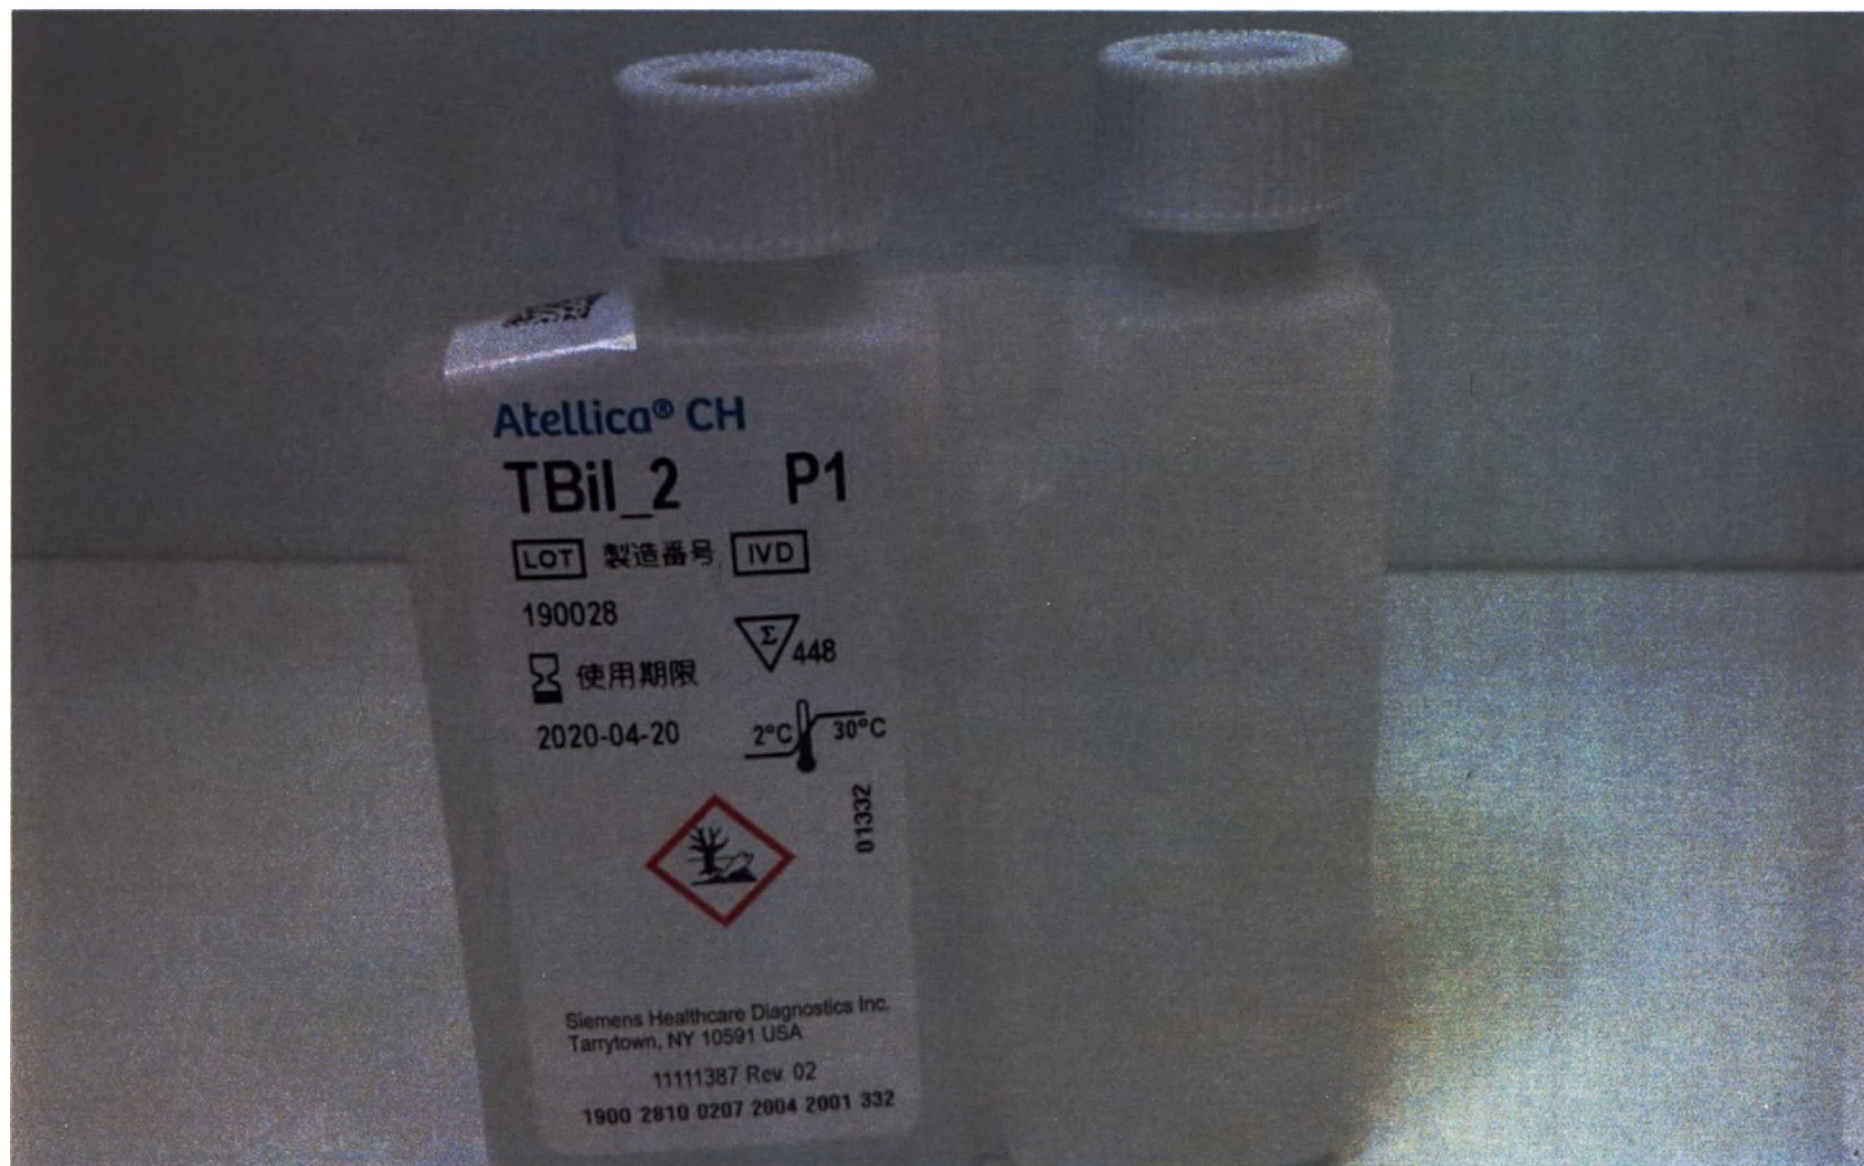


Рисунок 2 Набор реагентов для определения общего билирубина на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica CH Total Bilirubin_2 (Atellica CH TBil_2)): флаконы с реагентами, общий вид, пакет 1

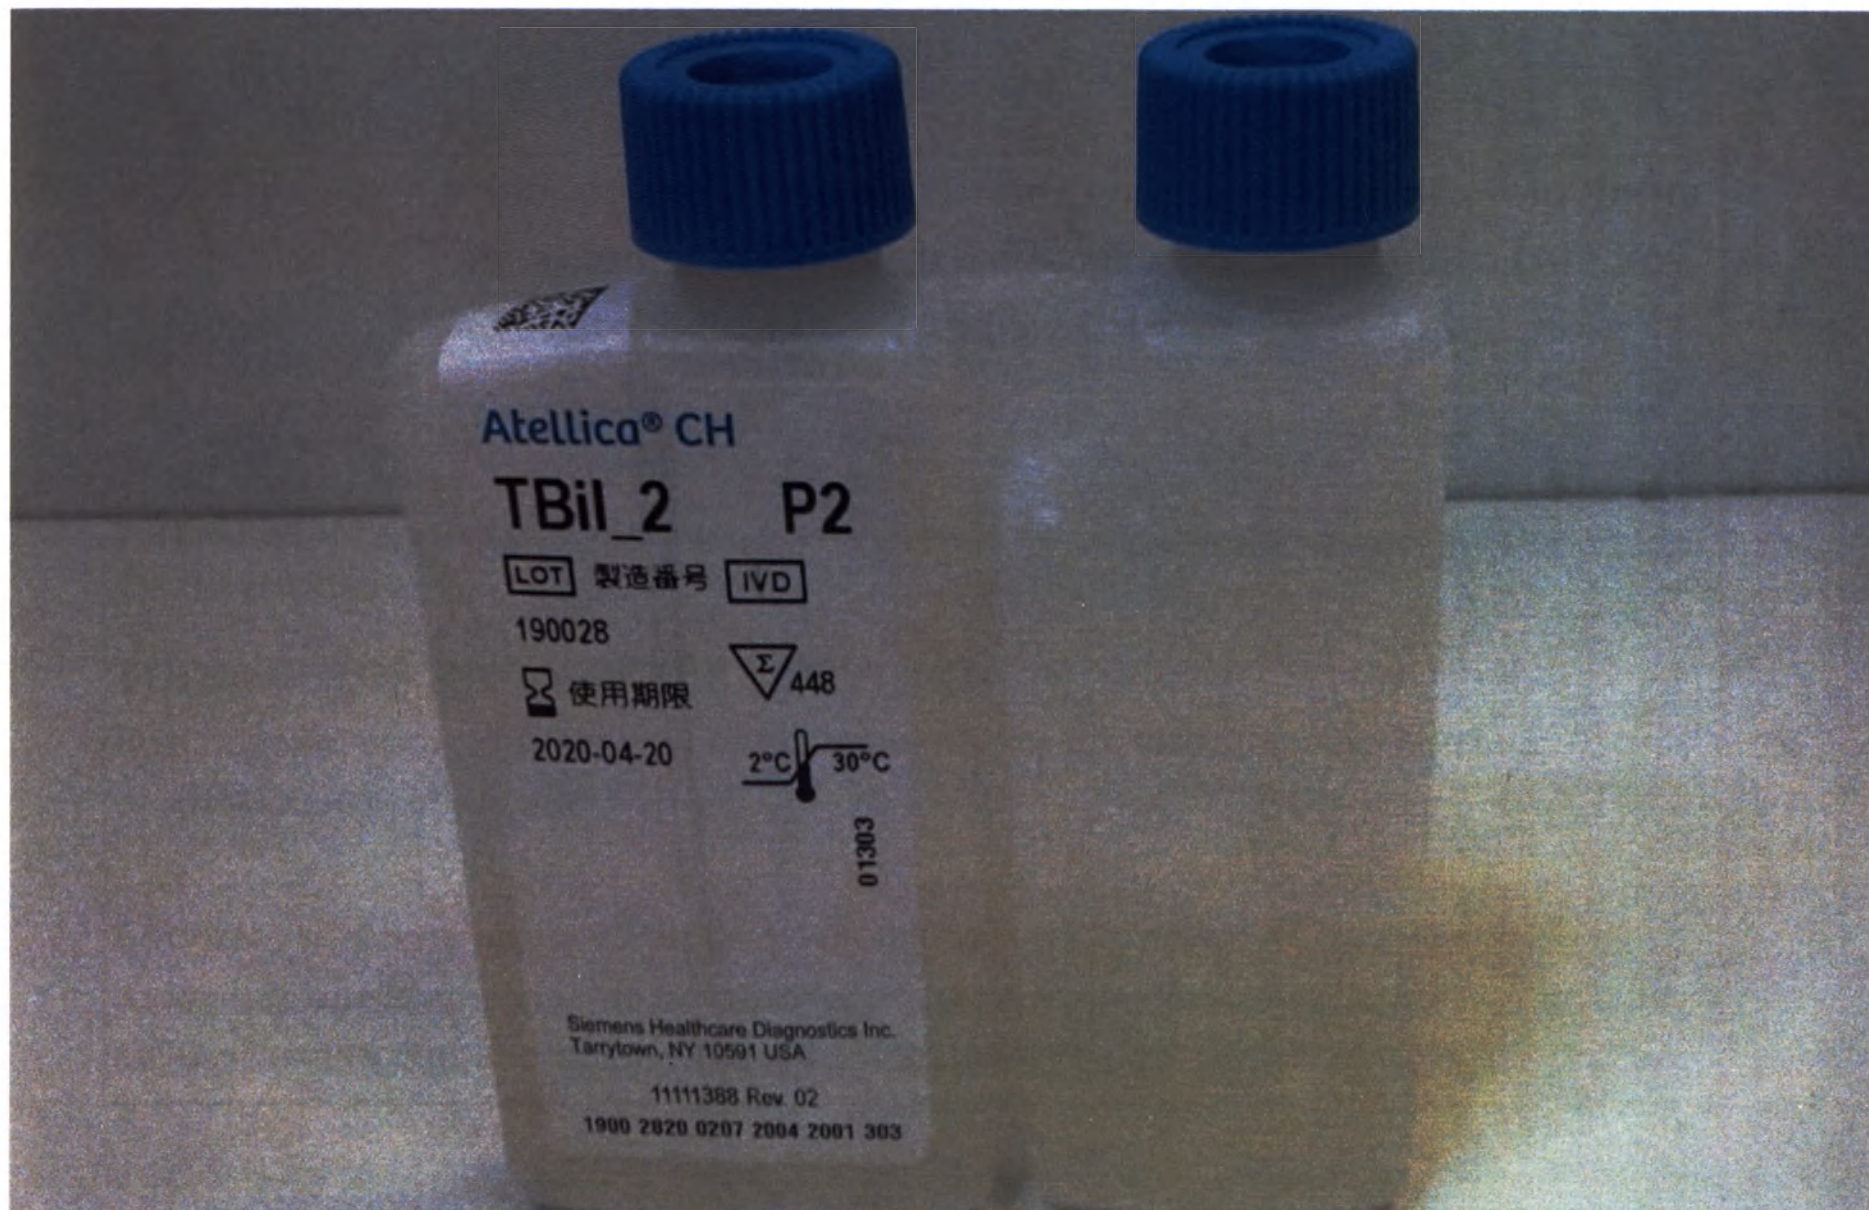


Рисунок 3 Набор реагентов для определения общего билирубина на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica CH Total Bilirubin_2 (Atellica CH TBil_2)): флаконы с реагентами, общий вид, пакет 2.

11097531

**Набор реагентов для определения общего билирубина
на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica
CH Total Bilirubin_2 (Atellica CH TBil_2))**

Информация о производителе и стране производства:
см.на упаковке

Регистрационное удостоверение:

№ РЗН 2020/10584 от _____

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

**Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на
оригинальной упаковке**

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению

Авторизованный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96

**Рисунок 4 Набор реагентов для определения общего билирубина на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica CH Total Bilirubin_2
(Atellica CH TBil_2)): макет маркировки для Российской Федерации**

Всего прошито и пронумеровано
5 листа (ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»

