

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «НП «ВЦ»


О.Р. Абдиев



Фотографические изображения, макеты маркировки и упаковки медицинского изделия
Ингалятор ультразвуковой цифровой VivoSpiro® PM&HM модель «MVS01» с принадлежностями
по ТУ 26.60.13-002-01813706-2020


Основной состав:

- базовый блок ингалятора VivoSpiro[®];

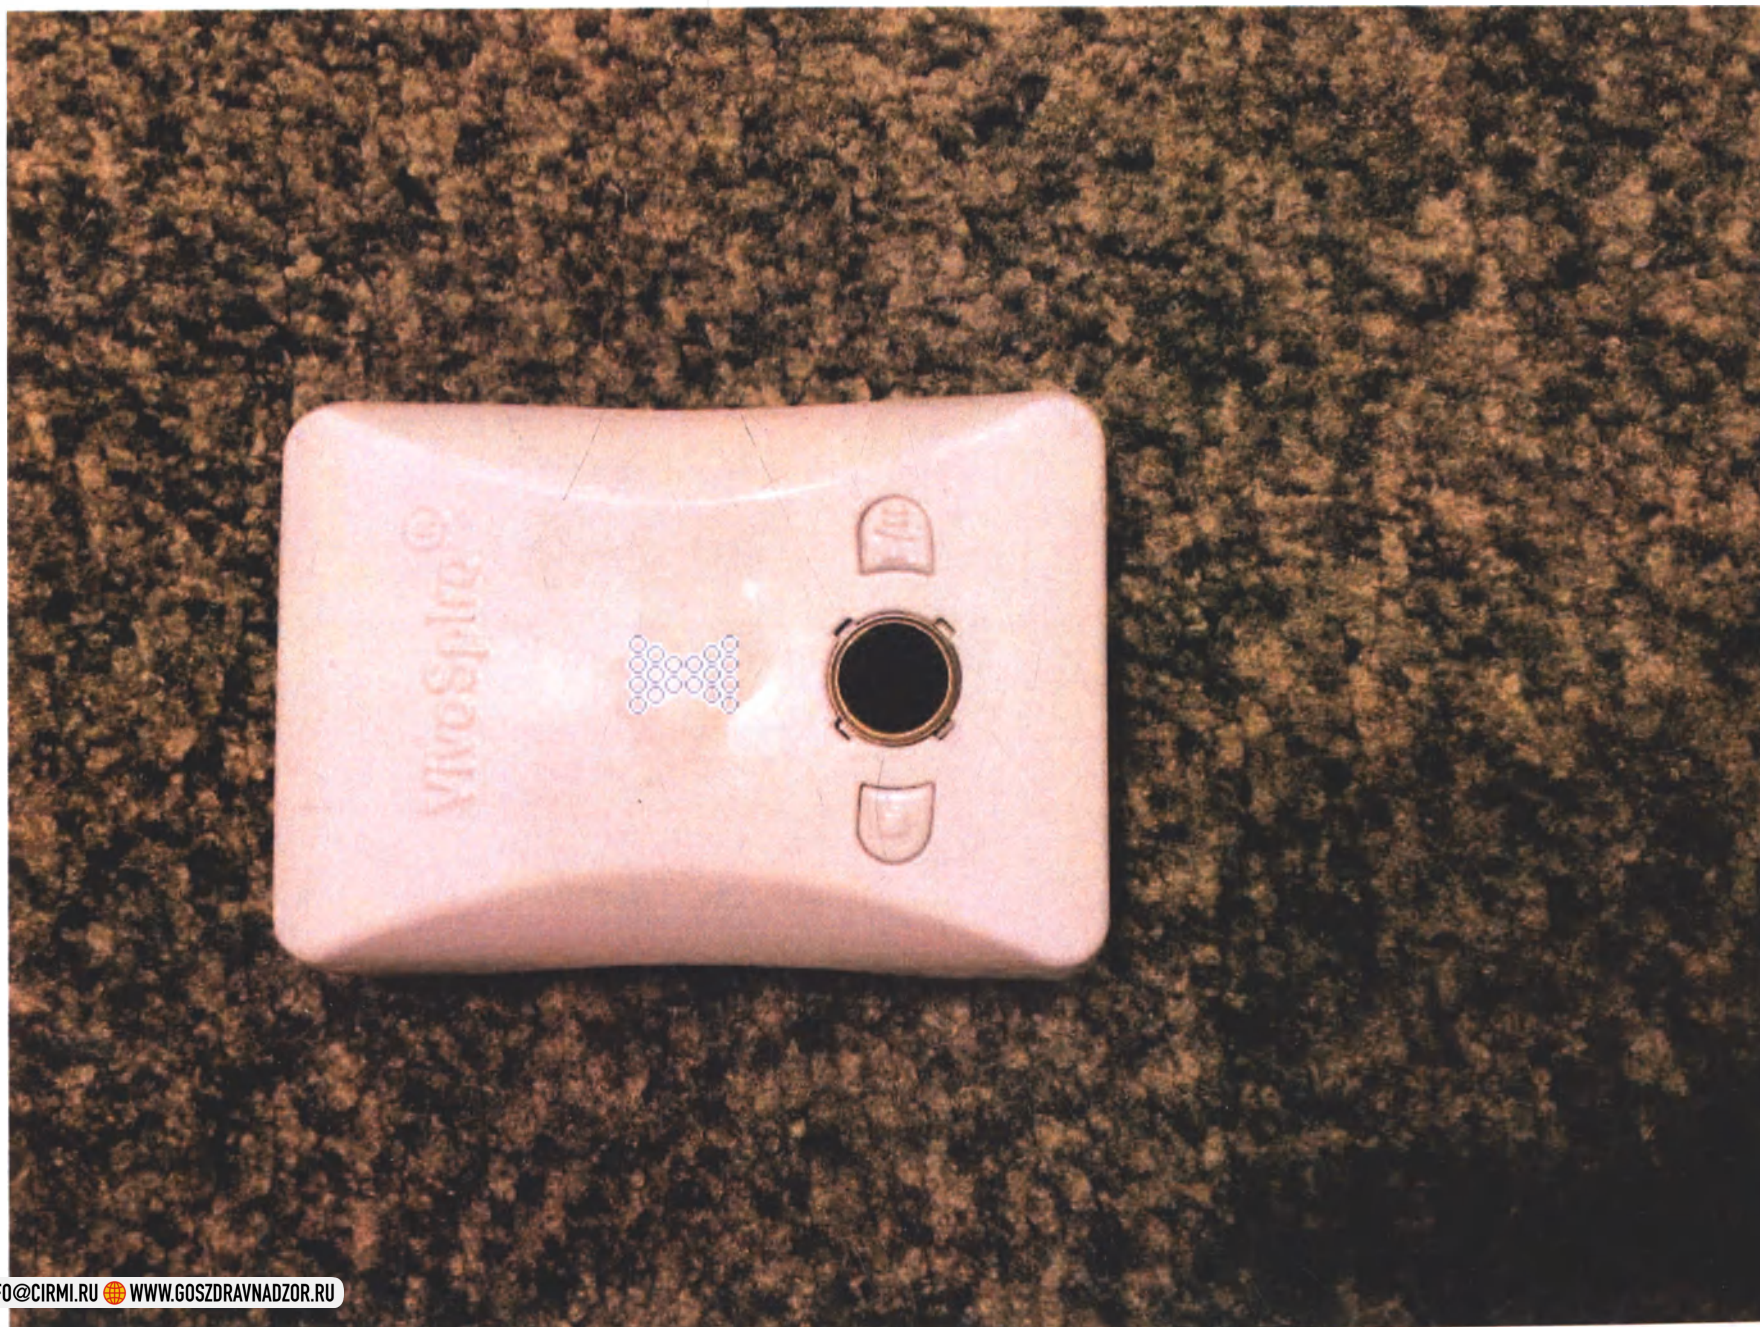






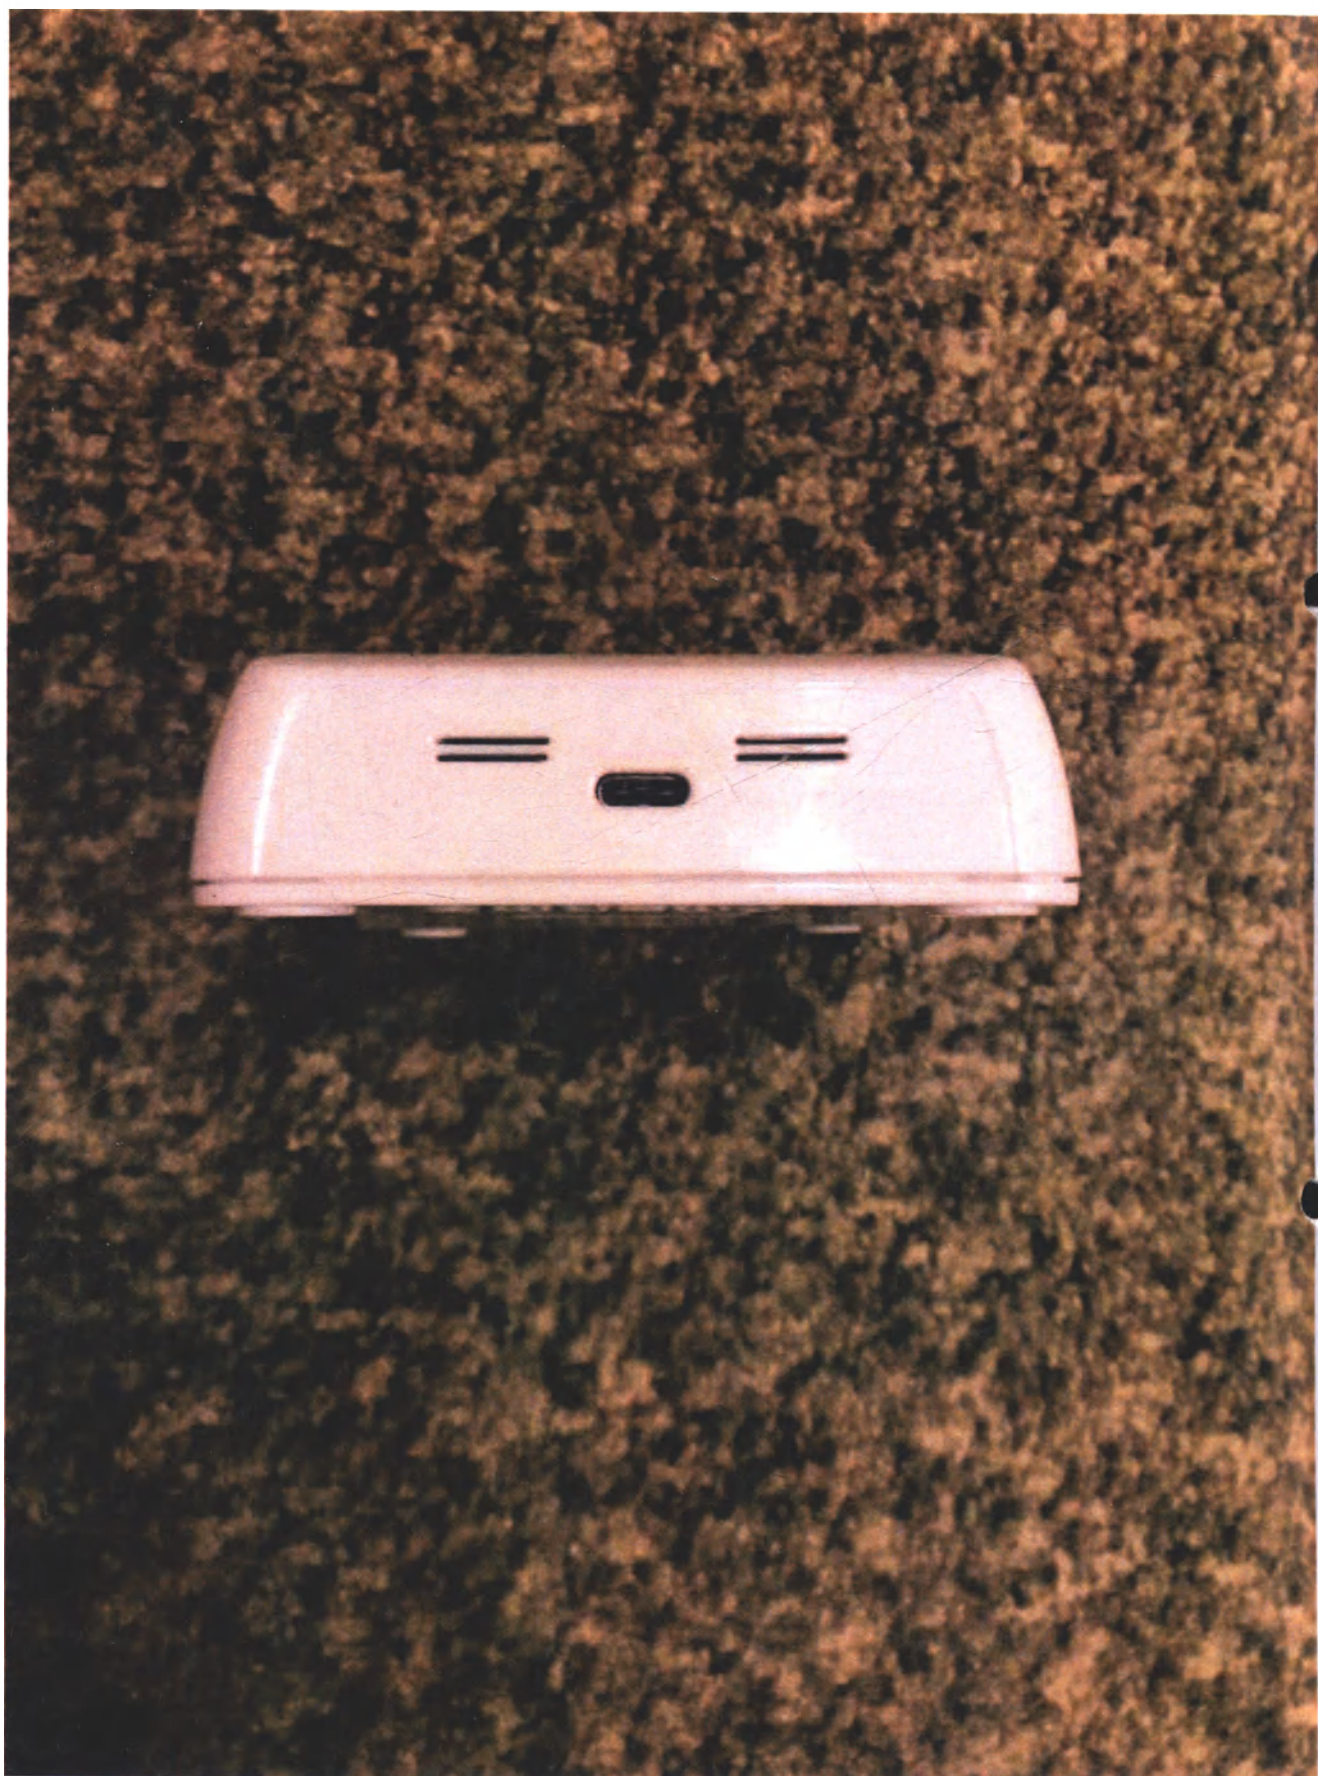



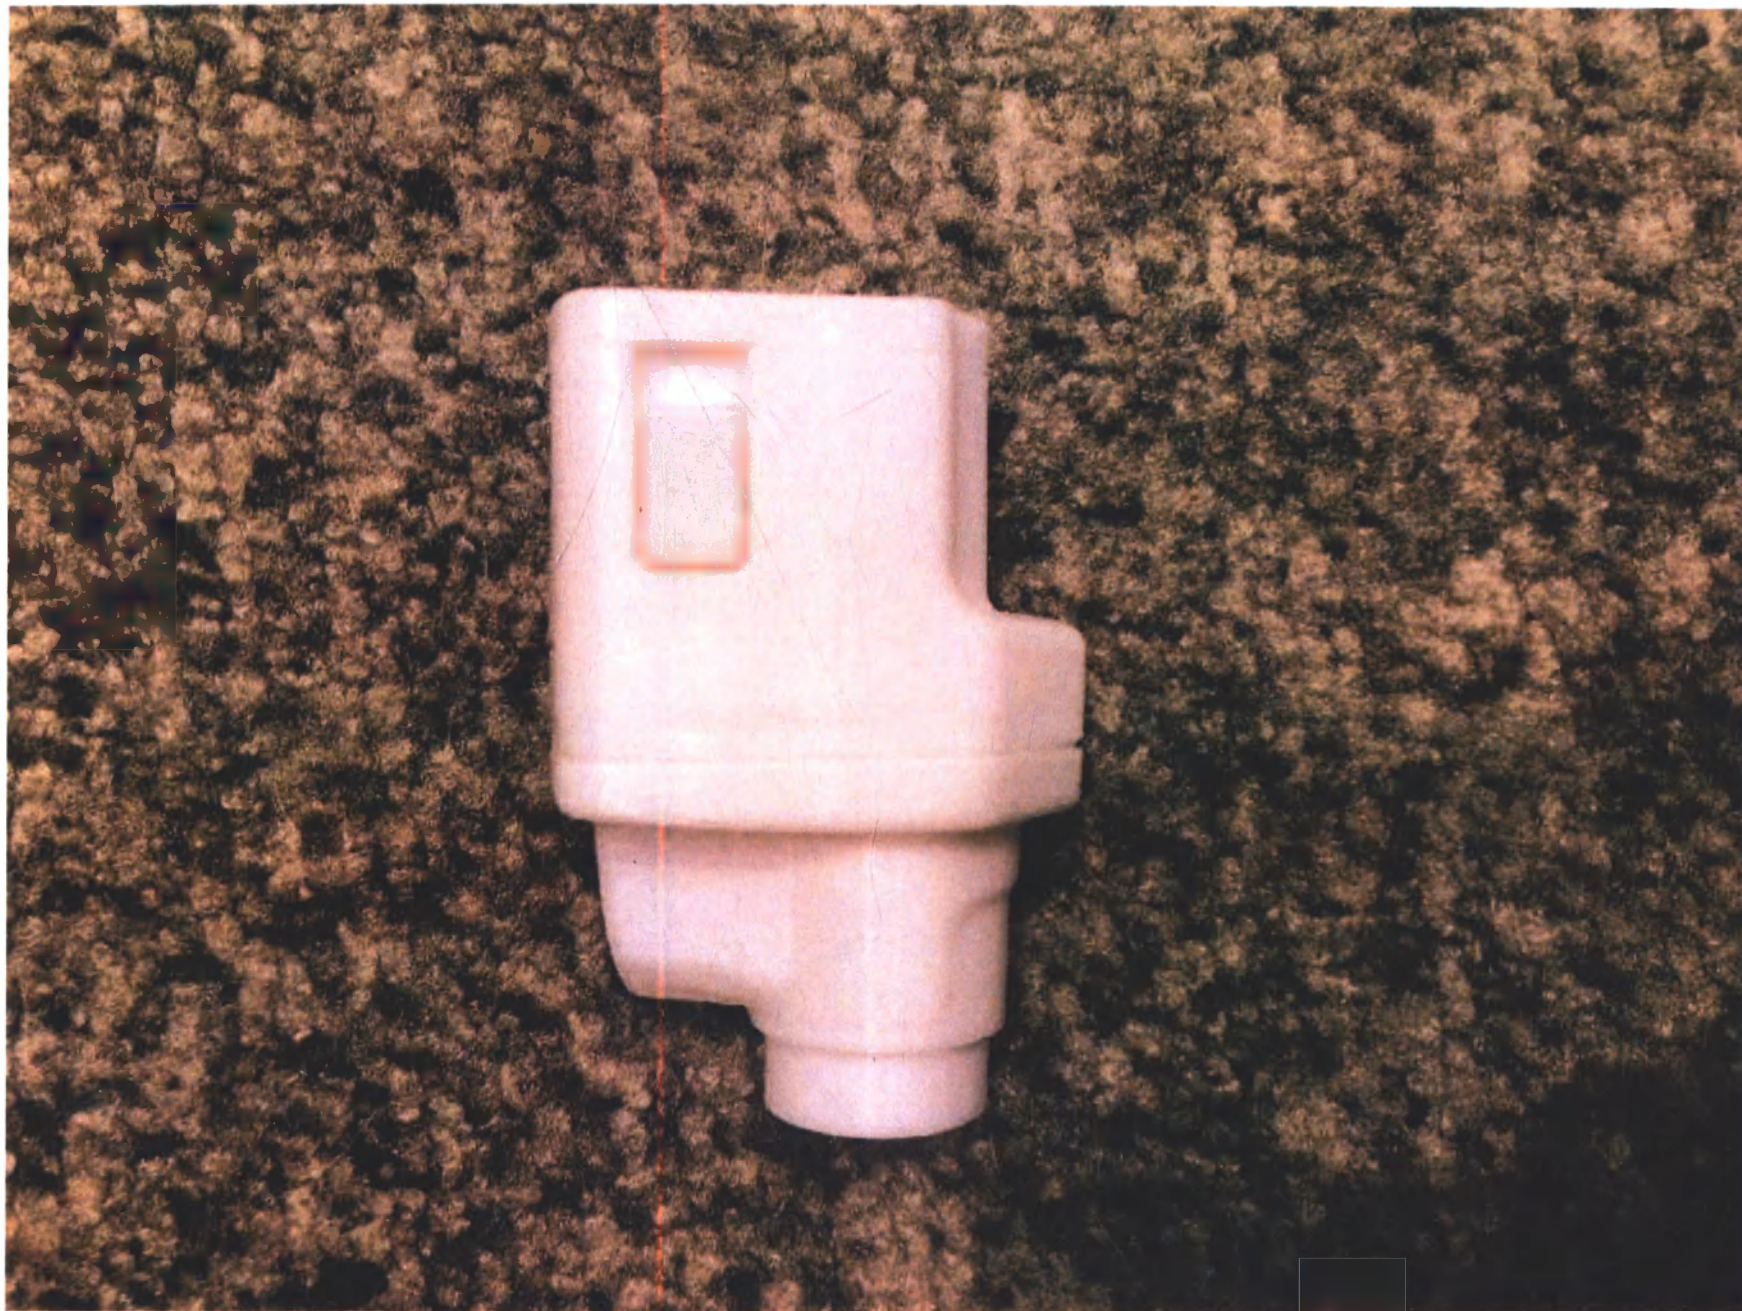




- программное обеспечение VivoSpiro[®] Clinic Software (USB 2.0 флеш-накопитель или компакт-диск) (при необходимости);






— стартовый набор картриджей — не более 2 шт. (при необходимости);

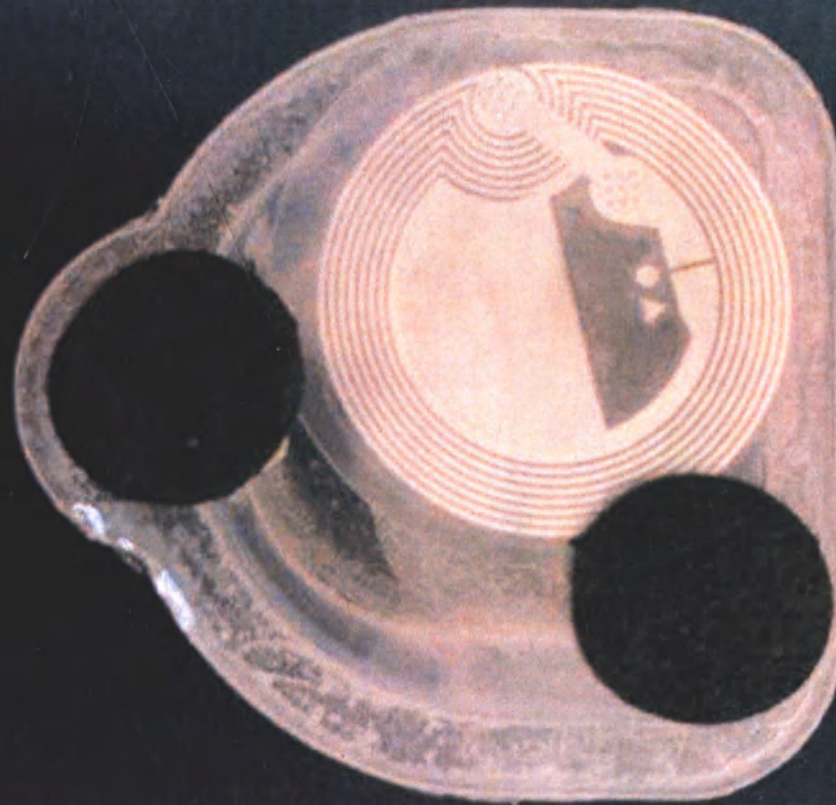

- устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии; 31. Аэрозольные маски для взрослых, для детей с носовым зажимом или без: лицевые; трахеостомические, по РУ № ФСЗ 2009/03551 от 20 ноября 2019 года, производства «Интерсерджикал Лдт», Великобритания– не более 100 шт. (при необходимости);

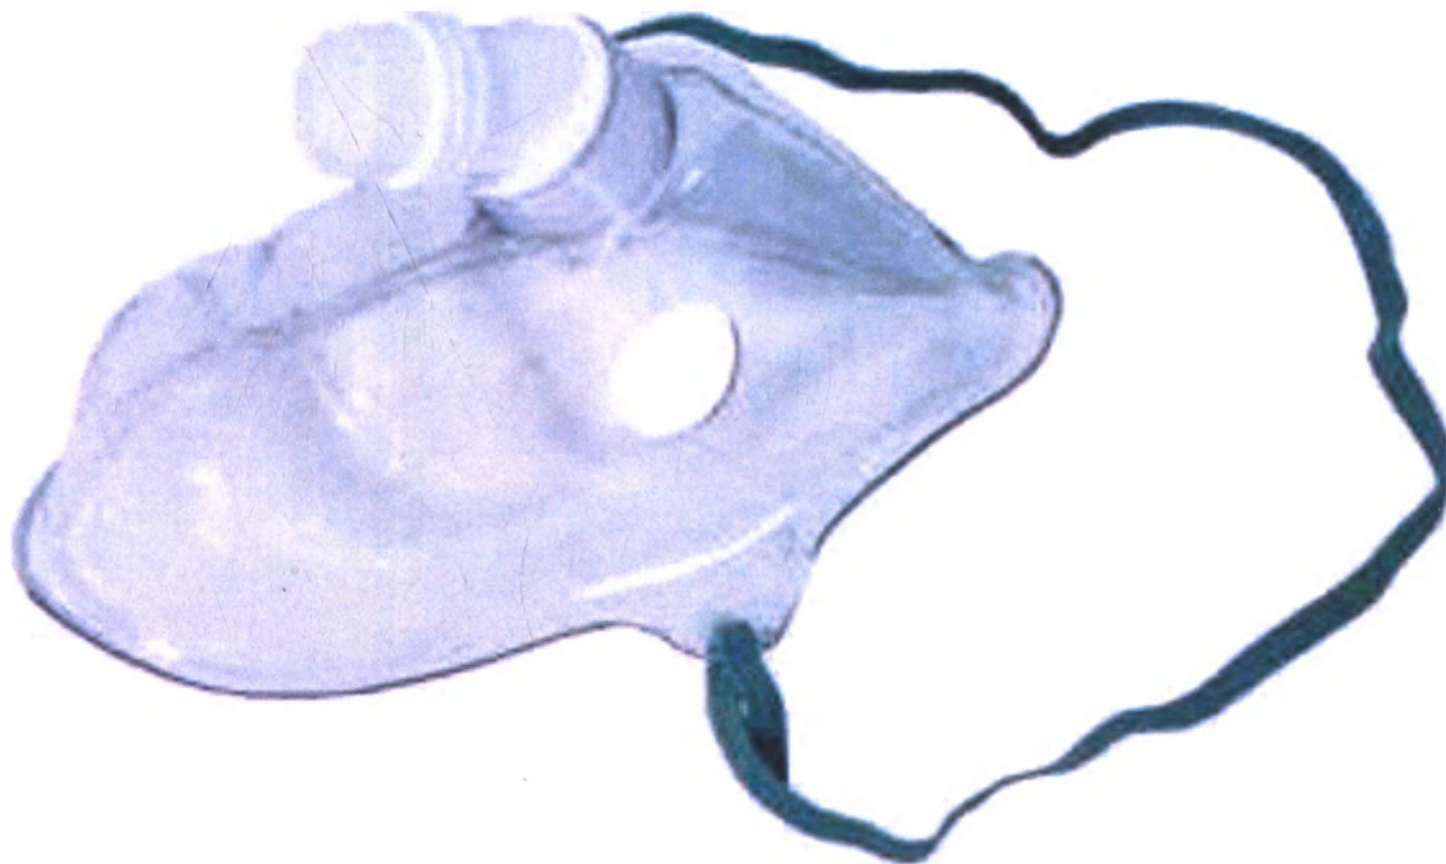

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный Инновационный внедренческий центр» Российская Федерация, город Москва, территория Сколково инновационного центра, Большой бульвар, д. 42, стр.1, эт. 0, пом. 149, раб. 7 Phone: +7 (383) 363-23-45, E-mail: info@pm-hm.ru		
Руководство по эксплуатации	Ингалятор ультразвуковой цифровой VivoSpiro® PM&HM модель «MVS01» с принадлежностями по ТУ 26.60.13-002-01813706-2020	Стр. 1 из 35
		Версия 2
		<i>Утверждено</i> <i>Генеральный директор</i> <i>ООО «НП ИВЦ»</i> <i>О.Р. Абдиев</i> <i>«15» мая 2020г.</i>

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИНГАЛЯТОР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЦИФРОВОЙ VIVOSPIRO® PM&HM МОДЕЛЬ «MVS01» С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ ПО ТУ 26.60.13-002-01813706-2020


ООО «НП ИВЦ», ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.

Принадлежности:

- стандартный кабель USB 2.0 типа A – B, для подключения к персональному компьютеру;



- стандартный кабель USB 2.0 типа C – C, для подключения модуля генерации к базовому блоку;

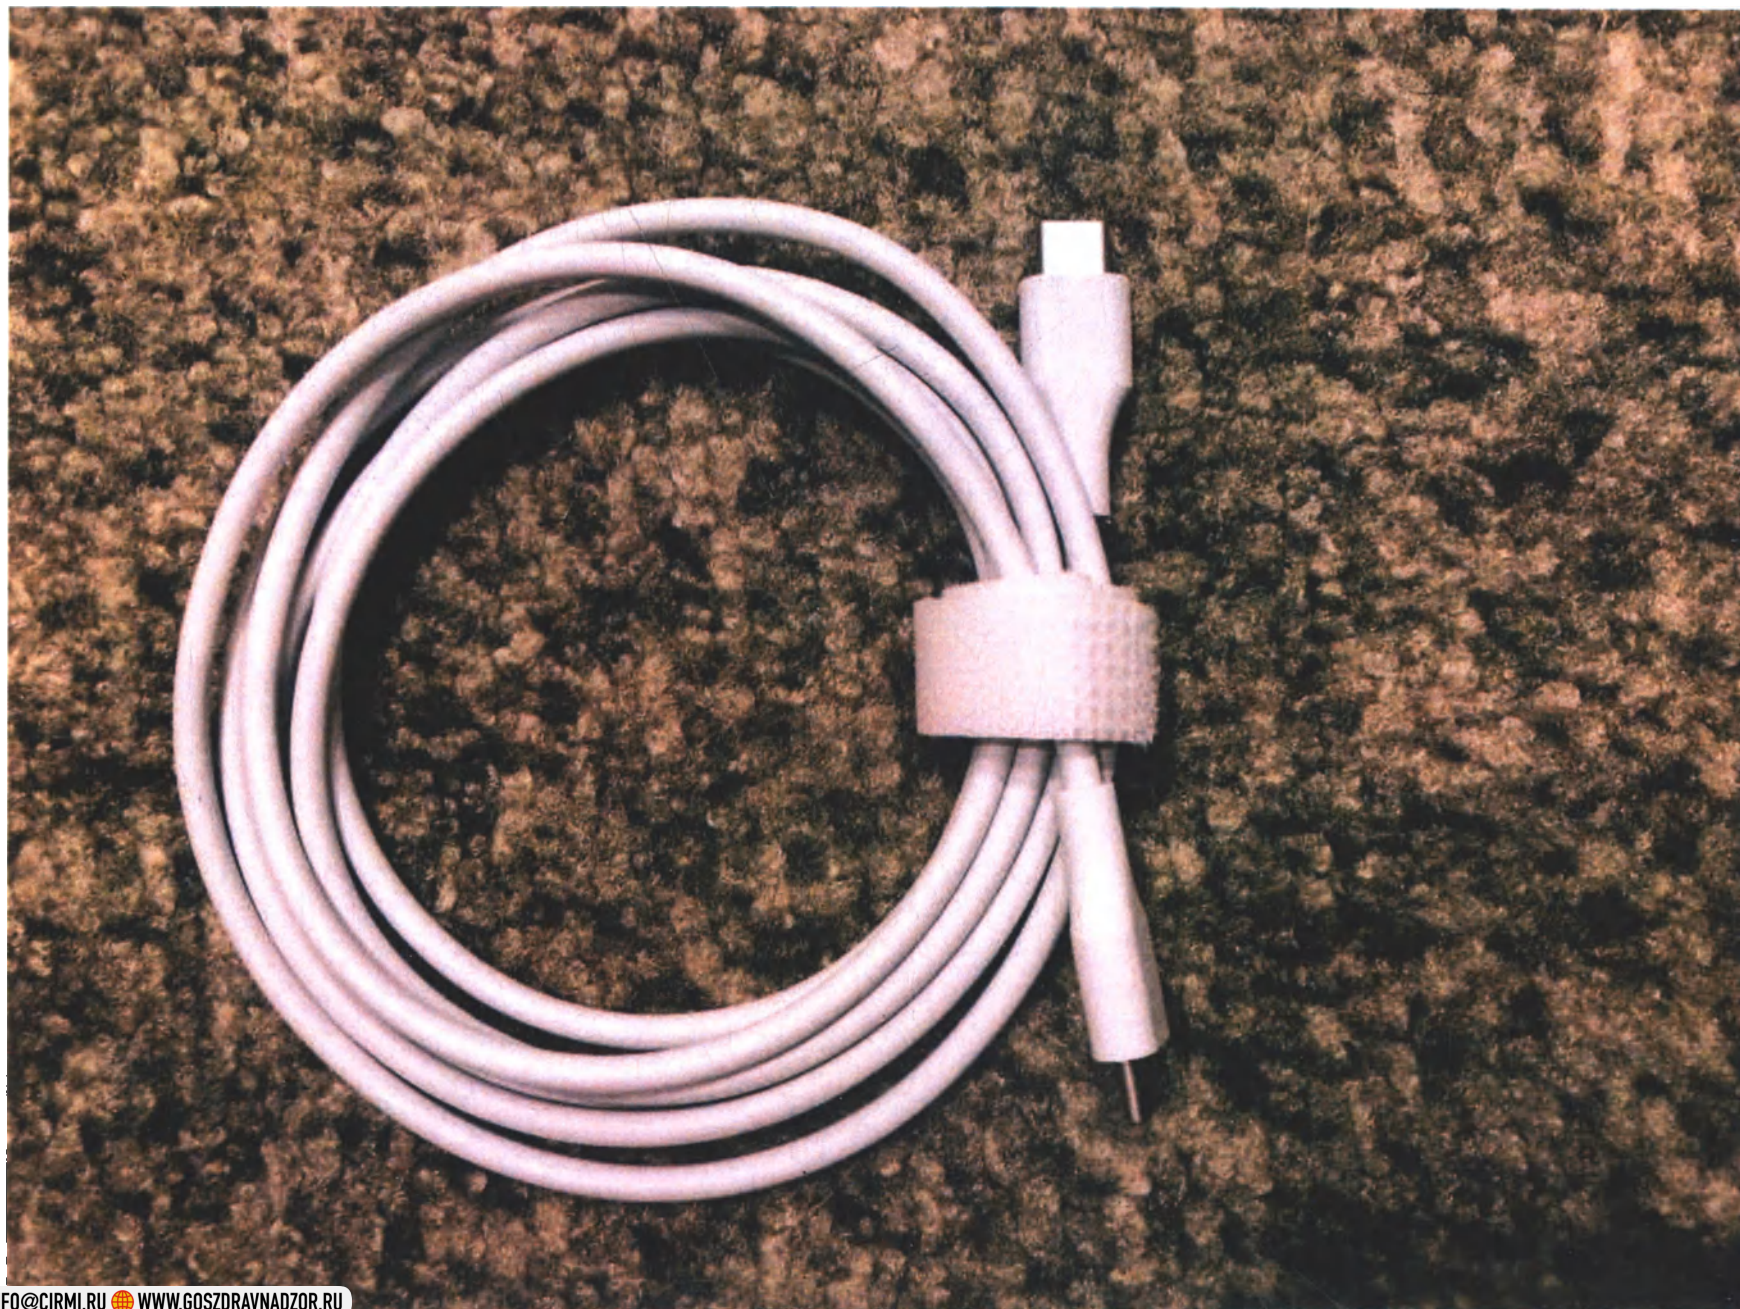


– сменный узел с мембраной.







Макет потребительской упаковки

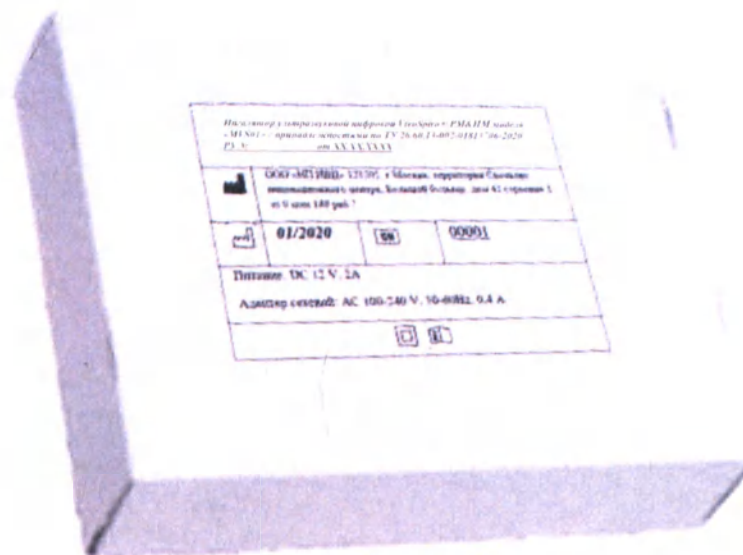

Наименование медицинского изделия			
<u>РУ №</u> <u>от XX.XX.XXX</u>			
	ООО «НП ИВЦ» 121205, г.Москва, территория Сколково инновационного центра, Большой бульвар, дом 42 строение 1, эт 0 пом 149 раб 7		
	мм/гггг		
Питание: DC 12 V, 2A			
Адаптер сетевой: AC 100-240 V, 50-60Hz, 0,4 A			
 			

Примено
и пронумеровано
20 (двадцать)
листов.

