

Руководитель направления по регистрации
продукции для *in vitro* диагностики, биохимия
и портативные системы в диагностике



____ Тышкунова Е.С.

« 16 » февраля 2023 г.

Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики *in vitro*

Дилуент IMT для анализаторов биохимических серии Atellica (A-LYTE IMT Diluent (IMT Diluent))

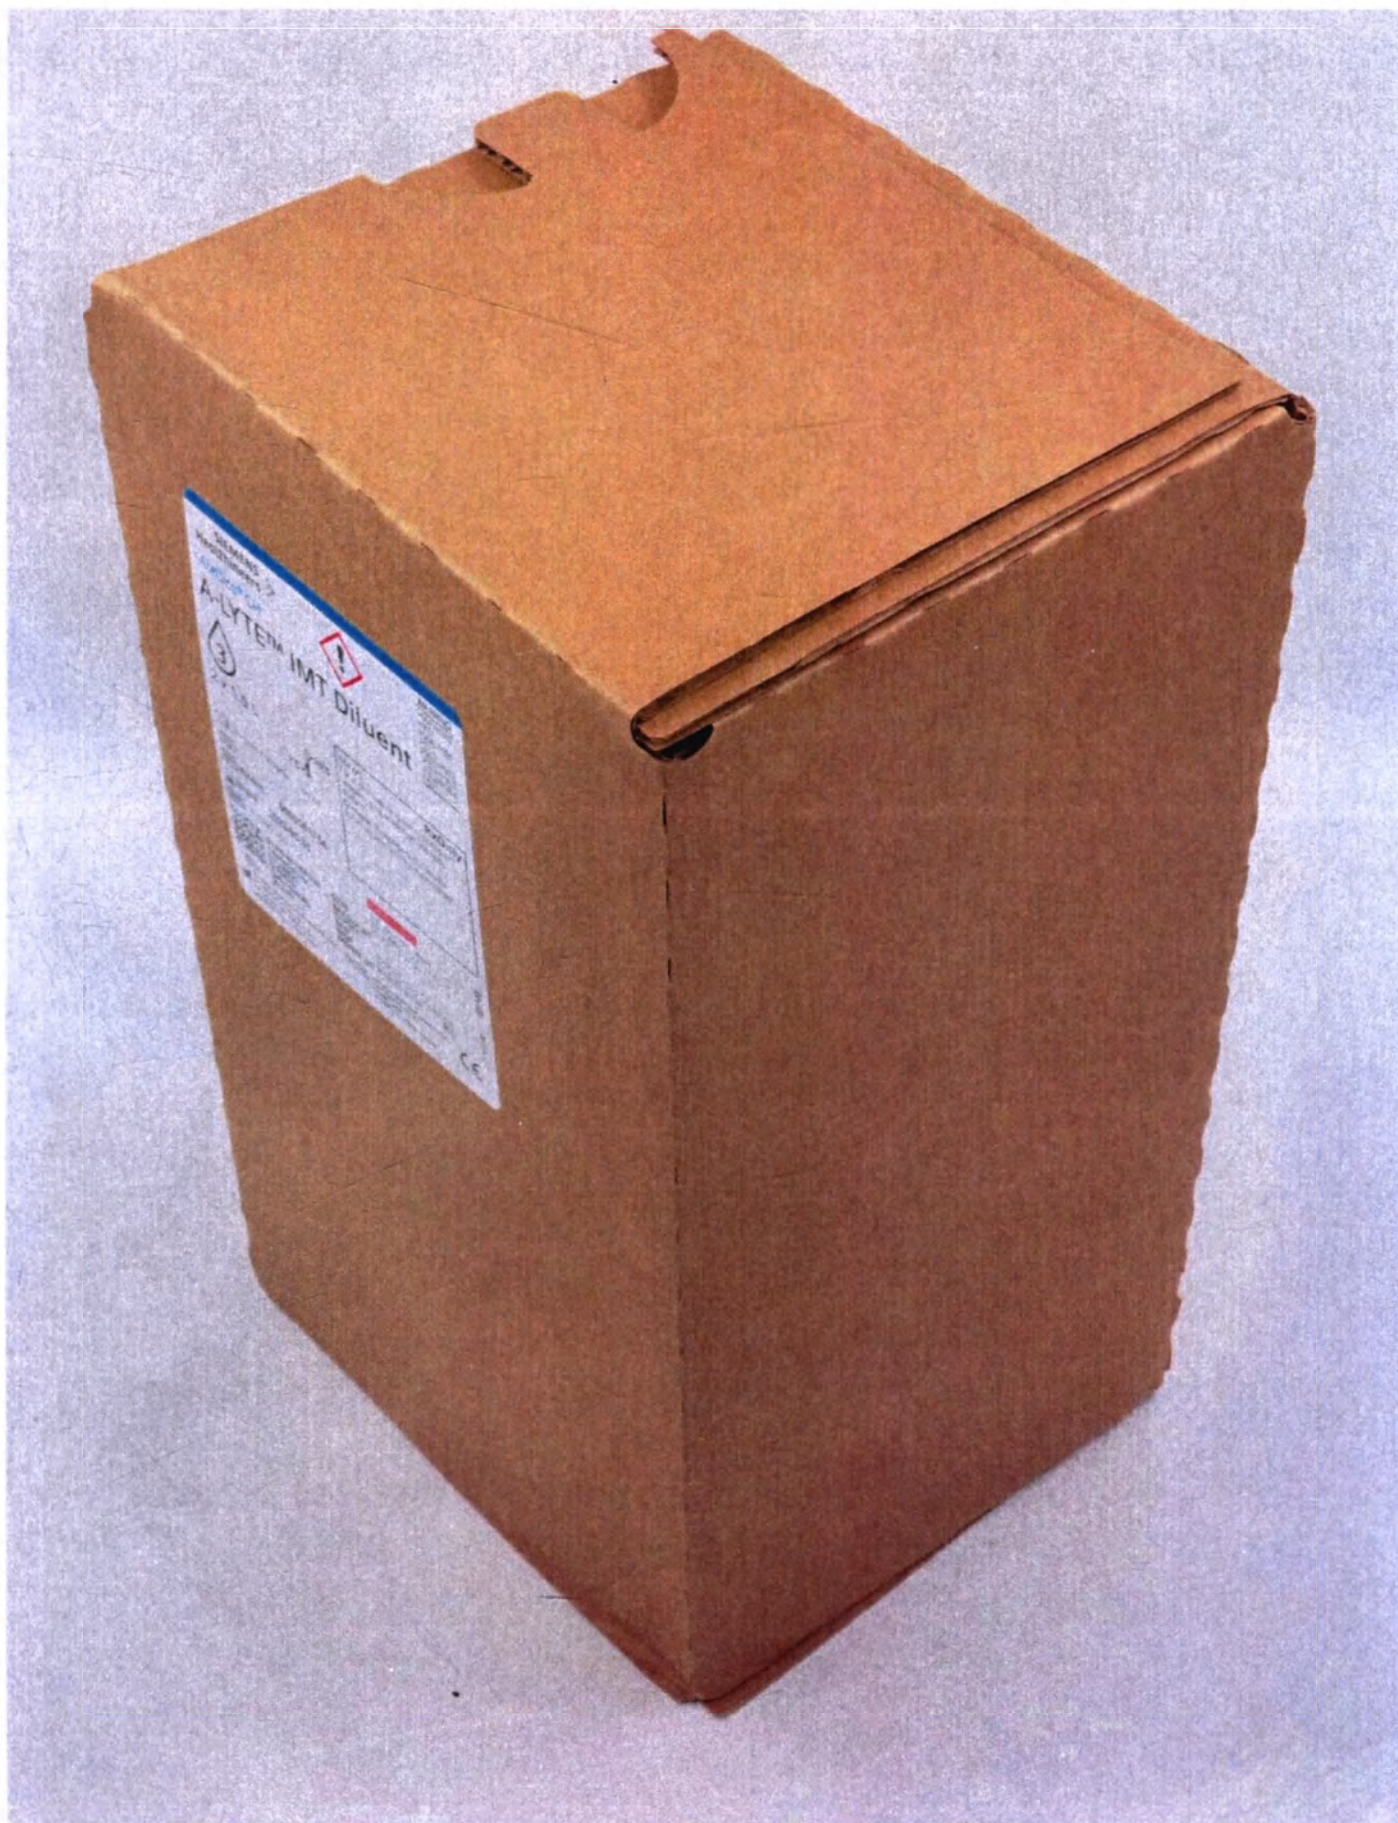


Рисунок 2. Дилуэнт IMT для анализаторов биохимических серии Atellica (A-LYTE IMT Diluent (IMT Diluent)): общий вид

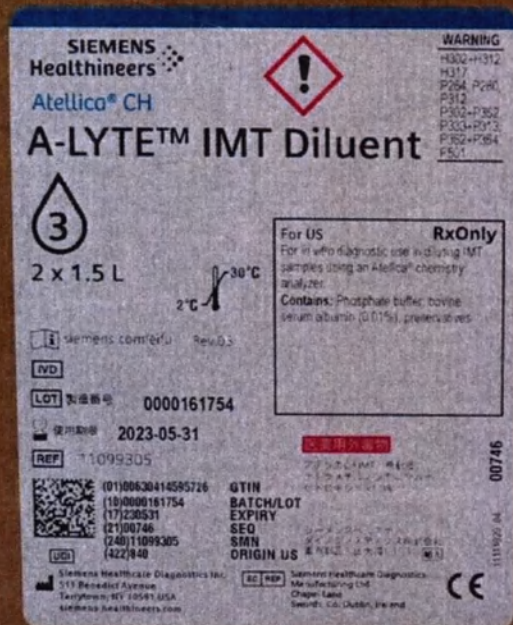


Рисунок 2. Дилуэнт IMT для анализаторов биохимических серии Atellica (A-LYTE IMT Diluent (IMT Diluent)), внешняя (наружная) упаковка, фронтальная сторона



Рисунок 3. Дилуэнт IMT для анализаторов биохимических серии Atellica (A-LYTE IMT Diluent (IMT Diluent)): Дилуэнт A-LYTE IMT Diluent (IMT Diluent), 1,5 литра – 2 шт., общий вид

11099305

Дилуэнт ИМТ для анализаторов биохимических серии
Atellica (A-LYTE IMT Diluent (IMT Diluent))

Информация о производителе и стране производства:
см. на упаковке

Регистрационное удостоверение:
№ РЗН 2020/11477 от 30.07.2020

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на
оригинальной упаковке

Инструкция по применению на русском языке Rev. 02

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению

Авторизованный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96

Рисунок 4. Дилуэнт ИМТ для анализаторов биохимических серии Atellica (A-LYTE IMT Diluent
(IMT Diluent)): макет маркировки для Российской Федерации



Всего прошито и пронумеровано
5 листа (ов).

ООО «Сименс Здоровоохранение»

