


Руководитель отдела качества и
корпоративных технологий


Медведева И.Б.
«18» марта 2020 г.



Фотографические изображения медицинского изделия

Анализатор автоматический биохимический Atellica CH 930, в вариантах исполнения, с принадлежностями

**производства «Сименс Хелскеа Диагностикс Инк.»,
Siemens Healthcare Diagnostics Inc.**

2020

1. Анализатор — автоматический биохимический Atellica CH 500; вариант исполнения 1, в составе:




1. ж анализатора автоматического биохимическ Atellica CH 930.




2. Комплектующие для анализатора автоматического биохимического Atellica CH 930:
2.1. Узлы крыльчатки миксера (не более 6 шт.) (при необходимости);




2.2. Иглы реагента (не более 6 шт.);

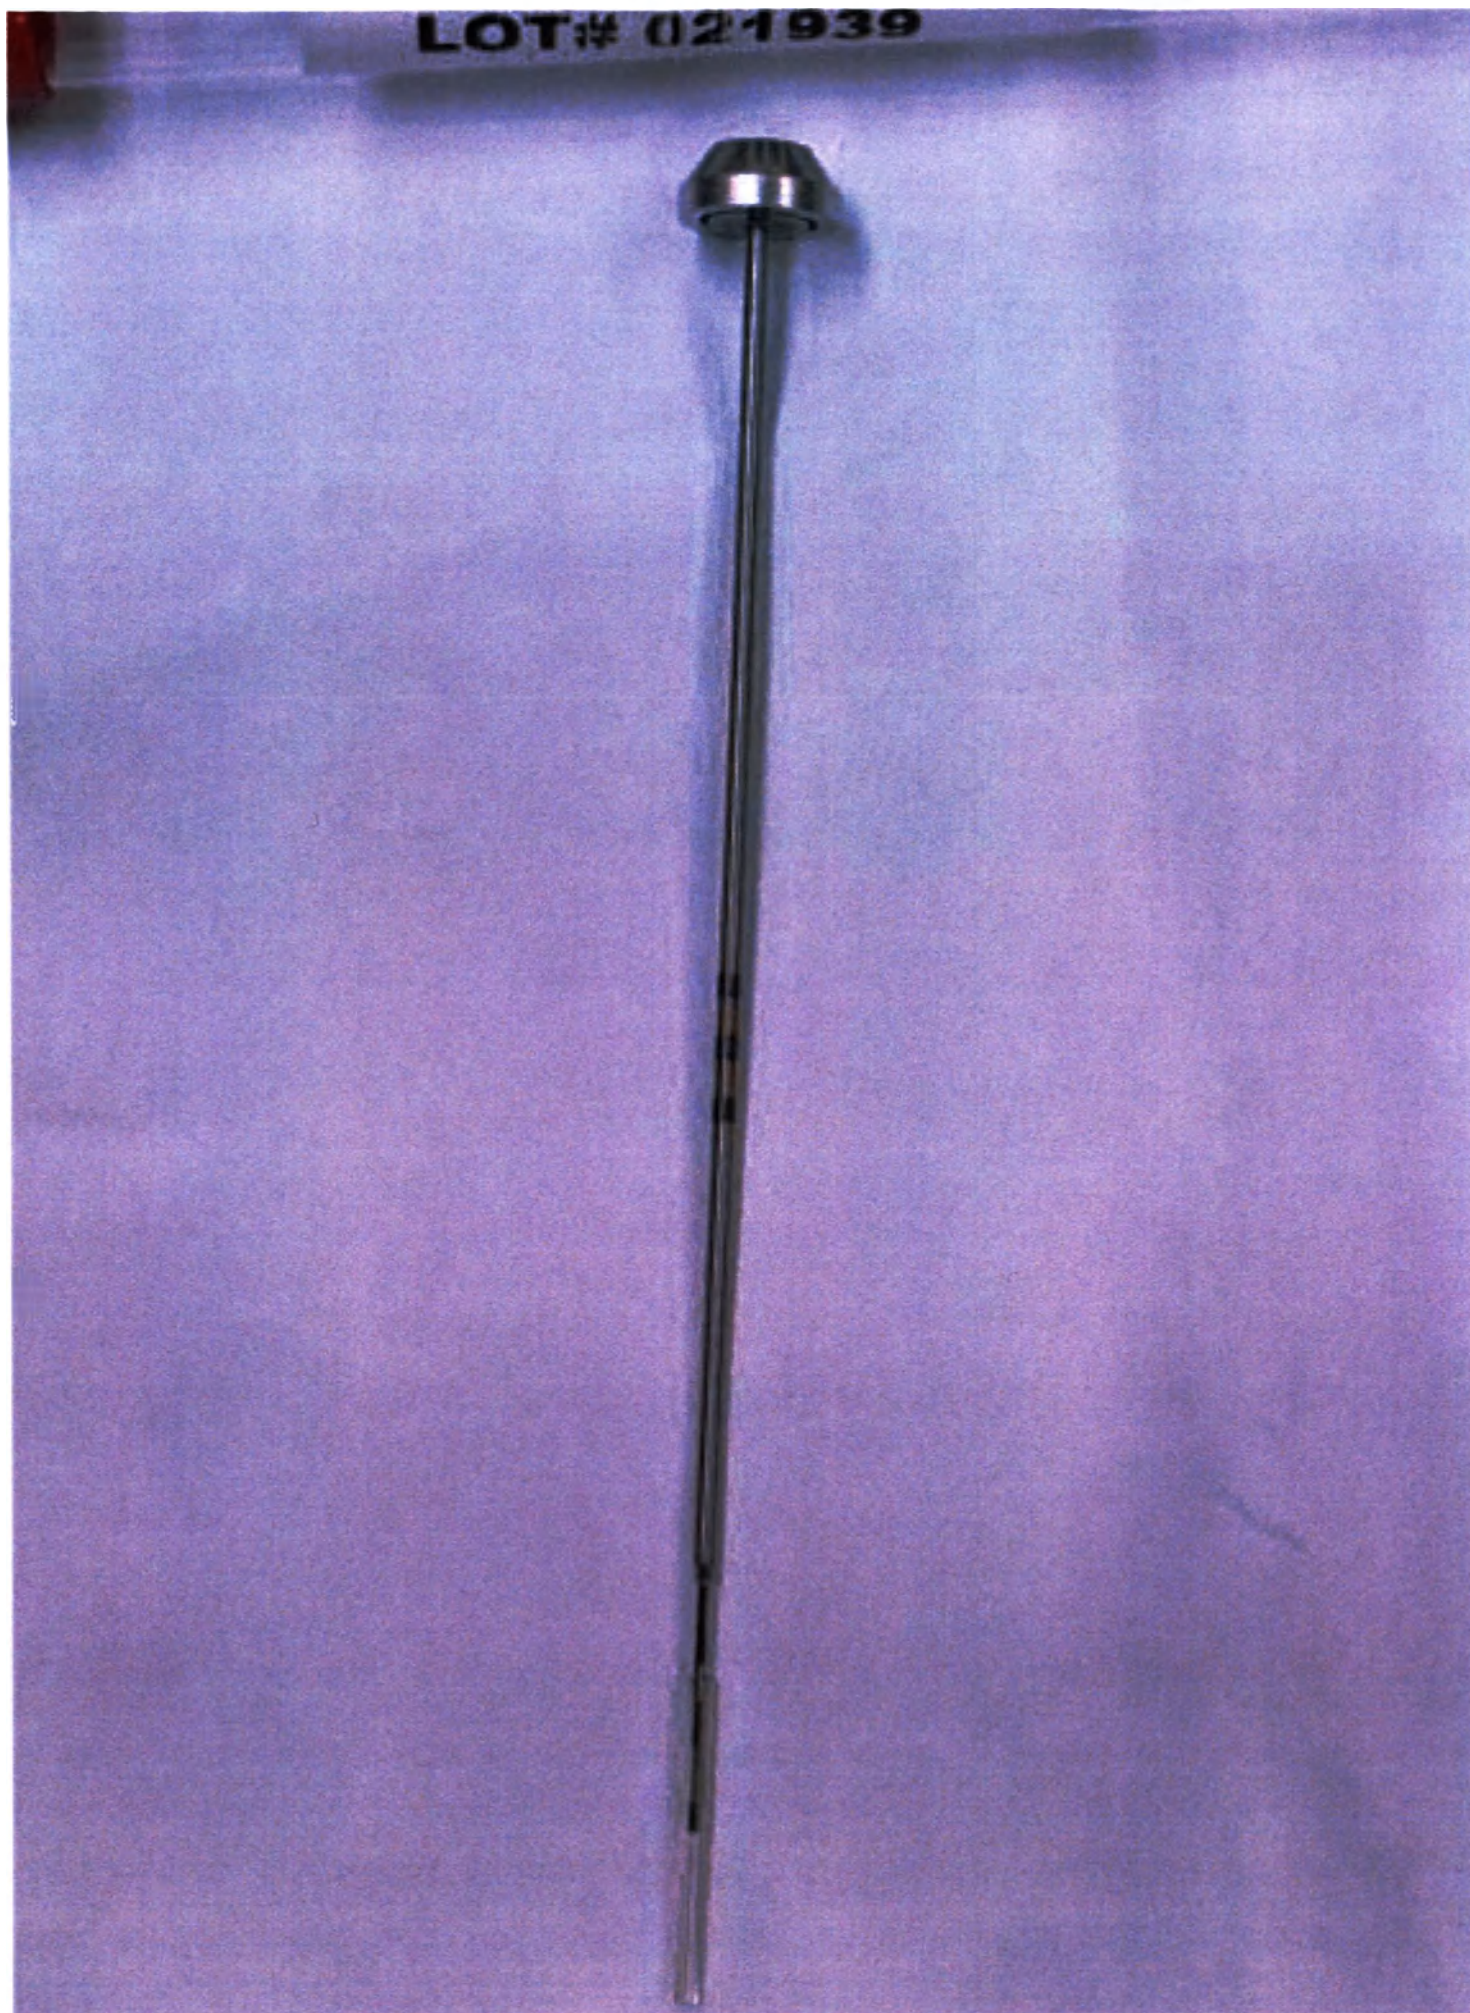


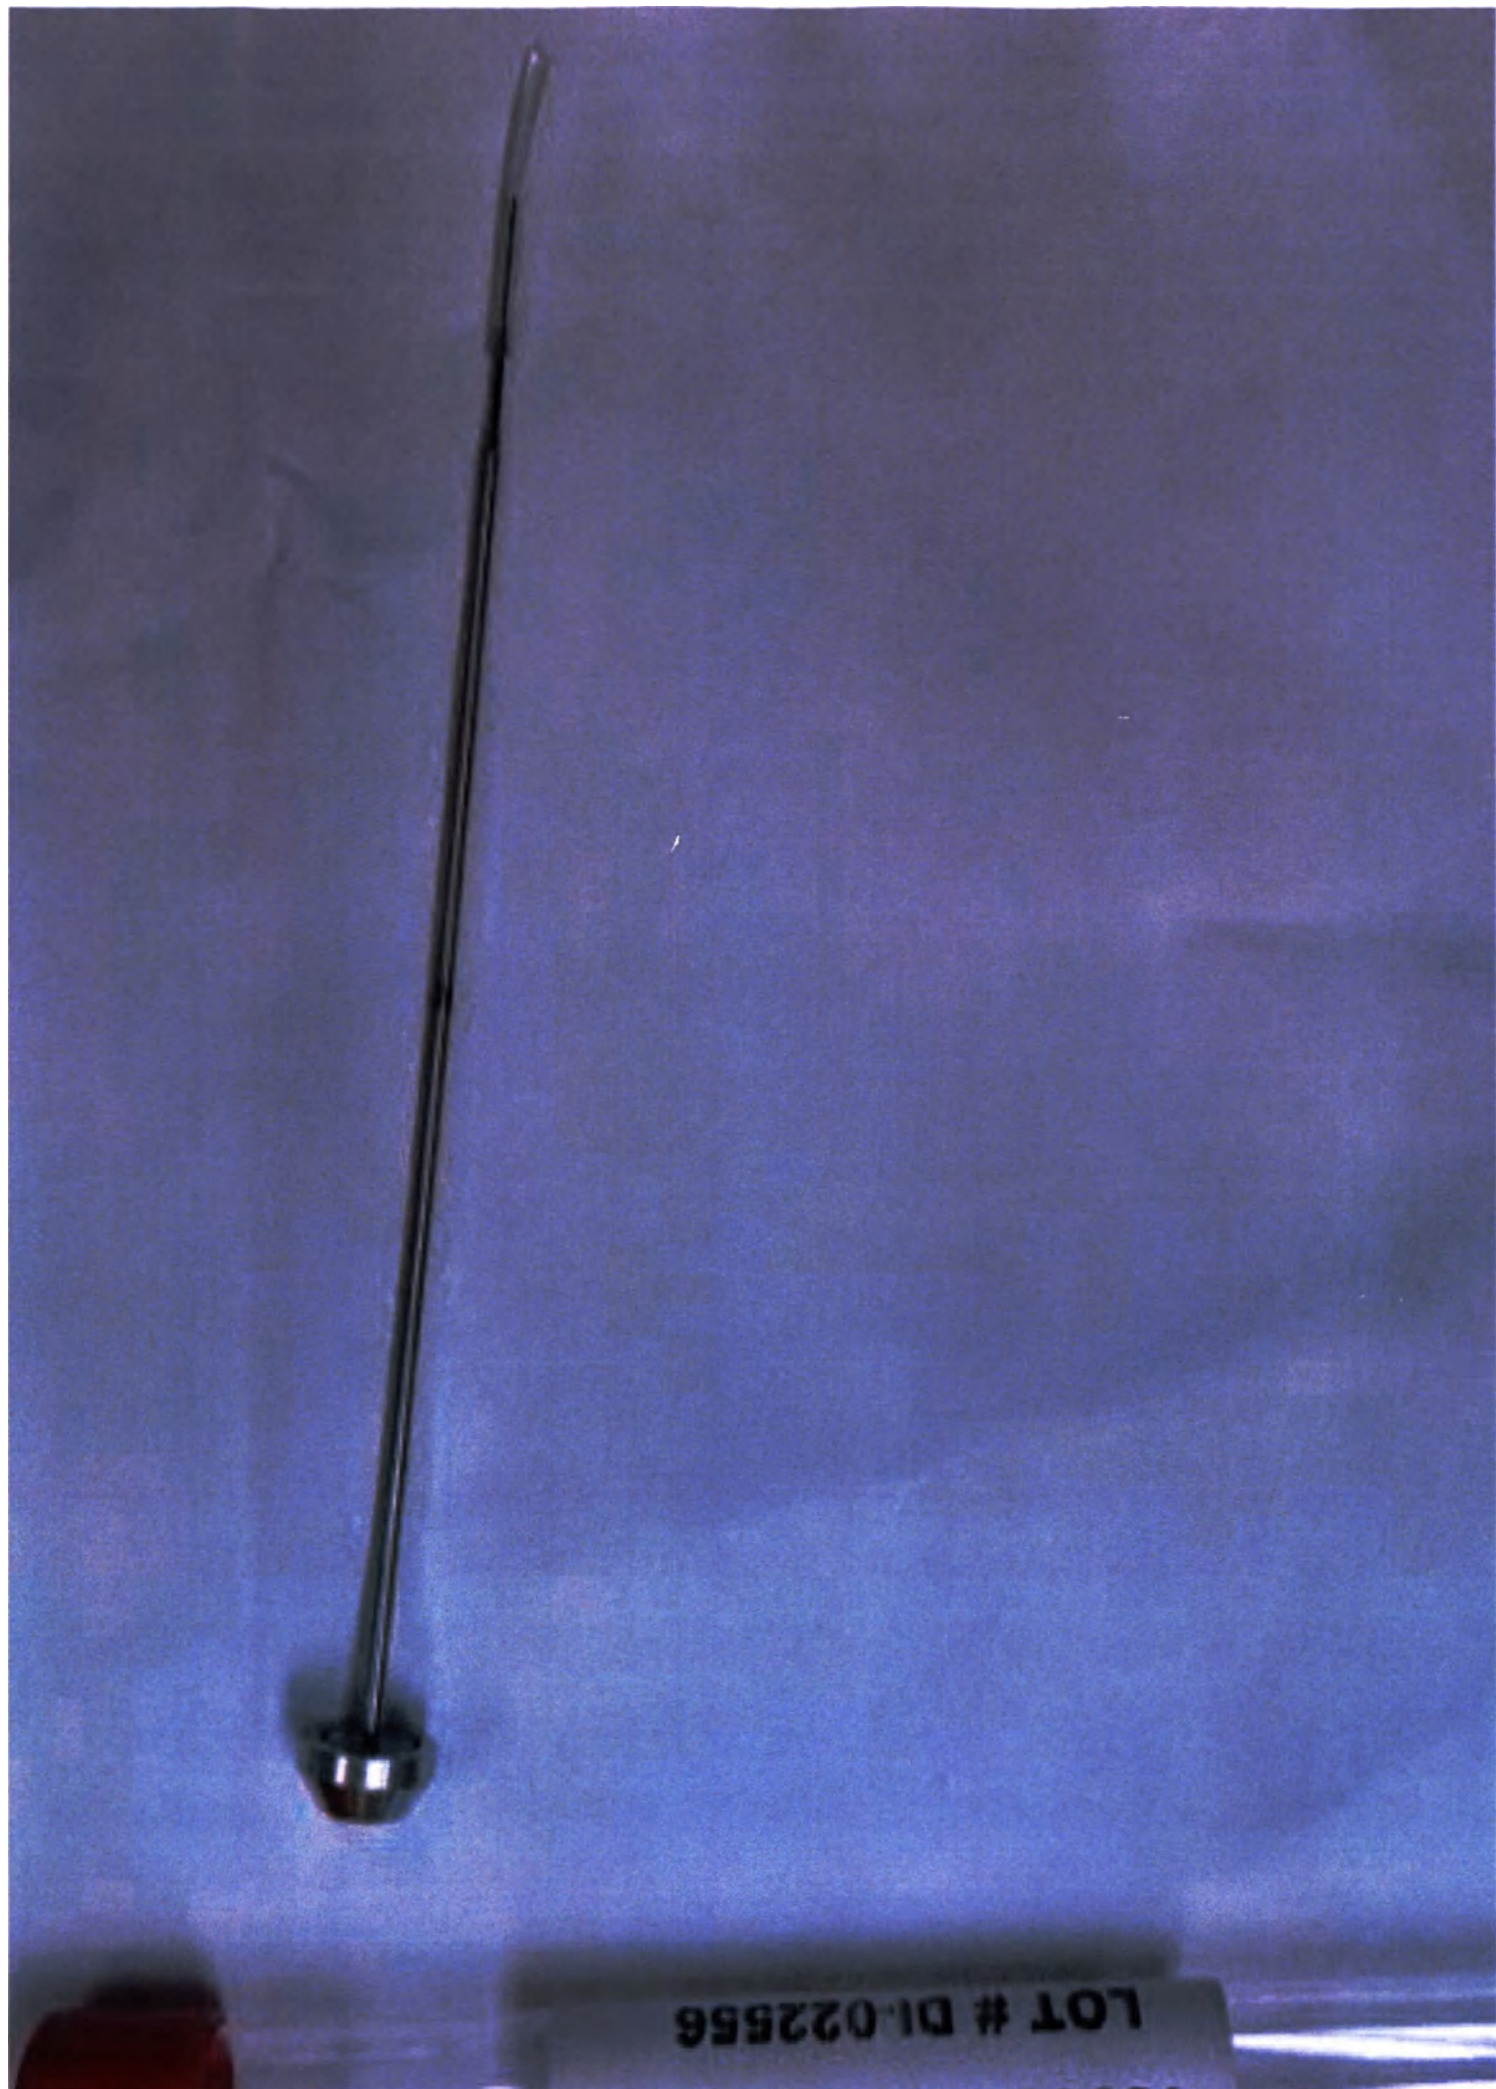


2.4. Промывочные зонды одинарные (не более 4 шт.) (при необходимости);

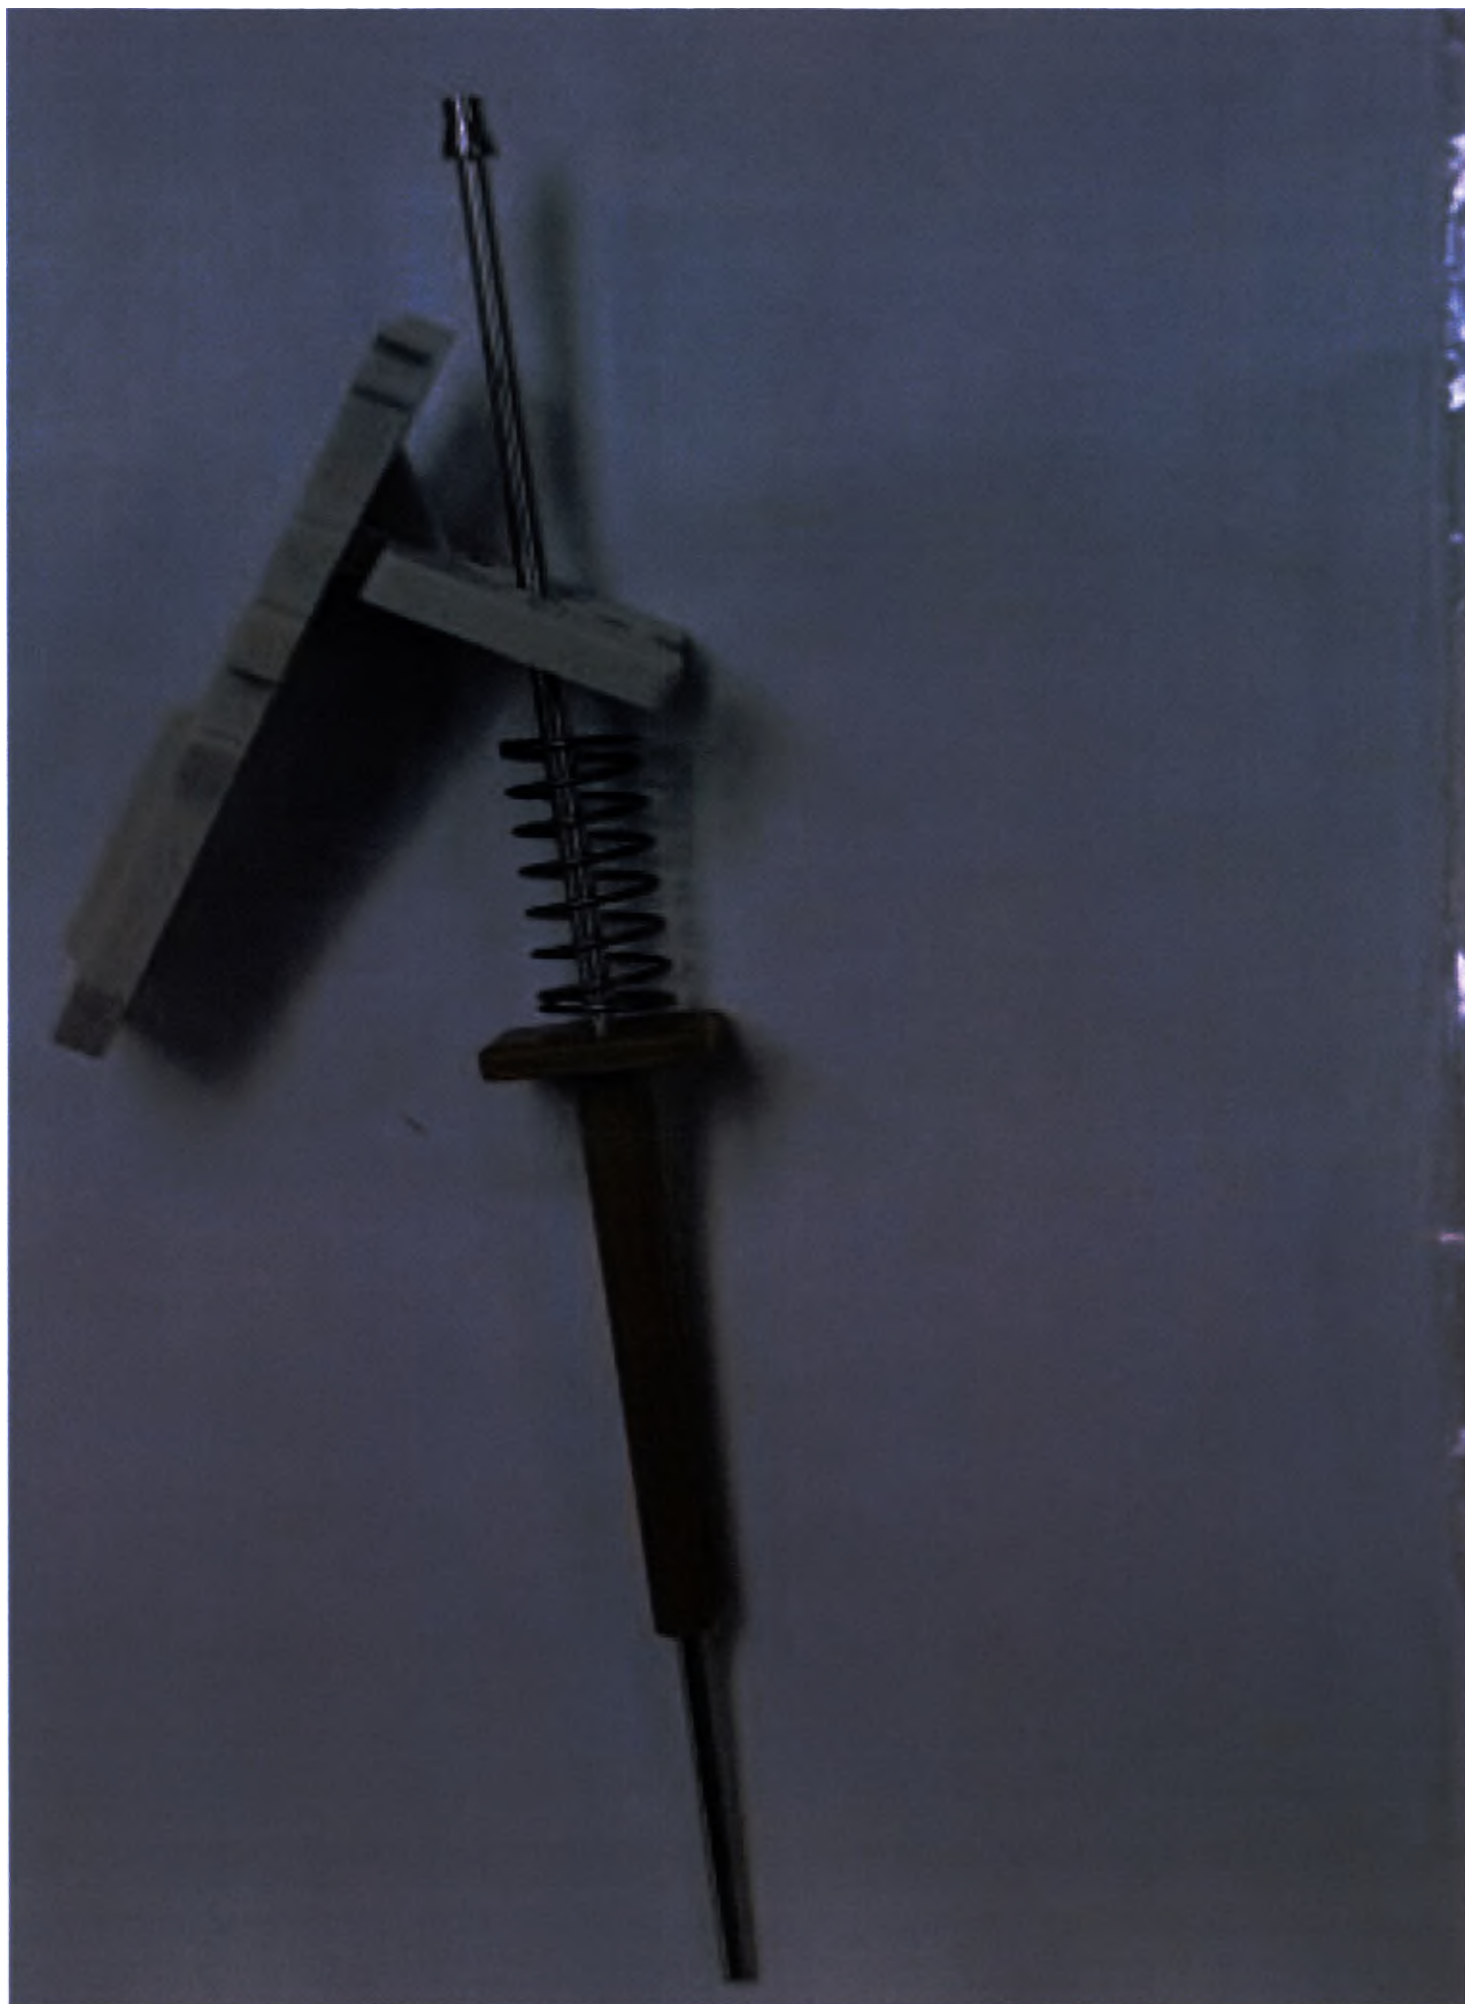

2.5. Сенсоры оптические (не более 2 шт.);

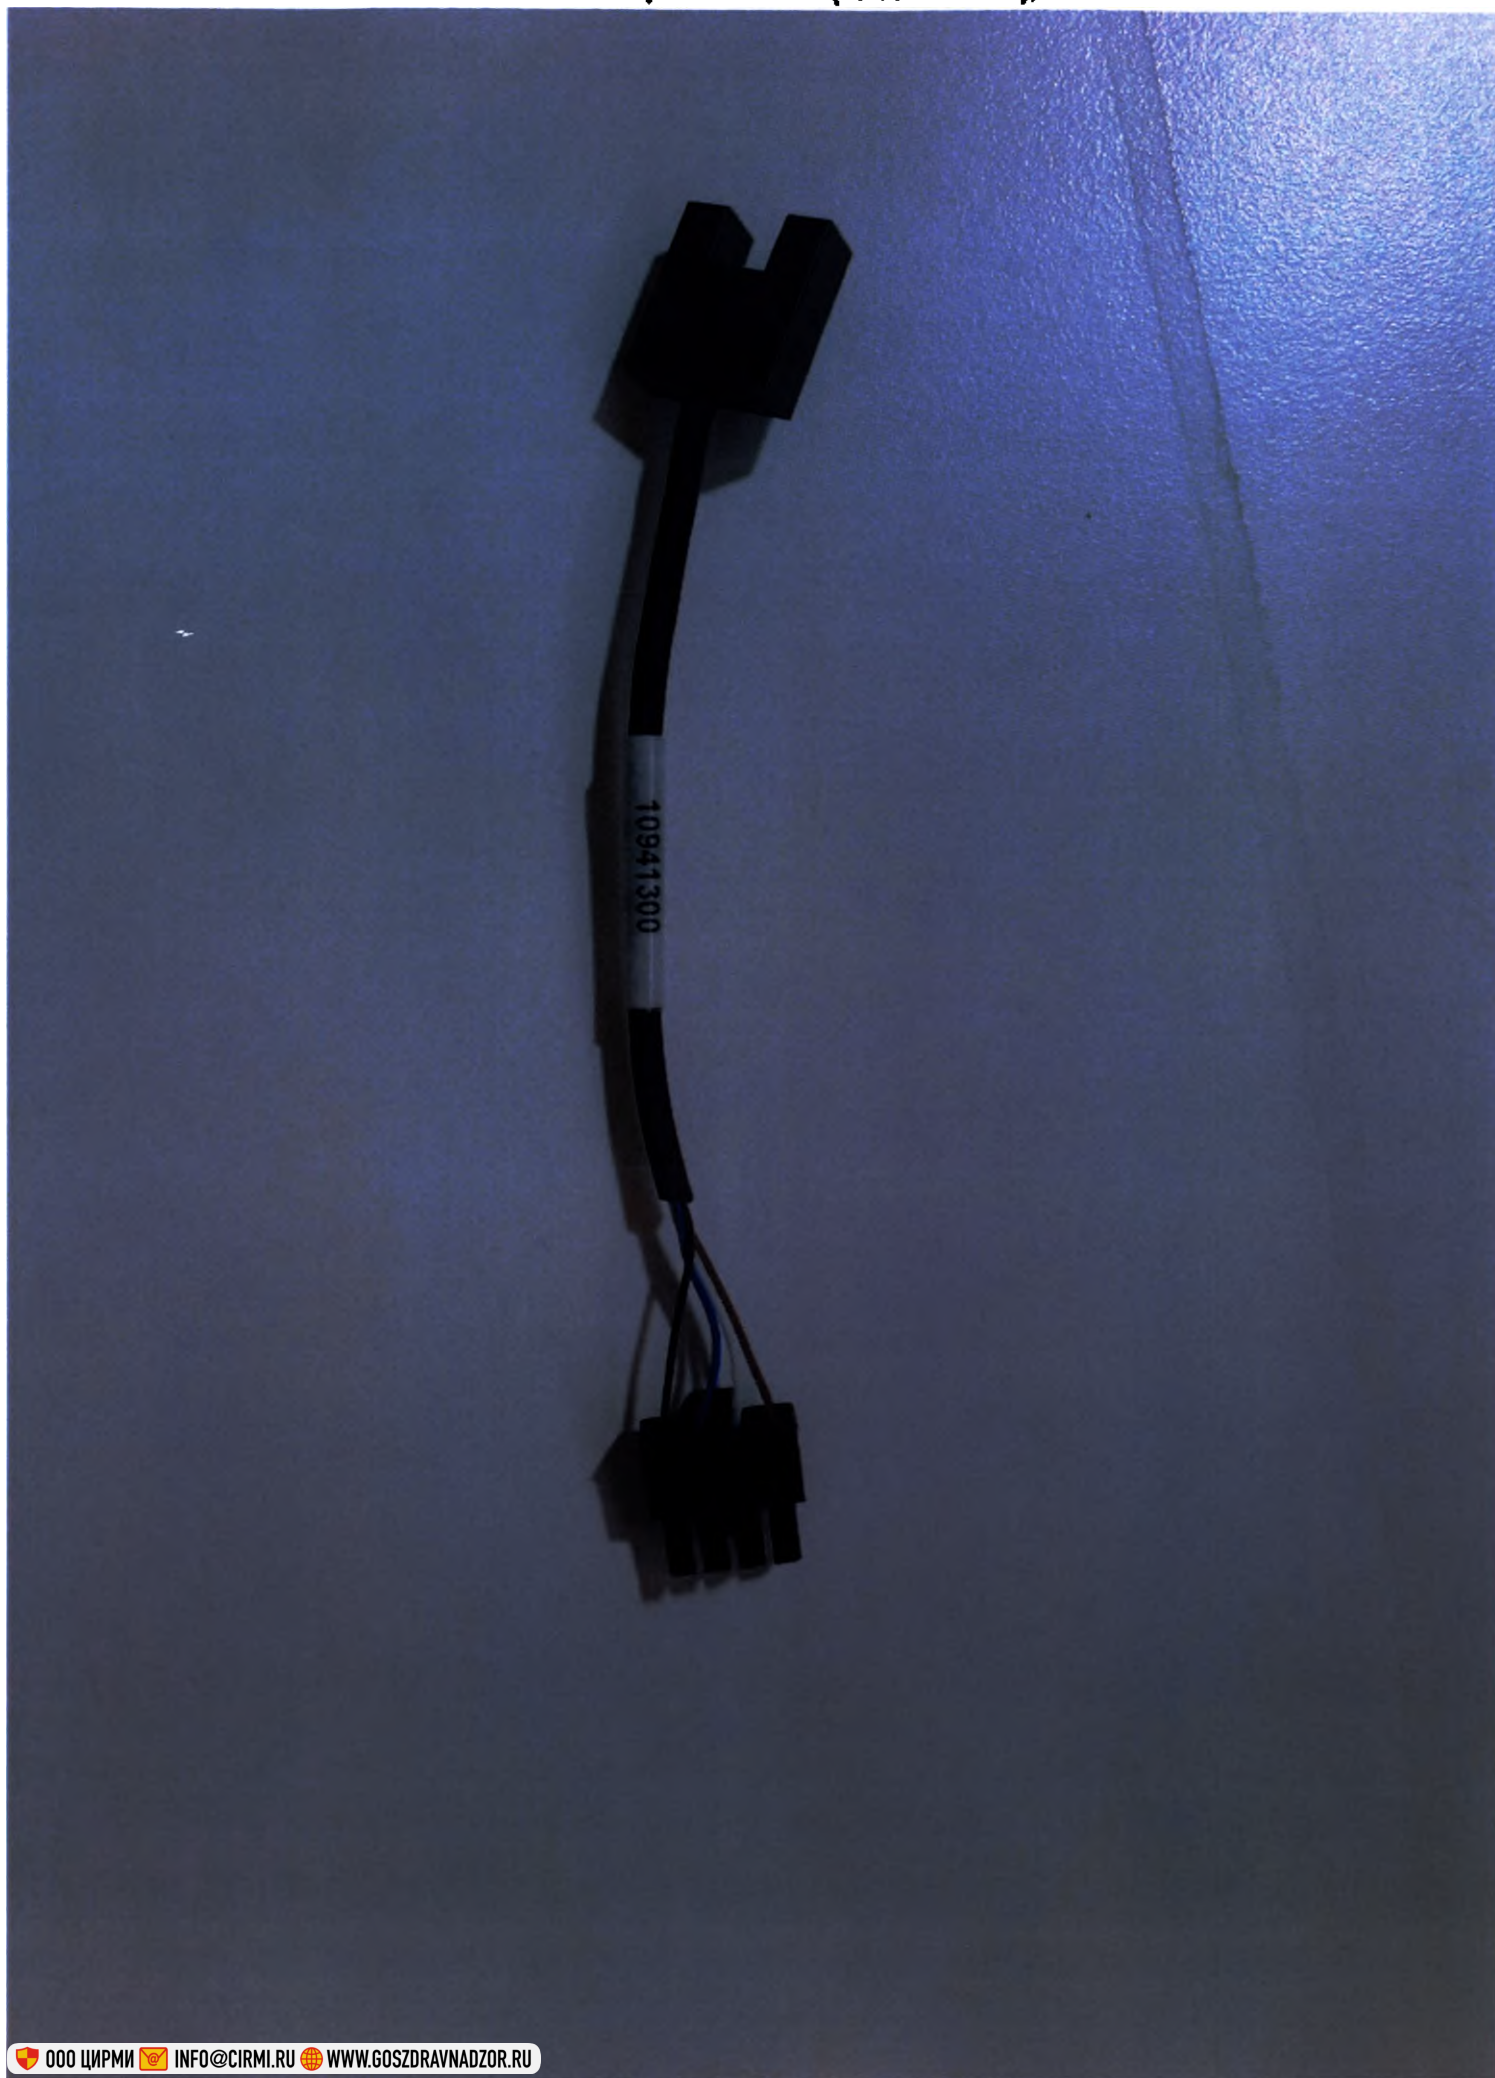

2.6. Зонды промывочные вакуумные (не более 6 шт.) (при необходимости);

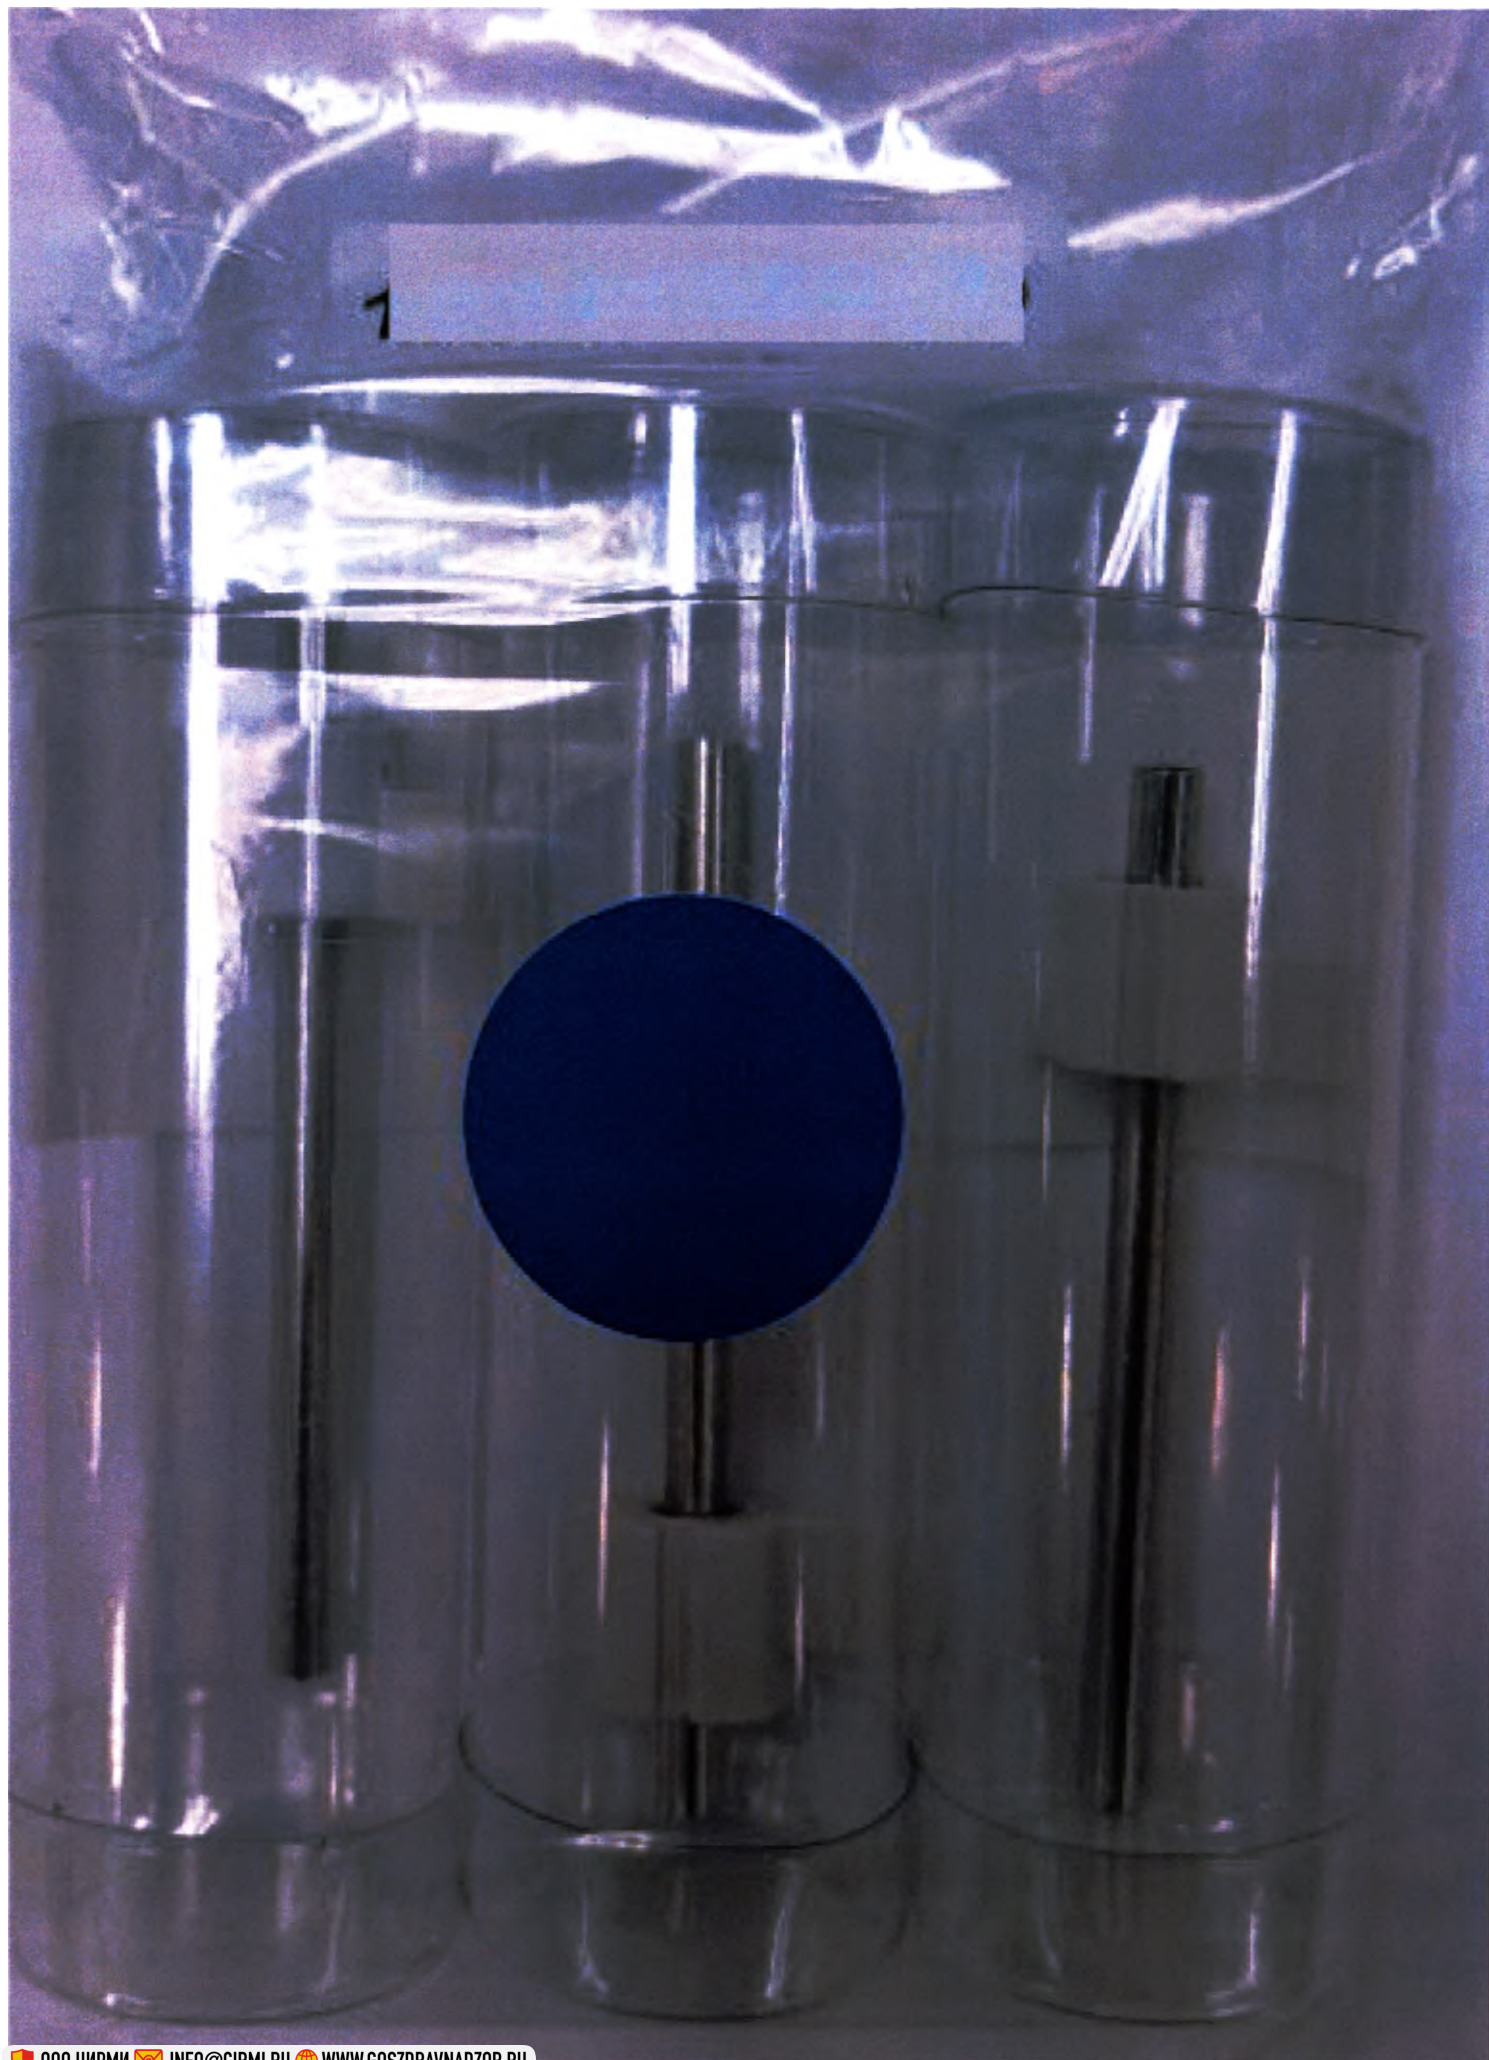

2.7.5 ы промывочные тройные (не более 20 шт.) (и необходимости);




2.8. Лампы галогеновые (не более 2 шт.);



2.9. Сенсоры U (не более 4 шт.);



10. Трубки для перистальтической помпы (не менее 2 шт.);

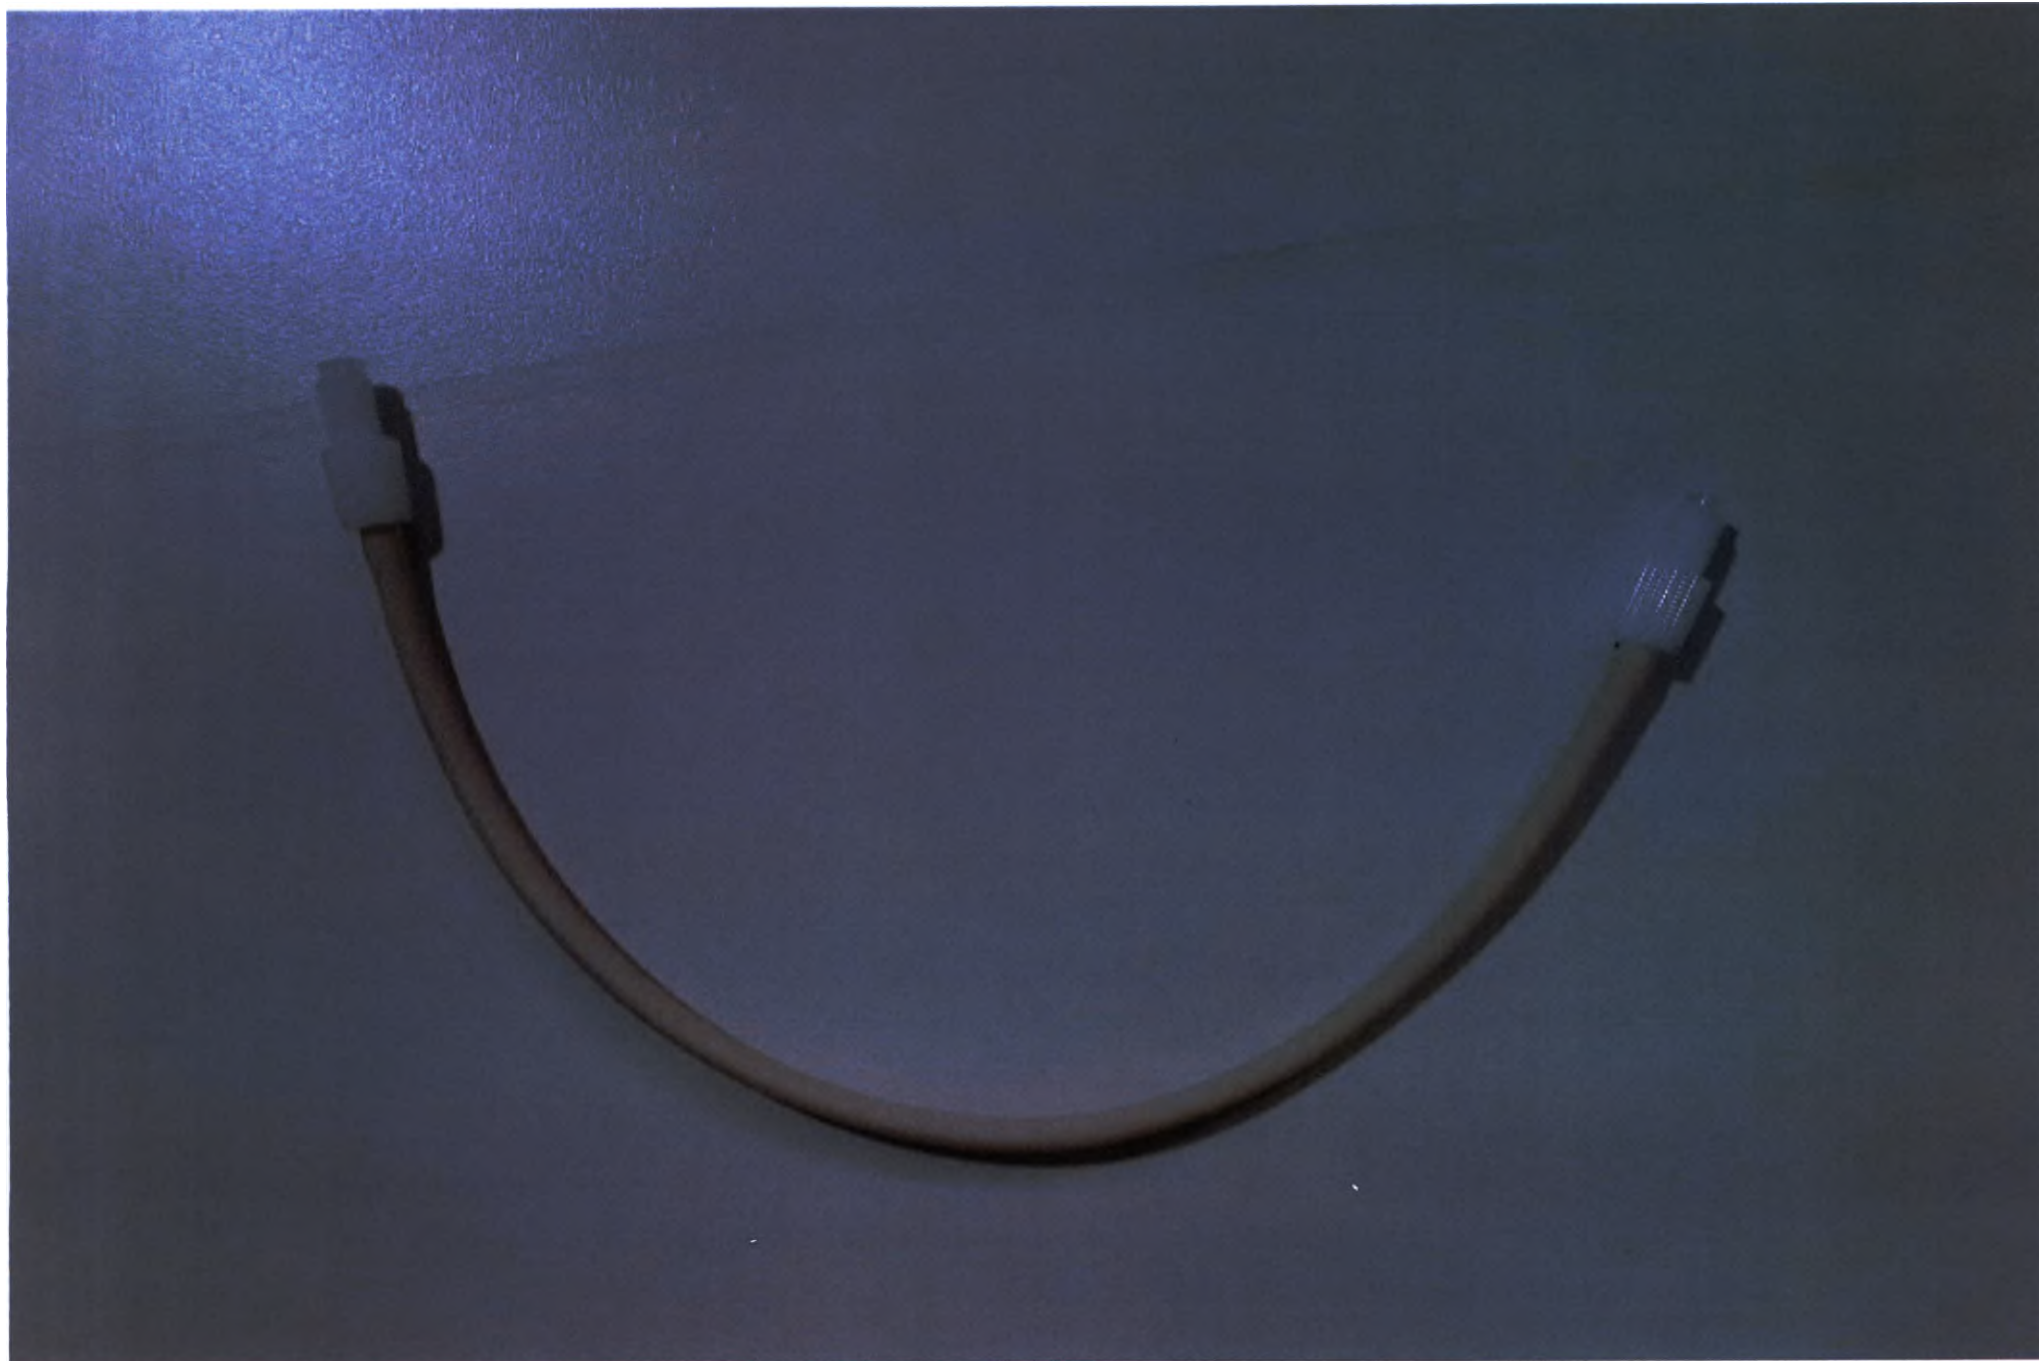

2.11. Оптодатчики L (не более 2 шт.;



2.12. Сенсоры L (не более 4шт.);



2.13. —звечники вакуумного зонда (не более 8 шт.) (г — необходимости);



2.14. Пружины (не более 6 шт.) (при необходимости);





2.10. Изучен был инвентарный номер (на упаковке 2 шт.).





siemens-healthineers.com

Анализатор автоматический биохимический Atellica® CH 930

Руководство пользователя



II. Анализатор автоматический биохимический Atellica CH 930, вариант исполнения 2, в составе:



1. Блок анализатора автоматического биохимического Atellica CH 930.



2. Комплектующие для анализатора автоматического биохимического Atellica CH 930:

2.1. Узлы крыльчатки миксера (не более 6 шт.) (при необходимости);



2.2. Иглы реагента (не более 6 шт.);

LOT# 021939




2.3. Иглы образцов (не более 6 шт.);

LOT # DI-022556




2.4.Промывочные зонды одинарные (не более 4 шт.) (при необходимости);

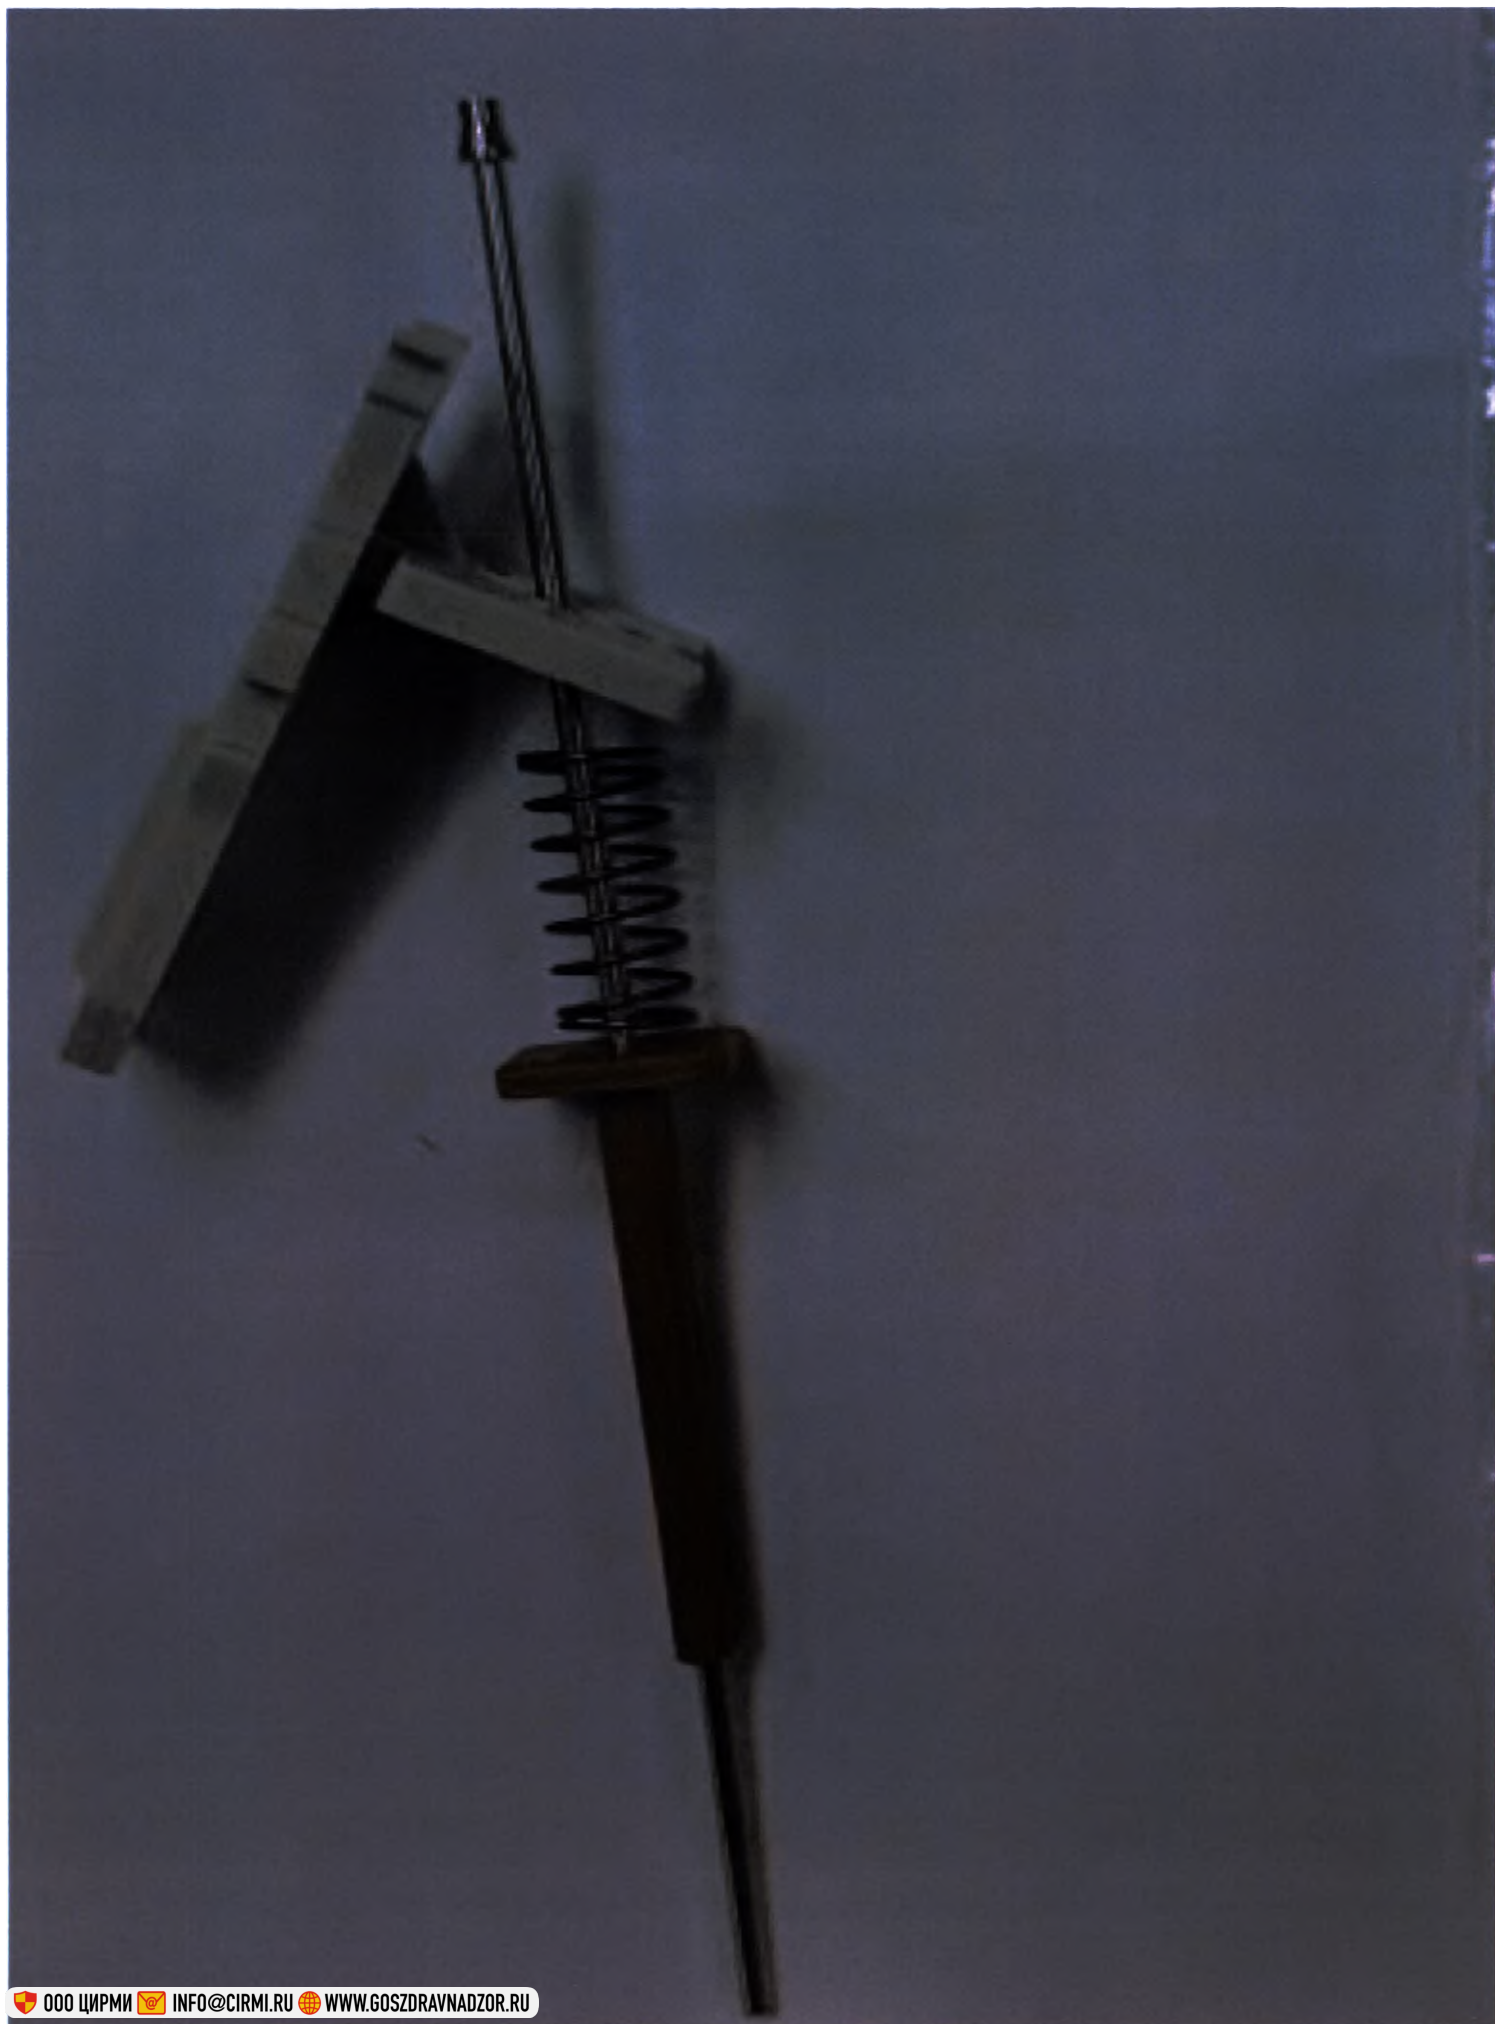

2.5. Сенсоры оптические (не более 2 шт.);



2.6. Зонды промывочные вакуумные (не более 6 шт.) (при необходимости);

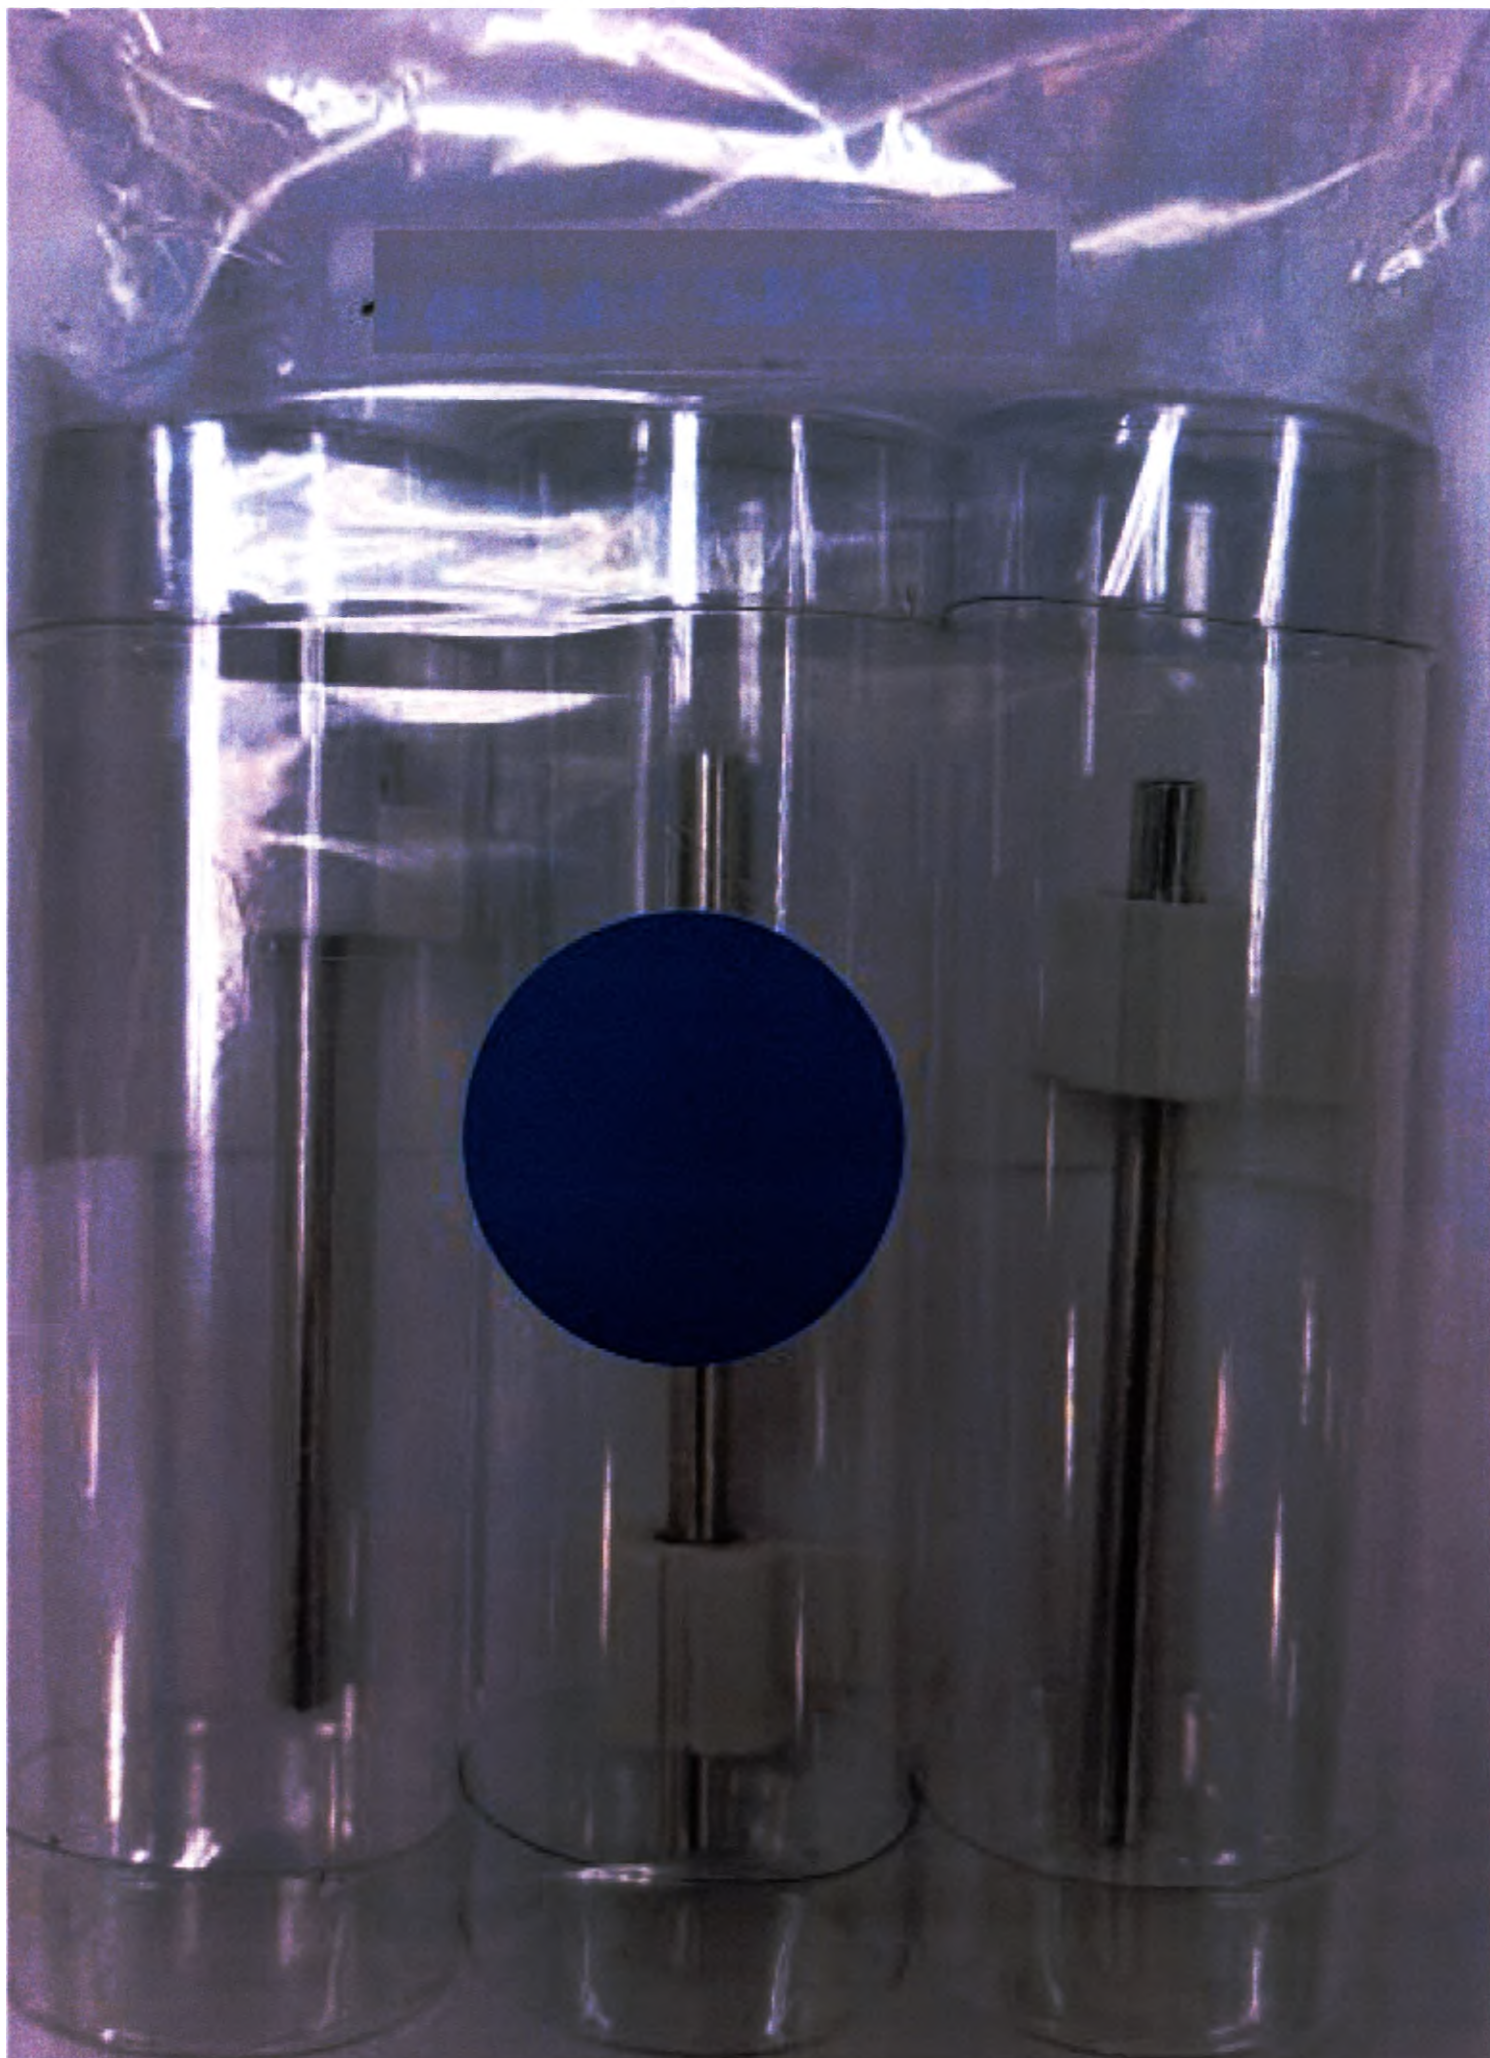

2.7.ды промывочные тройные (не более 20 шт.) и (при необходимости);



2.8. Лампы галогеновые (не более 2 шт.);




2.9. Сенсоры U (не более 4 шт.);



2. Трубки для перистальтической помпы (более 2 шт.);



2.11 Оптодатчики L (не более 2 шт.);

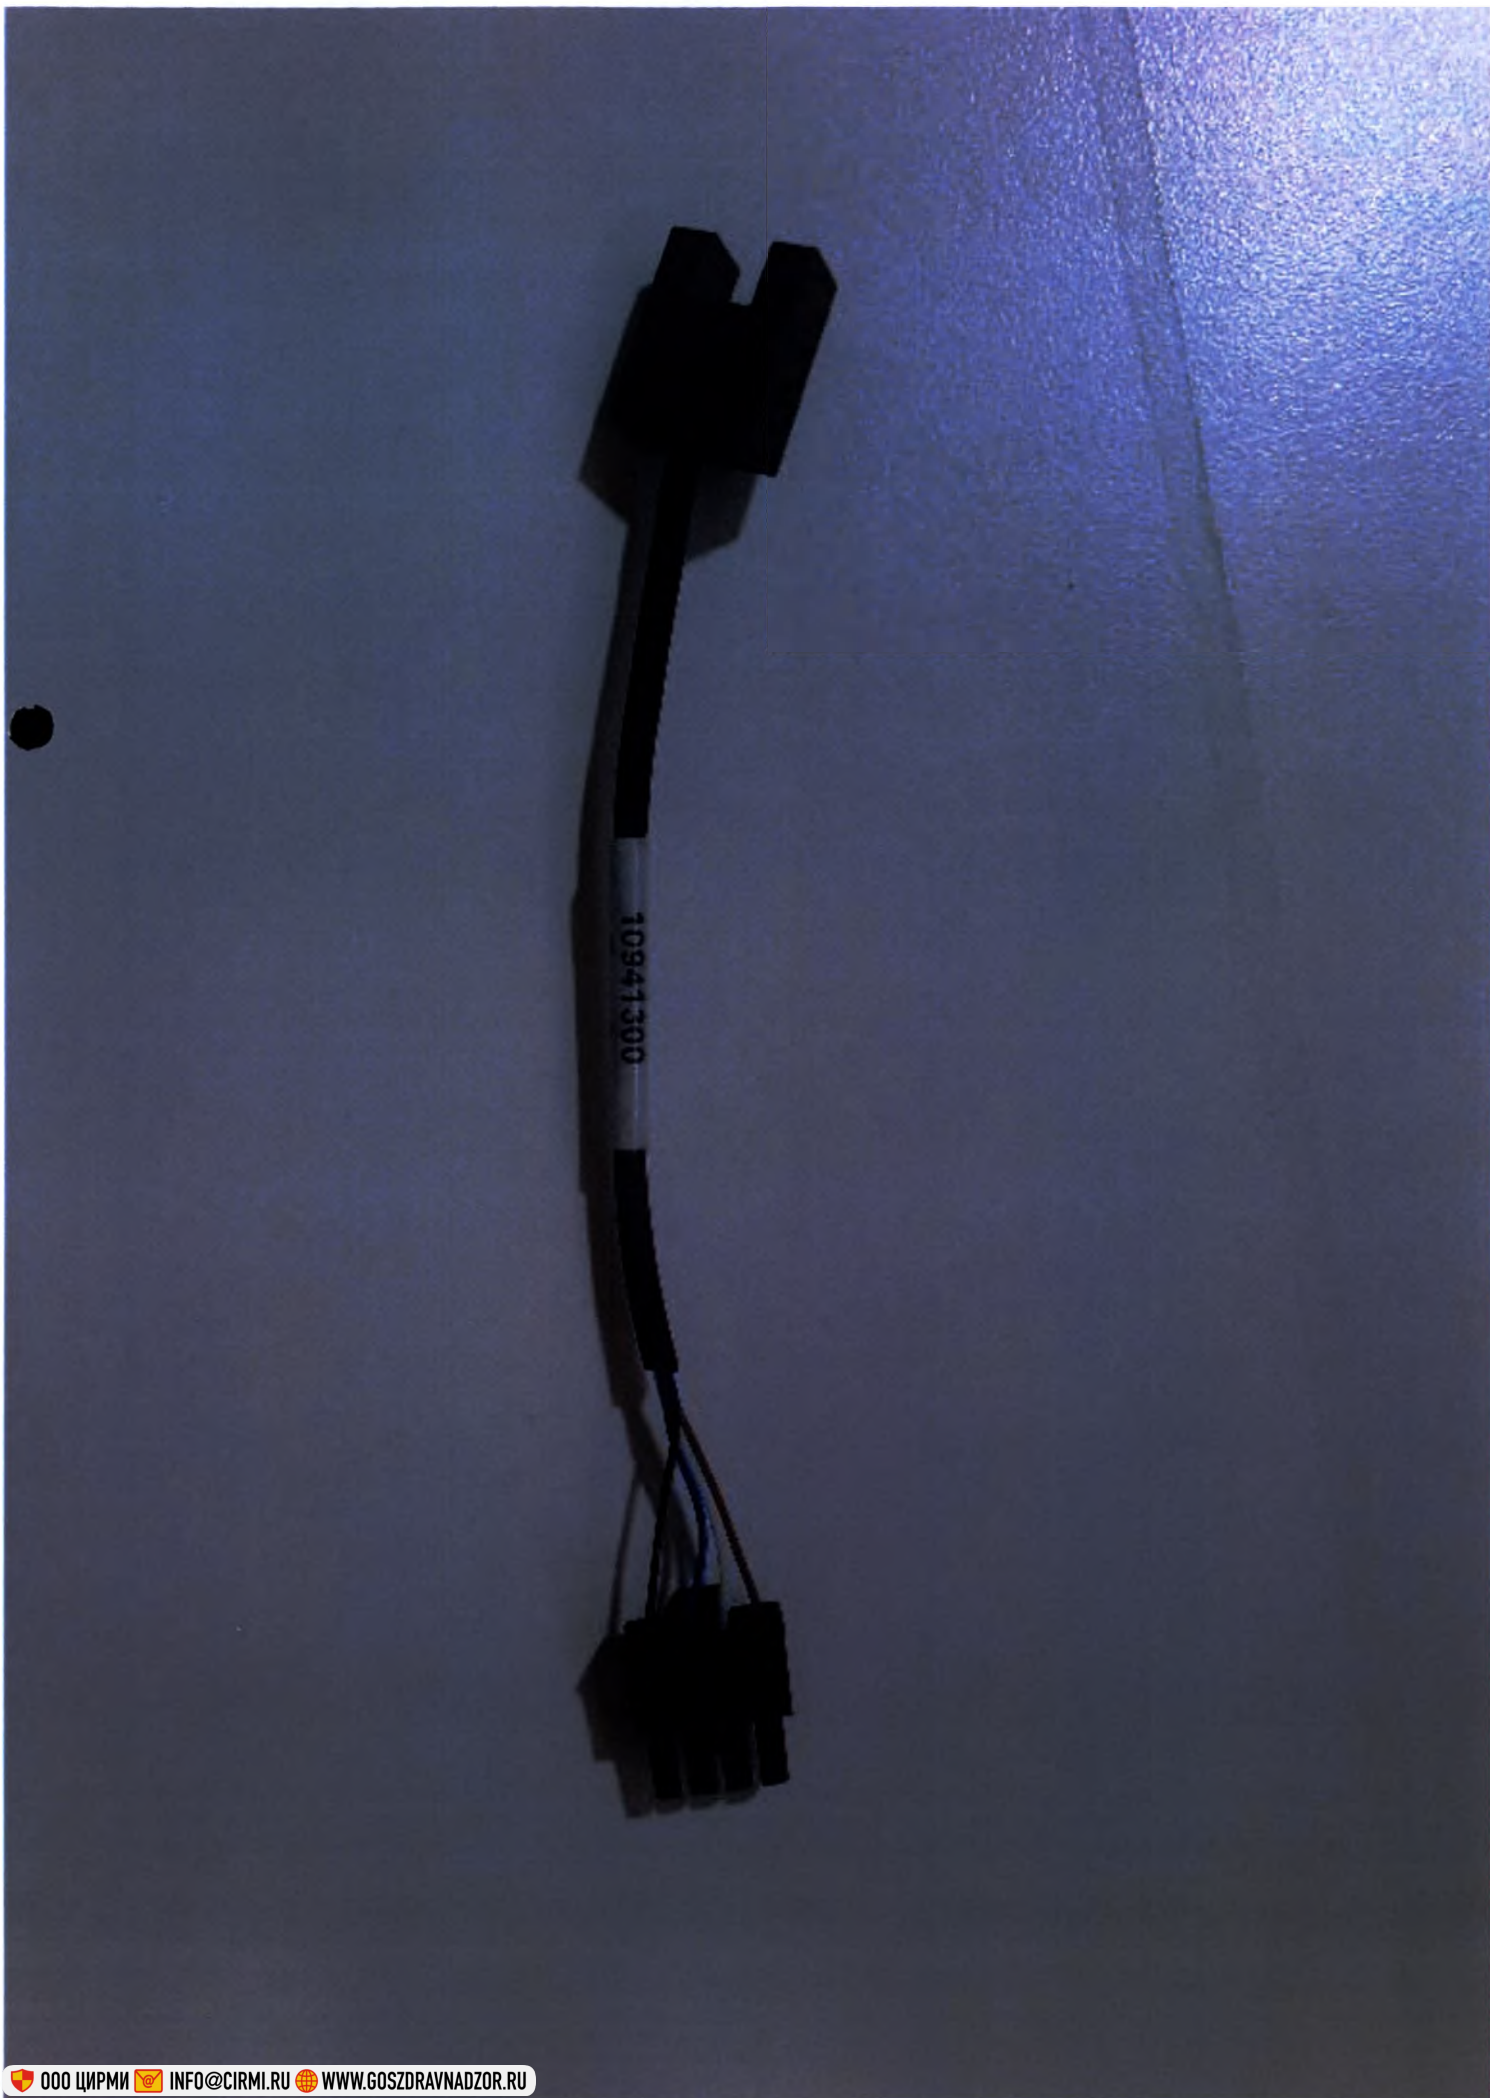

2.12 Сенсоры L (не более 4шт.);




2.13. Наконечники вакуумного зонда (не более 8 шт.) (при необходимости);



2.14. Пружины (не более 6 шт.) (при необходимости);



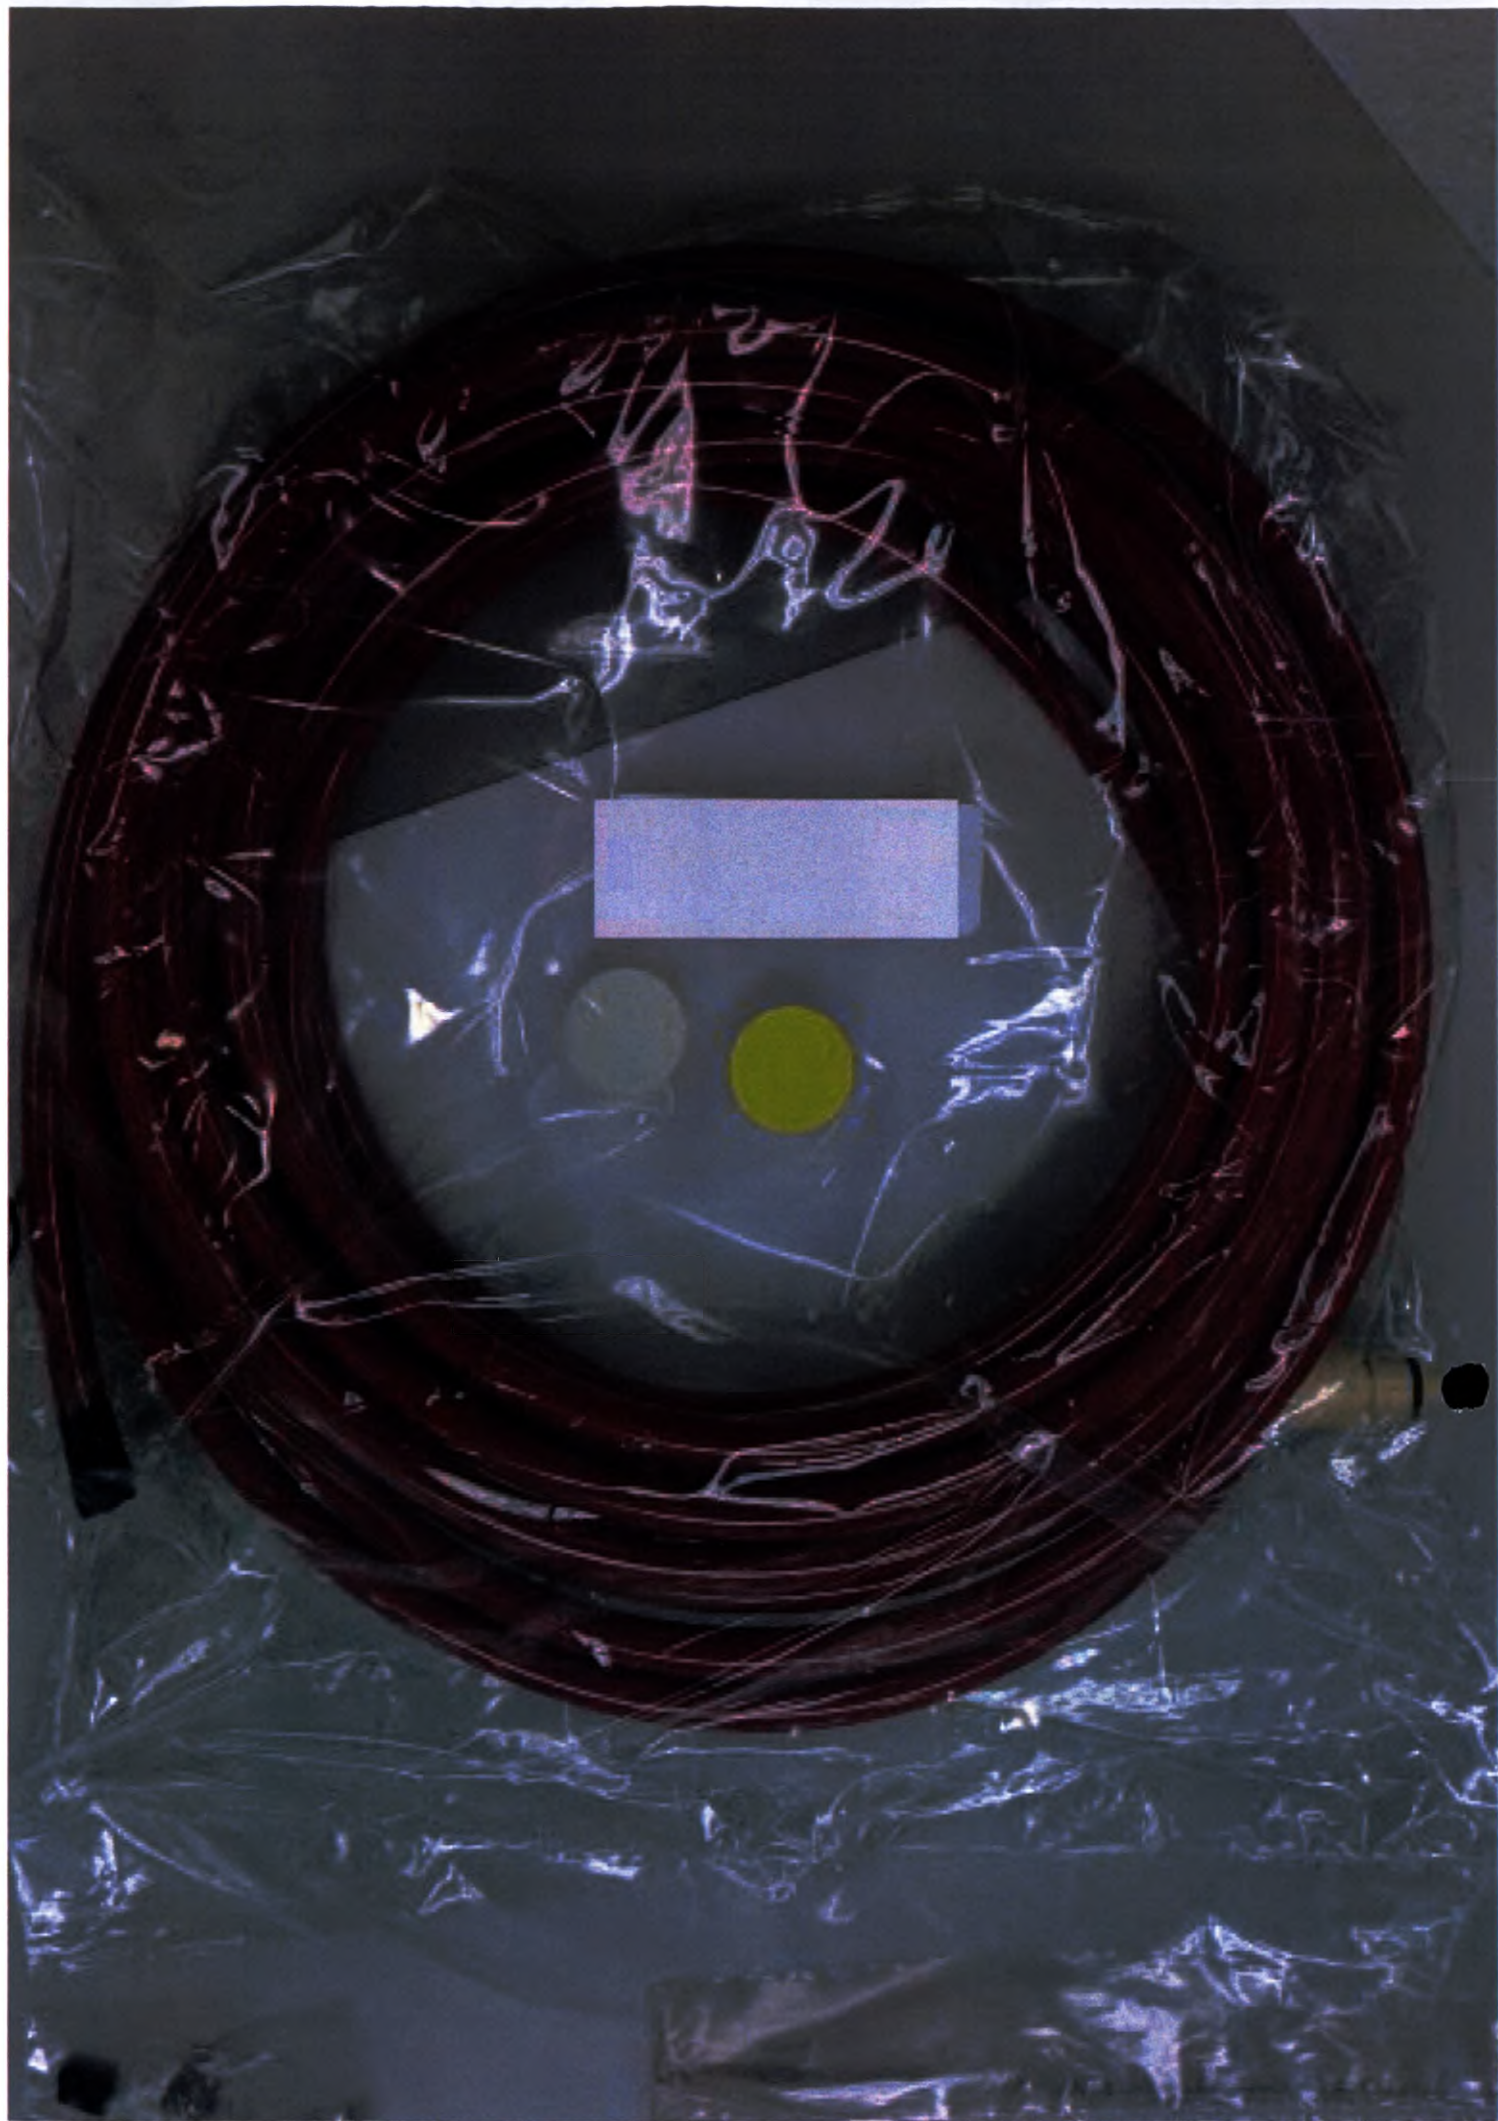

2.16. Трубки для подачи воды (не более 2 шт.).



3. Модуль прямой загрузки Direct Load в составе: 3.1. Блок модуля прямой загрузки Direct Load;




3.2. Рабочая станция для модуля прямой загрузки Direct Load:



- Клавиатура MEDIGENIC;



- Мышь MEDIGENIC;

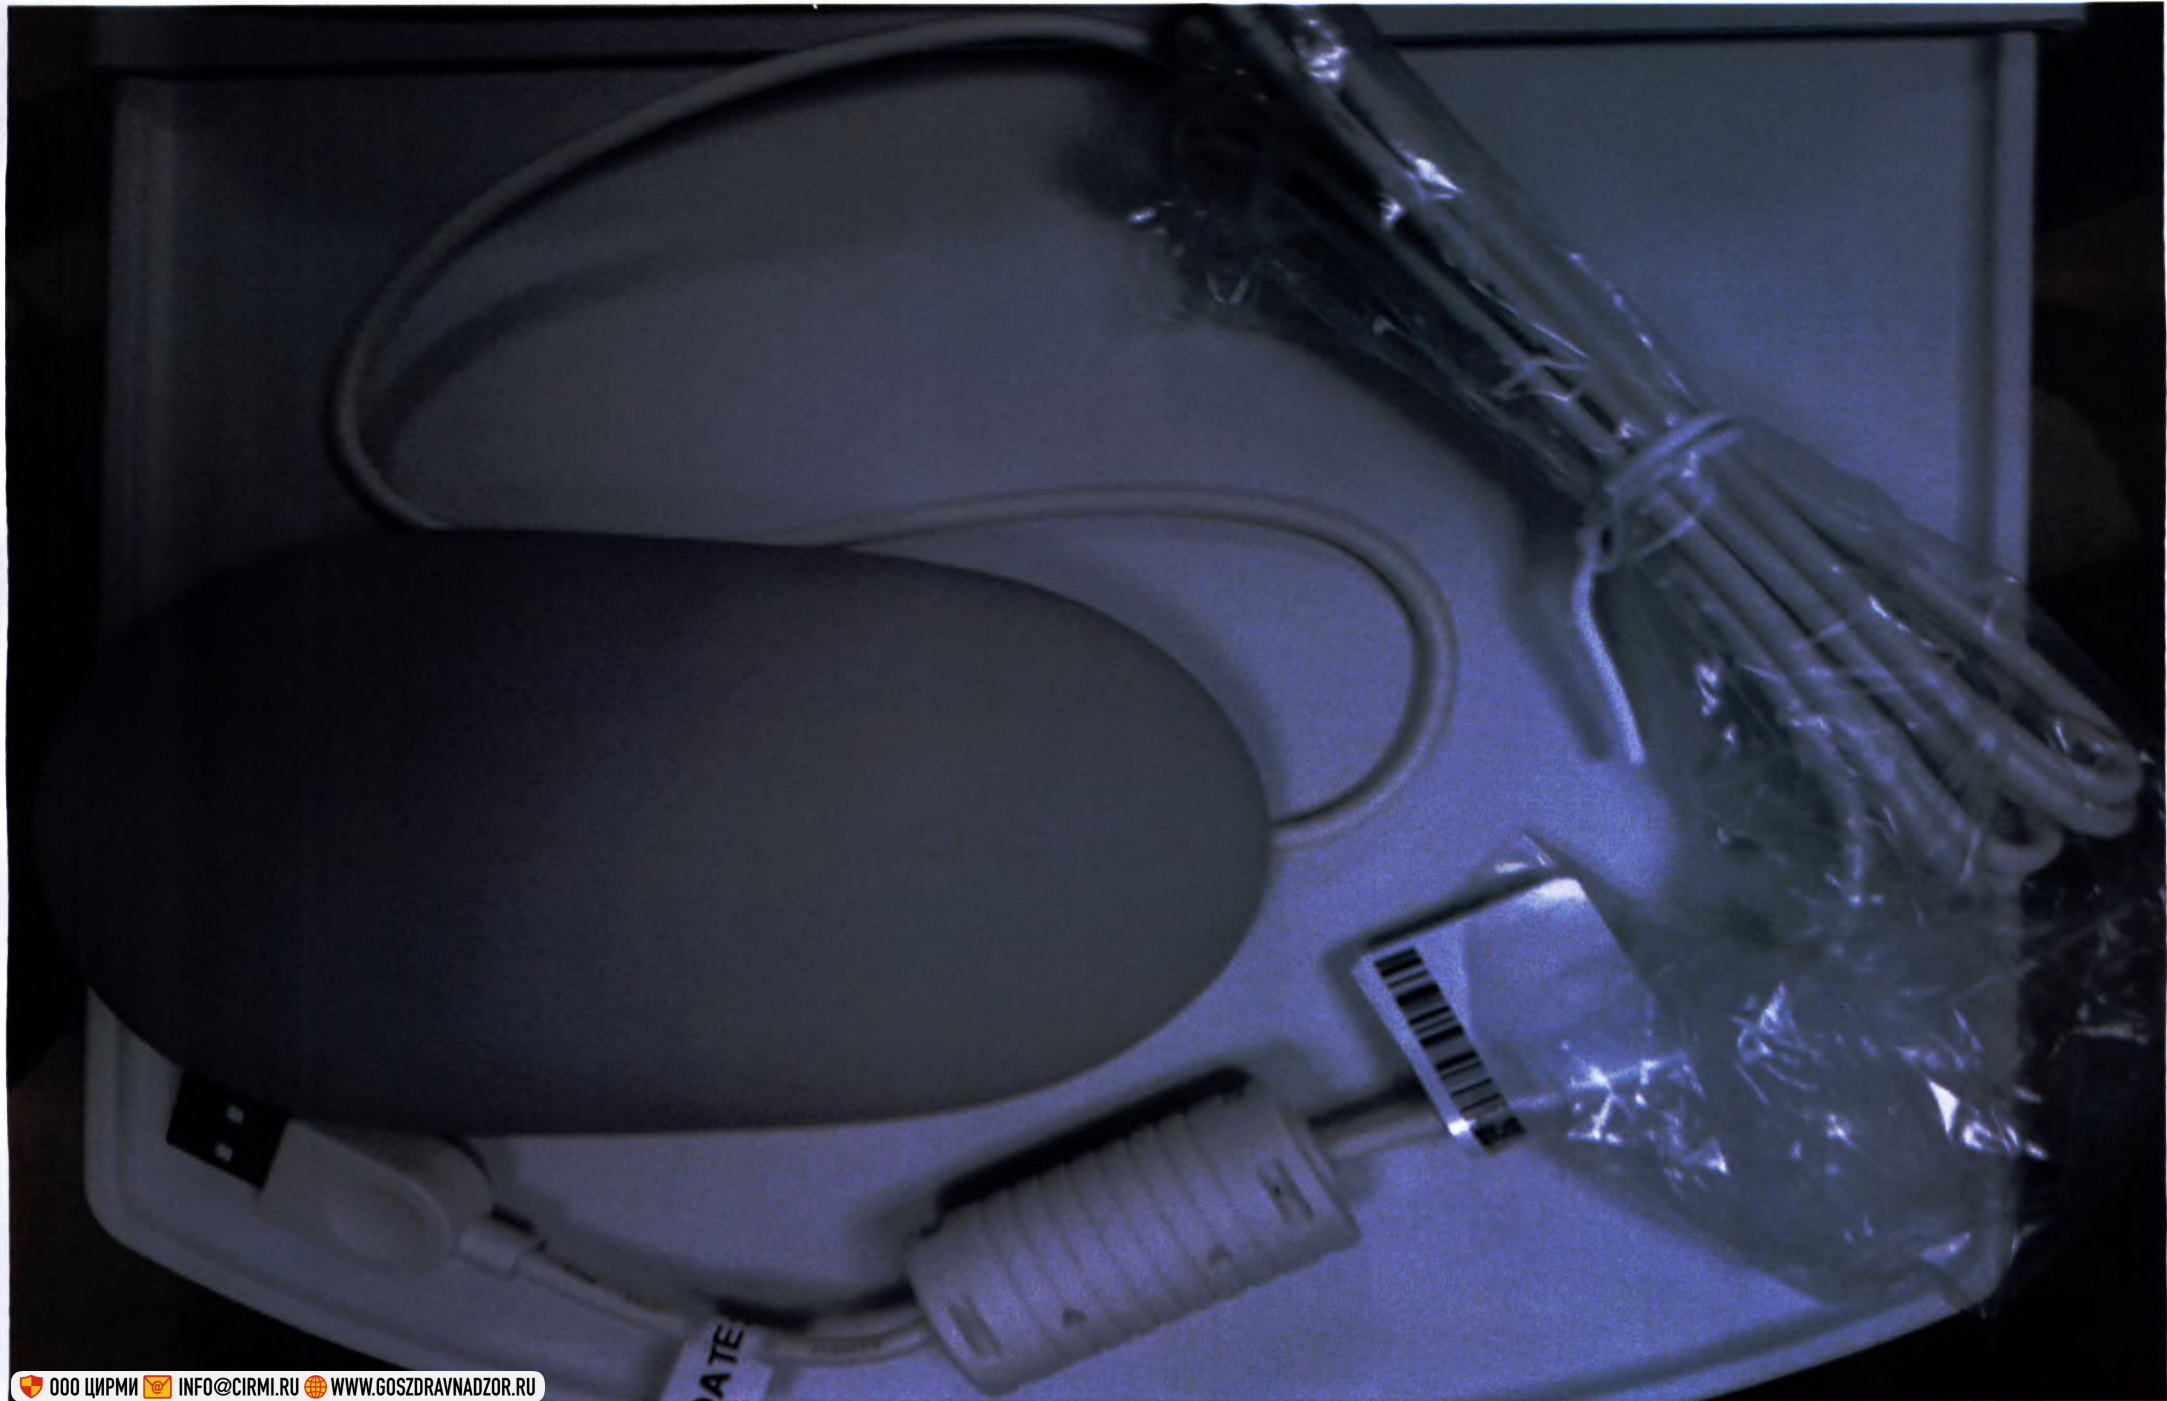

- Монитор;



- Кронштейн для монитора;



- Индикатор статуса.




3.3. Камеры TCS (не более 6 шт.)



3.4. Панели (не более 2 шт.).



3.5. Крышки аналитического модуля (не более 1 шт.).

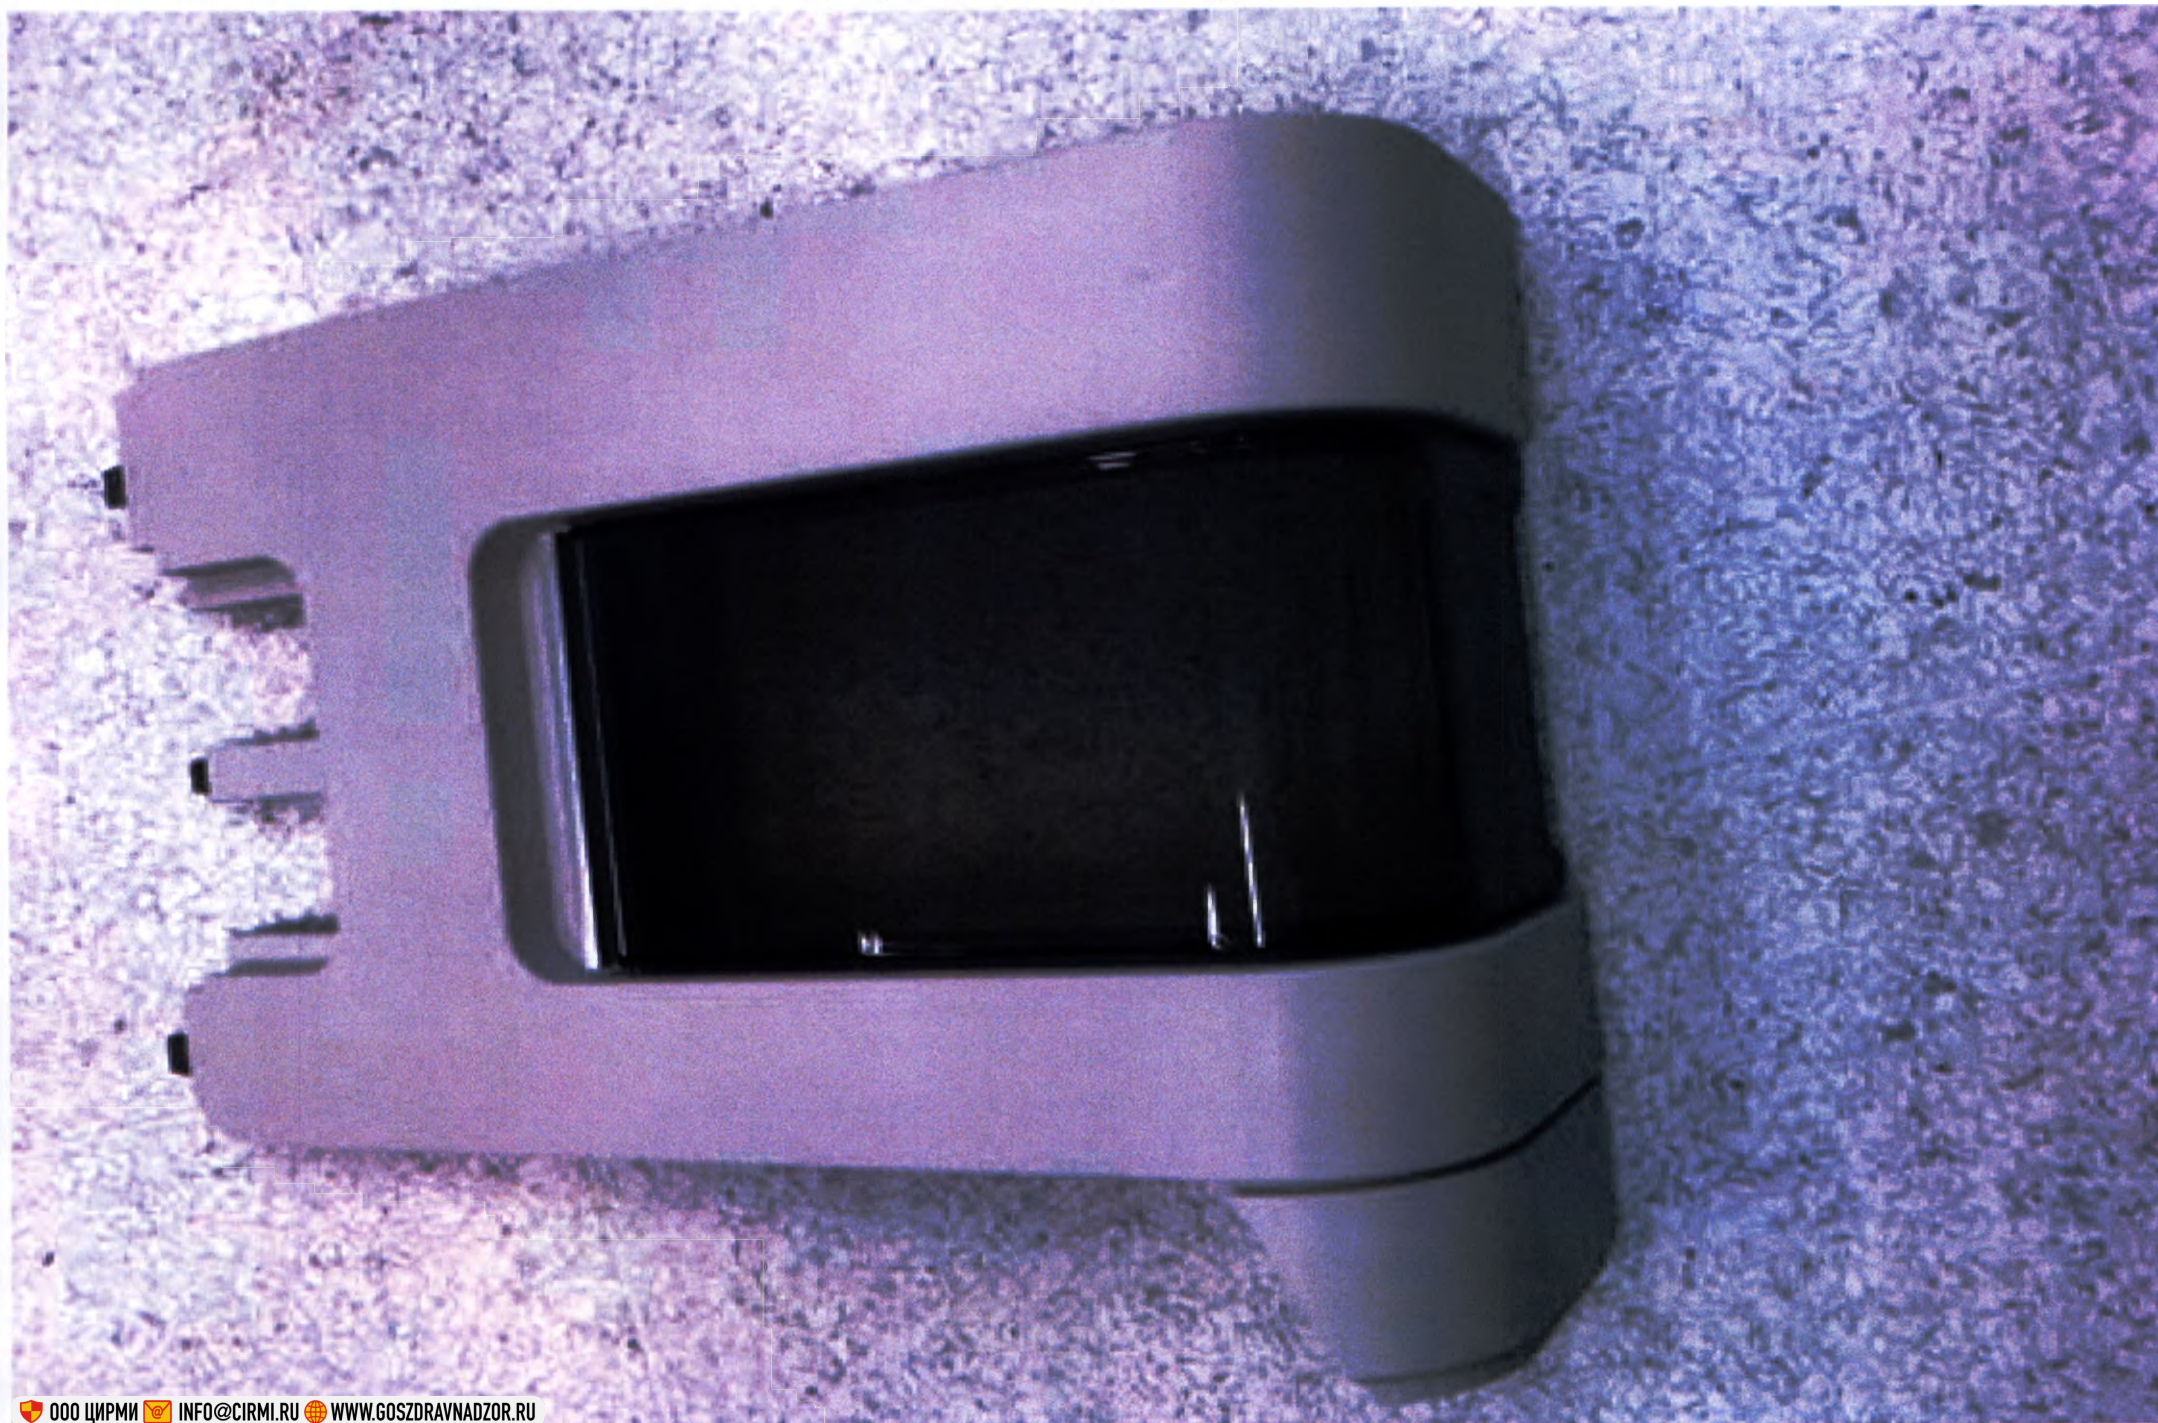



siemens-healthineers.com

Анализатор автоматический биохимический Atellica® CH 930

Руководство пользователя

5. Кабели питания (не более 2 шт.).



III. Принадлежности к анализатору автоматическому биохимическому Мепаса СП 550, вариант исполнения 1.

1. Предохранители 15.0А/80В (не более 50 шт.).




2. Предохранители 3.0A/80V (не более 50




2. Предохранители 5.0А/80В (не более 5С ...).



3. Предохранители 12.0A/250В (не более 50 шт.).

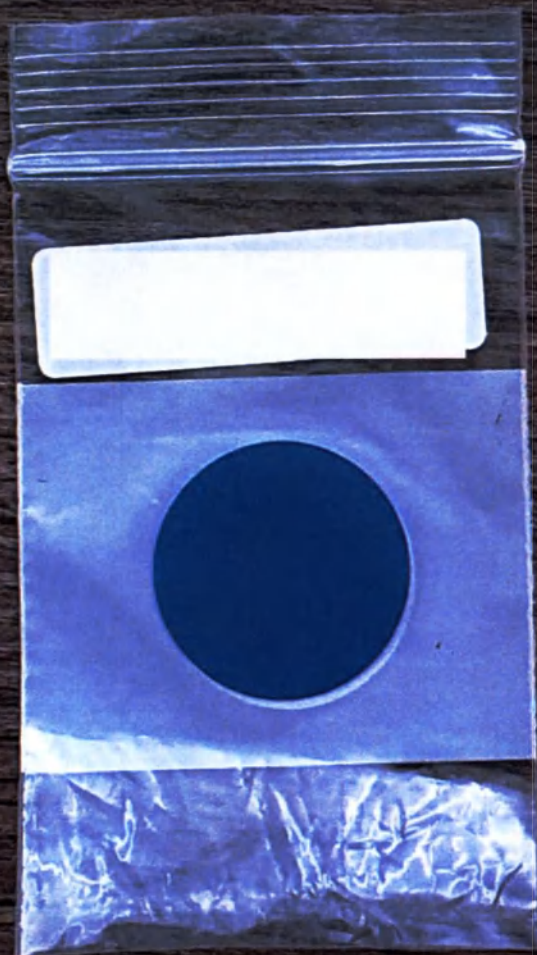


5. Предохранители 10.0A/250В (не более 50 шт.).

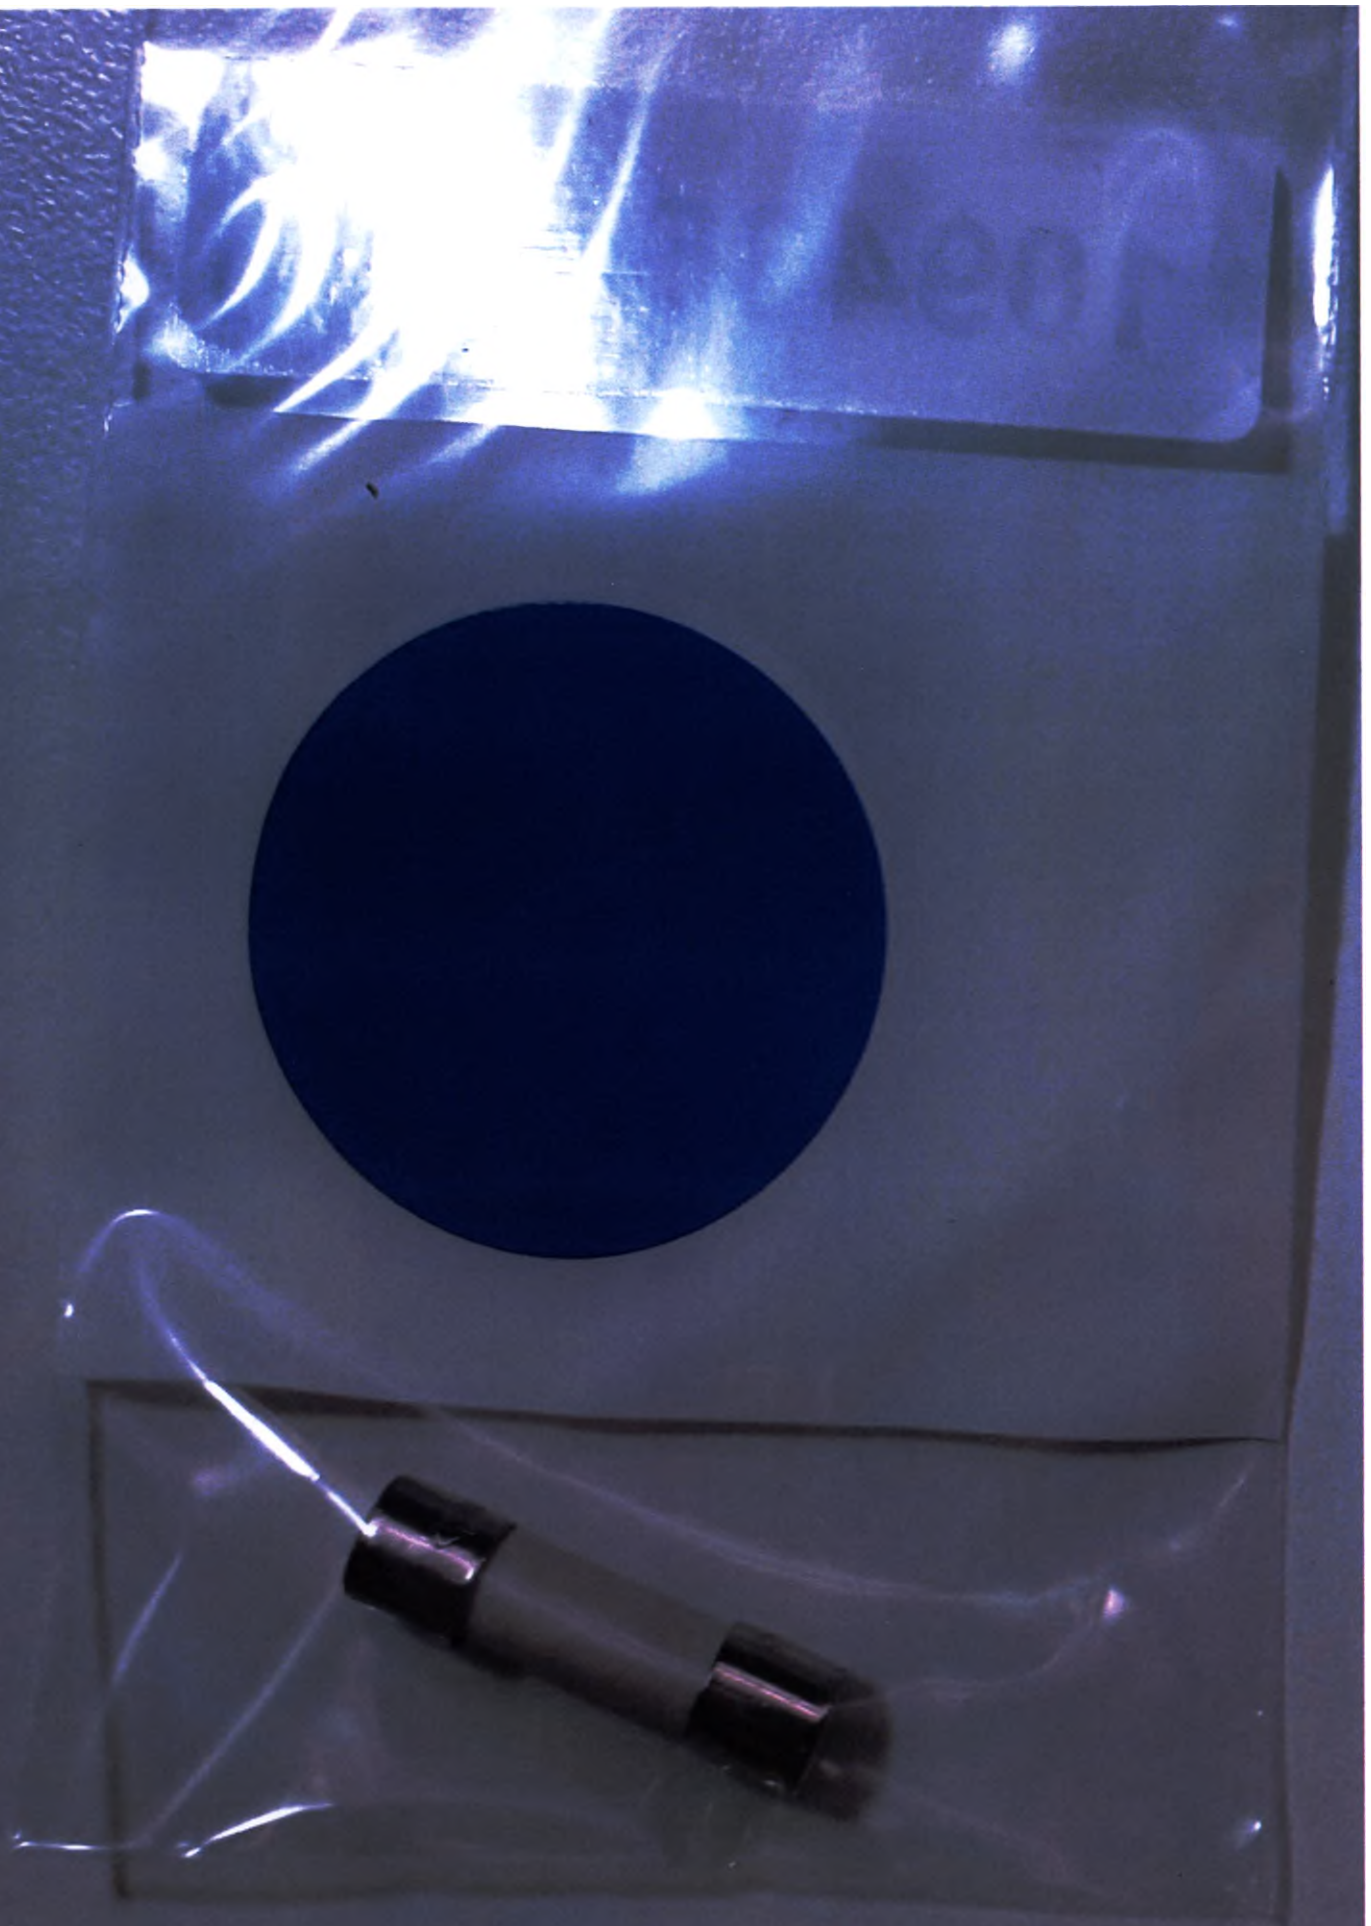

6. Предохранители 3.15A/250В (не более 50 шт.).



7. Предохранители 8.0А/250В (не более 50 шт.).

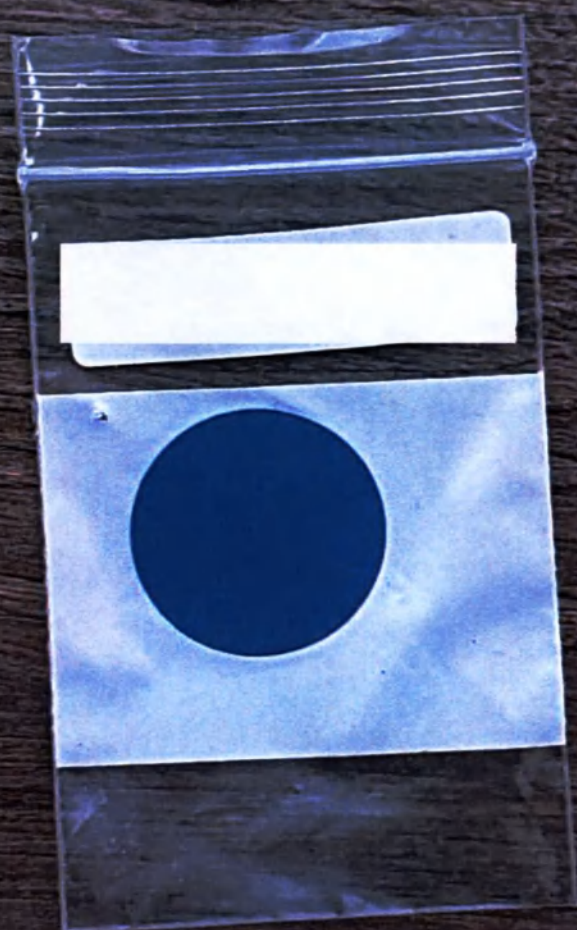

8. Предохранители 5.0A/250В (не более 50 шт.).



9. Транспортировщики пробирок (не более 50 шт.).



10. Панели фильтра задние (не более 5 шт.).




11. Фильтры воздушные (не более 50 шт.).



12. Система системные моющие Atellica CH (2 x 1,5 л) Более 1000 шт.).



13. Средства системные кондиционирующие Atellica CH (2 x ...) (не более 1000 шт.).

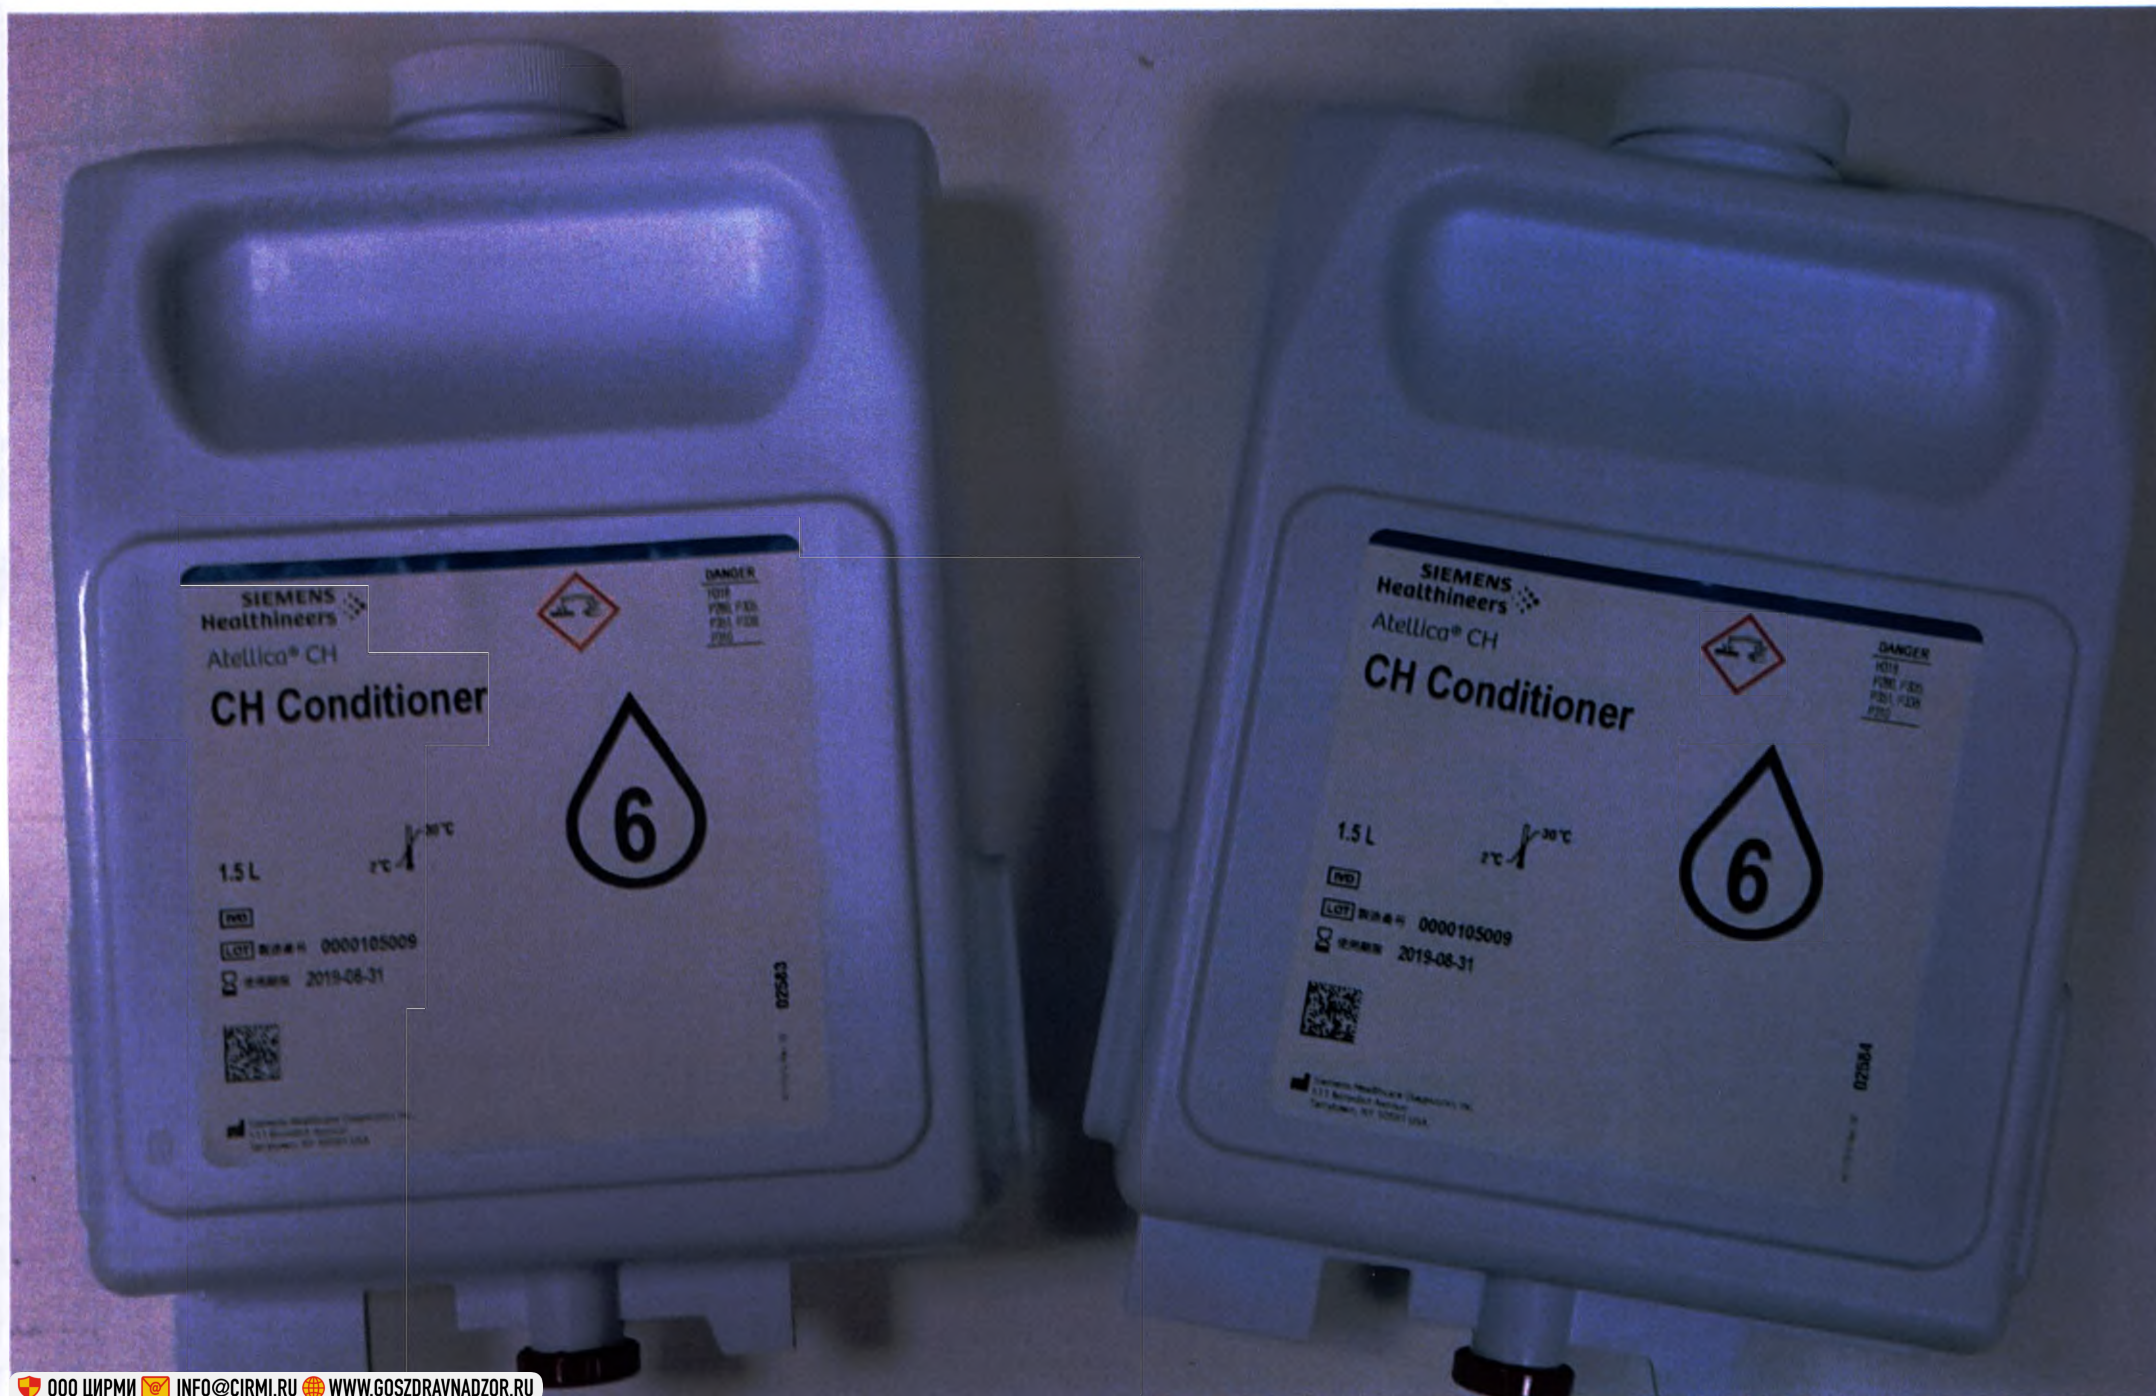


14. Система системные чистящие Atellica CH (2 x 1,5 л, ... более 1000 шт.).



15. Средства системные для разведения Atellica CH (2 x 1,5 л (не более 1000 шт.).




16. Сегменты реакционные (не более 10С. .).

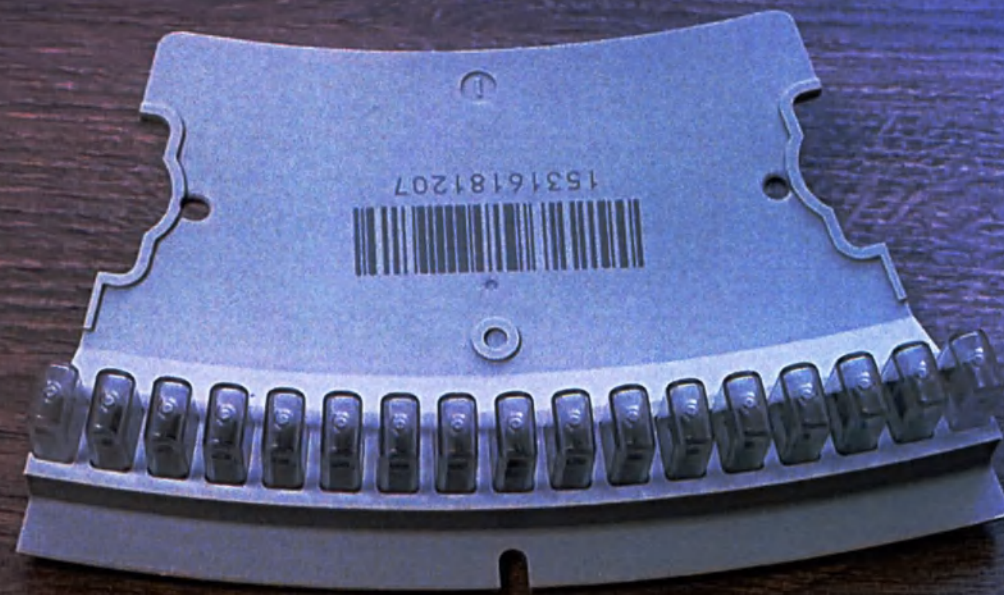


17. Сегменты для разведения (не более 100 уп.) :



18. Средство для рутинной проверки работы узлов анализатора CHK Atellica CH (9 x 47 мл) (не более 1000 шт.).

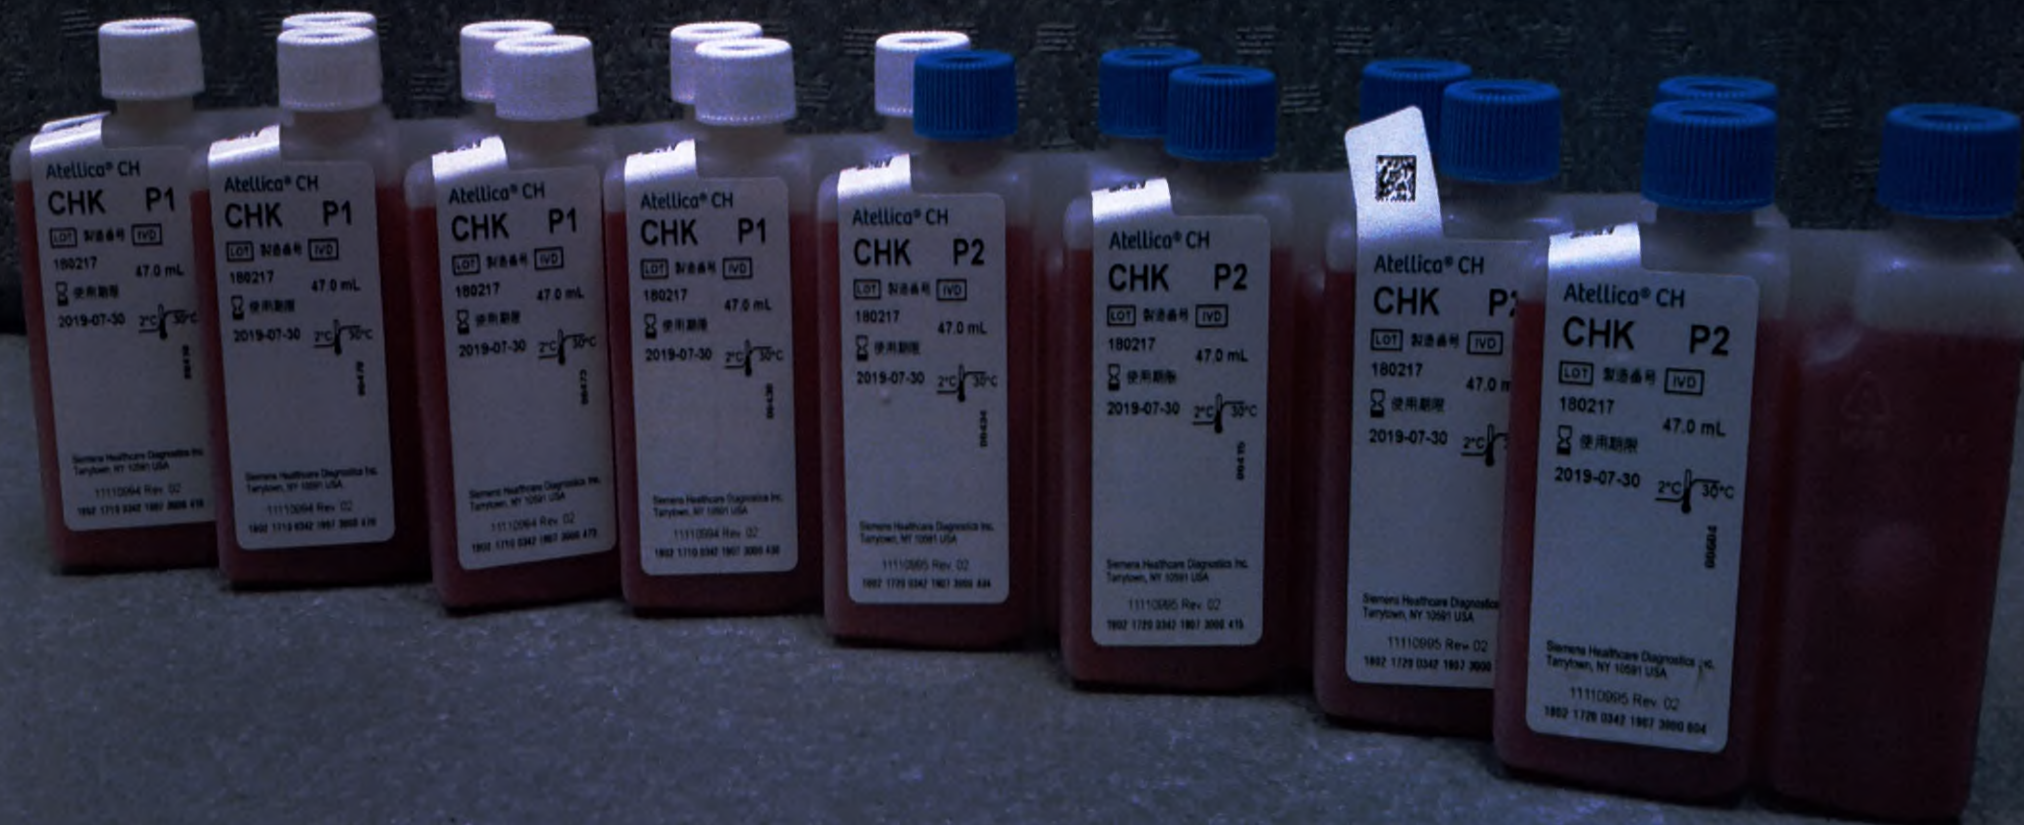


19. Материал инсталляционный AMIX.

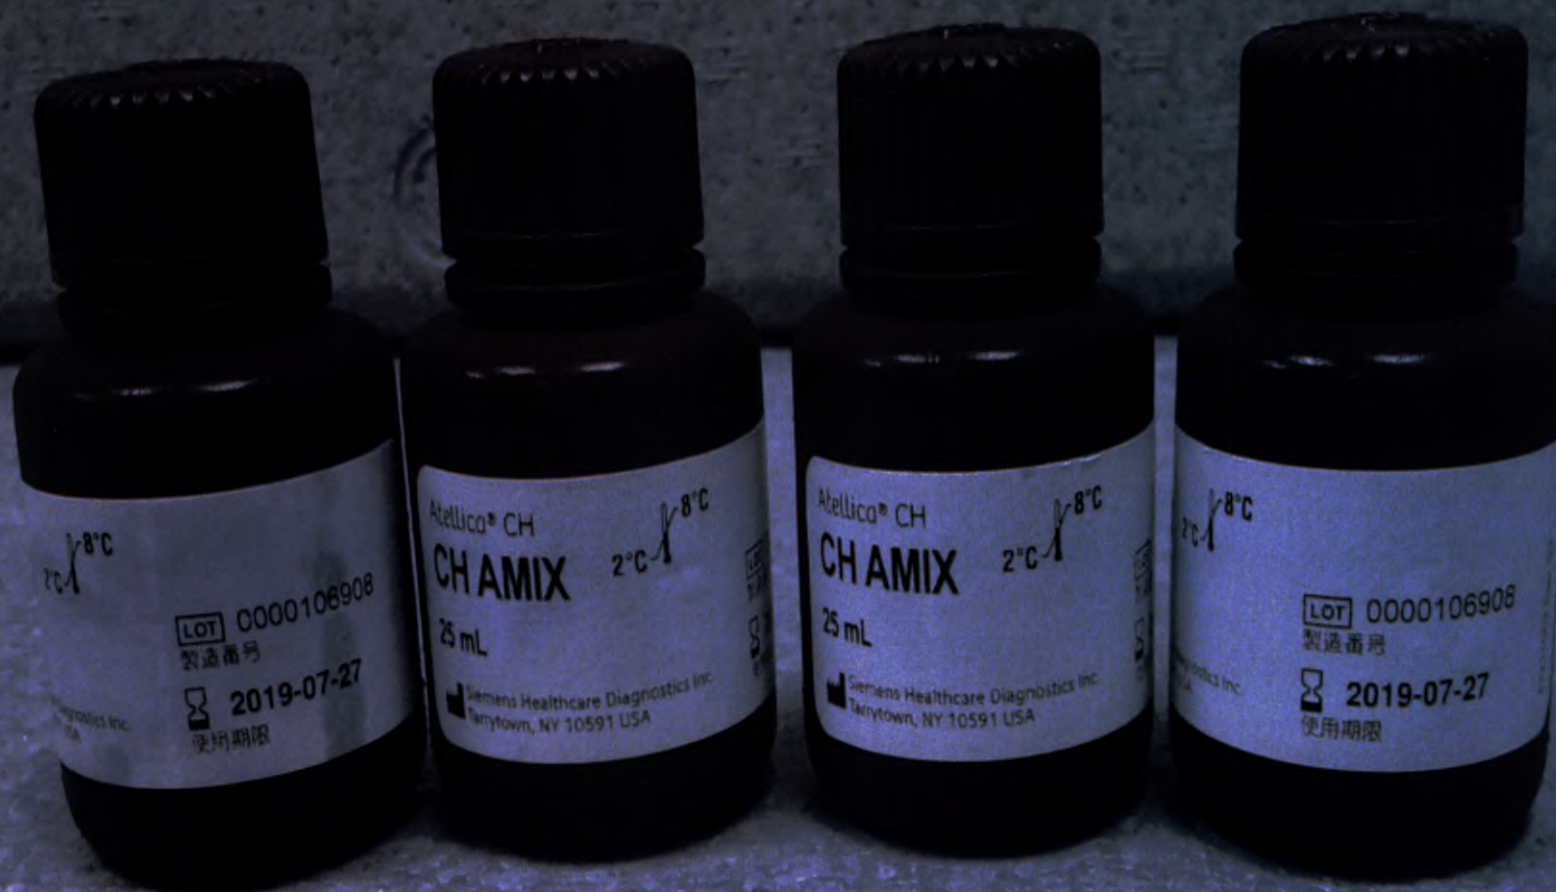

20. Средства системные для охлаждения галогеновой лампы (1 x 250 мл) (не более 1000 шт.).




21. Средства — системные для водяной бани Atellica CH (4 x 36, л) (не более 1000 шт.).

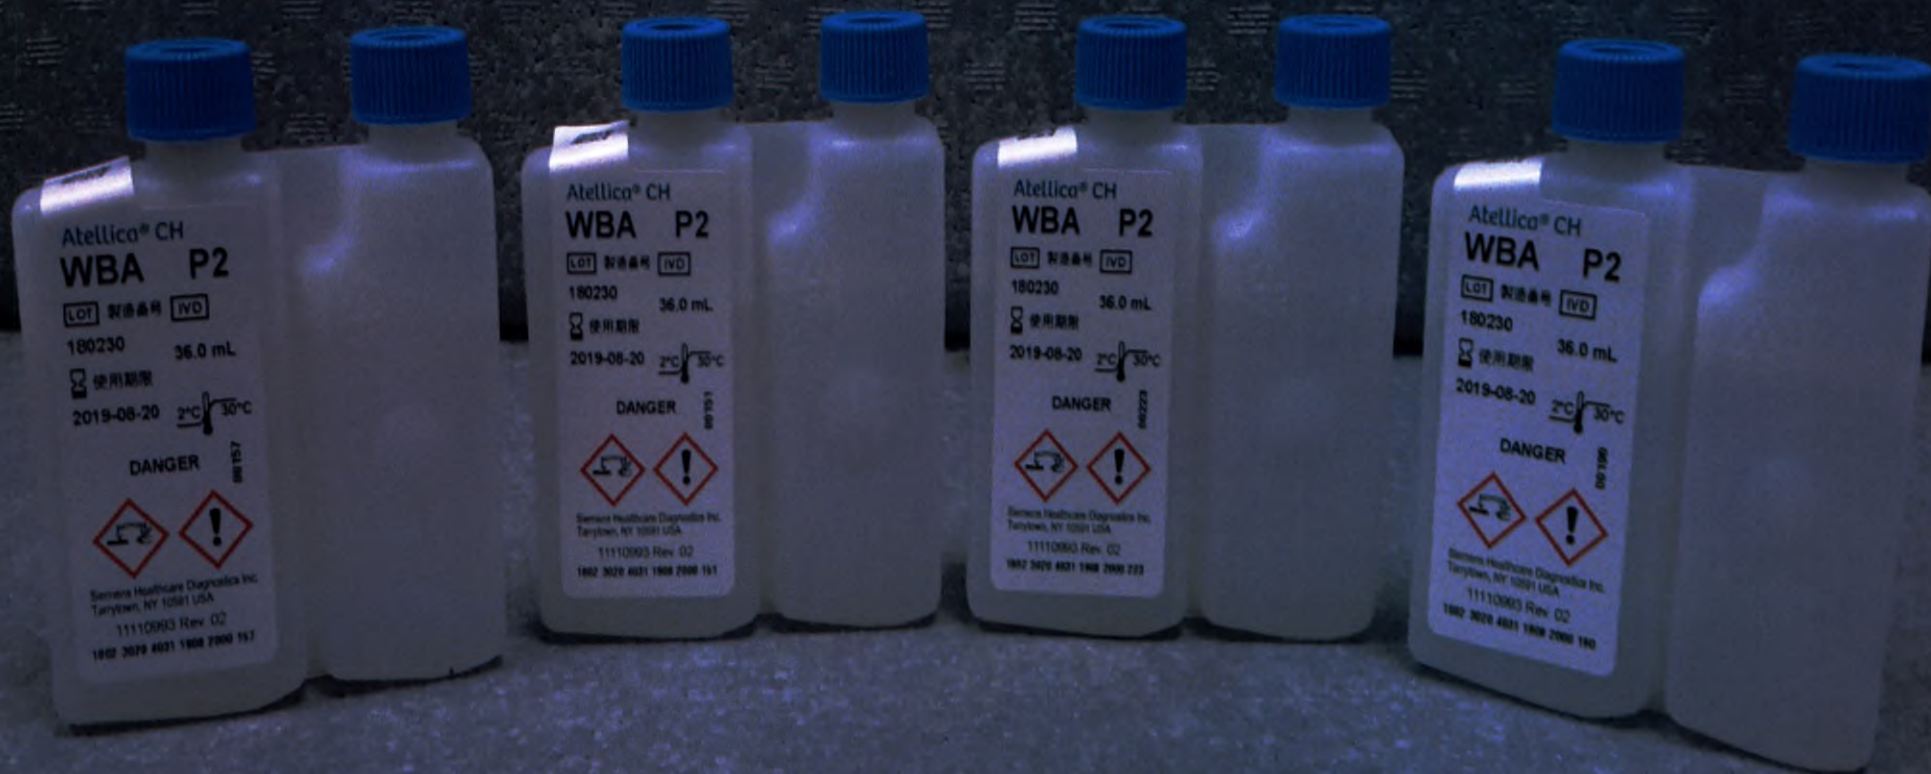

22. Средства системные для очистки реagentных зондов — ашалок и ковет (не более 1000 шт.), варианты — пополнения:
- Средство очищающее 4 Atellica CH (4x47 мл) ттгли



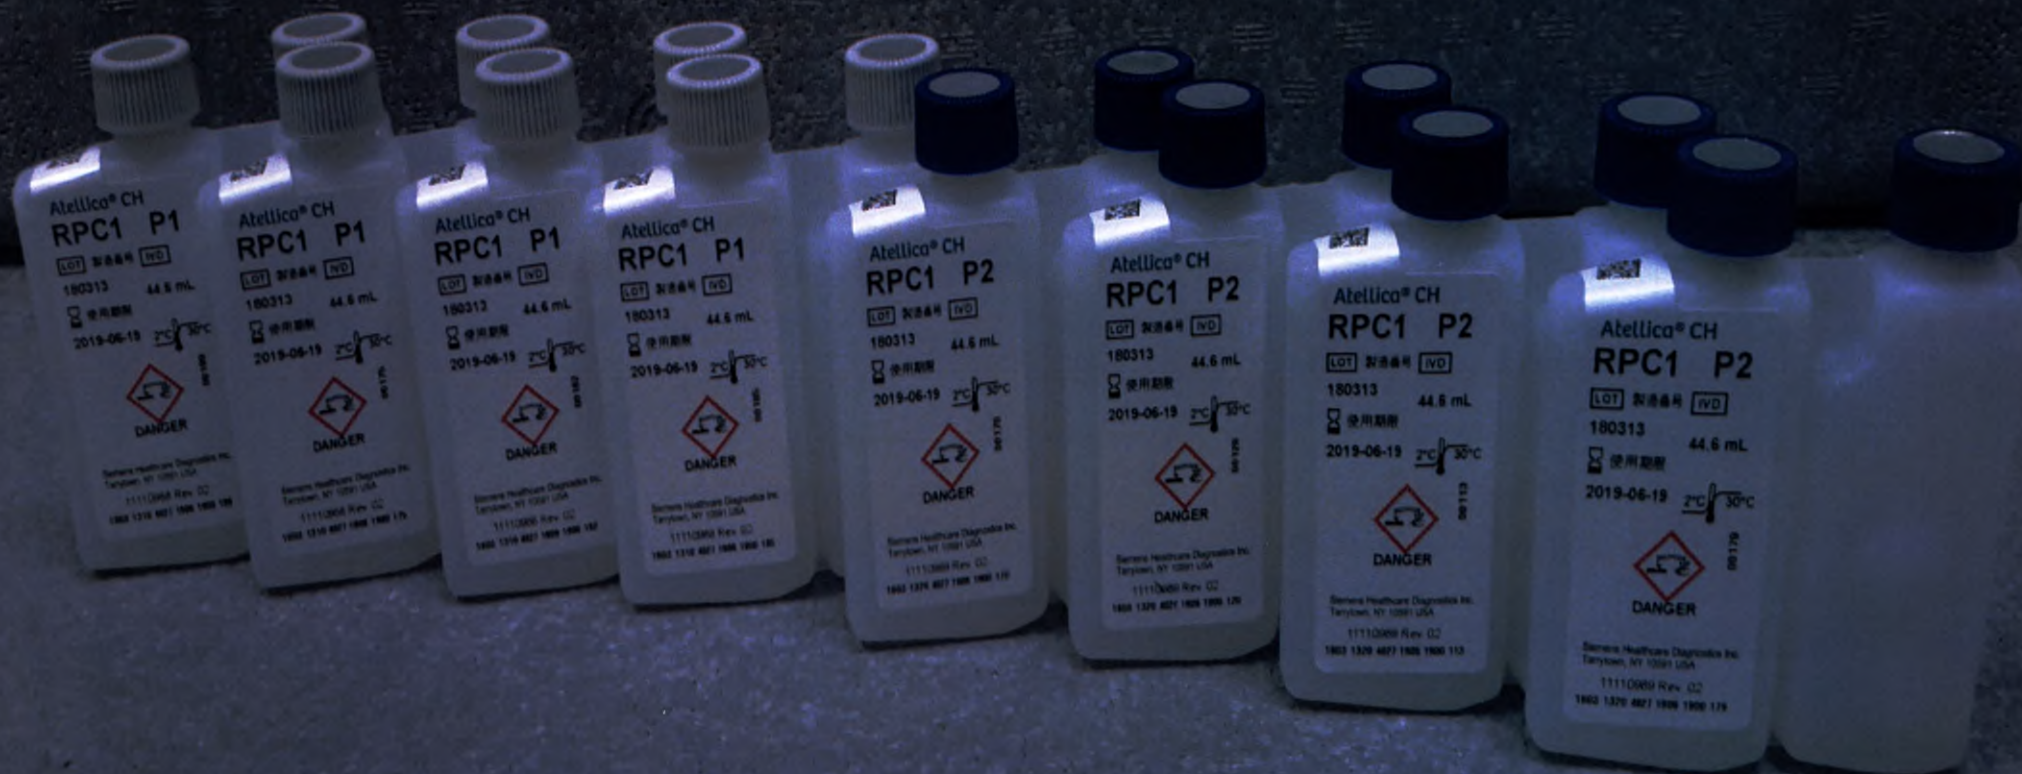


- Средство очищающее 2 Atellica CH (8 x 44,6 мл).



2.3. Набор для системной очистки и дезинфекции анализатора и оценки качества воды.

- Средство системное очищающее (2л) (не более 1000 шт.) и/или

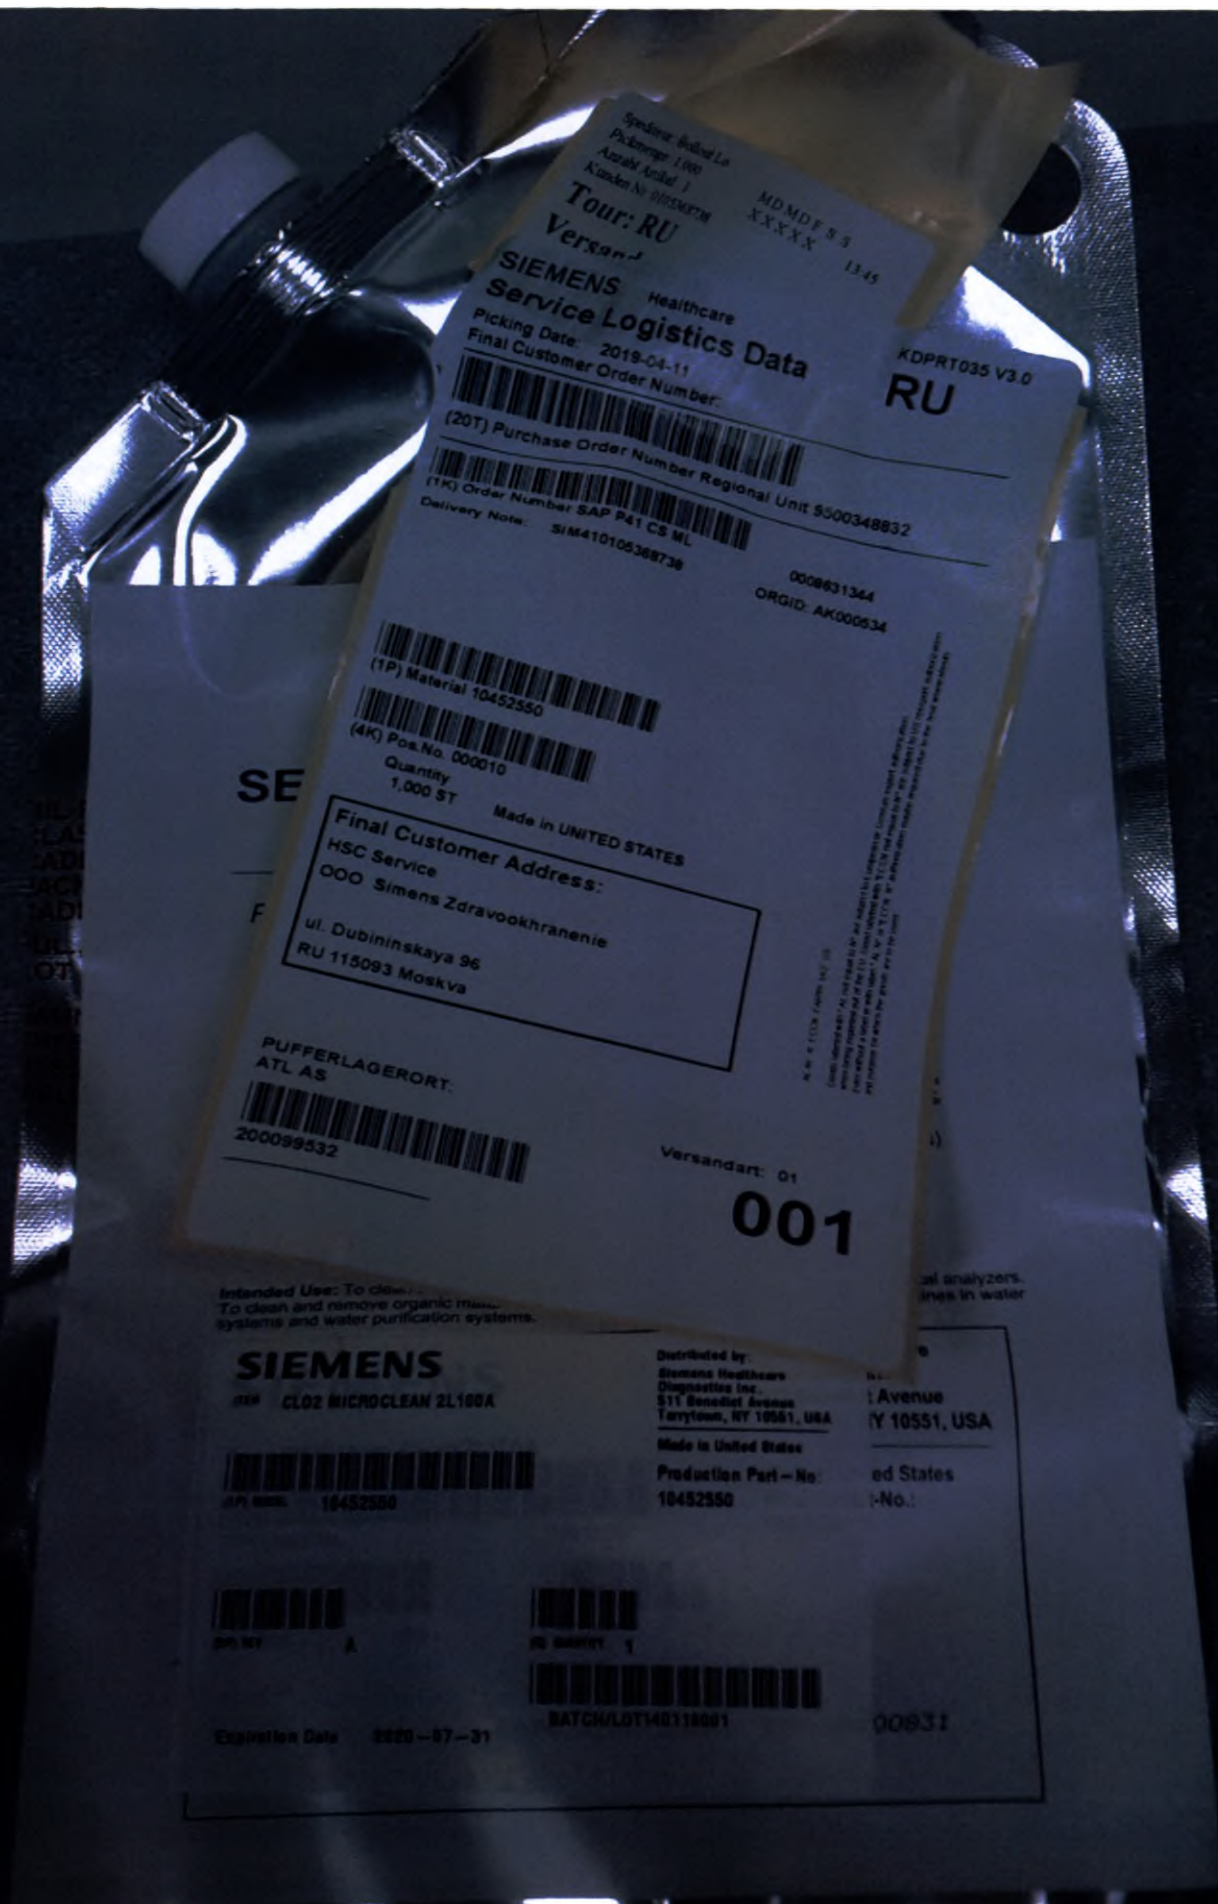


- Полоски индикаторные для оценки качества воды (не более 1000 шт.).




2 флаконы для реагентов пустые (не более 100 , -)



25. Инструменты для вывода концентрированных отходов СН 930 (не более 2 шт.).

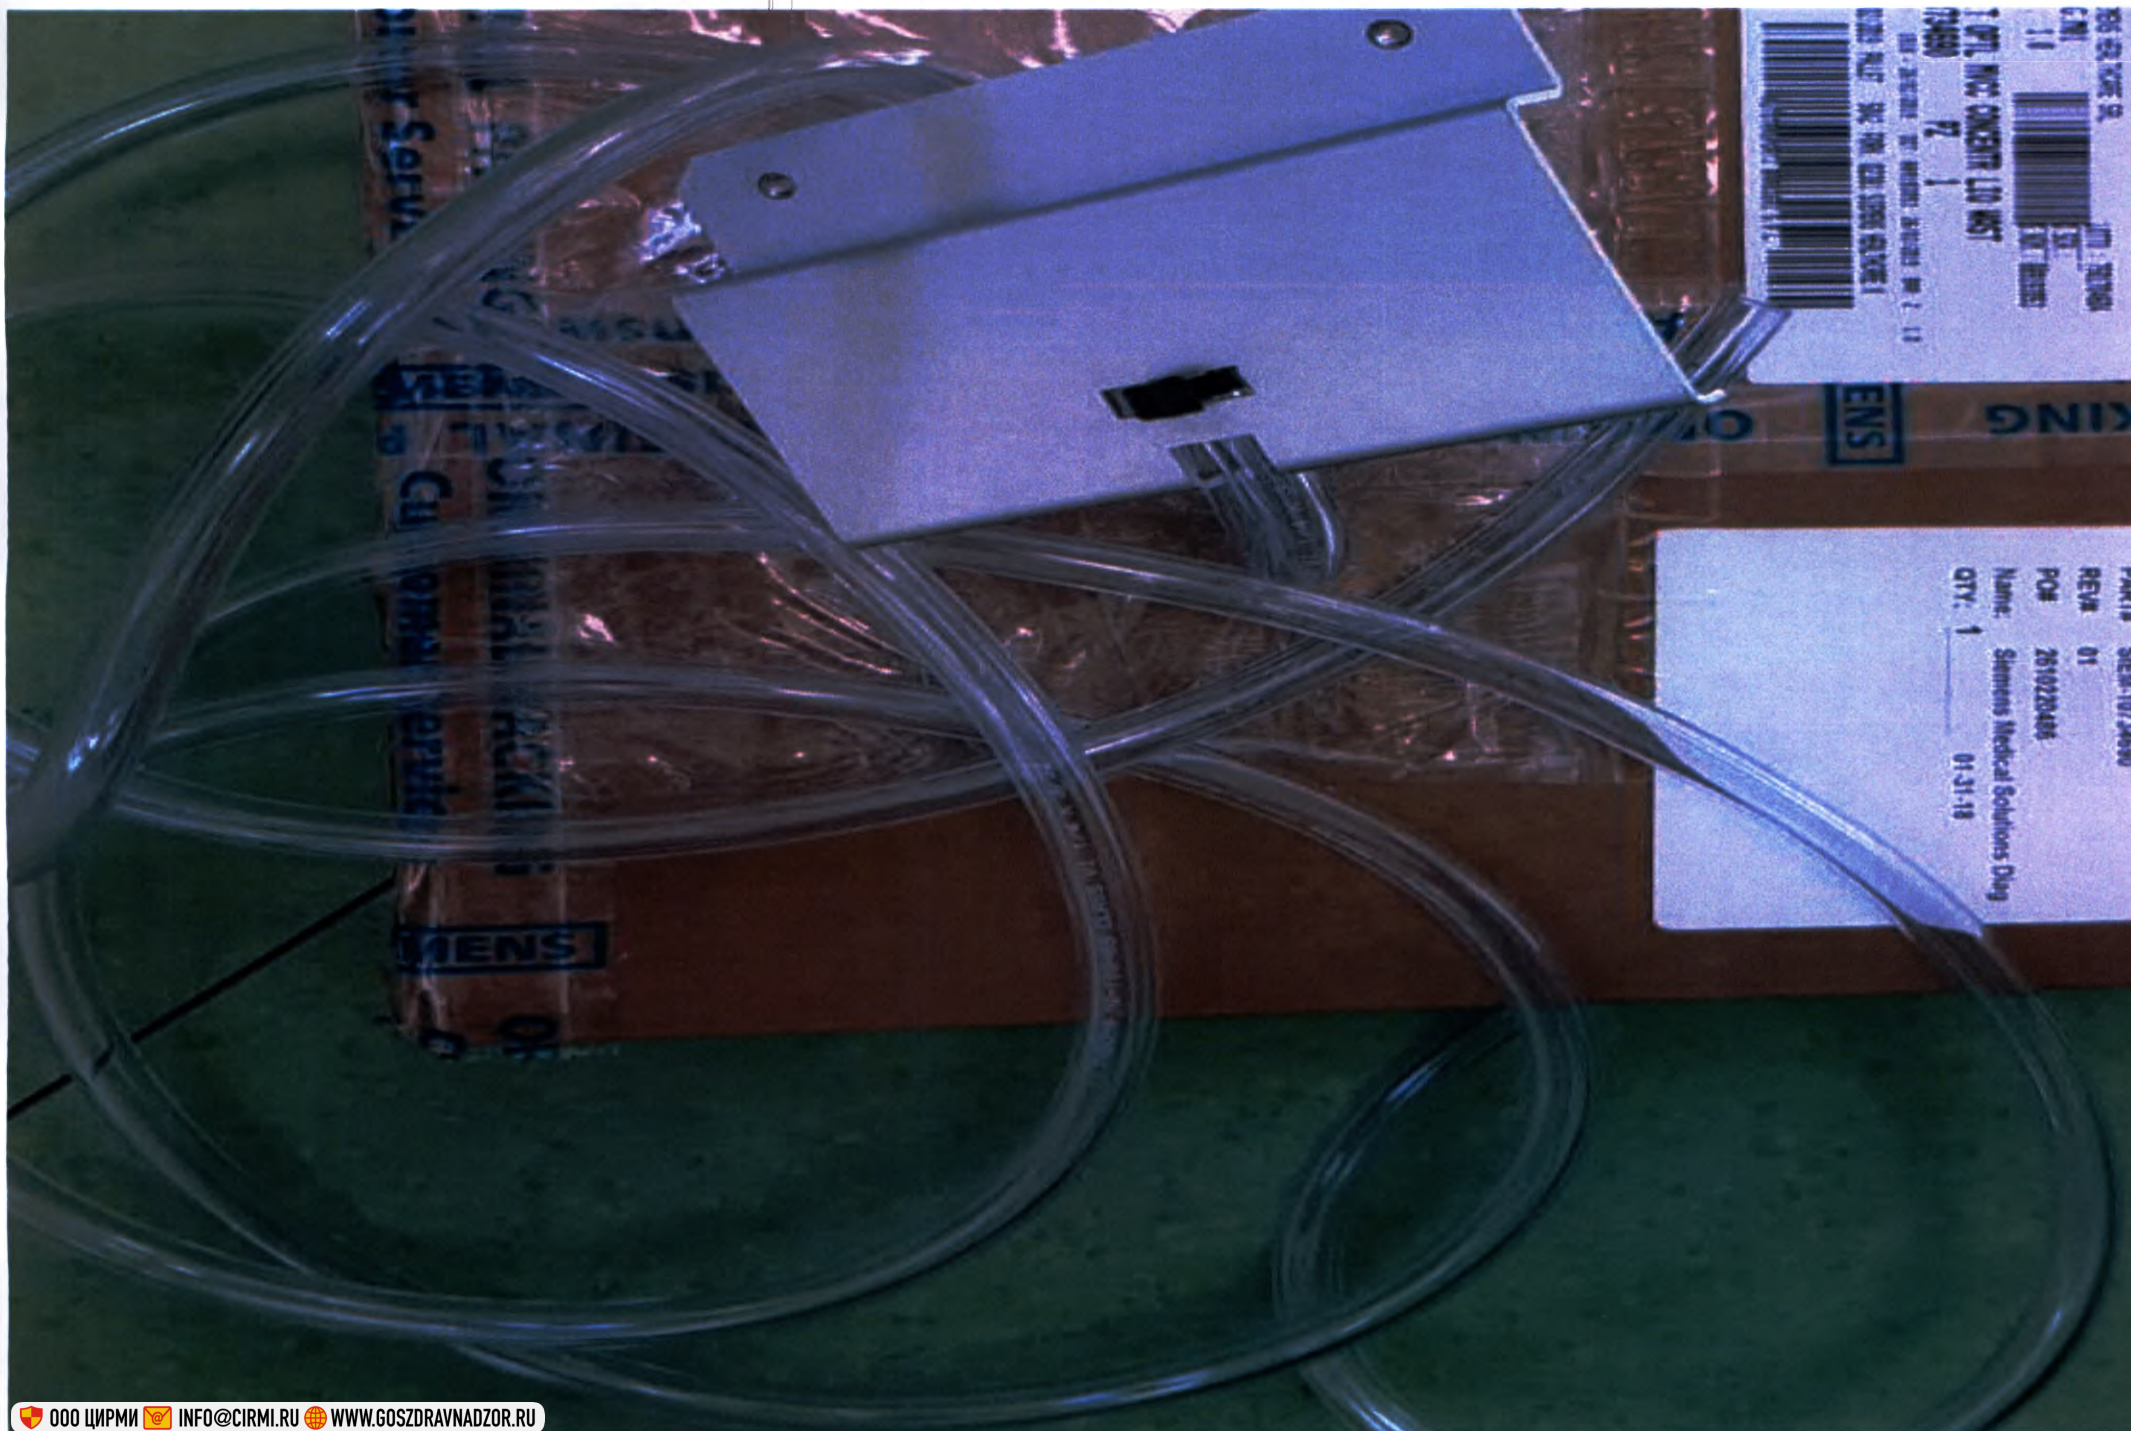

26. Переходник для кабеля питания.

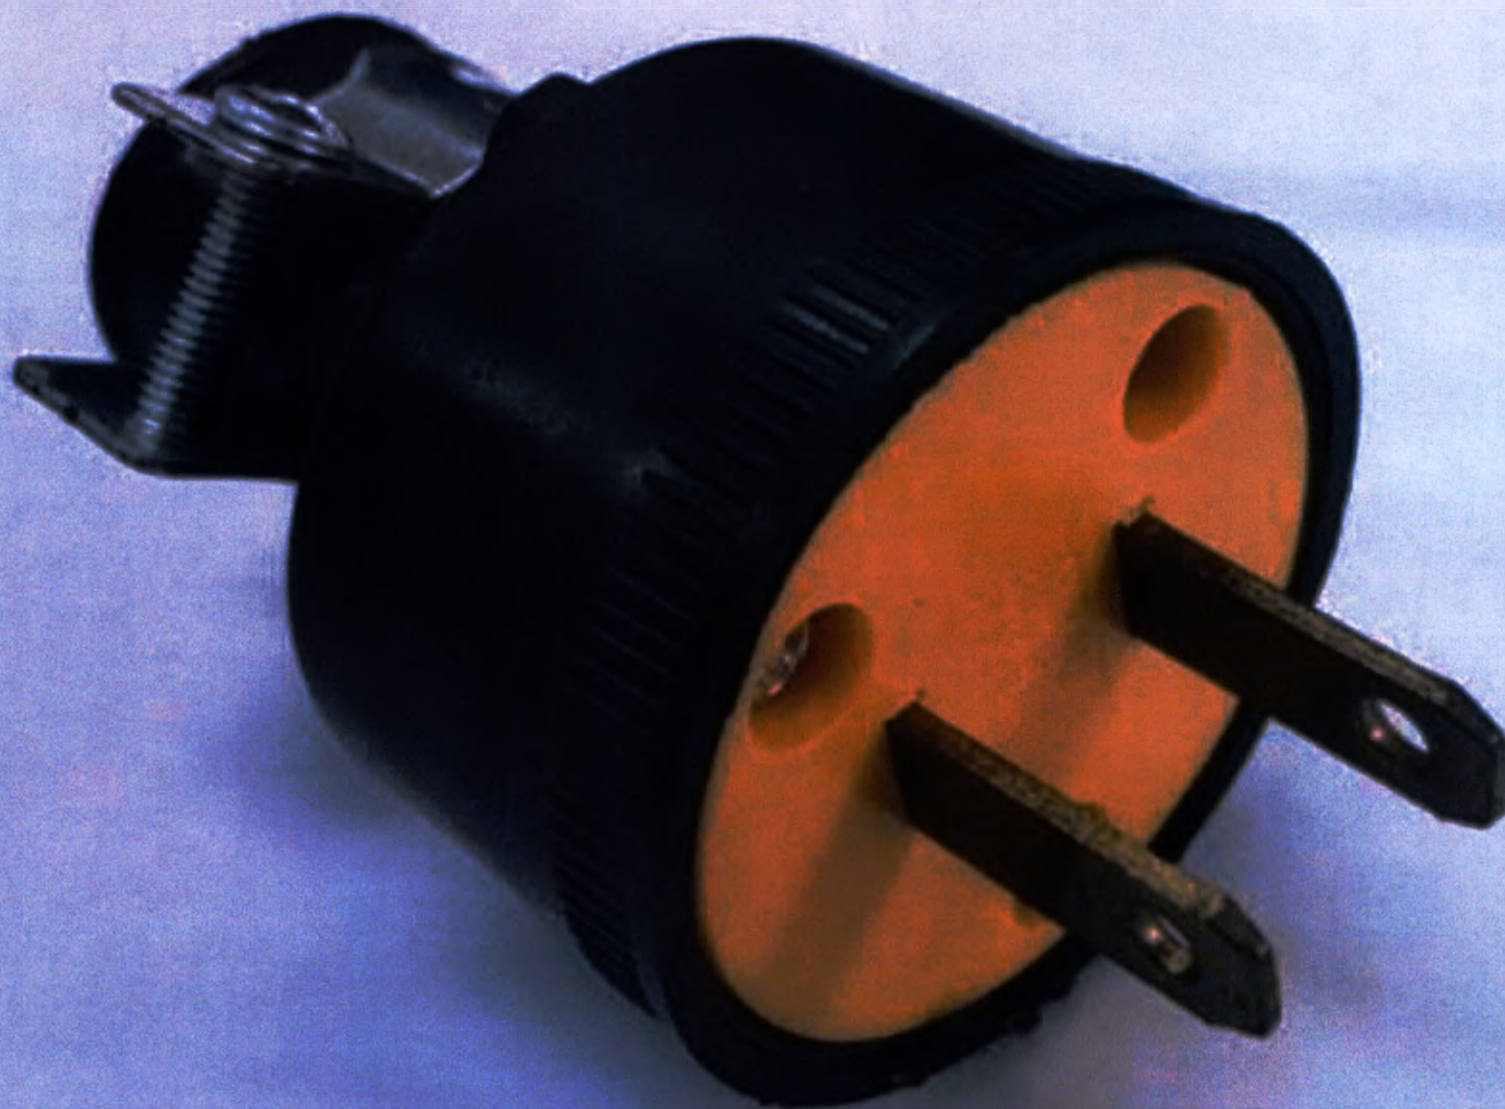

IV. Принадлежности к анализатору автоматическому биохимическому Аиенса СП 550, вариант исполнения 2.

1. Предохранители 15.0A/80V (не более 50 шт.).




2. Предохранители 3.0A/80V (не более 50 шт.).



3. Предохранители 5.0А/80В (не более 5шт.).




4. Предохранители 12.0А/250В (не более 50 шт.).

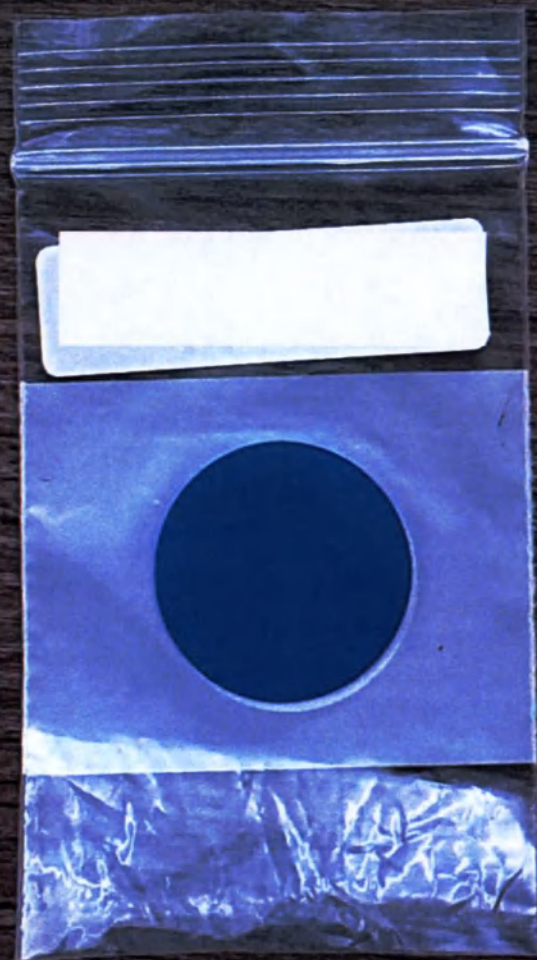


5. Предохранители 10.0A/250В (не более 50 шт.).



6. Предохранители 3.15A/250В (не более 50 шт.).

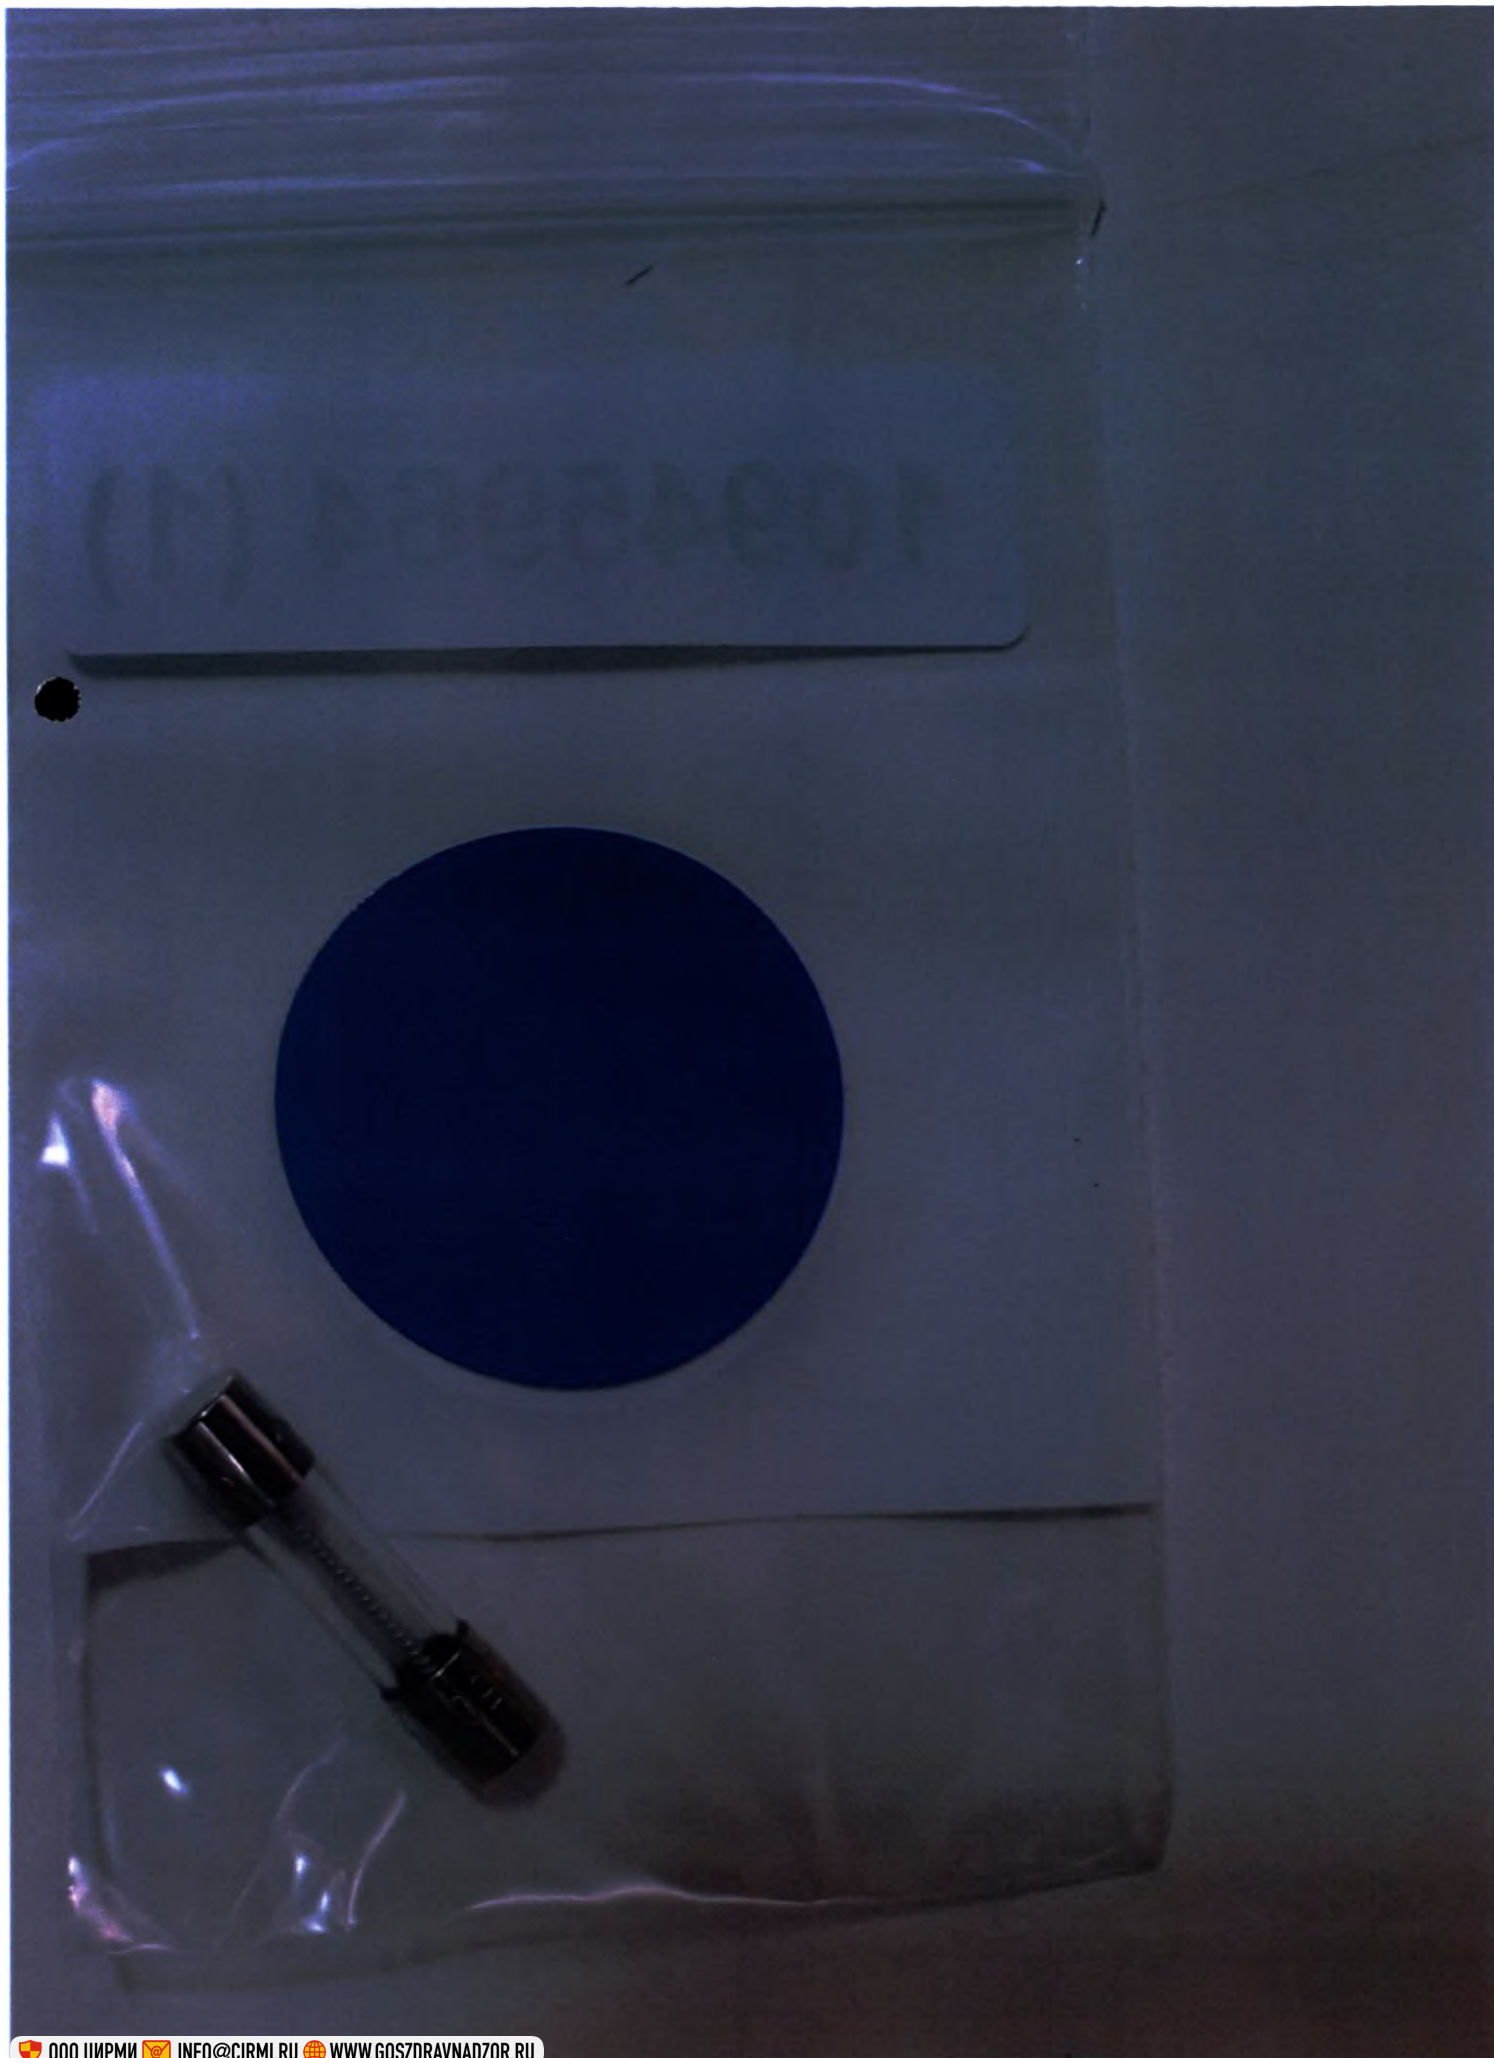

7. Предохранители 8.0А/250В (не более 50 шт.).

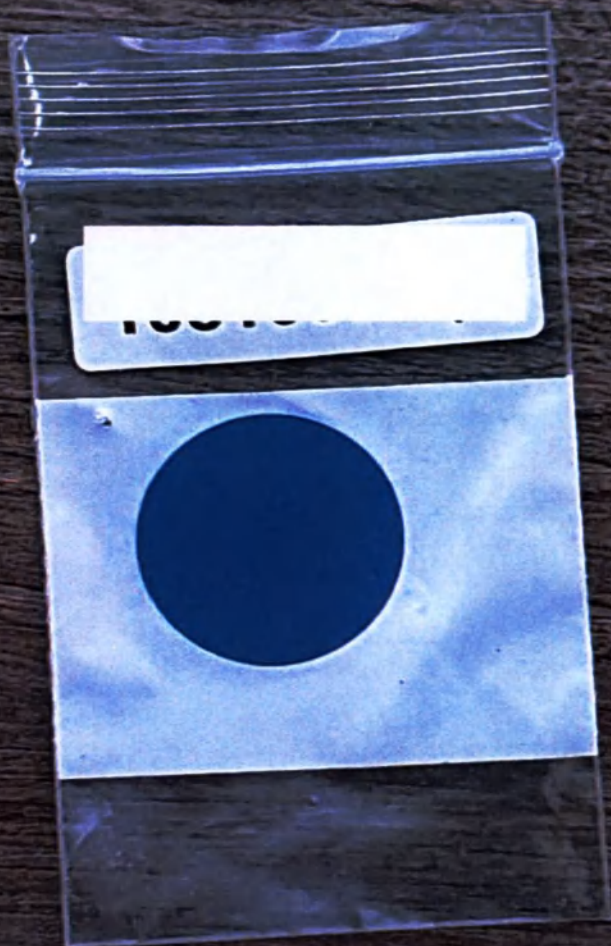



9. Транспортировщики пробирок (не более 50 шт.).



10. Панели фильтра задние (не более 5 шт.)



11. Фильтры воздушные (не более 50 шт.).




12. Средства системные моющие Atellica CH (2 x 1,5 л) > 1000 шт.)



13. Средства — темные кондиционирующие Atellica CH (2 x 1л) (не более 1000 шт.).




14. Средства системные чистящие Atellica CH (2 x 1,5 л) — не более 1000 шт.).

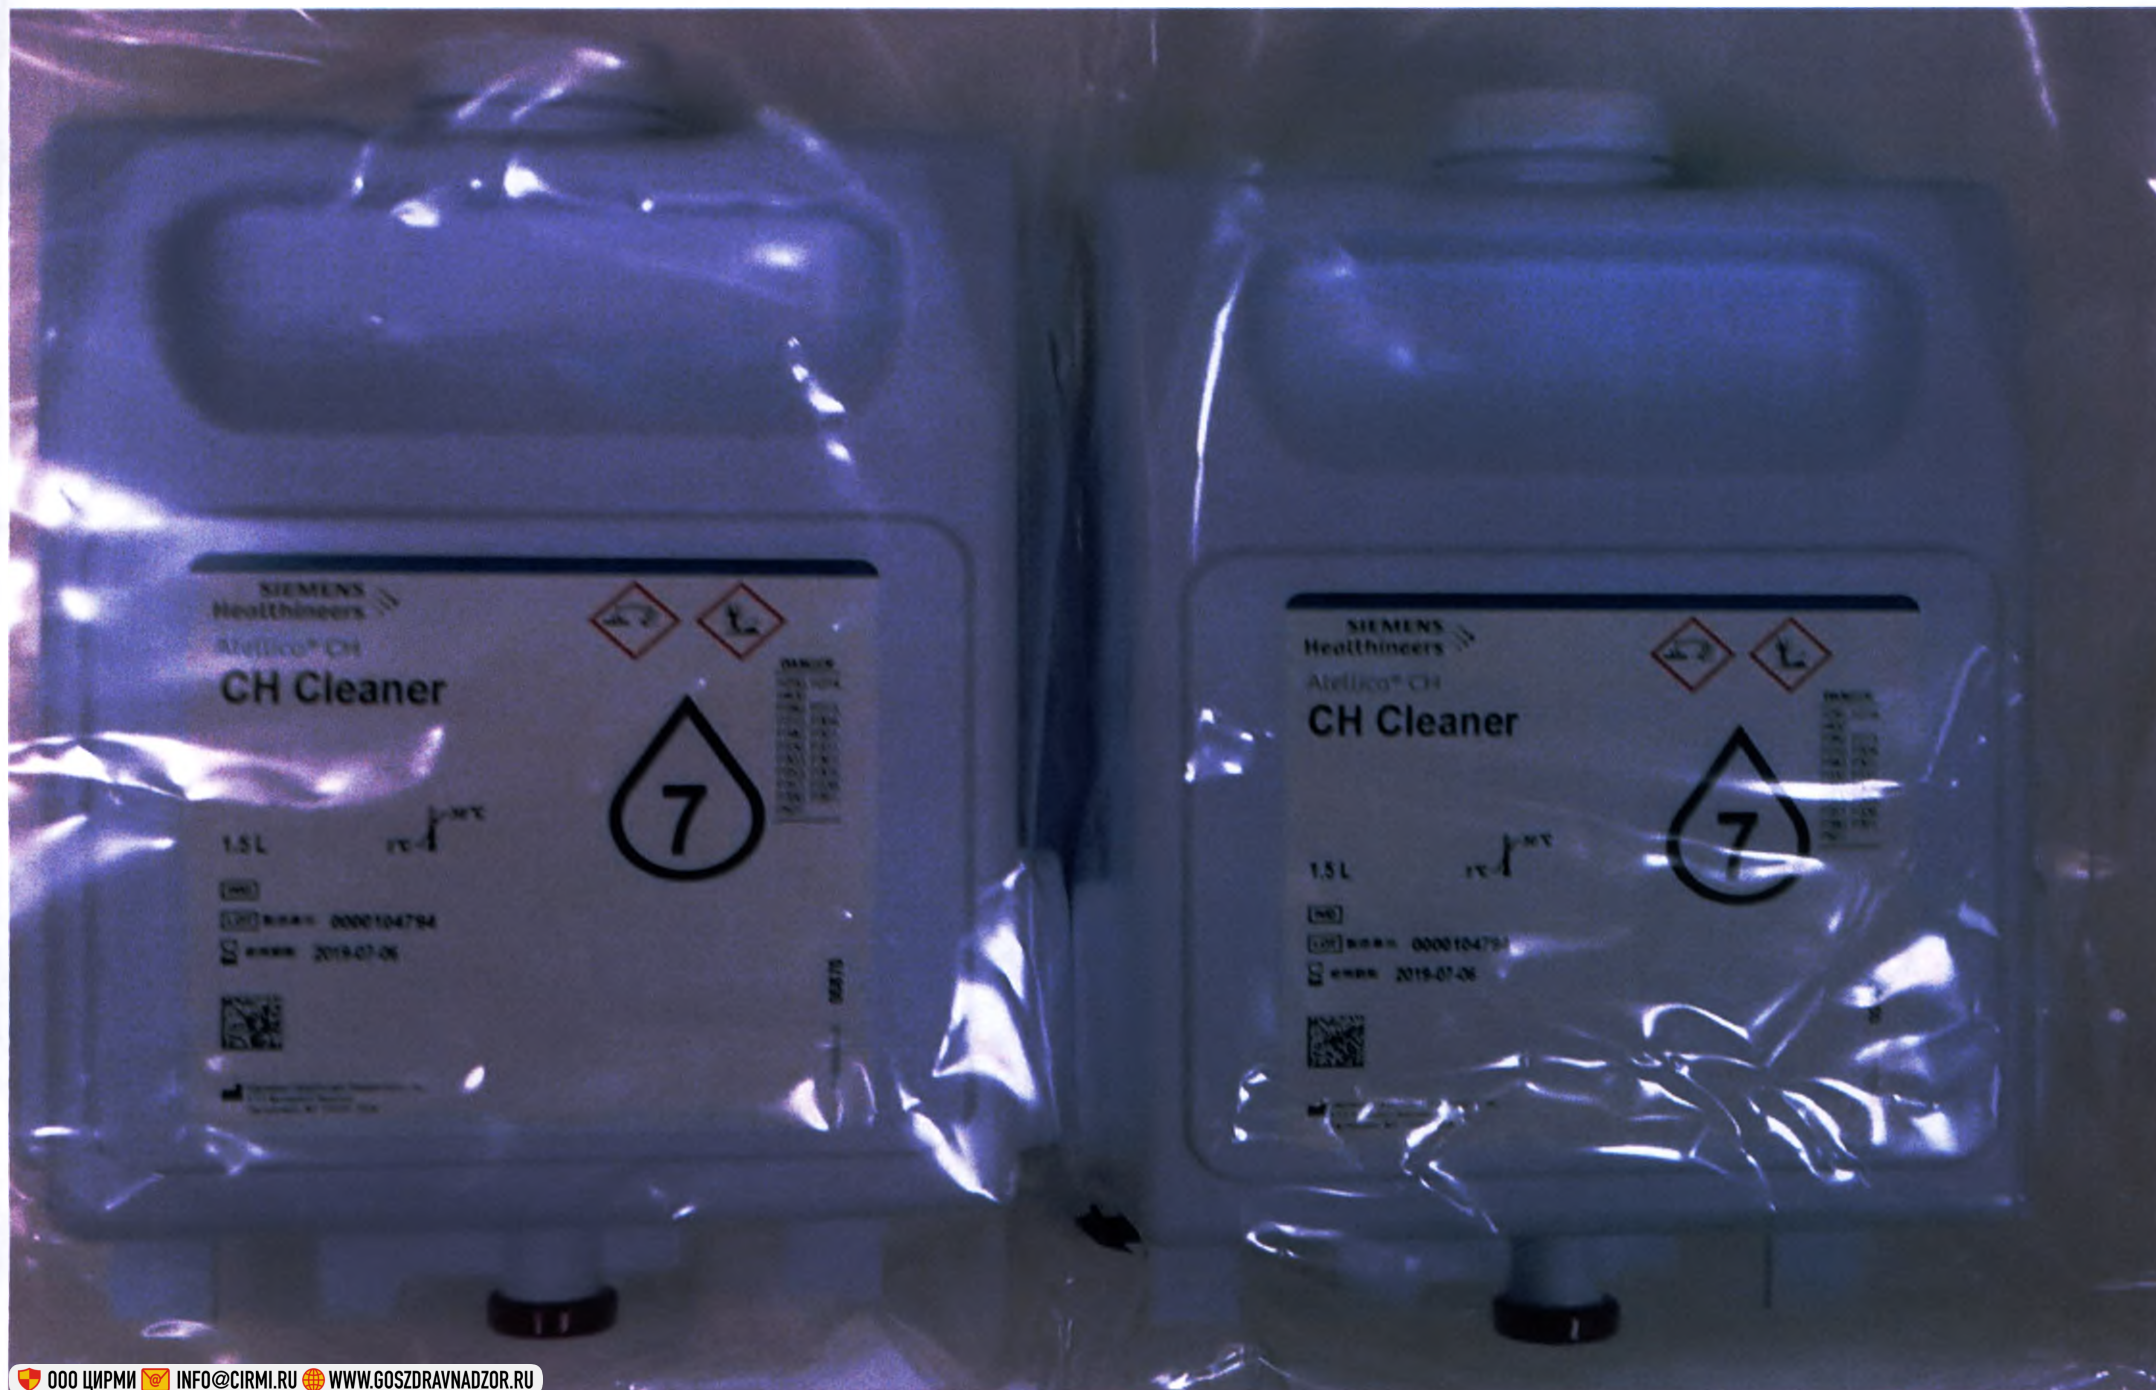

15. Средства емные для разведения Atellica CH (2 x 1,5 л) (более 1000 шт.).




16. Сегменты реакционные (не более 100 уп.)

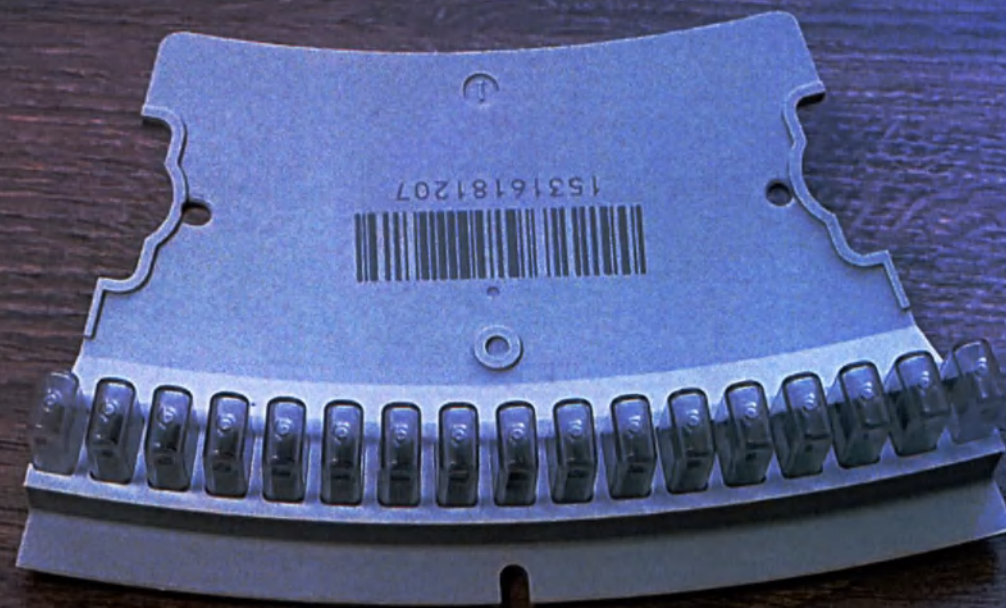

17. Сегменты для разведения (не более 100 у.е.).




18. Средство для рутинной проверки работы узлов анализатора CHK Atellica® CH (8 x 47 мл) (не более 1000 шт.).

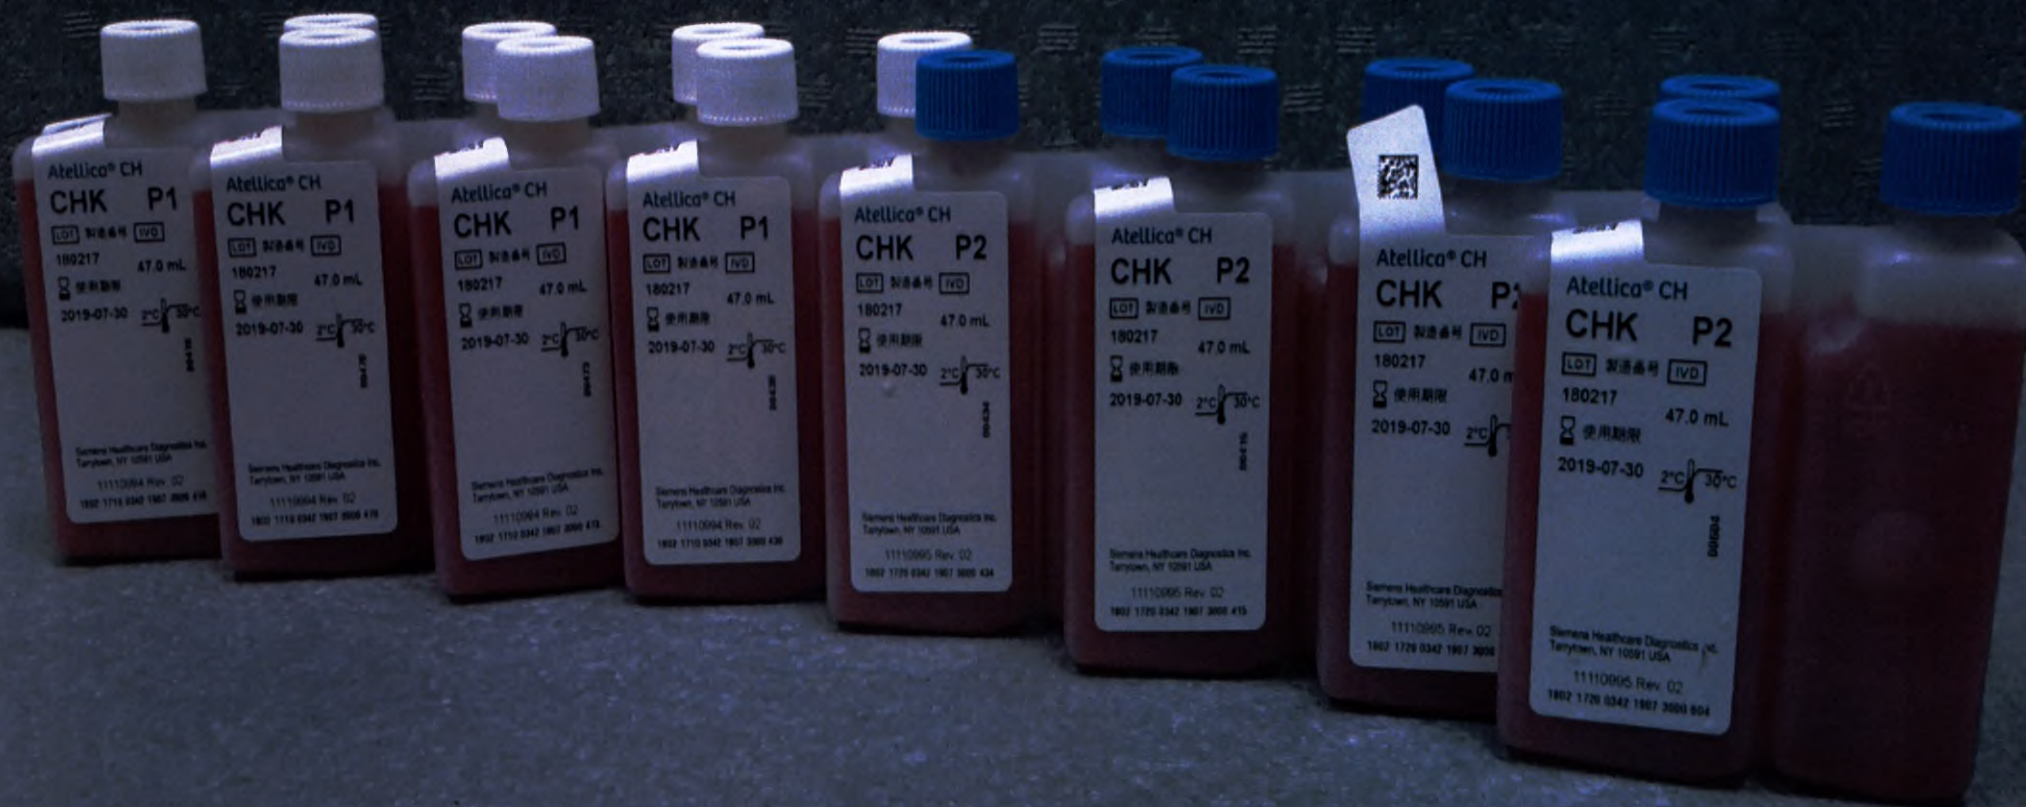

19. Материал инсталляционный AMIX



20. Средства системные для охлаждения галогеновой лампы (1 x 250 мл) (не более 1000 шт.).

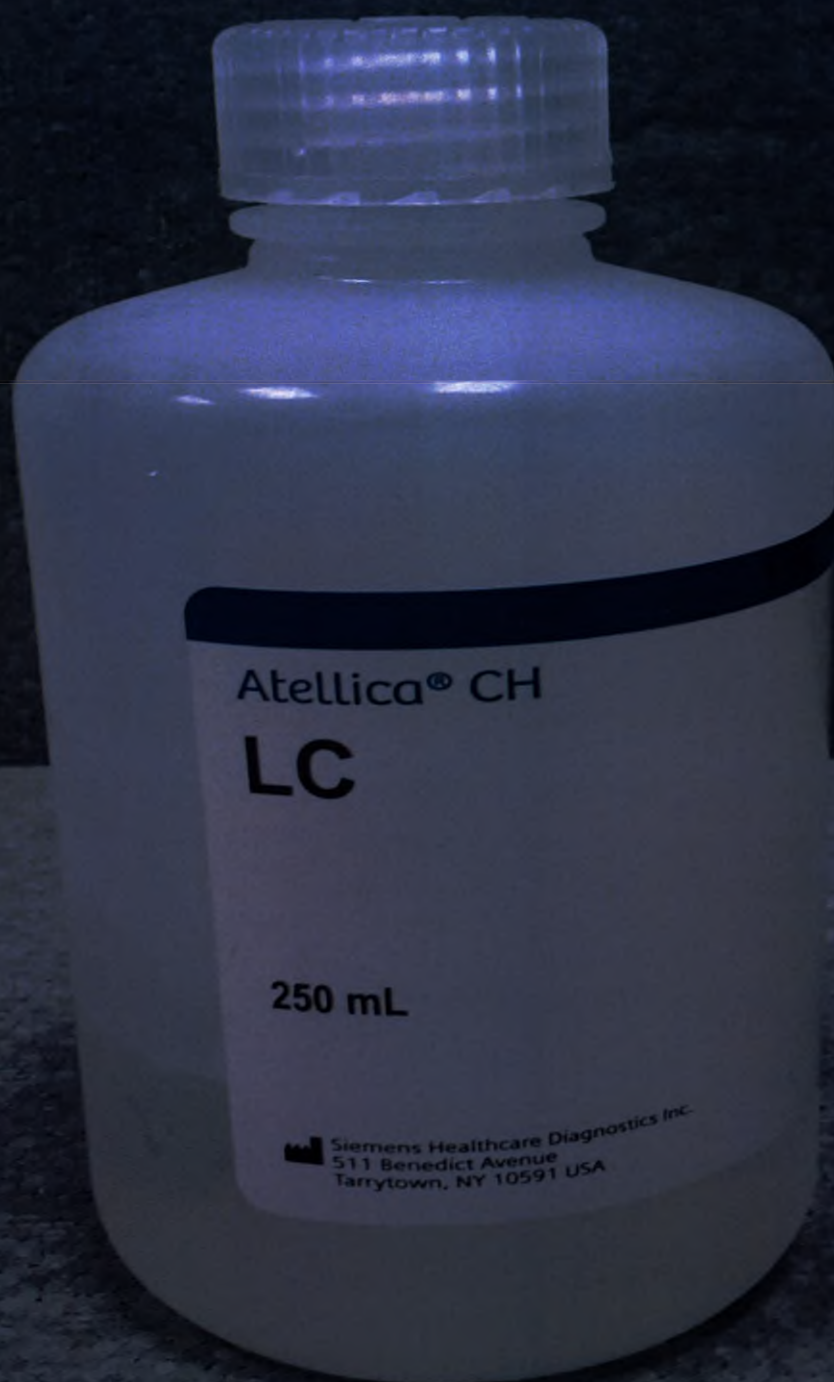


21. Средства —темные для водяной бани Atellica CH (4 x 36,0) (не более 1000 шт.).



22. Средства системные для очистки реактивных зондов, мешалок и «ювели» (не более 1000 шт.),
варианты исполнения:

- Средство очищающее 4 Atellica CH (4x47 мл) и/или



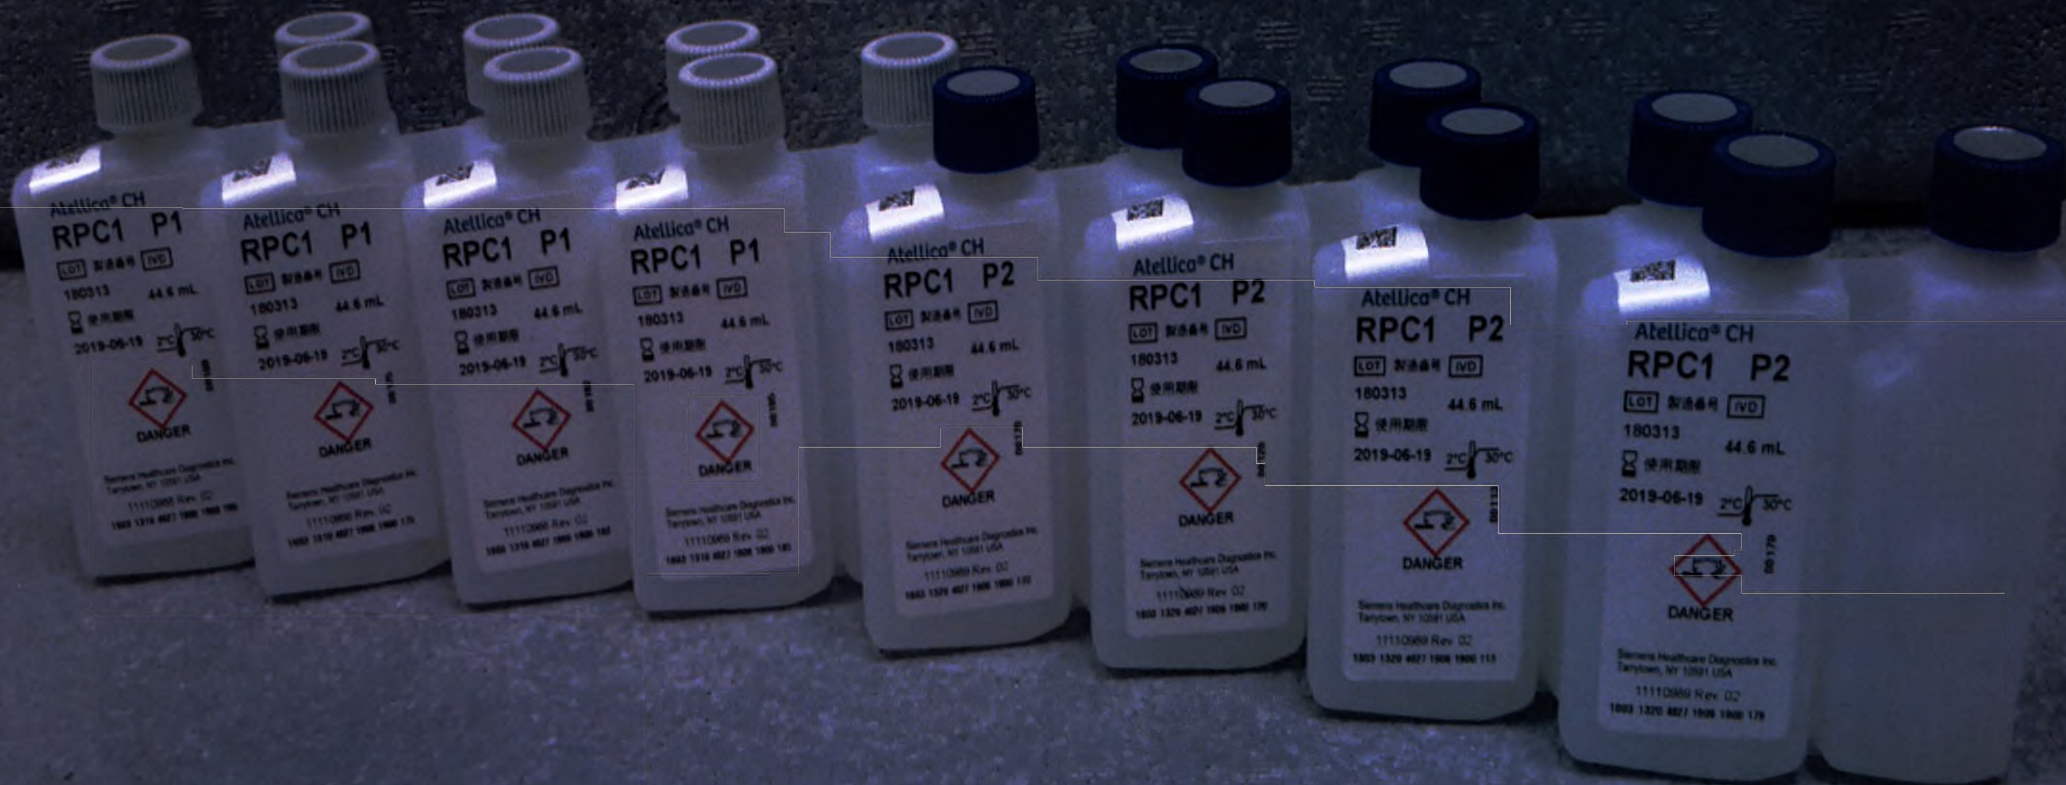

- Средство очищающее 2 Atellica CH (8 x 44,6 мл).




23. Адаптеры для чашечек образцов 1 мл (не более 5 уп.).





25. Набор для системной очистки гидросистемы анализатора и оценки качества воды:
- Средство системное очищающее (2л) (не более 1000 шт.) и/или

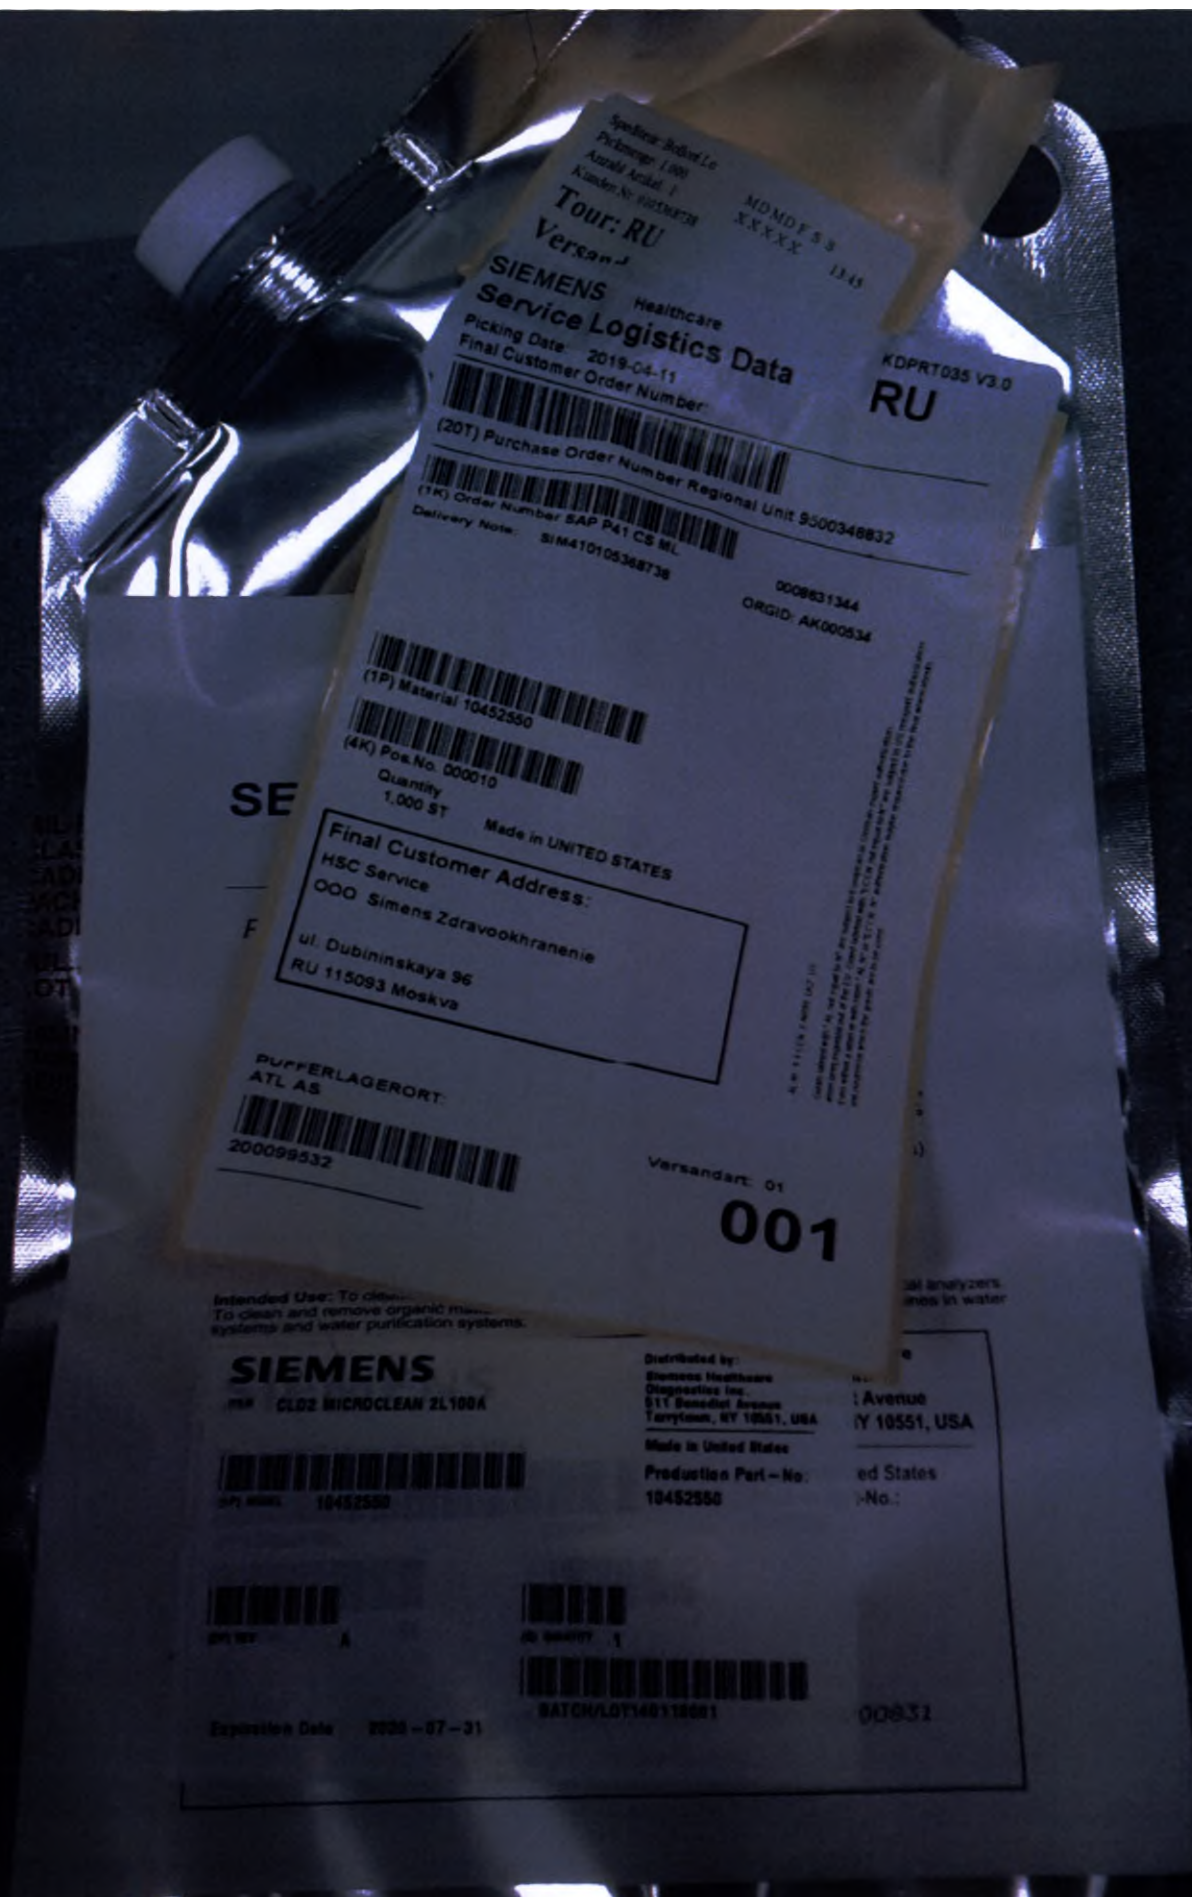

- Полоски индикаторные для оценки качества воды (не более 1000 шт.).



26. Чашечки для образцов 1 мл (не более 5 шт.).



27. Чашечки для образцов 2 мл (не более 3 шт.).



28. Флаконы для реагентов пустые (не более 10 уп.).



30. Принтеры штрих-кодов (не более 2 шт.)



3.1. Этикетки для принтера штрих-кодов (не более 1 уп.).



33. Лента красящая (не более 2 шт.).



37. Адаптеры для пробирок калибраторов и контролей качества (не более 100 шт.).



38. Штативы для образцов серые (не более 50 шт.).



39. Штативы для образцов синие (не более 10 шт.).



40. Штативы для образцов желтые (не более 10 шт.)



41. Штативы для образцов зеленые (не более 10 шт.).



42. Штативы для образцов оранжевые (не более 10 шт.).



43. Штативы для образцов красные (не более 10 шт.).




44. Трубы адаптера штатива для проб длинные (не более 200 шт.).



45. Трубы адаптера штатива для проб короткие (не более 200 шт.).



46. Узлы штепселя с транспортировщиком для массовой загрузки (не более 10 шт.).

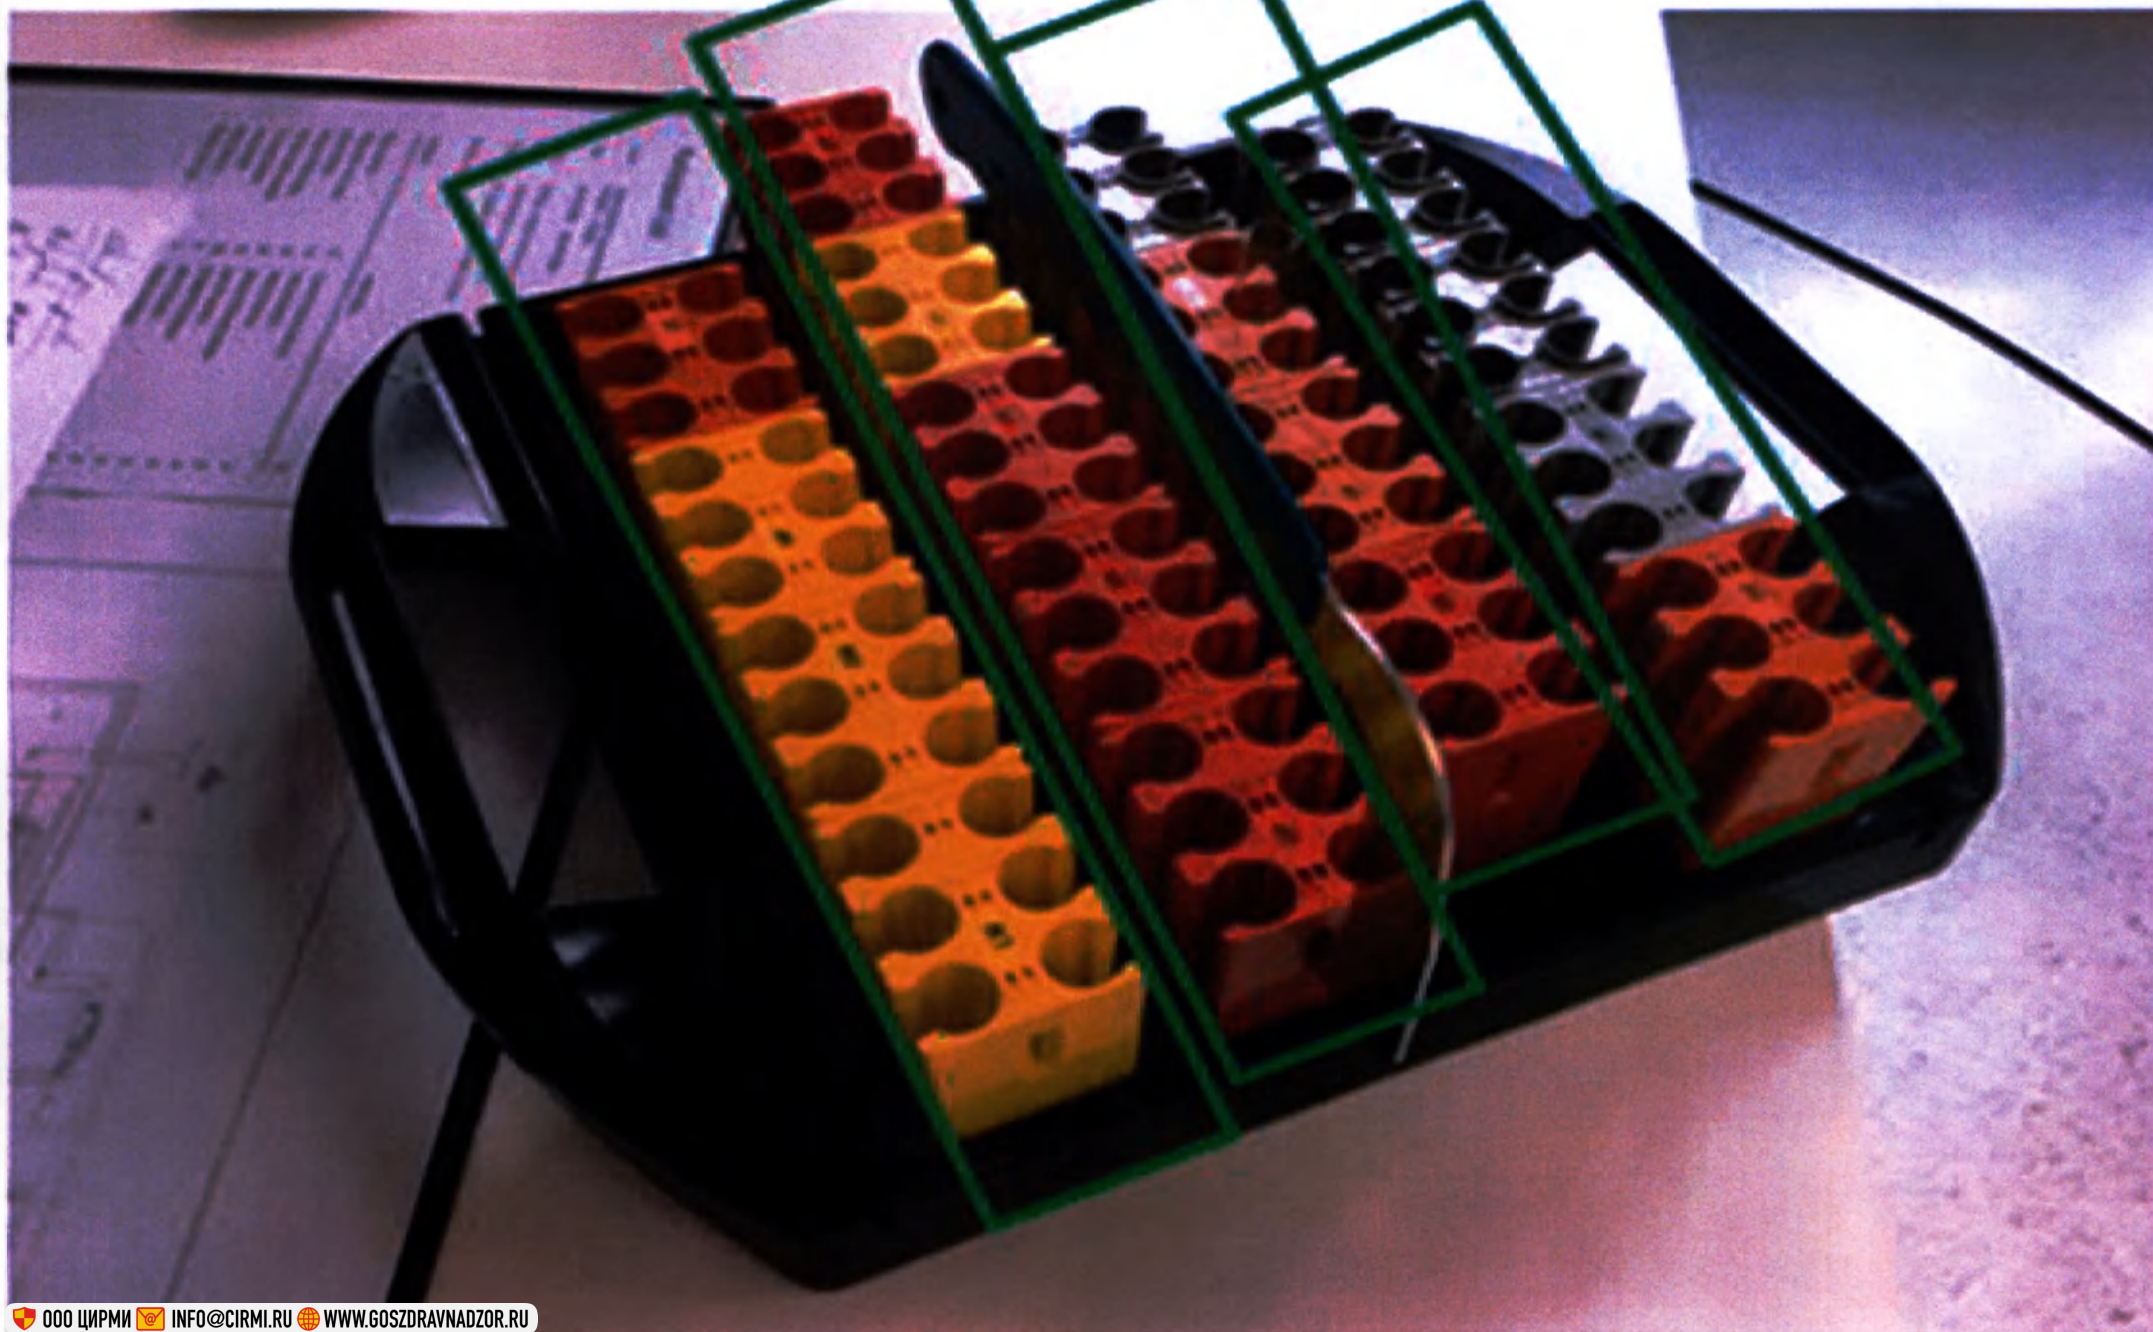

47. Стойки для штативов (не более 2 шт)




48. Штативы для настройки камер (не более 2 шт.).



49. Сканеры штрих-кодов (не более 2 шт.).




50. Доврик для компьютерной мыши специализированный (1 шт.).

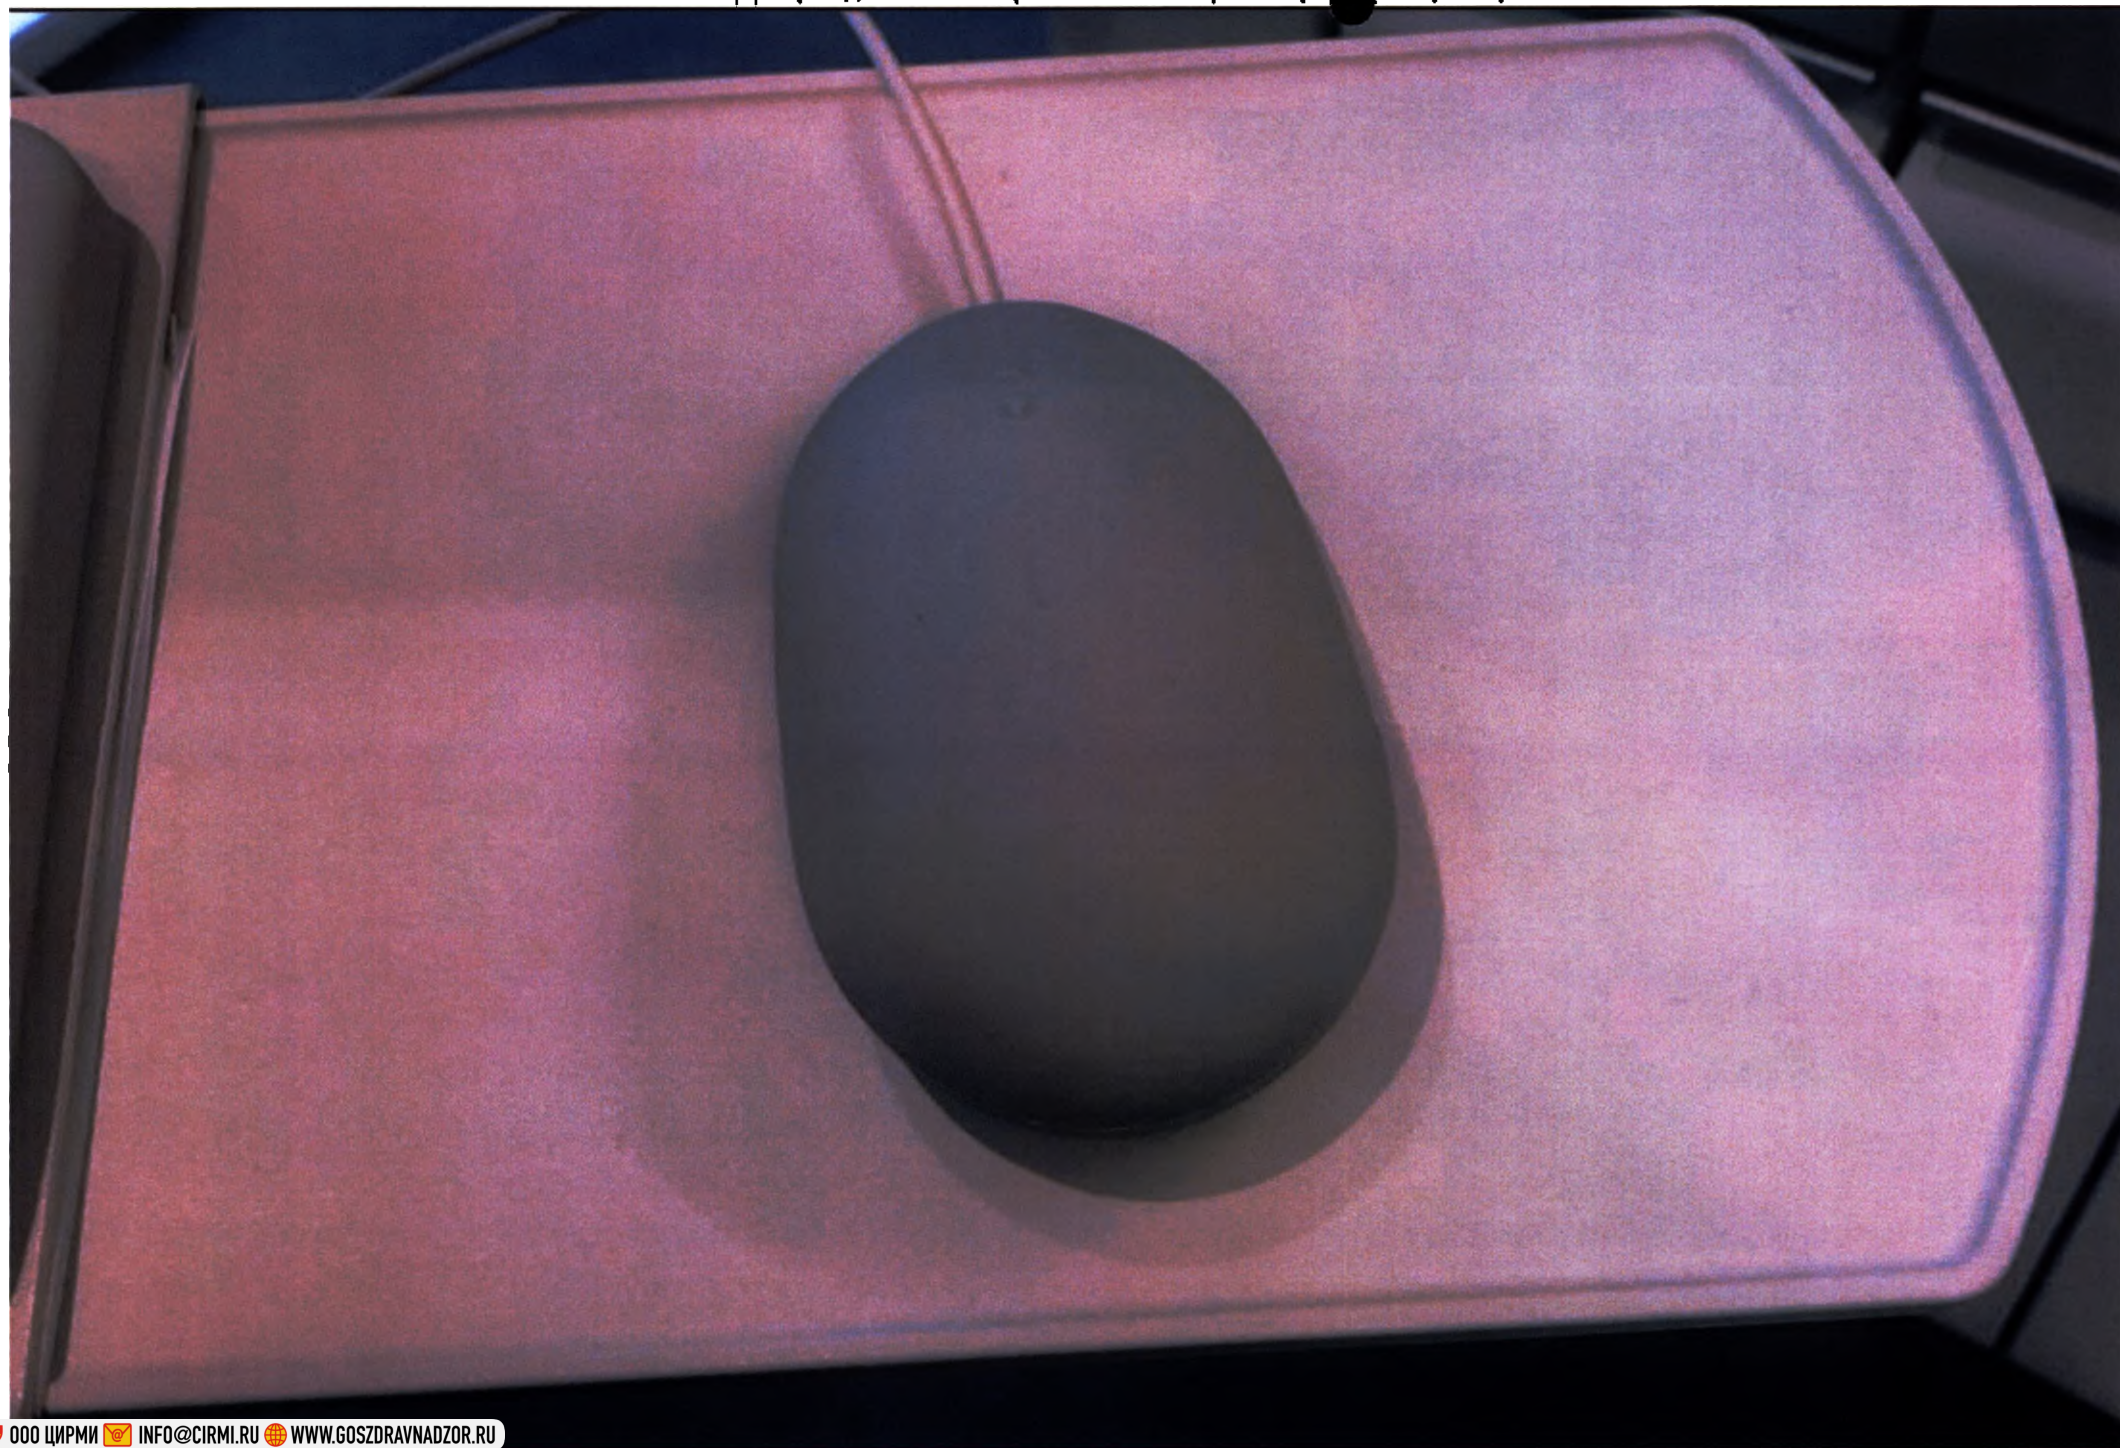

51. Роутеры (не более 2шт.).



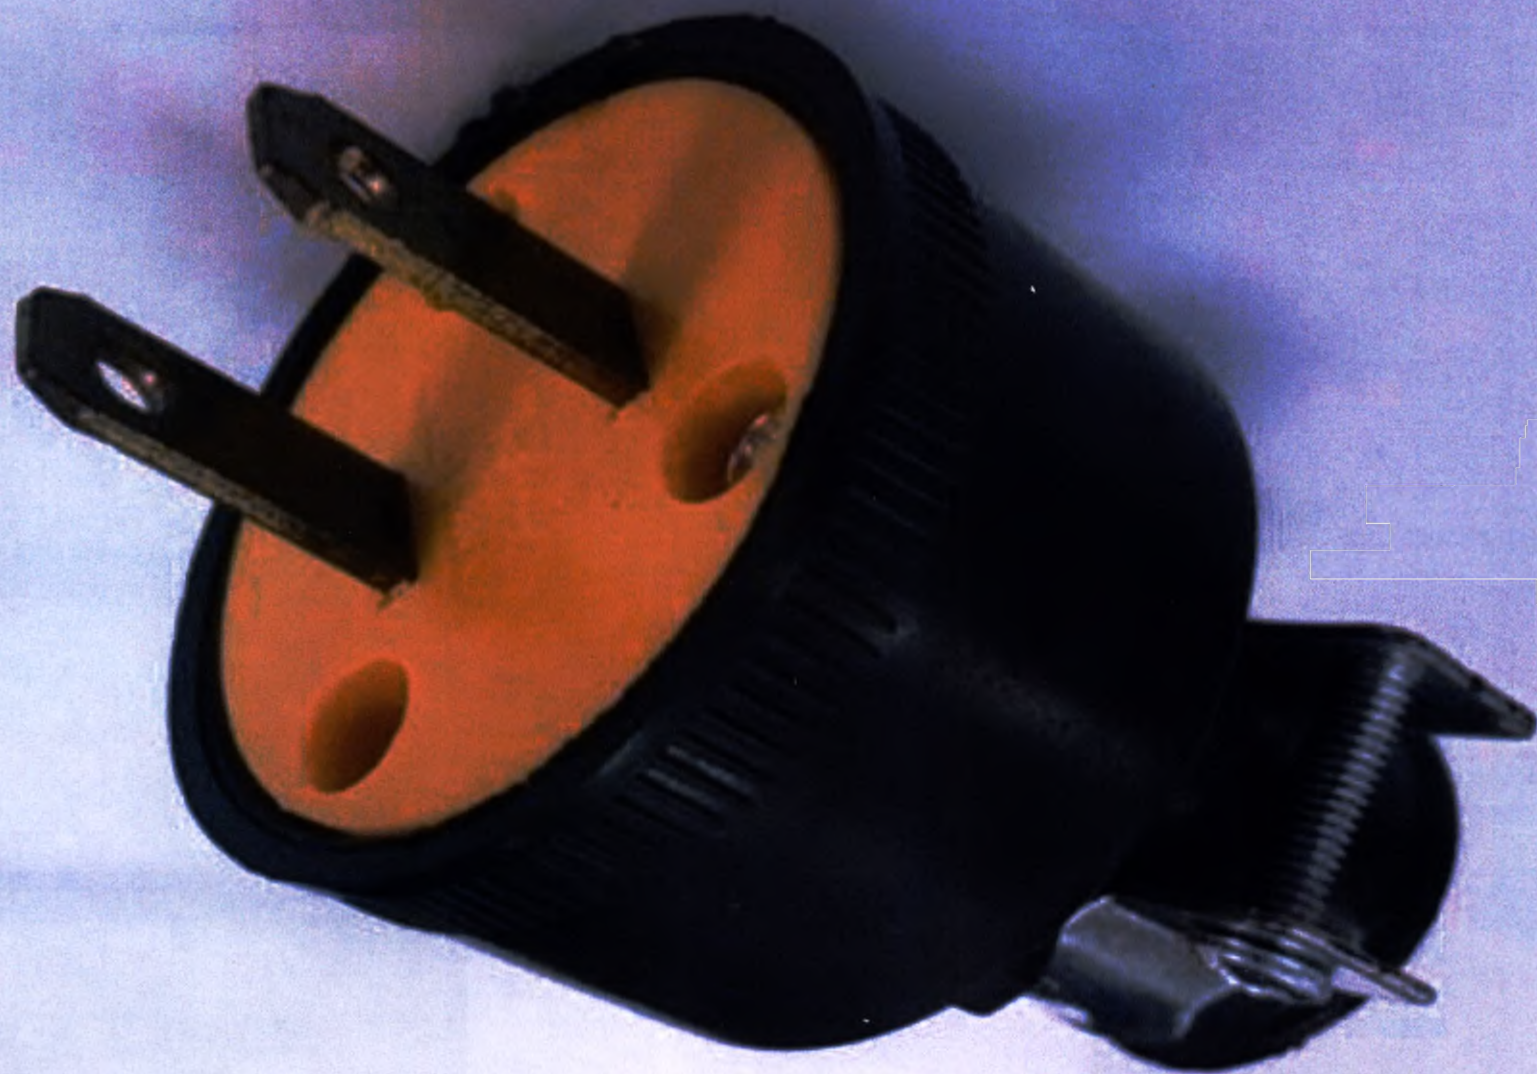

Всего прошито и пронумеровано 131 листа (ов)

ООО «Сиенс Здравоохранение»

