

Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие


**Набор реагентов для количественного определения витамина B12
иммунохемилюми-несцентным методом в сыворотке и плазме крови
человека на иммунохимических анализаторах Alinity i «B12 Реагенты
(Alinity i B12 Reagent Kit)»
(размером не менее 18 x 24 сантиметра)**



INVERSIONS PERFORMED

Alinity i B12 Reagent Kit

 **Abbott**

REF 07P6722  2 x 100 

 www.abbottdiagnostics.com/IFU R01

 Exp. 2020-03-08


 LOT 04213UI00




G7096R01

(01) 00380740131401 (17) 200308
(10) 04213UI00 (240) 07P6722

MICROPARTICLES	2 x 5.4 mL
CONJUGATE	2 x 4.9 mL
ASSAY DILUENT	2 x 8.1 mL
PRE-TREATMENT REAGENT 3	2 x 5.3 mL
PRE-TREATMENT REAGENT 2	2 x 5.3 mL
PRE-TREATMENT REAGENT 1	2 x 48.1 mL



CONTAINS: AZIDE

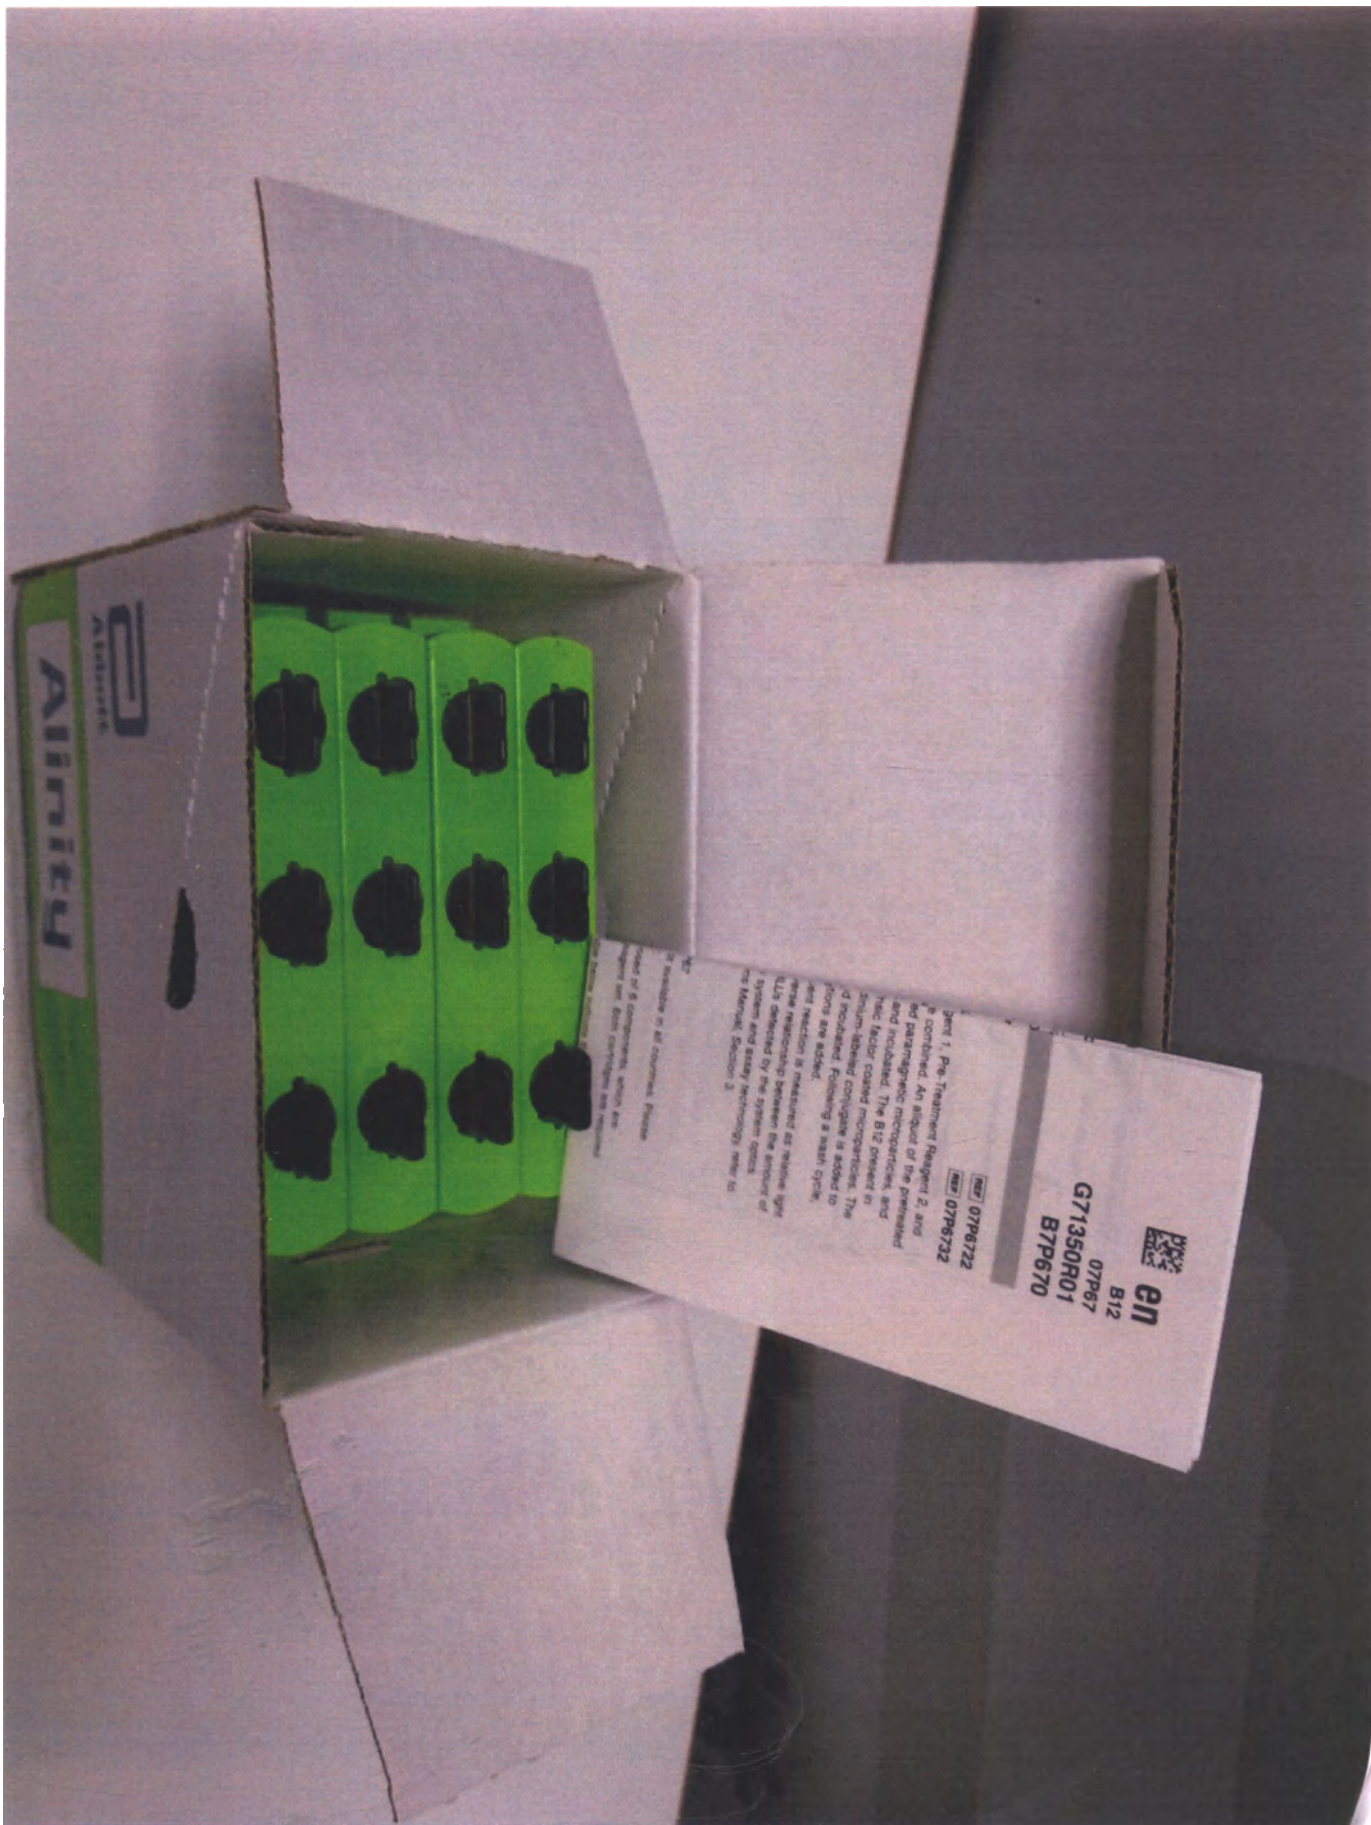








INVERSIONS PERFORMED


Alinity i B12 Reagent Kit



REF 07P6732



2 x 600



www.abbottdiagnostics.com/IFU

R01



Exp. 2020-10-26

LOT

11473UI00



G70998R01

MICROPARTICLES

2 x 24.8 mL

CONJUGATE

2 x 24.3 mL

ASSAY DILUENT

2 x 42.8 mL

PRE-TREATMENT REAGENT 3

2 x 24.8 mL

PRE-TREATMENT REAGENT 2

2 x 24.6 mL


PRE-TREATMENT REAGENT 1

2 x 48.1 mL



CONTAINS: AZIDE

(01) 00380740131418 (17) 201026
(10) 11473UI00 (240) 07P6732

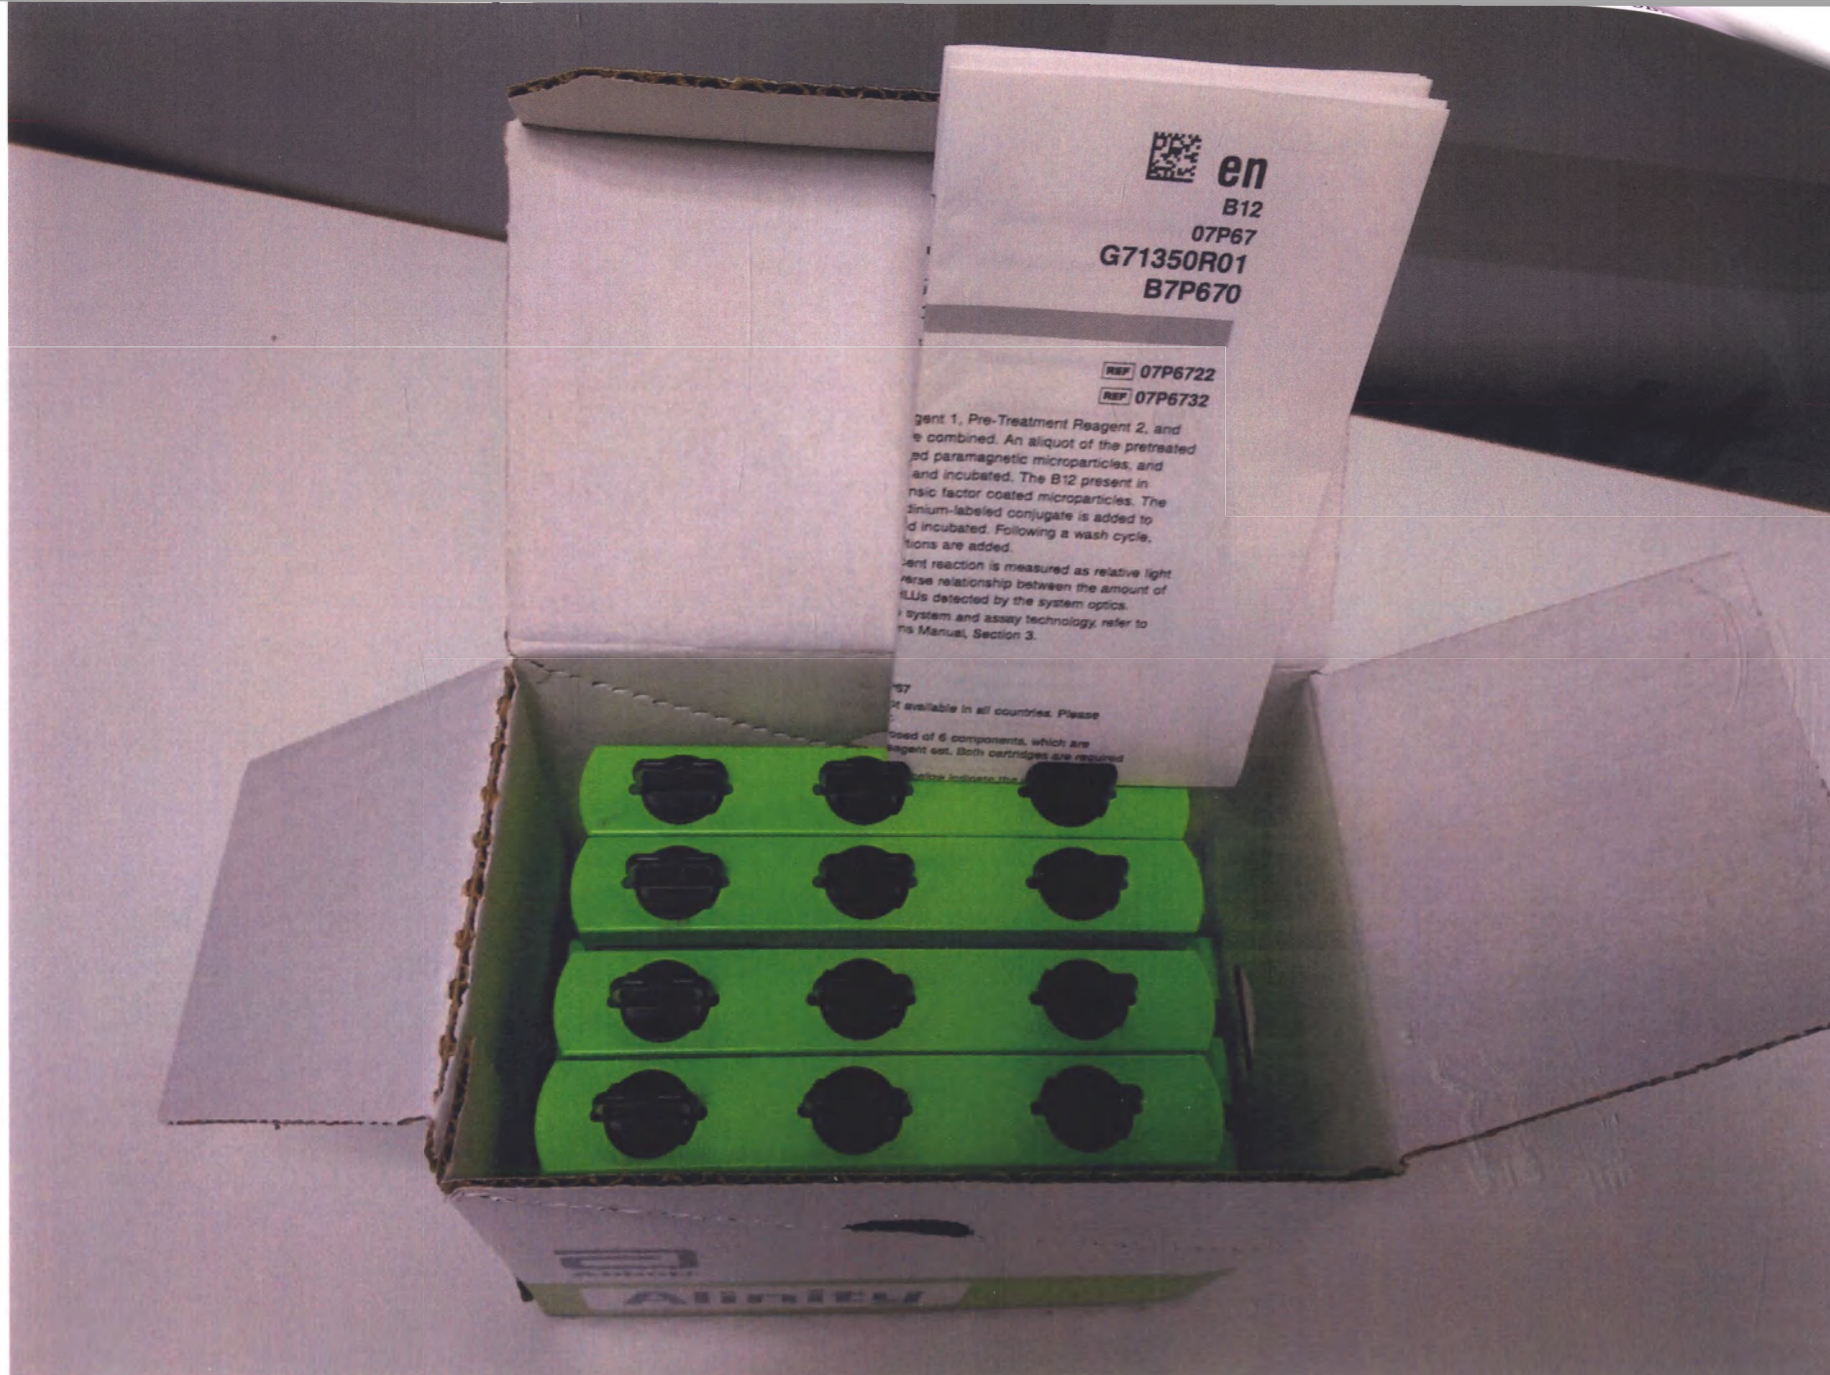









Макет маркировки на медицинское изделие

**Набор реагентов для количественного определения витамина B12
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови
человека на иммунохимических анализаторах Alinity i "B12
Реагенты (Alinity i B12 Reagent Kit)"**



REF

07P67-22

IVD



Набор реагентов для количественного определения витамина B12
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на
иммунохимических анализаторах Alinity i "B12 Реагенты (Alinity i B12 Reagent Kit)"

«B12 Реагенты (Alinity i B12 Reagent Kit)»

2 комплекта по 2 картриджа на 100 тестов в составе:

1. Картридж 1/2

- Микрочастицы (Alinity i B12 Microparticles) – 2 x 5,4 мл
- Конъюгат (Alinity i B12 Conjugate) – 2 x 4,9 мл
- Дилуент теста (Alinity i B12 Assay Diluent) – 2 x 8,1 мл

2. Картридж 2/2

- Реагент предварительной обработки 1 (Alinity i B12 Pre-Treatment Reagent 1) - 2 x 48,1 мл
- Реагент предварительной обработки 2 (Alinity i B12 Pre-Treatment Reagent 2) - 2 x 5,3 мл
- Реагент предварительной обработки 3 (Alinity i B12 Pre-Treatment Reagent 3) - 2 x 5,3 мл

3. Инструкция по применению

Производитель: Abbott Ireland Diagnostics Division Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland (Ирландия)

РУ № _____ / _____ от _____ / Инструкция по применению на русском языке:
www.abbottdiagnostics.com/IFU/

Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,

Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

B12

Alinity i B12 Reagent Kit

Abbott



Abbott Ireland
Diagnostics Division
Lisnamuck, Longford
Co. Longford
Ireland
+353-43-3331000



REF 07P6722

2 x 100

www.abbottdiagnostics.com/IFU

G70995R01

MICROPARTICLES	2 x	5.4 mL
CONJUGATE	2 x	4.9 mL
ASSAY DILUENT	2 x	8.1 mL
PRE-TREATMENT REAGENT 3	2 x	5.3 mL
PRE-TREATMENT REAGENT 2	2 x	5.3 mL
PRE-TREATMENT REAGENT 1	2 x	48.1 mL



CONTAINS: AZIDE

PRODUCT OF IRELAND

Картридж 1/2



MICROPARTICLES

5.4 mL



G71000R01



ABBOTT
AIDD Longford, Ireland

Alinity i

CONJUGATE

4.9 mL



G71002R01

SN

B12

1/2

ASSAY DILUENT

07P67

IVD

8.1 mL



G71004R01



LOT

Abbott




PRE-TREATMENT REAGENT 3

5.3 mL



CONTAINS: AZIDE

G71010R01



ABBOTT
AIDD Longford, Ireland



PRE-TREATMENT REAGENT 2

5.3 mL



G71008R01

SN

B12

2/2

PRE-TREATMENT REAGENT 1 07P67

IVD

48.1 mL



G71006R01



LOT

 Abbott



REF 07P67-32

IVD



Набор реагентов для количественного определения витамина B12
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на
иммунохимических анализаторах Alinity i "B12 Реагенты (Alinity i B12 Reagent Kit)"

«B12 Реагенты (Alinity i B12 Reagent Kit)»

2 комплекта по 2 картриджа на 600 тестов в составе:

1. Картридж 1/2

- Микрочастицы (Alinity i B12 Microparticles) – 2 x 24,8 мл
- Конъюгат (Alinity i B12 Conjugate) – 2 x 24,3 мл
- Дилуент теста (Alinity i B12 Assay Diluent) – 2 x 42,8 мл

2. Картридж 2/2

- Реагент предварительной обработки 1 (Alinity i B12 Pre-Treatment Reagent 1) - 2 x 48,1 мл
- Реагент предварительной обработки 2 (Alinity i B12 Pre-Treatment Reagent 2) - 2 x 24,6 мл
- Реагент предварительной обработки 3 (Alinity i B12 Pre-Treatment Reagent 3) - 2 x 24,8 мл

3. Инструкция по применению

Производитель: Abbott Ireland Diagnostics Division Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland (Ирландия)

РУ № _____ / _____ от _____ / Инструкция по применению на русском языке:
www.abbottdiagnostics.com/IFU/

Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:
Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва,
Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,

Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

B12

Alinity i B12 Reagent Kit

Abbott



Abbott Ireland
Diagnostics Division
Lisnamuck, Longford
Co. Longford
Ireland
+353-43-3331000



PRODUCT OF IRELAND



REF 07P6732 2 x 600

www.abbottdiagnostics.com/IFU


G70998R01

MICROPARTICLES	2 x 24.8 mL
CONJUGATE	2 x 24.3 mL
ASSAY DILUENT	2 x 42.8 mL
PRE-TREATMENT REAGENT 3	2 x 24.8 mL
PRE-TREATMENT REAGENT 2	2 x 24.6 mL
PRE-TREATMENT REAGENT 1	2 x 48.1 mL



CONTAINS: AZIDE

Картридж 1/2		
 MICROPARTICLES 24.8 mL  G71001R01  ABBOTT AIDD Longford, Ireland	 CONJUGATE 24.3 mL  G71003R01 SN	B12 1/2 ASSAY DILUENT 42.8 mL  G71005R01  Exp. LOT 

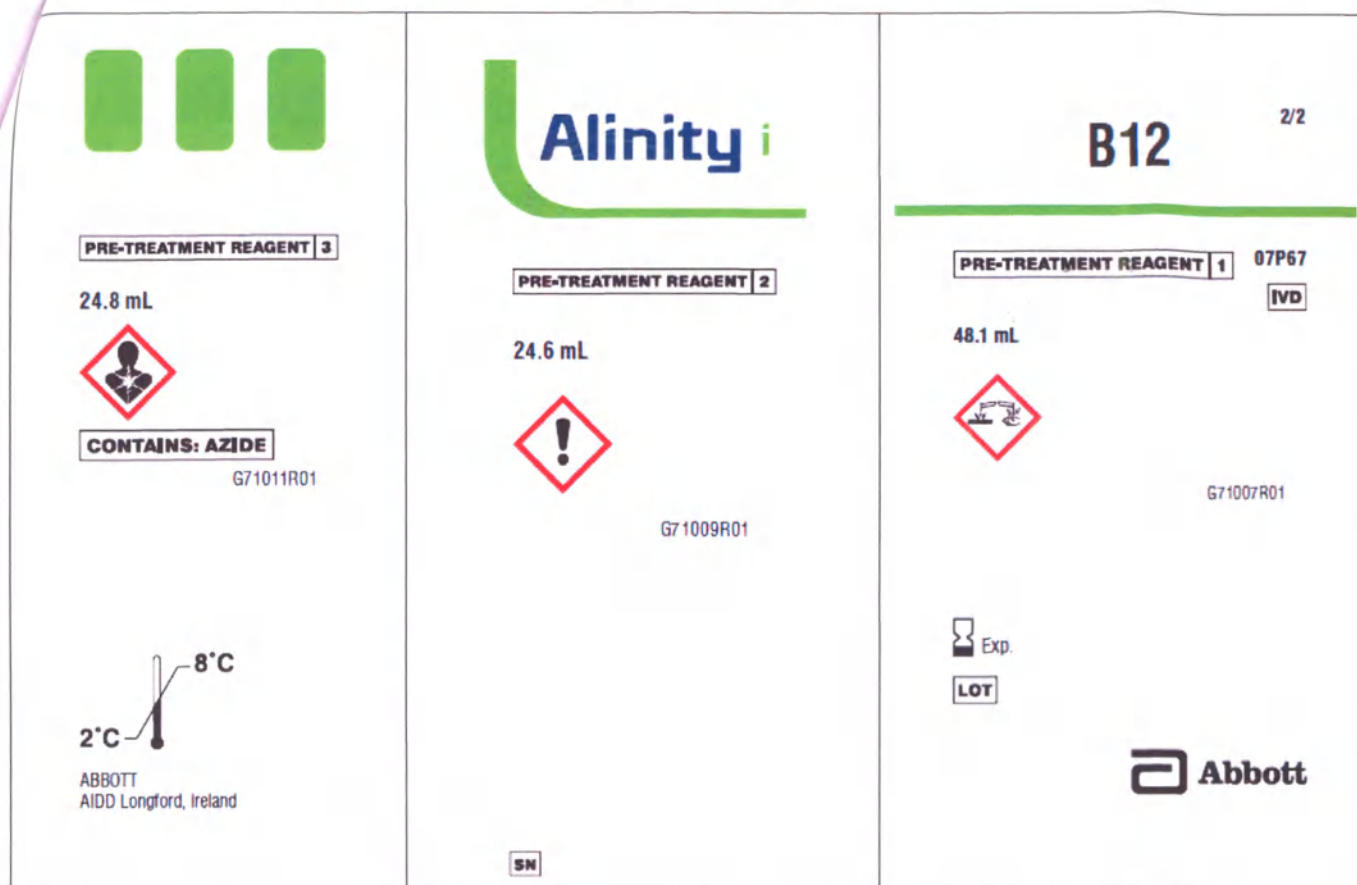

Сведения о стандартах, применяемых к этикетке на МИ:

Стандарт	Наименование стандарта
ГОСТ Р ИСО 18113-1 – 2015	Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> – Информация, предоставляемая производителем (маркировка). Часть 1. Термины, определения и общие требования
ГОСТ Р ИСО 18113-2 – 2015	Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> – Информация, предоставляемая производителем (маркировка). Часть 2. Реагенты для диагностики <i>in vitro</i> для профессионального применения
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования

Расшифровка символов представлена в инструкции по применению.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
_____ листов

Подпись _____

