

Для проведения Анализов In vitro - набор 10 тестов

Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для
качественного определения иммуноглобулинов I
и иммуноглобулинов МВ и/или сердечного тропонина I
в образцах сыворотки (плазмы) или цельной крови
человека

Био Трейсер Кардиотест 3 в 1

Назначение: при температуре 20-30 °С. На анализовый материал

Исходный материал

Состав: 1 шт

Срок годности: 10 лет

Срок хранения: 10 лет

Срок годности: 10 лет

Срок хранения: 10 лет

Срок годности: 10 лет

Срок хранения: 10 лет

Срок годности: 10 лет

Срок хранения: 10 лет

Срок годности: 10 лет

Срок хранения: 10 лет

Срок годности: 10 лет

Срок хранения: 10 лет

Срок годности: 10 лет

Срок хранения: 10 лет

Срок годности: 10 лет

Срок хранения: 10 лет

Срок годности: 10 лет

Срок хранения: 10 лет

Срок годности: 10 лет

Срок хранения: 10 лет

Срок годности: 10 лет

Срок хранения: 10 лет

Срок годности: 10 лет

Срок хранения: 10 лет

Срок годности: 10 лет

Срок хранения: 10 лет

Срок годности: 10 лет

Срок хранения: 10 лет

Срок годности: 10 лет

Срок хранения: 10 лет

Срок годности: 10 лет

Срок хранения: 10 лет

Срок годности: 10 лет

Срок хранения: 10 лет

Срок годности: 10 лет

Срок хранения: 10 лет

Срок годности: 10 лет

Срок хранения: 10 лет

Срок годности: 10 лет

Срок хранения: 10 лет

Срок годности: 10 лет

Срок хранения: 10 лет

Срок годности: 10 лет

Срок хранения: 10 лет

Срок годности: 10 лет

Срок хранения: 10 лет

Срок годности: 10 лет

Срок хранения: 10 лет

Срок годности: 10 лет

Срок хранения: 10 лет

Срок годности: 10 лет

Срок хранения: 10 лет

Срок годности: 10 лет

Срок хранения: 10 лет

Срок годности: 10 лет

Срок хранения: 10 лет

Срок годности: 10 лет

Срок хранения: 10 лет

Срок годности: 10 лет

Срок хранения: 10 лет

Срок годности: 10 лет

Срок хранения: 10 лет

Срок годности: 10 лет

Срок хранения: 10 лет

Срок годности: 10 лет

Срок хранения: 10 лет

Срок годности: 10 лет

Срок хранения: 10 лет

Срок годности: 10 лет

Срок хранения: 10 лет

Срок годности: 10 лет

Срок хранения: 10 лет

Срок годности: 10 лет

Срок хранения: 10 лет

Био Трейсер Кардиотест 3 в 1

Для проведения Анализов In vitro - набор 10 тестов

Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для
качественного определения иммуноглобулинов I, иммуноглобулинов МВ и/или сердечного тропонина I
в образцах сыворотки (плазмы) или цельной крови
человека

Назначение: при температуре 20-30 °С. На анализовый материал


Исходный материал

Состав: 1 шт

Срок годности: 10 лет

Срок хранения: 10 лет

Срок годности: 10 лет

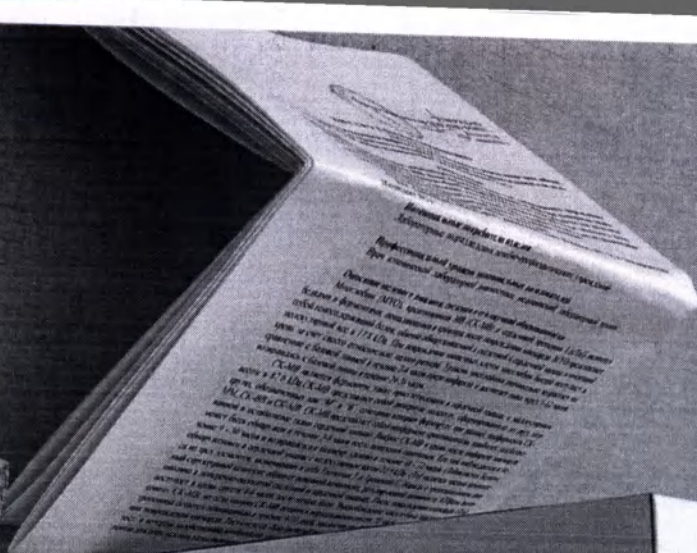

Для проведения диагностики in vitro - набор 10 тестов

Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения микробина, креатининазы MB и/или сердечного тропонина I в образцах сыворотки (плазмы) или цельной крови человека

Био Трейсер Кардиотест 3 в 1

Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения микробина, креатининазы MB и/или сердечного тропонина I в образцах сыворотки (плазмы) или цельной крови человека

Состав: 10 шт.
Формат: 10 шт. в упаковке
Срок годности: 12 мес.
Дата выпуска: 01.2019
Дата окончания: 01.2021

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОСИС»
17.21.20.23-003.15569000-2019


ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОСИС»
17.21.20.23-003.15569000-2019

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОСИС»
17.21.20.23-003.15569000-2019

Био Трейсер Кардиотест 3 в 1

Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения микробина, креатининазы MB и/или сердечного тропонина I в образцах сыворотки (плазмы) или цельной крови человека

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОСИС»
17.21.20.23-003.15569000-2019

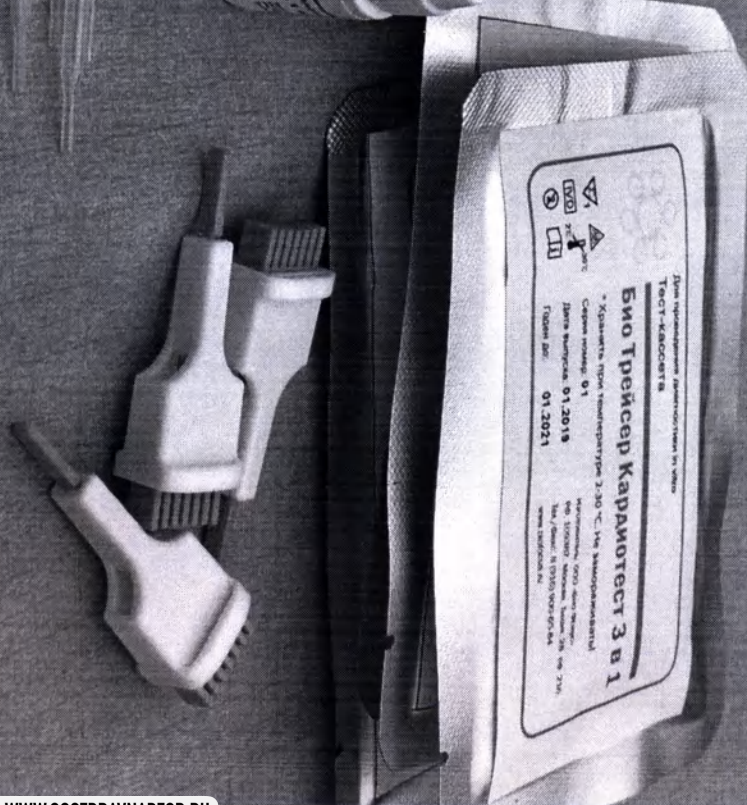



6818
25.08.2020

Инструкция по применению
 Для проведения диагностики in vitro - набор 10 тестов
 Набор реагентов
 Тест-система иммунохроматографическая для
 качественного определения миоглобина,
 креатинкиназы MB и/или сердечного тропонина I
 в образцах сыворотки (плазмы) или цельной крови
 человека

Хранить при температуре 2-30°C. Не замораживать!
 Пожароопасно, содержание интоксикантов пограничного периода использования

Код продукта №1

Состав:
 - тест-кассеты: 10 шт
 - флакон сывороточный полимерный в комплекте с крышкой нависающей и
 флакон сывороточный, содержащий буферный раствор: 3 шт
 - картриджная палочка для образца: 10 шт
 - ланцет-скарификатор: 10 шт
 - салфетки стерильные: 20 шт
 - инструкция по применению: 1 шт

Серия номер: 03
 Дата выпуска: 01.2019
 Годен до: 01.2021

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «БИО ФОРУМ»
 109387, Москва, Тимяк, 28, оф. 216
 Тел./факс: 8 (916) 900-65-84
 www.bioforum.ru

Для проведения диагностики in vitro - набор 10 тестов

Набор реагентов
 Тест-система иммунохроматографическая для
 качественного определения миоглобина, креатинкиназы
 MB и/или сердечного тропонина I в образцах сыворотки
 (плазмы) или цельной крови человека

Био Трейсер Кардиотест 3 в 1

Код продукт №1

Состав:
 - тест-кассеты: 10 шт
 - флакон сывороточный полимерный в комплекте с крышкой нависающей и
 флакон сывороточный, содержащий буферный раствор: 3 шт
 - картриджная палочка для образца: 10 шт
 - ланцет-скарификатор: 10 шт
 - салфетки стерильные: 20 шт
 - инструкция по применению: 1 шт

Серия номер: 03
 Дата выпуска: 01.2019
 Годен до: 01.2021

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «БИО ФОРУМ»
 109387, Москва, Тимяк, 28, оф. 216
 Тел./факс: 8 (916) 900-65-84
 www.bioforum.ru

Для проведения диагностики in vitro
 ТЕСТ-КАССЕТА

Био Трейсер Кардиотест 3 в 1

* Хранить при температуре 2-30 °С. Не замораживать!

Серия номер: 03
 Дата выпуска: 01.2019
 Годен до: 01.2021

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «БИО ФОРУМ»
 109387, Москва, Тимяк, 28, оф. 216
 Тел./факс: 8 (916) 900-65-84
 www.bioforum.ru

АСПИРИН®
 СПИРТОВАЯ
 САЛФЕТКА ДЛЯ
 ИНЪЕКЦИЙ
 60x100 мм

70% ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ

Для проведения диагностики in vitro
 Тест-кассета

Био Трейсер Кардиотест 3 в 1

* Хранить при температуре 2-30 °С. Не замораживать!


Серия номер: 03
 Дата выпуска: 01.2019
 Годен до: 01.2021

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «БИО ФОРУМ»
 109387, Москва, Тимяк, 28, оф. 216
 Тел./факс: 8 (916) 900-65-84
 www.bioforum.ru

Кардиотест
 3 в 1

C
 Myo
 CK
 Tnl

S

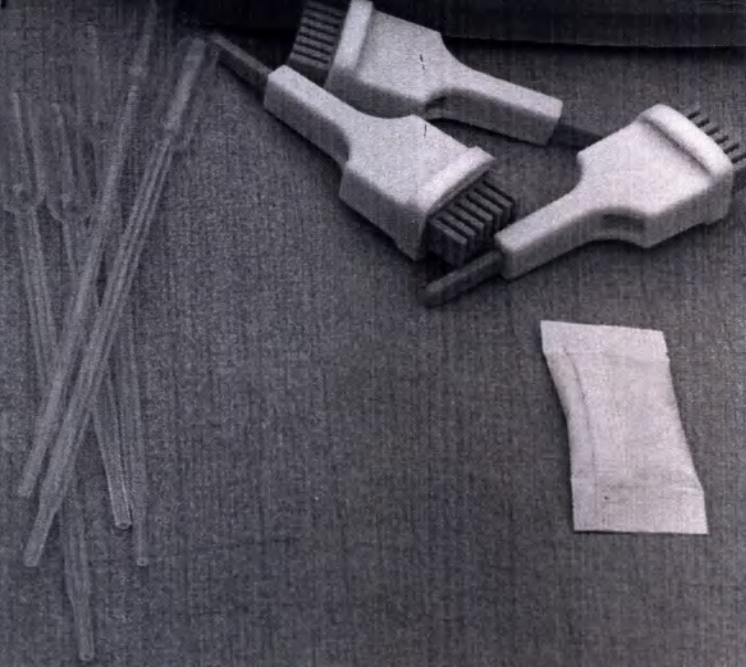

Для проведения диагностики in vitro • набор 10 тестов

Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для
качественного определения миоглобина,
креатинкиназы MB и/или сердечного тропонина I
в образцах сыворотки (плазмы) или цельной крови
человека

Био Трейсер Кардиотест 3 в 1

Хранить при температуре 2-30°C. Не замораживать!
Пожалуйста, прочтите инструкцию по применению перед использованием

Комплект №1

Состав:
- тест-кассета: 10 шт
- флакон-капельница полимерный в комплекте с крышкой навинчиваемой
и пробкой-капельницей, содержащий буферный раствор: 1 шт
- одноразовая пипетка для образца: 10 шт
- ланцет-скафикатор: 10 шт
- салфетка спиртовая: 20 шт
- инструкция по применению: 1 шт

Серия номер: 03
Дата выпуска: 01.2019
Годен до: 01.2021

ТУ 21.20.23-002-15580960-2019
РУ №
Изготовитель: ООО «Био Фокус»
РФ, 109387, Москва, Тихая, 28, оф. 216.
Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84
www.biofocus.ru

IVD

20°C 30°C

10

Для проведения диагностики in vitro • набор 10 тестов



Набор реагентов

Тест-система иммунохроматографическая для
качественного определения миоглобина,
креатинкиназы MB и/или сердечного тропонина I
в образцах сыворотки (плазмы) или цельной крови
человека

Био Трейсер Кардиотест 3 в 1

Хранить при температуре 2-30°C. Не замораживать!
Пожалуйста, прочтите инструкцию по применению перед использованием

Комплект №1

Состав:
- тест-кассета: 10 шт
- флакон-капельница полимерный в комплекте с крышкой навинчиваемой
и пробкой-капельницей, содержащий буферный раствор: 1 шт
- одноразовая пипетка для образца: 10 шт
- ланцет-скафикатор: 10 шт
- салфетка спиртовая: 20 шт
- инструкция по применению: 1 шт

Серия номер: 03
Дата выпуска: 01.2019
Годен до: 01.2021

ТУ 21.20.23-002-15580960-2019

РУ №

Изготовитель: ООО «Био Фокус»
РФ, 109387, Москва, Тихая, 28, оф. 216.
Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84
www.biofocus.ru




Для проведения диагностики in vitro - набор 10 тестов

Набор реагентов
Тест-система иммунохимическая для определения
кreatинкиназы MB и/или сердечного тропонина I
в образцах сыворотки (плазмы) или цельной крови
человека

Био Трейсер Кардиотест 3 в 1

- Хранить при температуре 2-30°C. Не замораживать.
- Потреблять, избегая попадания в контейнер с крышкой.
- Комплект №1
- Содержит: 10 шт.
- Тест-система иммунохимическая для определения
- кreatинкиназы MB и/или сердечного тропонина I
- в образцах сыворотки (плазмы) или цельной крови
- человека
- 10 шт.
- Серия номер: 03
- Дата выпуска: 01.2019
- Годен до: 01.2021

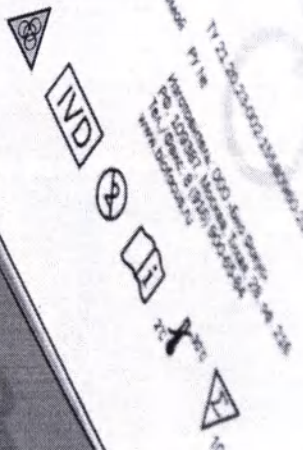

TY 21.20.2020/02.2020/03.2020

Импортирует: ООО «Био Трейсер»

г. Москва, ул. Мясницкая, д. 28, стр. 2/3

Тел: +7 (495) 915-15-15

www.biobioser.ru

Тест-система
 Био Трейсер
 Кардиотест 3 в 1
 10 тестов

Импортирует:
 ООО «Био Трейсер»
 г. Москва, ул. Мясницкая,
 д. 28, стр. 2/3
 Тел: +7 (495) 915-15-15
 www.biobioser.ru

Для проведения диагностики in vitro - набор 10 тестов

Набор реагентов
Тест-система иммунохимическая для
определения
кreatинкиназы MB и/или
сердечного тропонина I
в образцах сыворотки (плазмы) или
цельной крови
человека

Био Трейсер Кардиотест 3 в 1

Комплект №1

Содержит: 10 шт.

Тест-система иммунохимическая для

определения

кreatинкиназы MB и/или

сердечного тропонина I

в образцах сыворотки (плазмы) или

цельной крови

человека

10 шт.

Для определения активности в крови • набор 10 тестов



Набор реагентов
Тест-система микрофотометрическая для
качественного определения миоглобина,
креатинкиназы МВ и/или сердечного тропонина I
в сыворотке крови (мазках) или цельной крови
человека

Био Трейсер Кардиотест 3 в 1

Вскрыть при температуре +5...+25°C, не замораживать!
Хранить в сухом месте, вдали от прямых солнечных
лучей.


Срок
использования 2 лет

Внедренный в клиническую практику с 2004 года
сертифицированный лабораторией «Био Трейсер»
научно-исследовательский центр для крови и
сердечно-сосудистой системы. Сертификат
аккредитации № 107

Сертификат
аккредитации № 107

Т/ 21.20.23.002 15580960.2019
Р/ 18

Исполнитель: ООО «Био Фокус»
РФ, 109387, Москва, Тихая, 28, оф. 216.
Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84
www.biofocus.ru

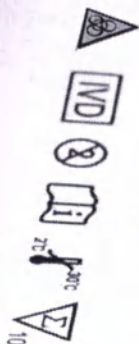


Тест-система
Био Трейсер

Кардиотест 3 в 1
10 тестов

Изготовитель:
ООО «Био Фокус»
РФ, 109387, Москва,
Тихая, 28, оф. 216.
Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84
www.biofocus.ru

Био Трейсер





100% 100% 100%

Система иммунохроматографическая для качественного определения миоглобина, креатинкиназы МВ и/или сердечного тропонина I в образцах сыворотки (плазмы) или цельной крови человека

Система иммунохроматографическая для качественного определения миоглобина, креатинкиназы МВ и/или сердечного тропонина I в образцах сыворотки (плазмы) или цельной крови человека

100% 100% 100%

Система иммунохроматографическая для качественного определения миоглобина, креатинкиназы МВ и/или сердечного тропонина I в образцах сыворотки (плазмы) или цельной крови человека

Био Трейсер Кардиотест 3 в 1

Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для
качественного определения миоглобина, креатинкиназы
МВ и/или сердечного тропонина I в образцах сыворотки
(плазмы) или цельной крови человека



Для проведения диагностики in vitro • набор 10 тестов

Для проведения диагностики in vitro • набор 10 тестов



Набор реагентов

Тест-система иммунохроматографическая для
качественного определения миоглобина, креатинкиназы
МВ и/или сердечного тропонина I в образцах сыворотки
(плазмы) или цельной крови человека

Био Трейсер Кардиотест 3 в 1

Для учреждений здравоохранения

Хранить при температуре 2–30 °С. Не замораживать!
Пожалуйста, прочтите инструкцию по применению
перед использованием

Каталожный номер комплекта: 1411

Для проведения диагностики in vitro • набор 10 тестов

Био Трейсер Кардиотест 3 в 1

Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения миоглобина, креатинкиназы MB и/или сердечного тропонина I в образцах сыворотки (плазмы) или цельной крови человека

Комплект №1

Состав:

- тест-кассета: 10 шт
- флакон-капсулицид полимерный в комплекте с крышечкой навинчиваемой и пробой-капсулицидом, содержащий буферный раствор: 1 шт
- одноразовая пипетка для образцов: 10 шт
- автосчитыватель: 1 шт
- свистящие опрыскиватели: 20 шт
- инструкция по применению: 1 шт

Серия номер: 03
Дата выпуска: 01.2019
Годен до: 01.2021

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Био Фокус»
РФ, 109387, Москва, Тимирязевская ул., д. 28, оф. 216
Тел./факс: 8 (916) 900-65-84
www.biofocus.ru

Для проведения диагностики in vitro
Тест-кассета

Био Трейсер Кардиотест 3 в 1

* Хранить при температуре 2-30 °C. Не замораживать!

Серия номер: 03
Дата выпуска: 01.2019
Годен до: 01.2021

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Био Фокус»
РФ, 109387, Москва, Тимирязевская ул., д. 28, оф. 216
Тел./факс: 8 (916) 900-65-84
www.biofocus.ru

Для проведения диагностики in vitro
Тест-кассета

Био Трейсер Кардиотест 3 в 1

* Хранить при температуре 2-30 °C. Не замораживать!

Серия номер: 03
Дата выпуска: 01.2019
Годен до: 01.2021

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Био Фокус»
РФ, 109387, Москва, Тимирязевская ул., д. 28, оф. 216
Тел./факс: 8 (916) 900-65-84
www.biofocus.ru

АССЕССИМА
СПИРИТОВАЯ
САЛФЕТКА ДЛЯ
ИНИЦИАЦИИ
60x100 мм

70% ЭТАНОЛ
СПИРТ

Био Трейсер Кардиотест 3 в 1
Буферный раствор
Серия номер: 03
Дата выпуска: 01.2019
Годен до: 01.2021

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Био Фокус»
РФ, 109387, Москва, Тимирязевская ул., д. 28, оф. 216
Тел./факс: 8 (916) 900-65-84
www.biofocus.ru

Инструкция по применению
 Для проведения диагностики in vitro набор 10 тестов

Данный набор предназначен для проведения диагностики in vitro. Он содержит 10 тестов, которые используются для определения концентрации миоглобина, креатинкиназы MB и/или сердечного тропонина I в образцах сыворотки (плазмы) или цельной крови человека.

Состав набора:

- 10 шт. флажков-кассет, помещенных в полиэтиленовый пакет
- 1 шт. флажков-кассет, помещенных в полиэтиленовый пакет
- 1 шт. флажков-кассет, помещенных в полиэтиленовый пакет
- 1 шт. флажков-кассет, помещенных в полиэтиленовый пакет
- 1 шт. флажков-кассет, помещенных в полиэтиленовый пакет
- 1 шт. флажков-кассет, помещенных в полиэтиленовый пакет
- 1 шт. флажков-кассет, помещенных в полиэтиленовый пакет
- 1 шт. флажков-кассет, помещенных в полиэтиленовый пакет
- 1 шт. флажков-кассет, помещенных в полиэтиленовый пакет
- 1 шт. флажков-кассет, помещенных в полиэтиленовый пакет

Для проведения диагностики in vitro набор 10 тестов

Набор реагентов
 Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения миоглобина, креатинкиназы MB и/или сердечного тропонина I в образцах сыворотки (плазмы) или цельной крови человека

Био Трейсер Кардиотест 3 в 1

Хранить при температуре 2-30 °С. Не замораживать!
 Показатели, полученные при применении набора, являются ориентировочными.


Комплект №1

Состав:

- 10 шт. флажков-кассет, помещенных в полиэтиленовый пакет
- 1 шт. флажков-кассет, помещенных в полиэтиленовый пакет
- 1 шт. флажков-кассет, помещенных в полиэтиленовый пакет
- 1 шт. флажков-кассет, помещенных в полиэтиленовый пакет
- 1 шт. флажков-кассет, помещенных в полиэтиленовый пакет
- 1 шт. флажков-кассет, помещенных в полиэтиленовый пакет
- 1 шт. флажков-кассет, помещенных в полиэтиленовый пакет
- 1 шт. флажков-кассет, помещенных в полиэтиленовый пакет
- 1 шт. флажков-кассет, помещенных в полиэтиленовый пакет
- 1 шт. флажков-кассет, помещенных в полиэтиленовый пакет

Серия: 03
 Дата выпуска: 01.2019
 Годен до: 01.2021

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Био Трейсер»
 РФ, 109387, Москва, Троицк, 28, оф. 216.
 Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84
 www.biobios.ru



Для проведения диагностики in vitro набор 10 тестов

Набор реагентов
 Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения миоглобина, креатинкиназы MB и/или сердечного тропонина I в образцах сыворотки (плазмы) или цельной крови человека

Био Трейсер Кардиотест 3 в 1

Комплект №1

Состав:

- 10 шт. флажков-кассет, помещенных в полиэтиленовый пакет
- 1 шт. флажков-кассет, помещенных в полиэтиленовый пакет
- 1 шт. флажков-кассет, помещенных в полиэтиленовый пакет
- 1 шт. флажков-кассет, помещенных в полиэтиленовый пакет
- 1 шт. флажков-кассет, помещенных в полиэтиленовый пакет
- 1 шт. флажков-кассет, помещенных в полиэтиленовый пакет
- 1 шт. флажков-кассет, помещенных в полиэтиленовый пакет
- 1 шт. флажков-кассет, помещенных в полиэтиленовый пакет
- 1 шт. флажков-кассет, помещенных в полиэтиленовый пакет
- 1 шт. флажков-кассет, помещенных в полиэтиленовый пакет

Для проведения диагностики in vitro набор 10 тестов

Тест-кассета

Био Трейсер Кардиотест 3 в 1

Хранить при температуре 2-30 °С. Не замораживать!

Серия: 03
 Дата выпуска: 01.2019
 Годен до: 01.2021

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Био Трейсер»
 РФ, 109387, Москва, Троицк, 28, оф. 216.
 Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84
 www.biobios.ru

АСЕПТИКА
 СПИРТОВАЯ
 САЛФЕТКА ДЛЯ
 ИНЪЕКЦИЙ
 60x100 мм

70% УЛЬТРАЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ СПИРТ

Для проведения диагностики in vitro

Тест-кассета

Био Трейсер Кардиотест 3 в 1

Хранить при температуре 2-30 °С. Не замораживать!


Серия: 03
 Дата выпуска: 01.2019
 Годен до: 01.2021


ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Био Трейсер»
 РФ, 109387, Москва, Троицк, 28, оф. 216.
 Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84
 www.biobios.ru

Кардиотест 3 в 1

C
 Myo
 CK
 Tnl

S

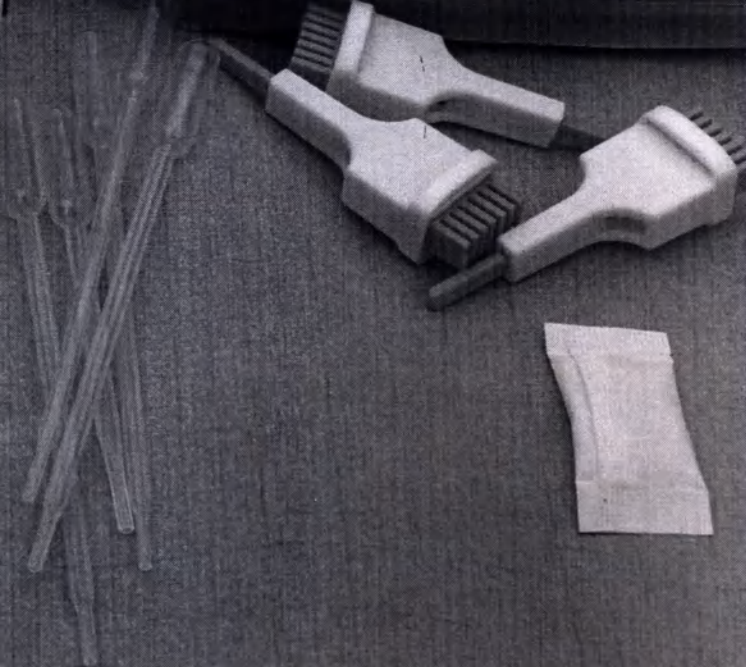

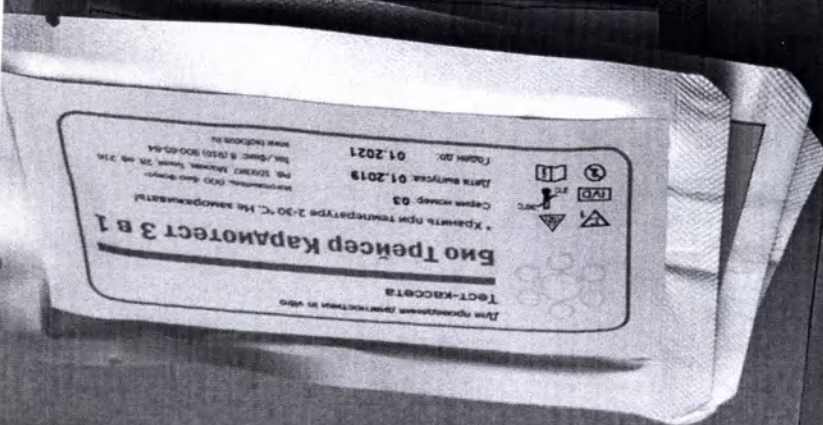

Для проведения диагностики in vitro - набор 10 тестов

Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения миоглобина, креатинкиназы МВ и/или сердечного тропонина I в образцах сыворотки (плазмы) или цельной крови человека

Био Трейсер Кардиотест 3 в 1

Для упрощения обслуживания
Хранить при температуре 2-30 °С. Не замораживать!
Показатели, полученные в результате тестирования, являются ориентировочными

Контрольный номер комплекта: 1411

Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения миоглобина, креатинкиназы МВ и/или сердечного тропонина I в образцах сыворотки (плазмы) или цельной крови человека

Био Трейсер Кардиотест 3 в 1

Для проведения диагностики in vitro - набор 10 тестов

Состав:
- тест-карты - 10 шт.
- флакон с реагентом - 1 шт.
- флакон с реагентом - 1 шт.
- флакон с реагентом - 1 шт.
- флакон с реагентом - 1 шт.
- флакон с реагентом - 1 шт.
- флакон с реагентом - 1 шт.
- флакон с реагентом - 1 шт.
- флакон с реагентом - 1 шт.
- флакон с реагентом - 1 шт.

Срок годности: 12 месяцев
Дата выпуска: 01.2021
Серия: 03

Для проведения диагностики in vitro - набор 10 тестов

Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения миоглобина, креатинкиназы МВ и/или сердечного тропонина I в образцах сыворотки (плазмы) или цельной крови человека

Био Трейсер Кардиотест 3 в 1

Хранить при температуре 2-30°C. Не замораживать!
Почувствительность, процент инструкции по применению перед использованием

Комплект №2

Состав:
- тест-кассеты: 10 шт
- флакон-капельница полимерный в комплекте с крышечкой навинчиваемой и пробой-капельницей, содержащий буферный раствор: 1 шт
- одноразовая пилетка для образца: 10 шт
- инструкция по применению: 1 шт

Серия номер: 02
Дата выпуска: 01.2019
Годен до: 01.2021

ТУ 21.20.23.002-155-00960-2019
Р/У №

Исполнитель: ООО «Био Трейсер»
г.р. 509387, Москва, Таша, 28, оф. 216.
Тел./Факс: 8 (916) 900-65-64
www.biobios.ru

IVD 30°C 10

Для проведения диагностики in vitro - набор 10 тестов

Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения миоглобина, креатинкиназы МВ и/или сердечного тропонина I в образцах сыворотки (плазмы) или цельной крови человека

Био Трейсер Кардиотест 3 в 1

Комплект №2

Состав:
- тест-кассеты: 10 шт
- флакон-капельница полимерный в комплекте с крышечкой навинчиваемой и пробой-капельницей, содержащий буферный раствор: 1 шт
- одноразовая пилетка для образца: 10 шт
- инструкция по применению: 1 шт

Для проведения диагностики in vitro
Тест-кассета

Био Трейсер Кардиотест 3 в 1

*Хранить при температуре 2-30°C. Не замораживать!

Серия номер: 02
Дата выпуска: 01.2019
Годен до: 01.2021

Исполнитель: ООО «Био Трейсер»
г.р. 509387, Москва, Таша, 28, оф. 216.
Тел./Факс: 8 (916) 900-65-64
www.biobios.ru

IVD 30°C

Для проведения диагностики in vitro
Тест-кассета

Био Трейсер Кардиотест 3 в 1

*Хранить при температуре 2-30°C. Не замораживать!

Серия номер: 02
Дата выпуска: 01.2019
Годен до: 01.2021

Исполнитель: ООО «Био Трейсер»
г.р. 509387, Москва, Таша, 28, оф. 216.
Тел./Факс: 8 (916) 900-65-64
www.biobios.ru



IVD 30°C

Кардиотест 3 в 1

С
Myo
CK
Tnl

Био Трейсер Кардиотест 3 в 1
Буферный раствор
02
01.2019
01.2021



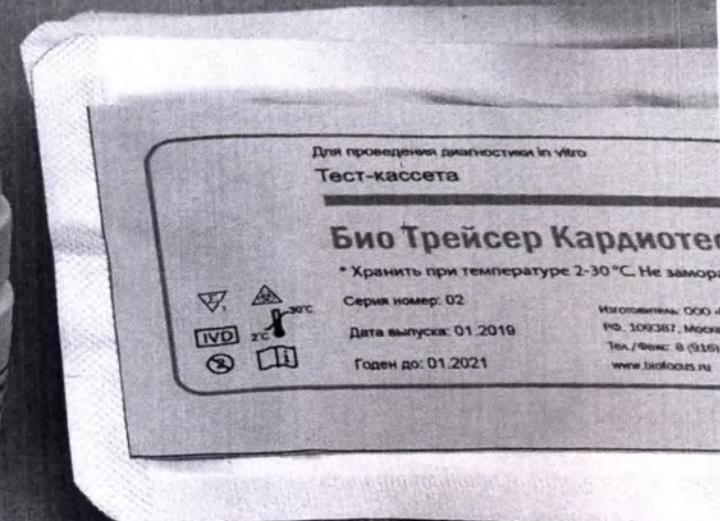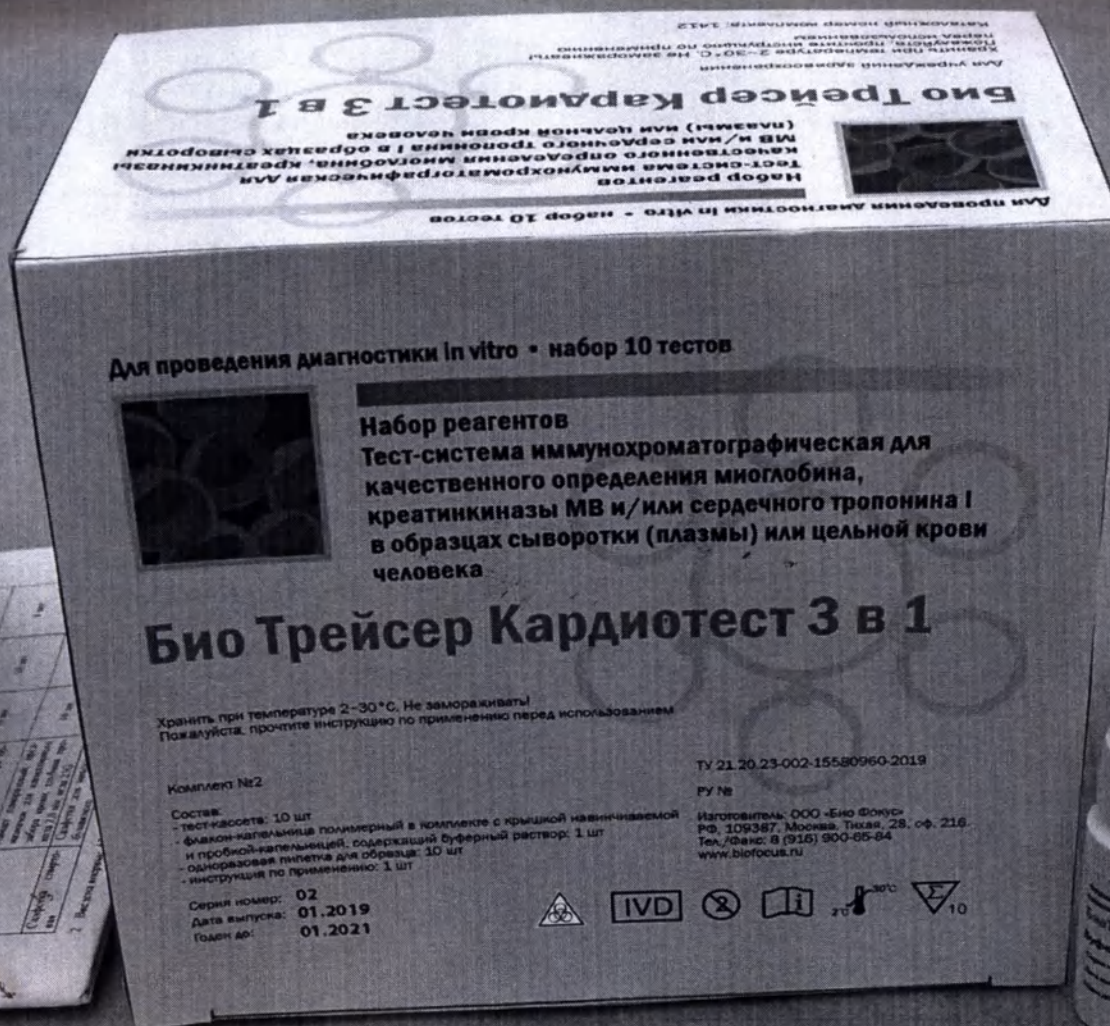

Для проведения диагностики in vitro - набор 10 тестов



Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для
качественного определения миоглобина,
креатинкиназы MB и/или сердечного тропонина I
в образцах сыворотки (плазмы) или цельной крови
человека

Био Трейсер Кардиотест 3 в 1

Хранить при температуре 2-30°C. Не замораживать!
Пожалуйста, прочтите инструкцию по применению перед использованием

Комплект №2

Состав:

- тест-кассета: 10 шт
- флакон-капельница полимерный в комплекте с крышечкой навинчиваемой и пробой-капельницей, содержащий буферный раствор: 1 шт
- одноразовая пилетка для образца: 10 шт
- инструкция по применению: 1 шт

Серия номер: 02

Дата выпуска: 01.2019

Годен до: 01.2021

ТУ 21.20.23-002-15580960-2019

РУ №

Изготовитель: ООО «Био Фокус»
РФ, 1091387, Москва, Тихая, 28, оф. 216.
Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84
www.biofocus.ru



Для проведения диагностики in vitro
Тест-кассета

Био Трейсер Кардиотест 3 в 1

Хранить при температуре 2-30°C. Не замораживать!

Изготовитель: ООО «Био Фокус»
РФ, 1091387, Москва, Тихая, 28, оф. 216.
Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84
www.biofocus.ru

Для проведения диагностики in vitro - набор 10 тестов



Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для
качественного определения миоглобина, креатинкиназы
MB и/или сердечного тропонина I в образцах сыворотки
(плазмы) или цельной крови человека

Био Трейсер Кардиотест 3 в 1

Комплект №2

Состав:

- тест-кассета: 10 шт
- флакон-капельница полимерный в комплекте с крышечкой навинчиваемой и пробой-капельницей, содержащий буферный раствор: 1 шт
- одноразовая пилетка для образца: 10 шт
- инструкция по применению: 1 шт

Серия номер: 02

Дата выпуска: 01.2019

Годен до: 01.2021

Для проведения диагностики in vitro
Тест-кассета

Био Трейсер Кардиотест 3 в 1

Хранить при температуре 2-30°C. Не замораживать!

Серия номер: 02

Дата выпуска: 01.2019

Годен до: 01.2021

Изготовитель: ООО «Био Фокус»
РФ, 1091387, Москва, Тихая, 28, оф. 216.
Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84
www.biofocus.ru



Тест-система предназначена для определения качества и количества МВ и/или сердечного тропонина I в образцах сыворотки (плазмы) или цельной крови человека.

в образцах сыворотки (плазмы) или цельной крови человека

Бюро Трейсер Кармоторс 3 В 1

Хранить при температуре 2-20° С. Не замораживать.
Ромашка, порошок изюмина по назначению расфас. в/от 100г

11 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 10

五

Marionville, MO 64659
PO. 209381, Marion, Va. 26
Tel./Fax: 8 (915) 900-5324
www.bdcoursu

...with
...with
...with

△

者

Коммунизм №2

Состав:

- толщина: 10 см
- фактически плоский и однородный с толщиной 1 см

и пробной-затемняющей. Содержимое отпаривающей пробной для отпаривающей - отпаривающей пробной для отпаривающей.

- однократная инъекция в/в 0,2 г
- в/в струйно по назначению. 2 шт

Средняя норма: 0,2

Дата выдачи: 01.2019

01.2021

Ана и подвиги

НАПРАВЛЕНИЕ ИЛИ ОБЛАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЗАЩИТА ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ
 ТЕСТ-СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ ЗАЩИТНОГО
 КАЧЕСТВЕННОГО ПРОПОНИРАЮЩЕГО
 МБ N/1 НАН СЕРИИ КОЖИ

БМО 1991

КОМПАНИИ №2

Состав: 10 шт полноразмерных
10 шт полноразмерных
10 шт полноразмерных

ТРЕТИЙ КЛАСС. В ПОСЛЕДНИЙ КЛАССОВЫЙ ГОДОВЫЙ КУРС НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ПОДГОТОВИЛА 10 ДЕТЕЙ. В НАЧАЛЬНЫХ ШКОЛАХ РАЙОНА РАБОТАЕТ 10 УЧИТЕЛЕЙ. В НАЧАЛЬНЫХ ШКОЛАХ РАЙОНА РАБОТАЕТ 10 УЧИТЕЛЕЙ.

ПРОКОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ЗАКОНОДЛАВА ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ОАО "Иркутск"

Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для
качественного определения миоглобина,
креатинкиназы MB и/или сердечного тропонина I
в образцах сыворотки (плазмы) или цельной крови человека

Для проведения диагностики in vitro • набор 10 тестов



Для проведения диагностики in vitro • набор 10 тестов



Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для
качественного определения миоглобина,
креатинкиназы MB и/или сердечного тропонина I
в образцах сыворотки (плазмы) или цельной крови
человека

Био Трейсер Кардиотест 3 в 1

Хранить при температуре 2-30°C. Не замораживать!
Пожалуйста, прочтите инструкцию по применению перед использованием.

Комплект №2

Состав:


- тест-кассета: 10 шт
- флакон-капельница полимерный в комплекте с крышкой навинчиваемой и пробкой-капельницей, содержащий буферный раствор: 1 шт
- одноразовая пипетка для образца: 10 шт
- инструкция по применению: 1 шт

Серия номер: 02
Дата выпуска: 01.2019
Годен до: 01.2021

ТУ 21.20.23-002-15580960-2019

РУ №

Изготовитель: ООО «Био Фокус»
РФ, 109387, Москва, Тихая, 28, оф. 216.
Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84
www.biofocus.ru



Для проведения диагностики in vitro • набор 10 тестов



Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для
качественного определения миоглобина,
креатинкиназы MB и/или сердечного тропонина I
в образцах сыворотки (плазмы) или цельной крови
человека

Био Трейсер Кардиотест 3 в 1

Хранить при температуре 2-30°C. Не замораживать!
Пожалуйста, прочтите инструкцию по применению перед использованием

Комплект №2

- Состав:
- тест-кассета: 10 шт
 - флакон-капельница полимерный в комплекте с крышкой навинчиваемой и пробкой-капельницей, содержащий буферный раствор: 1 шт
 - одноразовая пипетка для образца: 10 шт
 - инструкция по применению: 1 шт

Серия номер: 02
Дата выпуска: 01.2019
Годен до: 01.2021

ТУ 21.20.23-002-15580960-2019

РУ №

Изготовитель: ООО «Био Фокус»
РФ, 109387, Москва, Тихая, 28, оф. 216.
Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84
www.biofocus.ru



Для проведения диагностики In vitro • набор 10 тестов




Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для
качественного определения миоглобина, креатинкиназы
MB и/или сердечного тропонина I в образцах сыворотки
(плазмы) или цельной крови человека

Био Трейсер Кардиотест 3 в 1

Комплект №2

- Состав:
- тест-кассета: 10 шт
 - флакон-капельница полимерный в комплекте с крышкой навинчиваемой и пробкой-капельницей, содержащий буферный раствор: 1 шт
 - одноразовая пипетка для образца: 10 шт
 - инструкция по применению: 1 шт

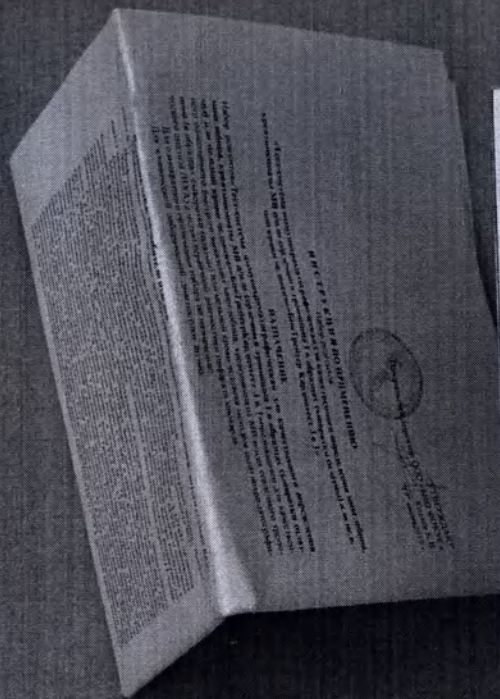

Для проведения диагностики in vitro • набор 10 тестов

Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для
качественного определения миоглобина,
креатинкиназы MB и/или сердечного тропонина I
в образцах сыворотки (плазмы) или цельной крови
человека

Био Трейсер Кардиотест 3 в 1

Хранить при температуре 2-30 °С. Не замораживать!
Пожалуйста, прочтите инструкцию по применению перед использованием

Комплект №2

Состав:
- тест-кассета: 10 шт
- флакон-наполнитель полимерный в комплекте с крышкой навинчиваемой
и пробой-капельницей, содержащий буферный раствор: 1 шт
- бумажная пленка для образца: 10 шт
- инструкция по применению: 1 шт

Серия номер: 04
Дата выпуска: 01.2019
Годен до: 01.2021

ТУ 21.20.23-002-15580960-2019
РУ №

Изготовитель: ООО «Био Фокус»
РФ, 125387, Москва, Тихая, 28, оф. 216.
Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84
www.biofocus.ru

IVD

Для проведения диагностики in vitro
Тест-кассета

Био Трейсер Кардиотест 3 в 1

* Хранить при температуре 2-30 °С. Не замораживать!

Серия номер: 04
Дата выпуска: 01.2019
Годен до: 01.2021

Изготовитель: ООО «Био Фокус»
РФ, 125387, Москва, Тихая, 28, оф. 216.
Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84
www.biofocus.ru


Для проведения диагностики in vitro
Тест-кассета

Био Трейсер Кардиотест 3 в 1

* Хранить при температуре 2-30 °С. Не замораживать!

Серия номер: 04
Дата выпуска: 01.2019
Годен до: 01.2021

Изготовитель: ООО «Био Фокус»
РФ, 125387, Москва, Тихая, 28, оф. 216.
Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84
www.biofocus.ru

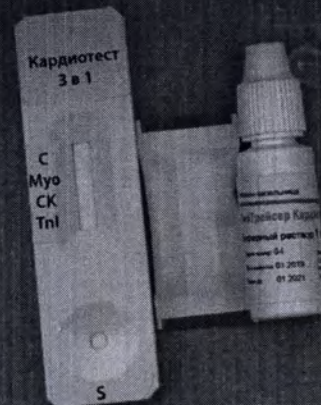

Для проведения диагностики in vitro • набор 10 тестов



Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для
качественного определения миоглобина,
креатинкиназы МВ и/или сердечного тропонина I
в образцах сыворотки (плазмы) или цельной крови
человека

Био Трейсер Кардиотест 3 в 1

Хранить при температуре 2-30°C. Не замораживать!
Пользоваться, прочитав инструкцию по применению перед использованием

Комплект №2

Состав:
- тест-кассета: 10 шт
- флакон-капельница полимерный в комплекте с крышкой навинчиваемой
и пробой-капельницей, содержащий буферный раствор: 1 шт
- одноразовая пипетка для образцов: 10 шт
- инструкция по применению: 1 шт

Серия номер: 04
Дата выпуска: 01.2019
Годен до: 01.2021

ТУ 21.20.23-002-15560960-2019

ИУ №

Исполнитель: ООО «Бир Форм»
ИП: 1093817, Москва, Тимая, 28, оф. 216.
Тел./факс: 8 (916) 900-65-64
www.bioros.ru



Для проведения диагностики in vitro • набор 10 тестов



Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для
качественного определения миоглобина, креатинкиназы
МВ и/или сердечного тропонина I в образцах сыворотки
(плазмы) или цельной крови человека

Био Трейсер Кардиотест 3 в 1

Комплект №2

Состав:
- тест-кассета: 10 шт
- флакон-капельница полимерный в комплекте с крышкой навинчиваемой и
пробой-капельницей, содержащий буферный раствор: 1 шт
- одноразовая пипетка для образцов: 10 шт
- инструкция по применению: 1 шт

Для проведения диагностики in vitro
Тест-кассета

Био Трейсер Кардиотест 3 в 1

Для проведения диагностики in vitro
Тест-кассета

Био Трейсер Кардиотест 3 в 1

* Хранить при температуре 2-30°C. Не замораживать!


Серия номер: 04

Дата выпуска: 01.2019

Годен до: 01.2021

Исполнитель: ООО «Бир Форм»
ИП: 1093817, Москва, Тимая, 28, оф. 216.
Тел./факс: 8 (916) 900-65-64
www.bioros.ru



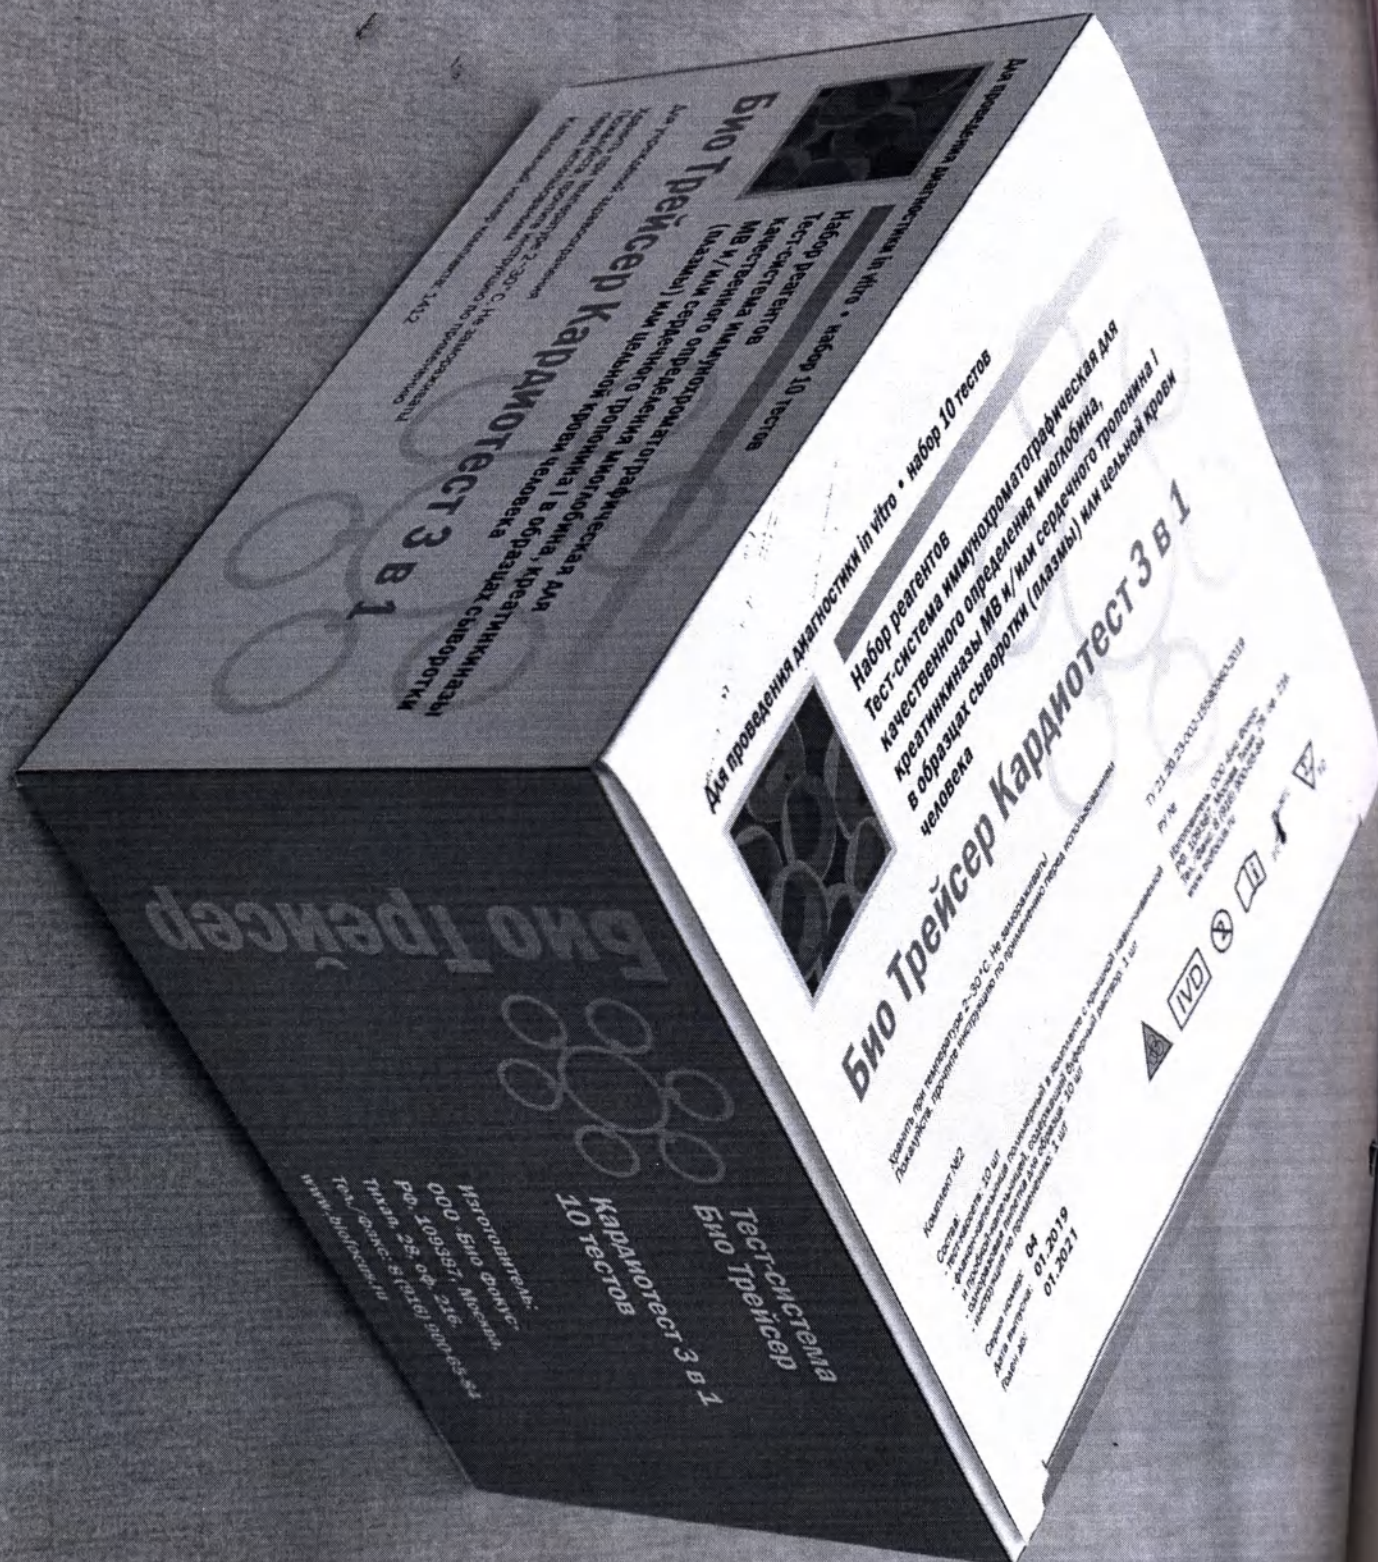


Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для
качественного определения миоглобина, креатинкиназы
МВ и/или сердечного тропонина I в образцах сыворотки
(плазмы) или цельной крови человека

Био Трейсер Кардиотест 3 в 1

Для проведения диагностики in vitro • набор 10 тестов

Для проведения диагностики in vitro • набор 10 тестов



Набор реагентов

Тест-система иммунохроматографическая для
качественного определения миоглобина,
креатинкиназы МВ и/или сердечного тропонина I
в образцах сыворотки (плазмы) или цельной крови
человека

Био Трейсер Кардиотест 3 в 1

Хранить при температуре 2-30°C. Не замораживать!
Пожалуйста, прочтите инструкцию по применению перед использованием

Комплект №2

Состав:

- тест-кассета: 10 шт
- флакон-капельница полимерный в комплекте с крышкой навинчиваемой и пробкой-капельницей, содержащий буферный раствор: 1 шт
- одноразовая пипетка для образца: 10 шт
- инструкция по применению: 1 шт

Серия номер: 04


Дата выпуска: 01.2019

Годен до: 01.2021

ТУ 21.20.23-002-15580960-2019

РУ №

Изготовитель: ООО «Био Фокус»
РФ, 109387, Москва, Тихая, 28, оф. 216.
Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84
www.biofocus.ru



Серия номер: 05
Дата выпуска: 01.2019
Годен до: 01.2021

TV 21.20.23-002-15580960-2019

РУ №

Для проведения диагностики in vitro



Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для
качественного определения миоглобина, креатинкиназы
МВ и/или сердечного тропонина I в образцах сыворотки
(плазмы) или цельной крови человека

Био Трейсер Кардиотест 3 в 1

Комплект №3

Состав:

- тест-кассета: 1 шт
- флакон-капельница полимерный в комплекте с крышкой навинчиваемой и пробкой-капельницей, содержащий буферный раствор: 1 шт
- одноразовая пипетка для образца: 1 шт
- ланцет-скафикатор: 1 шт
- салфетка спиртовая: 2 шт
- инструкция по применению: 1 шт

Изготовитель: ООО «Био Фокус»
РФ, 109387, Москва, Тихая, 28, оф. 216.
Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84
www.biofocus.ru



1 тест / набор



Набор реагентов

Тест-система иммунохроматографическая для
качественного определения миоглобина, креатинкиназы
МВ и/или сердечного тропонина I в образцах сыворотки
(плазмы) или цельной крови человека

Био Трейсер Кардиотест 3 в 1


Хранить при температуре 2~30°C. Не замораживать!
Пожалуйста, прочтите инструкцию по применению перед использованием

Каталожный номер комплекта: 1413

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИО ФОКУС»
 Казань КВ
 17 июня 2019 г.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
 Набор реагентов
 иммунохроматографическая для качественного определения миоглобина, креатинкиназы МВ и/или сердечного тропонина I в образцах сыворотки (плазмы) или цельной крови человека — БиоТрейсер Кардиотест 3 в 1

Набор реагентов
 Тест-система иммунохроматографическая для
 качественного определения миоглобина, креатинкиназы
 МВ и/или сердечного тропонина I в образцах сыворотки
 (плазмы) или цельной крови человека
Био Трейсер Кардиотест 3 в 1
 Хранить при температуре 2–30 °С. Не замораживать!
 Пожалуйста, прочтите инструкцию по применению перед использованием
 Каталожный номер комплекта: 1413
 Серия номер: 05
 Дата выпуска: 01.2019
 Годен до: 01.2021

Для проведения диагностики in vitro
Тест-кассета
Био Трейсер Карди
 * Хранить при температуре 2–30 °С. Не замораживать!
 Серия номер: 05
 Дата выпуска: 01.2019
 Годен до: 01.2021

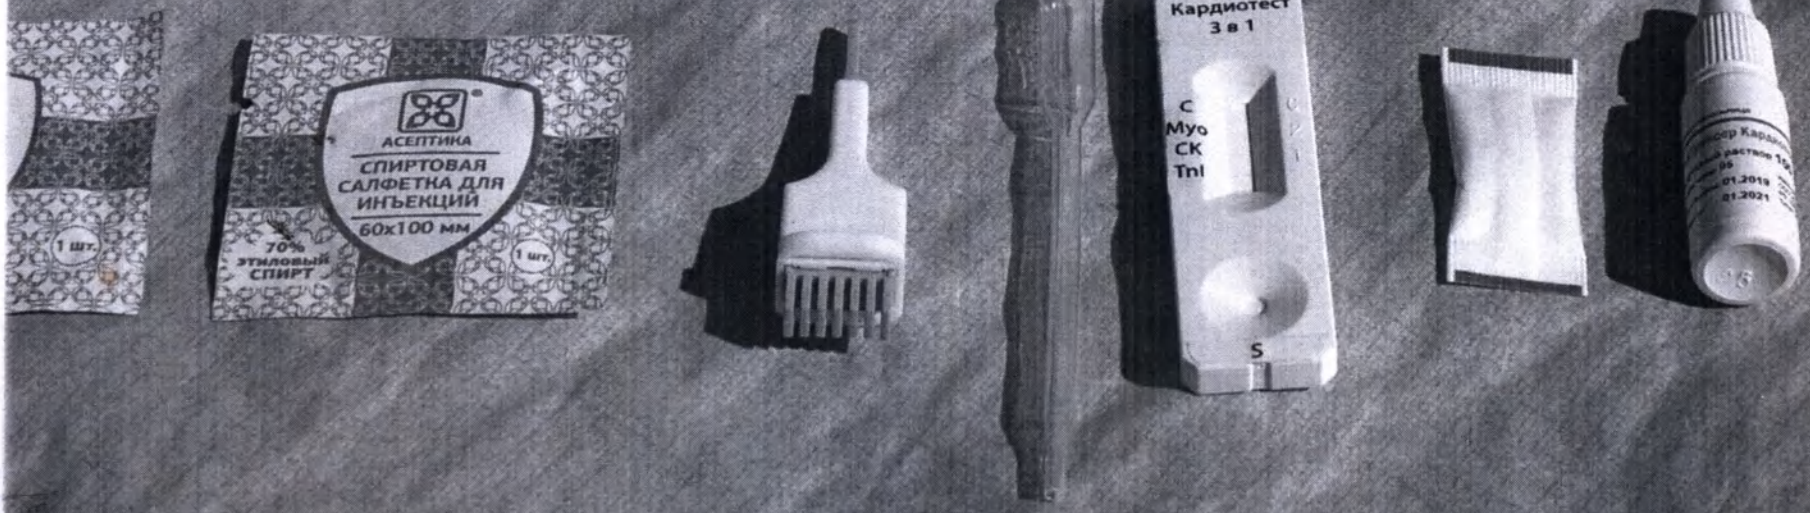



ТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО «БИО ФОКУС»
Козлов К.В.
17 июля 2019 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Набор реагентов иммунохроматографическая для качественного определения миоглобина, креатинкиназы МВ и/или сердечного тропонина I в образцах сыворотки (плазмы) или цельной крови человека—БиоТрейсер Кардиотест 3 в 1

НАЗНАЧЕНИЕ

система иммунохроматографическая для качественного определения миоглобина (МВ) и/или сердечного тропонина I в образцах сыворотки (плазмы) человека—БиоТрейсер Кардиотест 3 в 1—предназначена для качественного выявления миоглобина, креатинкиназы МВ и/или сердечного тропонина (плазмы) или цельной крови человека методом иммунохроматографии. Целью первичной диагностики инфаркта миокарда. Комплект набора по назначению лабораторной диагностики in vitro

Для проведения диагностики in vitro



Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для
качественного определения миоглобина, креатинкиназы
МВ и/или сердечного тропонина I в образцах сыворотки
(плазмы) или цельной крови человека

Био Трейсер Кардиотест 3 в 1

Комплект №3

Состав:
- тест-кассета: 1 шт
- флакон капиллярной полимерной в комплекте с крышкой навинчиваемой
и пробкой-капельницей, содержащий буферный раствор: 1 шт
- одноразовая пипетка для образца: 1 шт

- ланцет-скафикатор: 1 шт
- салфетка спиртовая: 2 шт
- инструкция по применению: 1 шт

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Био Фокус»
ТНБ 109387, Москва, Тихая, 28, оф. 210
Тел./Факс: 8 (495) 900-65-84
www.biocross.ru

Для проведения диагностики in vitro
Тест-кассета

Био Трейсер Кардио

* Хранить при температуре 2-30 °C. Не за


Серия номер: 05

Дата выпуска: 02.2019

Годен до: 02.2021

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Био Фокус»
ТНБ 109387, М
Тел./Факс: 8 (4
www.biocross.ru





ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Набор реагентов
«Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения антител к вирусам иммунодефицита человека (ВИЧ) в образцах биологических жидкостей (плазме и/или сыворотке) крови человека»-БиоТрейсер Кардиотест 3 в 1»

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов-Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения антител к вирусам иммунодефицита человека (ВИЧ) в образцах биологических жидкостей (плазме и/или сыворотке) крови человека-БиоТрейсер Кардиотест 3 в 1. Предназначен для качественного быстрого выявления антител к вирусам иммунодефицита человека (ВИЧ) в образцах сыворотки (плазмы) или цельной крови человека методом иммунохроматографической реакции (ИХР) с высокой чувствительностью и специфичностью.

Для однократного прикосновения к набору по назначению.

Для клинической лабораторной диагностики.

Серия номер: 05
Дата выпуска: 01.2019
Годен до: 01.2021

ТУ 21.20.23-002-15580960-2019

РУ №

Для проведения диагностики in vitro



Набор реагентов

Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения антител к вирусам иммунодефицита человека (ВИЧ) в образцах биологических жидкостей (плазме и/или сыворотке) крови человека-БиоТрейсер Кардиотест 3 в 1.

БиоТрейсер Кардиотест 3 в 1

Для проведения диагностики in vitro
Тест-кассета

БиоТрейсер Кардиотест 3 в 1


* Хранить при температуре 2-30 °С. Не замораживать!

Серия номер: 05

Дата выпуска: 01.2019

Годен до: 01.2021

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Био Фокус»
РФ, 509387, Москва, Тихая, 28. оф. 216
Тел./факс: 8 (926) 900 65 84
www.biofocus.ru



Салфетки антисептические из нетканого текстильного материала (100% этиловый спирт)

«М.А. Асептика»-спиртовые (70% этиловый спирт)

Назначение: для дезинфекции поверхностей, рук и др.

Состав: этиловый спирт (70% этиловый спирт)

Размер салфетки: 60x100 мм

Рекомендация: использовать по назначению.

Срок годности: 3 года с даты, указанной на упаковке.

Выпуск: № 052 2019/05/28 от 28.07.2019 г.

РФ, Москва, 115194, Россия, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9.

Тел./факс: 8 (495) 660-19-00, email: info@asptika.ru

Тел./факс: 2. Тел./факс: 2146060-19-00, email: info@asptika.ru

Использовать при температуре от +5 °С до +40 °С в

исключении для детей. Не допускать попадания на

лицо. Не использовать для дезинфекции рук.

Упаковка: 100 шт. в упаковке.

Срок годности: 3 года с даты, указанной на упаковке.

Выпуск: № 052 2019/05/28 от 28.07.2019 г.

РФ, Москва, 115194, Россия, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9.

Тел./факс: 8 (495) 660-19-00, email: info@asptika.ru

Тел./факс: 2. Тел./факс: 2146060-19-00, email: info@asptika.ru

Использовать при температуре от +5 °С до +40 °С в

исключении для детей. Не допускать попадания на

лицо. Не использовать для дезинфекции рук.

Упаковка: 100 шт. в упаковке.

Срок годности: 3 года с даты, указанной на упаковке.

Выпуск: № 052 2019/05/28 от 28.07.2019 г.

РФ, Москва, 115194, Россия, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9.

Тел./факс: 8 (495) 660-19-00, email: info@asptika.ru

Тел./факс: 2. Тел./факс: 2146060-19-00, email: info@asptika.ru

Использовать при температуре от +5 °С до +40 °С в

исключении для детей. Не допускать попадания на

лицо. Не использовать для дезинфекции рук.

Упаковка: 100 шт. в упаковке.

Срок годности: 3 года с даты, указанной на упаковке.

Выпуск: № 052 2019/05/28 от 28.07.2019 г.

РФ, Москва, 115194, Россия, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9.

Тел./факс: 8 (495) 660-19-00, email: info@asptika.ru

Тел./факс: 2. Тел./факс: 2146060-19-00, email: info@asptika.ru



«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель директора ООО «БИО ФОКУС»
Козлов К.В.
4/7 июня 2019 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Набор реагентов

«Тест-система иммунохроматографическая на качественное определение антител к вирусам гепатита В и С в образцах сыворотки (плазмы) и/или цельной крови человека» — БиоТрейсер Кардиотест 3 в 1

Изготовитель: ООО «Био Фокус»
РФ, 109387, Москва, Тихая, 28, оф. 216.
Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84
www.biofocus.ru




Био Трейсер Кардиотест 3 в 1

Для проведения диагностики in vitro
Тест-кассета

Био Трейсер Кардиотест 3 в 1

* Хранить при температуре 2-30 °С. Не замораживать!



Серия номер: 05

Дата выпуска: 01.2019

Годен до: 01.2021


Изготовитель: ООО «Био Фокус»
РФ, 109387, Москва, Тихая, 28, оф. 216.
Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84
www.biofocus.ru



70%
ЭТИЛОВЫЙ
СПИРТ

1 шт.

Салфетки антисептические из безалкогольного текстильного материала стерильные «М.А. Асептика» спиртовые (70% этиловый спирт) предназначены для дезинфекционной обработки кожи до и после инъекций.
Состав: нетканый текстильный материал, пропитанный 70% этиловым спиртом.
Размер: салфеток 60x100 мм.
Способ применения: вскрыть упаковку по линии надсечения.
Срок годности: 5 лет с даты, указанной на упаковке.
Выпускает: ООО «М.А. Асептика»
Производитель: ООО «М.А. Асептика»
Юр. адрес: 117524, Россия, г. Москва, р-н Замоскворецкий, д. 9, стр. 5, пом. 2. Тел.: +7 (495) 360-16-00, www.asseptika.ru
Условия хранения: при температуре от +5 °С до +40 °С в сухом, защищенном от света месте. Не допускать попадания на салфетки влаги.
Инструкция для детей: не использовать.
Срок годности: 5 лет с даты, указанной на упаковке.
Исходный номер: 2.1.2.790-10.
Исходный номер: 2.1.2.790-10.

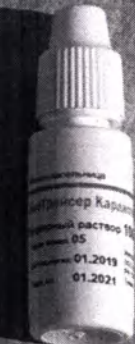

Импортер ООО «Био-Флюкс»
Р/О 109387, Москва, Тихая, 28, оф. 216,
Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84
www.bioflux.ru






Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для
качественного определения миоглобина, креатинкиназы
МВ и/или сердечного тропонина I в образцах сыворотки
(плазмы) или цельной крови человека

Био Трейсер Кардиотест 3 в 1

Хранить при температуре 2-30°C. Не замораживать!
Пожалуйста, прочтите инструкцию по применению перед использованием

Каталожный номер комплекта: 1413

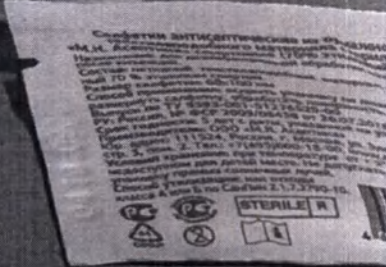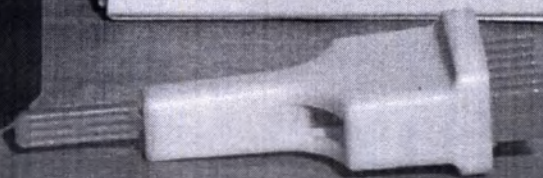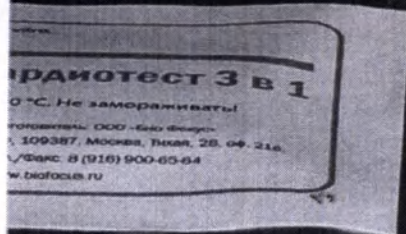

Изготовитель: ООО «Био Фокус»
РФ, 109387, Москва, Тихая, 28, оф. 216
Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84
www.biofocus.ru



1 тест / набор



Набор реагентов

**Тест-система иммунохроматографическая для
качественного определения миоглобина, креатинкиназы
МВ и/или сердечного тропонина I в образцах сыворотки
(плазмы) или цельной крови человека**

Био Трейсер Кардиотест 3 в 1

Хранить при температуре 2~30°C. Не замораживать!
Пожалуйста, прочтите инструкцию по применению перед использованием

Каталожный номер комплекта: 1413

Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для
качественного определения миоглобина, креатинкиназы
МВ и/или сербечного тропонина I в образцах сыворотки
(плазмы) или цельной крови человека

Био Трейсер Кардиотест 3 в 1

Комплект №3

Состав:
 - тест-кассета: 1 шт
 - флакон-капельница полимерный с крышкой навинчиваемой
 и пробкой-капельницей, содержащий буферный раствор: 1 шт
 - одноразовая пипетка для образца: 1 шт

- ланцет-скафикатор: 1 шт
 - салфетка спиртовая: 2 шт
 - инструкция по применению:

Изготовитель: ООО «Био Фокус»
 РФ, 109387, Москва, Тихая, 28, оф. 216.
 Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84
www.biofocus.ru





«ТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор ООО «БЮ ФОКУС»
Козлов К.В.
17 июня 2019 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Набор реагентов

«Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения миоглобина, креатинкиназы МВ и/или сердечного тропонина I в образцах сыворотки (плазмы) и в цельной крови человека»-БиоТрейсер Кардиотест 3 в 1»

НАЗНАЧЕНИЕ

«Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения миоглобина, креатинкиназы МВ и/или сердечного тропонина I в образцах сыворотки (плазмы) и в цельной крови человека»-БиоТрейсер Кардиотест 3 в 1-предназначен для качественного быстрого выявления миоглобина, креатинкиназы МВ и/или сердечного тропонина I в образцах сыворотки (плазмы) или цельной крови человека, источник иммунохроматографического анализа (ИХА) с целью первичной диагностики инфаркта миокарда. Для однократного применения набора по назначению. Для клинической лабораторной диагностики только.

Для проведения диагностики in vitro



Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения миоглобина, креатинкиназы МВ и/или сердечного тропонина I в образцах сыворотки (плазмы) или цельной крови человека

Био Трейсер Кардиотест 3 в 1

Комплект №3

Состав:

- тест-кассета: 1 шт
- флакон-капельница полимерный в комплекте с крышкой навинчиваемой и пробкой-капельницей, содержащий буферный раствор: 1 шт
- одноразовая пипетка для образца: 1 шт


- ланцет-скафикатор: 1 шт
- салфетка спиртовая: 2 шт
- инструкция по применению: 1 шт

Изготовитель: ООО «Бю Фокус»
РФ: 109387, Москва, Троицк, 28-ой 23Б
Тел./Факс: +7 (316) 300-65-66
www.biofocus.ru




Для проведения диагностики
Тест-кассета

Био Трейсер



* Хранить при темп.
Серия номер: 06
Дата выпуска: 01.2019
Годен до: 01.2021

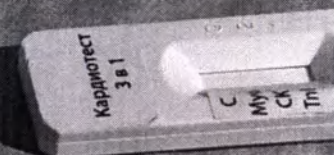




УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО «БИО ФОКУС»
Козлов К.В.
17 июня 2019 г.

СЦЕЛЯЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Набор реагентов
для качественного определения миоглобина, креатинкиназы
МВ и/или сердечного тропонина I в образцах сыворотки
(плазмы) или цельной крови человека

НАЗНАЧЕНИЕ

Иммунохроматографическая для качественного определения
сердечного тропонина I в образцах сыворотки (плазмы)
и/или цельной крови человека. Применяется для качественного
определения миоглобина, креатинкиназы МВ и/или сердечного тропонина
I в образцах сыворотки (плазмы) или цельной крови человека.



Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для
качественного определения миоглобина, креатинкиназы
МВ и/или сердечного тропонина I в образцах сыворотки
(плазмы) или цельной крови человека

Био Трейсер Кардиотест 3 в 1



Хранить при температуре 2-30°С. Не замораживать!
Пожалуйста, прочтите инструкцию по применению перед использованием

Каталожный номер комплекта: 1413

Серия номер: 06
Дата выпуска: 01.2019
Годен до: 01.2021

ТУ 21.20.23-002-15580930-2019

РН №

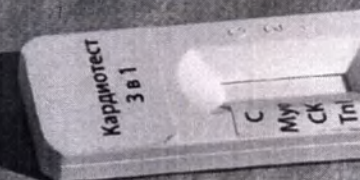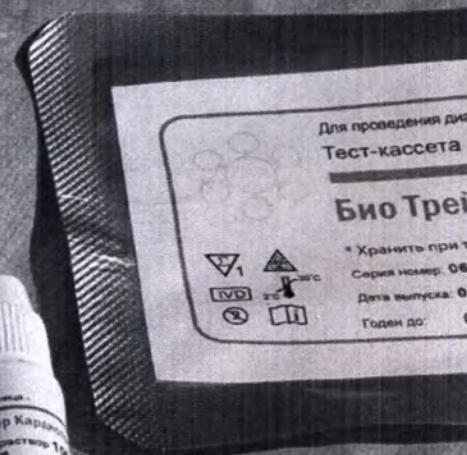



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО «БИО ФОКУС»
Козлов К.В.
01.2019 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Набор реагентов

Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения миоглобина, креатинкиназы МВ и/или сердечного тропонина I в образцах сыворотки (плазмы) или цельной крови человека—БиоТрейсер Кардиотест 3 в 1

НАЗНАЧЕНИЕ

Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения креатинкиназы МВ и/или сердечного тропонина I в образцах сыворотки (плазмы) или цельной крови человека—БиоТрейсер Кардиотест 3 в 1 предназначена для быстрого выявления миоглобина, креатинкиназы МВ и/или сердечного тропонина I (НХА) в сыворотке или цельной крови человека методом иммунохроматографии. Комплект реактивов набора по назначению лабораторной диагностики in vitro.



Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для
качественного определения миоглобина, креатинкиназы
МВ и/или сердечного тропонина I в образцах сыворотки
(плазмы) или цельной крови человека


Био Трейсер Кардиотест 3 в 1


Хранить при температуре 2–30°С. Не замораживать!
Пожалуйста, прочтите инструкцию по применению перед использованием

Каталожный номер комплекта: 1413

Серия номер: 06
Дата выпуска: 01.2019
Годен до: 01.2021

ТУ 21.20.23-002-17040900-2019
РФ №

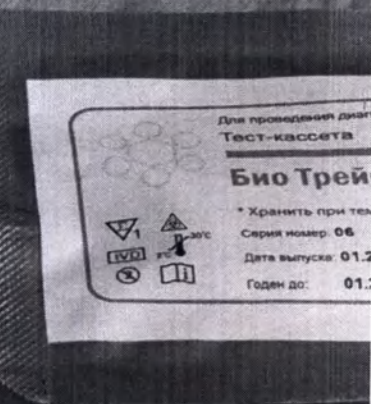



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Набор реагентов


«Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения миоглобина, креатинкиназы МВ и/или сердечного тропонина I в образцах сыворотки (плазмы) или цельной крови человека—БиоТрейсер Кардиотест 3 в 1»

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения миоглобина, креатинкиназы МВ и/или сердечного тропонина I в образцах сыворотки (плазмы) или цельной крови человека—БиоТрейсер Кардиотест 3 в 1» предназначен для качественного однократного быстрого выявления миоглобина, креатинкиназы МВ и/или сердечного тропонина I в образцах сыворотки (плазмы) или цельной крови человека методом иммунохроматографического анализа (ИХА) с целью первичной диагностики инфаркта миокарда.

Для однократного применения набора по назначению.
Для клинической лабораторной диагностики in vitro.

Для проведения диагностики in vitro



Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для
качественного определения миоглобина, креатинкиназы
МВ и/или сердечного тропонина I в образцах сыворотки
(плазмы) или цельной крови человека

Био Трейсер Кардиотест 3 в 1



Комплект №3

Состав:

- тест-кассета: 1 шт
- флакон-капельница полимерный в комплекте с крышкой навинчиваемой и пробой-капельницей, содержащий буферный раствор: 1 шт
- одноразовая пипетка для образца: 1 шт

- ланцет-скафикатор: 1 шт
- салфетка спиртовая: 2 шт
- инструкция по применению: 1 шт

Исготовитель: ООО «Био Фокус»
ИП: 109387, Москва, Тимая 28, оф. 210
Тел./Факс: 8 (910) 300-85-84
www.biofocus.ru

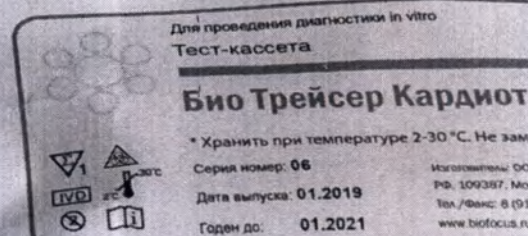

Изготовитель: ООО «Био Фокус»
РФ, 109387, Москва, Тихая, 28, оф. 216.
Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84
www.biofocus.ru



1 тест / набор



Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для
качественного определения миоглобина, креатинкиназы
МВ и/или сердечного тропонина I в образцах сыворотки
(плазмы) или цельной крови человека

Био Трейсер Кардиотест 3 в 1

Хранить при температуре 2~30°C. Не замораживать!
Пожалуйста, прочтите инструкцию по применению перед использованием

Каталожный номер комплекта: 1413

Серия номер: 06
Дата выпуска: 01.2019
Годен до: 01.2021

ТУ 21.20.23-002-15580960-2019

РУ №

Для проведения диагностики in vitro



Набор реагентов

**Тест-система иммунохроматографическая для
качественного определения миоглобина, креатинкиназы
МВ и/или сердечного тропонина I в образцах сыворотки
(плазмы) или цельной крови человека**

Био Трейсер Кардиотест 3 в 1

Комплект №3

Состав:

- тест-кассета: 1 шт
- флакон-капельница полимерный в комплекте с крышкой навинчиваемой и пробкой-капельницей, содержащий буферный раствор: 1 шт
- одноразовая пипетка для образца: 1 шт
- ланцет-скафикатор: 1 шт
- салфетка спиртовая: 2 шт
- инструкция по применению: 1 шт



Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для
качественного определения миоглобина, креатинкиназы
МВ и/или сердечного тропонина I в образцах сыворотки
(плазмы) или цельной крови человека

Био Трейсер Кардиотест 3 в 1


Хранить при температуре 2~30°С. Не замораживать!
Пожалуйста, прочтите инструкцию по применению перед использованием

Каталожный номер комплекта: 1413

Серия номер: 06
Дата выпуска: 01.2019
Годен до: 01.2021

ТУ 21.20.23.002-15580960-2019

РУ №

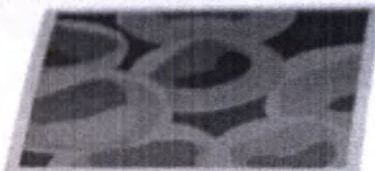

Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для
качественного определения миоглобина, креатинкиназы
МВ и/или сердечного тропонина I в образцах сыворотки
(плазмы) или цельной крови человека

Био Трейсер Кардиотест 3 в 1

Хранить при температуре 2~30°С. Не замораживать!
Пожалуйста, прочтите инструкцию по применению перед использованием

Каталожный номер комплекта: 1413

Серия номер: 06
Дата выпуска: 01.2019
Годен до: 01.2021

ТУ 21.20.23-002-15580960-2019

РУ №



УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО «БИО ФОКУС»
Козлов К.В.
17 июня 2019 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Набор реагентов
иммунохроматографическая для качественного определения миоглобина, тропонина I в образцах сыворотки (плазмы) и/или цельной крови человека—БиоТрейсер Кардиотест 3 в 1

НАЗНАЧЕНИЕ

Иммунохроматографическая для качественного определения тропонина I в образцах сыворотки (плазмы) и/или цельной крови человека методом иммунохроматографии. БиоТрейсер Кардиотест 3 в 1—предназначен для качественного определения миоглобина, креатинкиназы МВ и/или сердечного тропонина I в образцах сыворотки (плазмы) и/или цельной крови человека методом иммунохроматографии. Набор по назначению для диагностики инфаркта миокарда.



Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для
качественного определения миоглобина, креатинкиназы
МВ и/или сердечного тропонина I в образцах сыворотки
(плазмы) или цельной крови человека

Био Трейсер Кардиотест 3 в 1



Хранить при температуре 2–30 °С. Не замораживать!
Пожалуйста, прочтите инструкцию по применению перед использованием

Каталожный номер комплекта: 1413

Серия номер: 06
Дата выпуска: 01.2019
Годен до: 01.2021

ТУ 01.20.23-002-15580960-2019

ТУ №

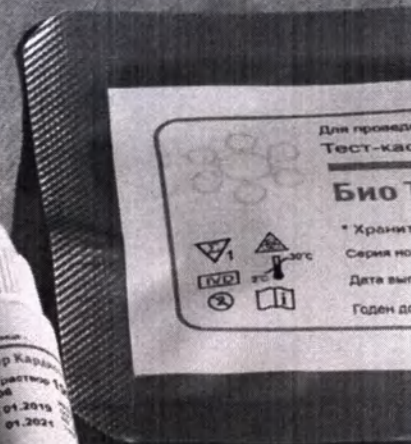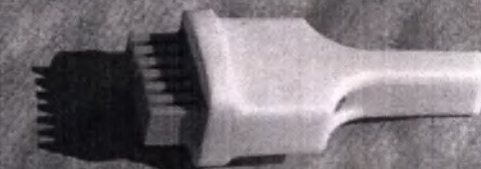



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
_____ листов
Генеральный директор
«БИО-ФОКУС» Козлов К.В.