





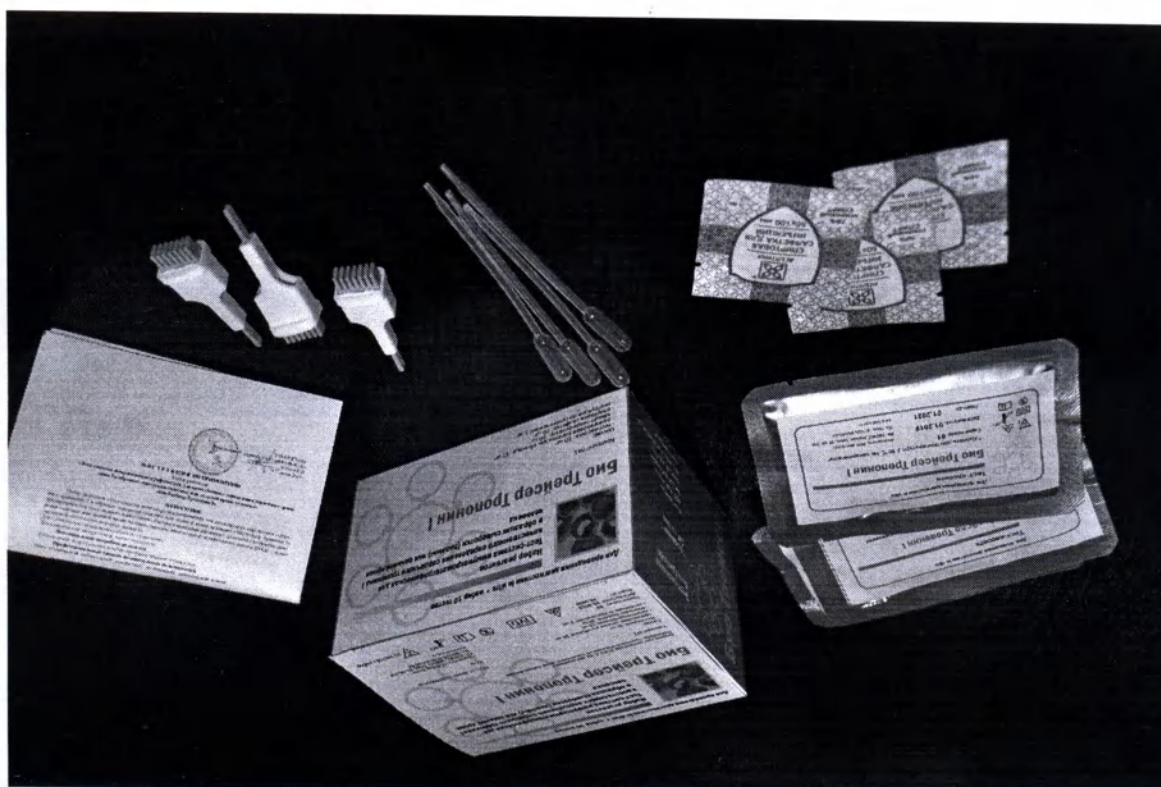

Для проведения диагностики in vitro • набор 10 тестов

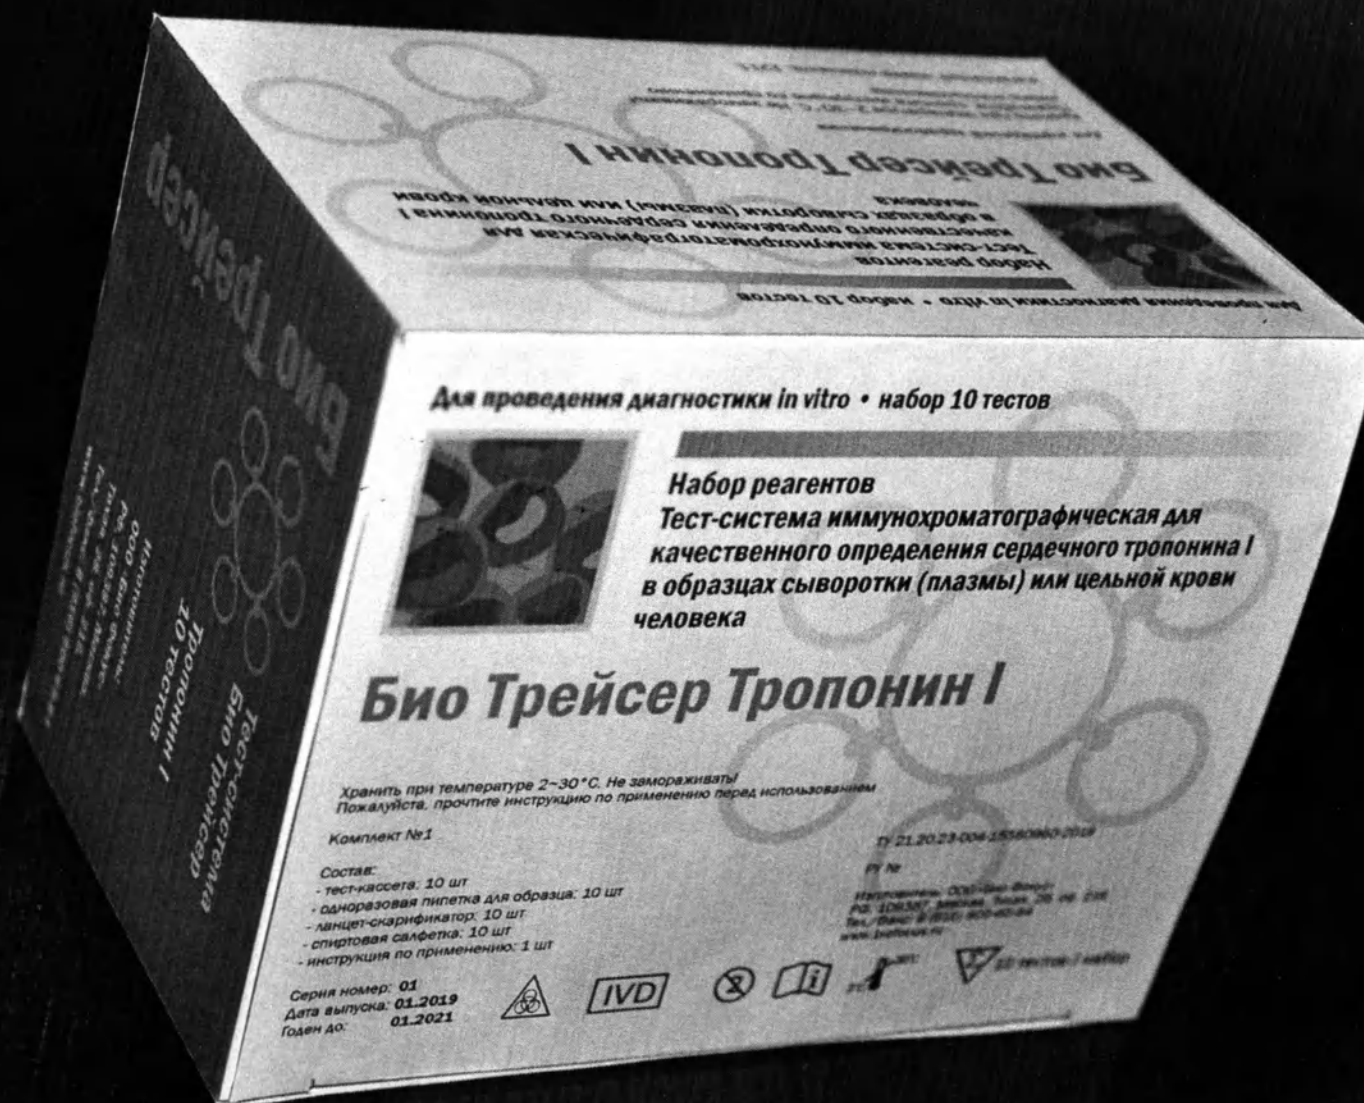

Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для
качественного определения сердечного тропонина I
в образцах сыворотки (плазмы) или цельной крови
человека

Био Трейсер Тропонин I

Хранить при температуре 2-30°C. Не замораживать!
Пожалуйста, прочтите инструкцию по применению перед использованием

Комплект №1

- Состав:
- тест-кассета: 10 шт
 - одноразовая пипетка для образца: 10 шт
 - ланцет-скарификатор: 10 шт
 - спиртовая салфетка: 10 шт
 - инструкция по применению: 1 шт

Серия номер: 01
Дата выпуска: 01.2019
Годен до: 01.2021



Для проведения диагностики In vitro • набор 10 тестов



Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для
качественного определения сердечного тропонина I
в образцах сыворотки (плазмы) или цельной крови
человека

Био Трейсер Тропонин I

Хранить при температуре 2-30°C. Не замораживать!
Пожалуйста, прочтите инструкцию по применению перед использованием

Комплект №1

Состав:
- тест-кассета: 10 шт
- одноразовая пипетка для образца: 10 шт
- ланцет-скарификатор: 10 шт
- спиртовая салфетка: 10 шт
- инструкция по применению: 1 шт

Серия номер: 01
Дата выпуска: 01.2019
Годен до: 01.2021



10 тестов / набор

TU 21.20.23-004-15560960-2019

РУ №

Изготовитель: ООО «Био Фокус»
РФ: 109387, Москва, Тихая, 28, оф. 216.
Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84
www.biofocus.ru

Для проведения диагностики In vitro • набор 10 тестов






Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для
качественного определения сердечного тропонина I
в образцах сыворотки (плазмы) или цельной крови
человека

Био Трейсер Тропонин I

Комплект №1

Состав:
- тест-кассета: 10 шт
- одноразовая пипетка для образца: 10 шт
- ланцет-скарификатор: 10 шт
- спиртовая салфетка: 10 шт
- инструкция по применению: 1 шт

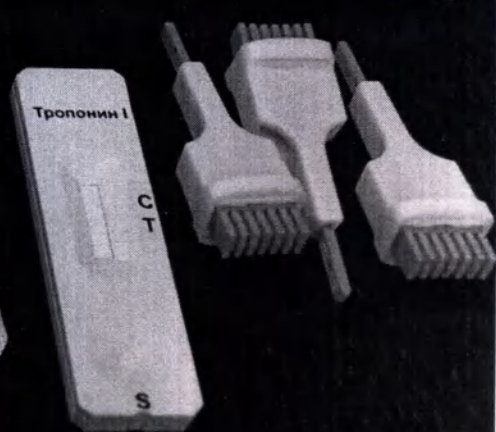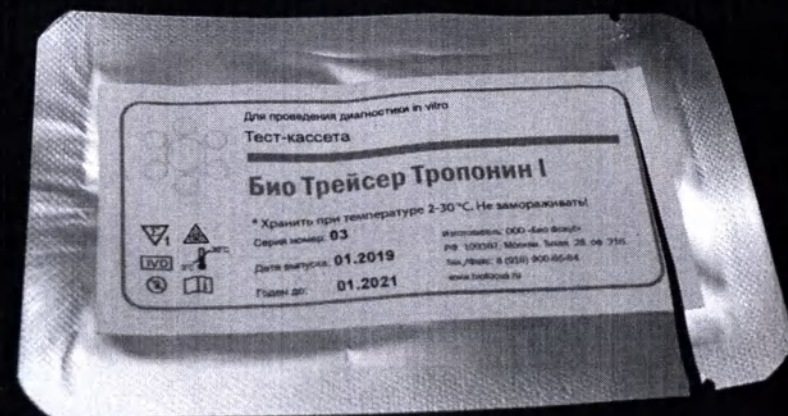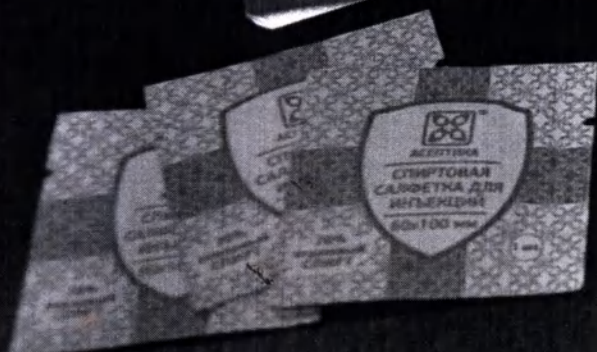[illegible]

Для проведения диагностики in vitro • набор 10 тестов



Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для
качественного определения сердечного тропонина I
в образцах сыворотки (плазмы) или цельной крови
человека

Био Трейсер Тропонин I

Хранить при температуре 2–30°C. Не замораживать!
Пожалуйста, прочтите инструкцию по применению перед использованием

Комплект №1

Состав:
- тест-кассета: 10 шт
- одноразовая пипетка для образца: 10 шт
- ланцет-скарификатор: 10 шт
- спиртовая салфетка: 10 шт
- инструкция по применению: 1 шт

Серия номер: 03
Дата выпуска: 01.2019
Годен до: 01.2021




10 тестов / набор

ТУ 21.20.23-004-15560960-2019

РХ №

Изготовитель: ООО «Био Фокус»
РФ, 109357, Москва, Тихая, 2Б, оф. 216.
Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84
www.biofocus.ru

Для проведения диагностики in vitro • набор 10 тестов



Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для
качественного определения сердечного тропонина I
в образцах сыворотки (плазмы) или цельной крови
человека

Био Трейсер Тропонин I

Комплект №1

Состав:
- тест-кассета: 10 шт
- одноразовая пипетка для образца: 10 шт
- ланцет-скарификатор: 10 шт
- спиртовая салфетка: 10 шт
- инструкция по применению: 1 шт

Для проведения диагностики in vitro • набор 10 тестов



Набор реагентов

Тест-система иммунохроматографическая для
качественного определения сердечного тропонина I
в образцах сыворотки (плазмы) или цельной крови
человека

Био Трейсер Тропонин I

Хранить при температуре 2-30°С. Не замораживать.
Пожалуйста, прочтите инструкцию по применению перед использованием.

Комплект №1

Состав:

- тест-кассета: 10 шт
- одноразовая пилетка для образца: 10 шт
- ланцет-скарификатор: 10 шт
- спиртовая салфетка: 10 шт
- инструкция по применению: 1 шт

Серия номер: 03

Дата выпуска: 01.2019

Повтор дат: 01.2021









10 тестов / набор

ТУ 21.20.23-004-15580960-2019

РУ №

Изготовитель: ООО «Био Фокус»
РФ, 109387, Москва, Тихая, 28, оф. 216.
Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84
www.biofocus.ru

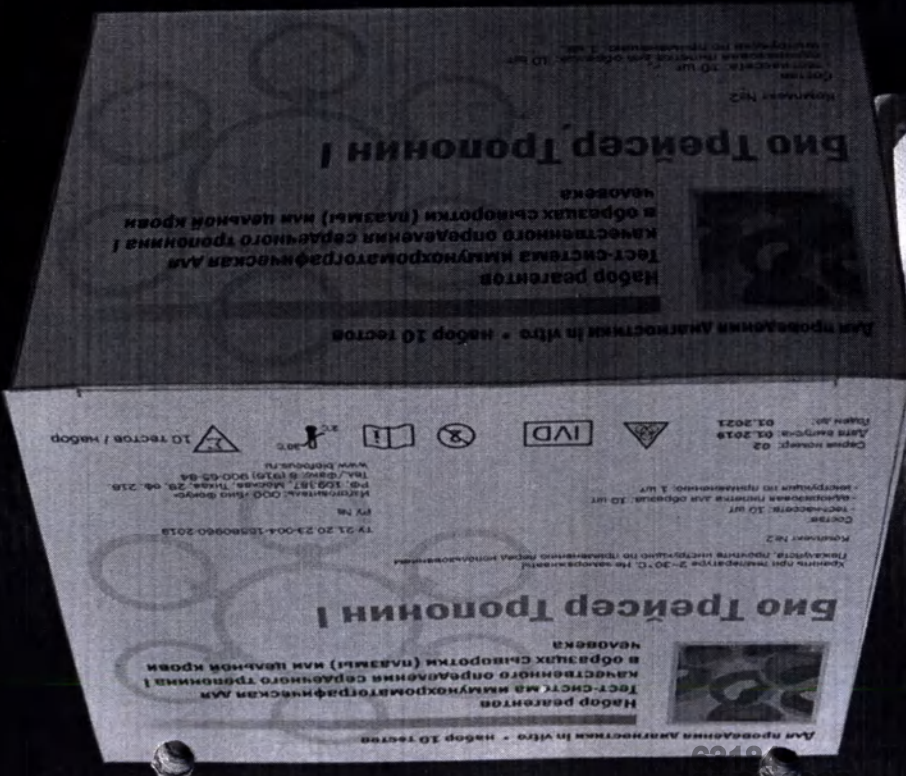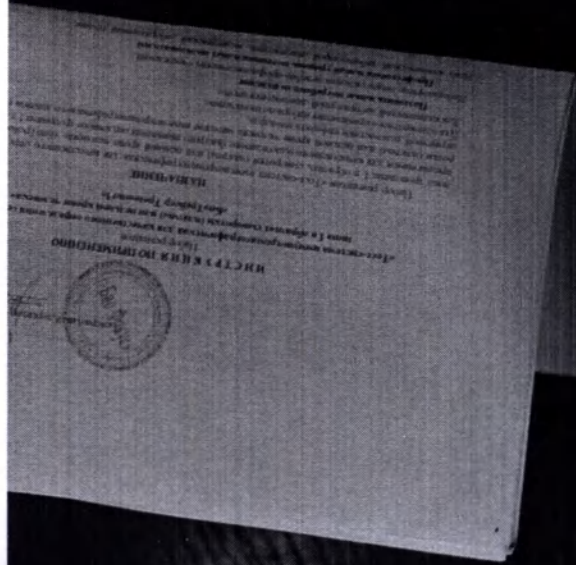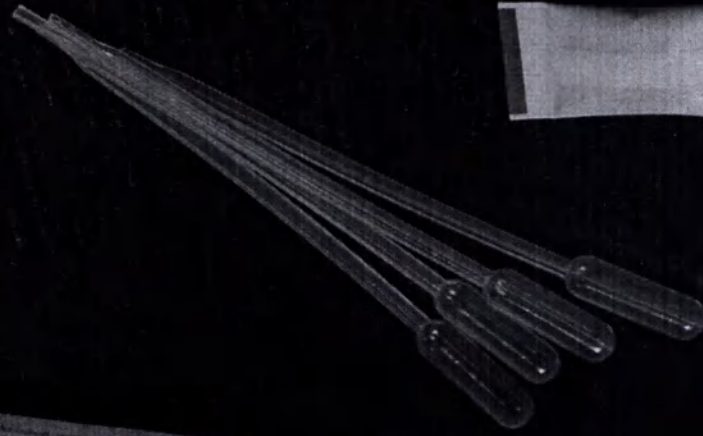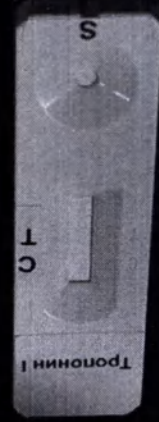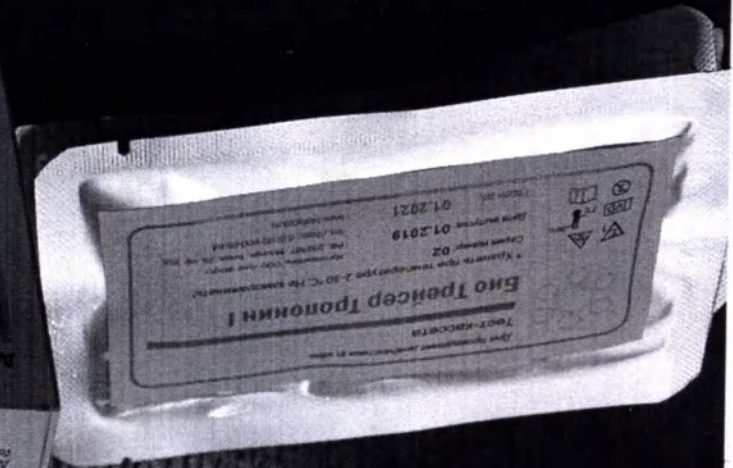

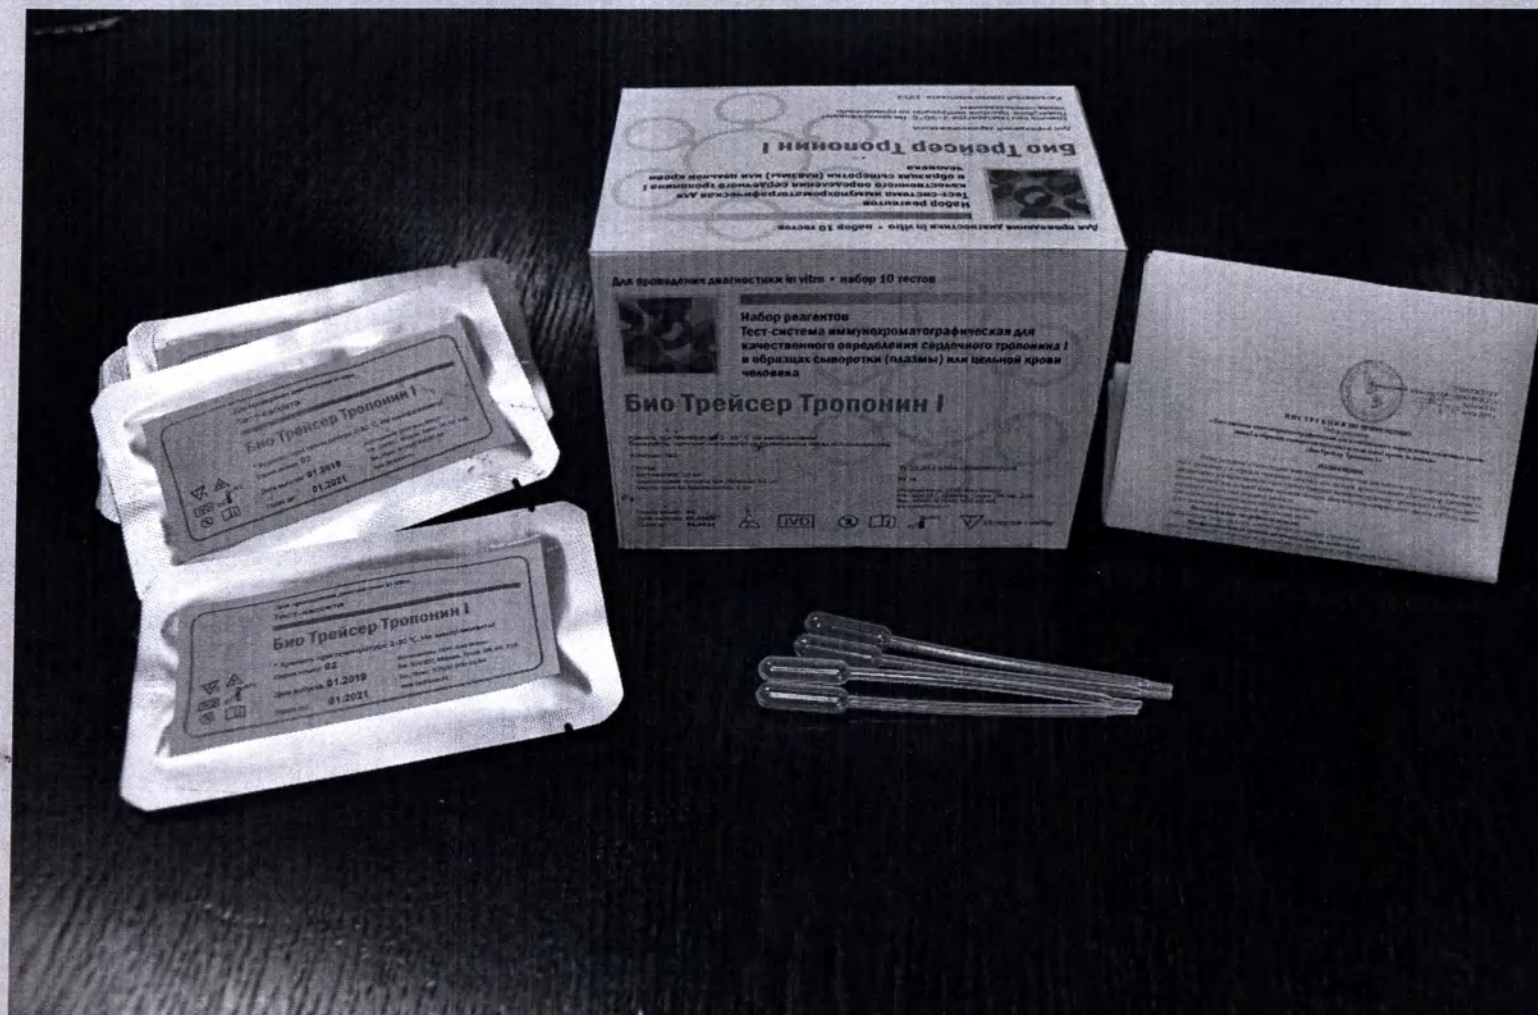



Для проведения диагностики in vitro • набор 10 тестов



Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для
качественного определения сердечного тропонина I
в образцах сыворотки (плазмы) или цельной крови
человека

Био Трейсер Тропонин I

Хранить при температуре 2-30°C, не замораживать!
Пожалуйста, прочтите инструкцию по применению перед использованием

Комплект №2

Состав:

- тест-кассета: 10 шт
- одноразовая пипетка для образца: 10 шт
- инструкция по применению: 1 шт

TU 21.20.23-004-15580950-2019

РУ НН


Изготовитель: ООО «Био Фокус»
РФ, 109387, Москва, Тульская, 25, оф. 216
Тел./Факс: 8 (495) 900-65-54
www.biofocus.ru

Серия номер: 02
Дата выпуска: 01.2019
Годен до: 01.2021



10 тестов / набор

Для проведения диагностики in vitro • набор 10 тестов



Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для
качественного определения сердечного тропонина I
в образцах сыворотки (плазмы) или цельной крови
человека

Био Трейсер Тропонин I

Комплект №2

Состав:

- тест-кассета: 10 шт
- одноразовая пипетка для образца: 10 шт
- инструкция по применению: 1 шт

Для проведения диагностики in vitro • набор 10 тестов

Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения сердечного тропонина I в образцах сыворотки (плазмы) или цельной крови человека

Био Трейсер Тропонин I

Хранить при температуре 2-30°C. Не замораживать!
После вскрытия, приложить инструкцию по назначению, перед использованием

Комплект №2

Система:
- Тест-кассеты: 10 шт.
- Иммунохроматографические картриджи для образцов: 10 шт.
- Инструкция по применению: 1 шт.

ТУ 21.20.23-004-15040960-2019
ИУ №

Исполнитель: ООО «Бит Фьюри»
Р/Н: 500387, Москва, Тихая, 28, оф. 218
Тел./факс: 8 (495) 900-45-84
www.bitfury.ru

Серия номер: 04
Дата выпуска: 01.2019
План дат: 01.2021

IVD

10 тестов / набор

Для проведения диагностики in vitro • набор 10 тестов

Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения сердечного тропонина I в образцах сыворотки (плазмы) или цельной крови человека

Био Трейсер Тропонин I

Комплект №2

Система:
- Тест-кассеты: 10 шт.
- Иммунохроматографические картриджи для образцов: 10 шт.
- Инструкция по применению: 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Тест-система

«Бит Трейсер Тропонин I» - тест-система иммунохроматографическая для качественного определения сердечного тропонина I в образцах сыворотки (плазмы) или цельной крови человека.

НАЗНАЧЕНИЕ
Тест-система «Бит Трейсер Тропонин I» предназначена для быстрого определения наличия или отсутствия тропонина I в образцах сыворотки (плазмы) или цельной крови человека. Тест-система «Бит Трейсер Тропонин I» предназначена для использования в лабораториях, оснащенных оборудованием для проведения иммунохроматографических тестов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Тест-система «Бит Трейсер Тропонин I» предназначена для использования в лабораториях, оснащенных оборудованием для проведения иммунохроматографических тестов. Тест-система «Бит Трейсер Тропонин I» предназначена для использования в лабораториях, оснащенных оборудованием для проведения иммунохроматографических тестов.

Для проведения диагностики in vitro • набор 10 тестов

Тест-кассета

Био Трейсер Тропонин I

Хранить при температуре 2-30°C. Не замораживать!

Серия номер: 04
Дата выпуска: 01.2019
План дат: 01.2021

Исполнитель: ООО «Бит Фьюри»
Р/Н: 500387, Москва, Тихая, 28, оф. 218
Тел./факс: 8 (495) 900-45-84
www.bitfury.ru

Для проведения диагностики in vitro
Тест-кассета

Био Трейсер Тропонин I

Хранить при температуре 2-30°C. Не замораживать!

Серия номер: 04
Дата выпуска: 01.2019
План дат: 01.2021

Исполнитель: ООО «Бит Фьюри»
Р/Н: 500387, Москва, Тихая, 28, оф. 218
Тел./факс: 8 (495) 900-45-84
www.bitfury.ru

Тропонин I

C

T

S

Тест-кассета

Био Трейсер Тропонин I

Хранить при температуре 2-30°C. Не замораживать!

Серия номер: 04
Дата выпуска: 01.2019
План дат: 01.2021

Исполнитель: ООО «Бит Фьюри»
Р/Н: 500387, Москва, Тихая, 28, оф. 218
Тел./факс: 8 (495) 900-45-84
www.bitfury.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Набор реагентов

Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения сердечного тропонина I в образцах сыворотки (плазмы) или цельной крови человека

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения сердечного тропонина I» предназначен для быстрого выявления сердечного тропонина I в образцах сыворотки (плазмы) или цельной крови человека. Тест-система предназначена для использования в лабораториях, оснащенных оборудованием для проведения иммунохроматографического анализа (ИХА).

Тест-система предназначена для использования в лабораториях, оснащенных оборудованием для проведения иммунохроматографического анализа (ИХА).

Био Трейсер Тропонин I

Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения сердечного тропонина I в образцах сыворотки (плазмы) или цельной крови человека


Для проведения диагностики in vitro • набор 10 тестов

Хранить при температуре 2-30°C. Не замораживать!
Срок годности: 12 месяцев со дня выпуска

Состав:
- Набор реагентов: 10 шт.
- Иммунохроматографическая тест-система: 10 шт.

Срок годности: 12 месяцев со дня выпуска

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Био Трейсер»
Р/о: 509357, Москва, Троицк, 26.09.2019
Тел./Факс: 8 (915) 500-85-84
www.biotracer.ru

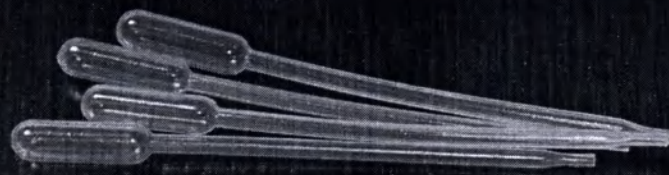


Для проведения диагностики in vitro
Тест-кассета

Био Трейсер Тропонин I

* Хранить при температуре 2-30°C. Не замораживать!

Серия номер: 04
Дата выпуска: 01.2019
Годен до: 01.2021

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Био Трейсер»
Р/о: 509357, Москва, Троицк, 26.09.2019
Тел./Факс: 8 (915) 500-85-84
www.biotracer.ru

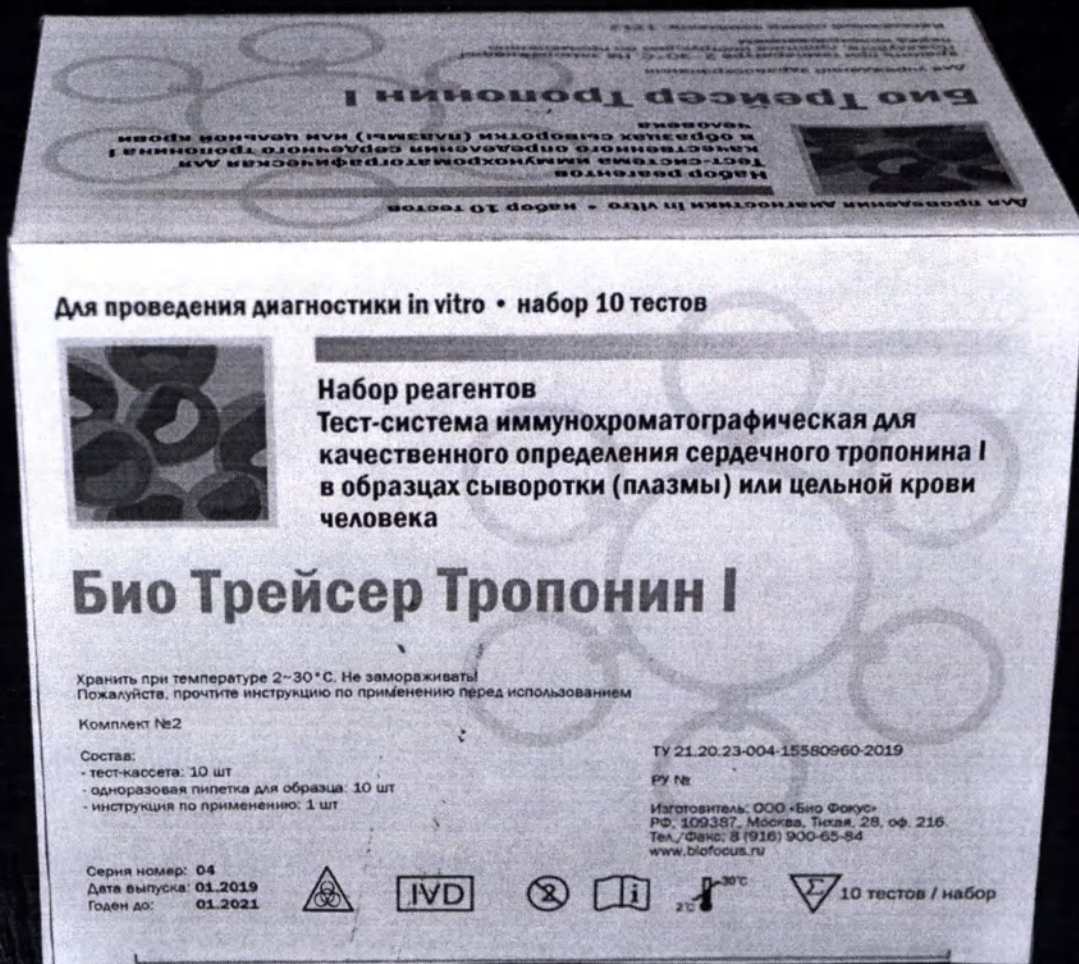

Для проведения диагностики in vitro • набор 10 тестов



Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для
качественного определения сердечного тропонина I
в образцах сыворотки (плазмы) или цельной крови
человека

Био Трейсер Тропонин I

Хранить при температуре 2~30°C. Не замораживать!
Пожалуйста, прочтите инструкцию по применению перед использованием

Комплект №2

Состав:
- тест-кассета: 10 шт
- одноразовая пипетка для образца: 10 шт
- инструкция по применению: 1 шт

ТУ 21.20.23-004-15580960-2019

РУ №

Изготовитель: ООО «Био Фокус»
РФ, 109387, Москва, Тихая, 28, оф. 216.
Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84
www.biofocus.ru

Серия номер: 04
Дата выпуска: 01.2019
Годен до: 01.2021



10 тестов / набор





Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для
качественного определения сердечного тропонина I
в образцах сыворотки (плазмы) или цельной крови
человека

Био Трейсер Тропонин I


Хранить при температуре 2–30 °С. Не замораживать!
Пожалуйста, прочтите инструкцию по применению перед использованием

Каталожный номер комплекта: 1213

Серия номер: 05
Дата выпуска: 01.2019
Годен до: 01.2021

ТУ 21.20.23.004.15580960-2019

РУ №

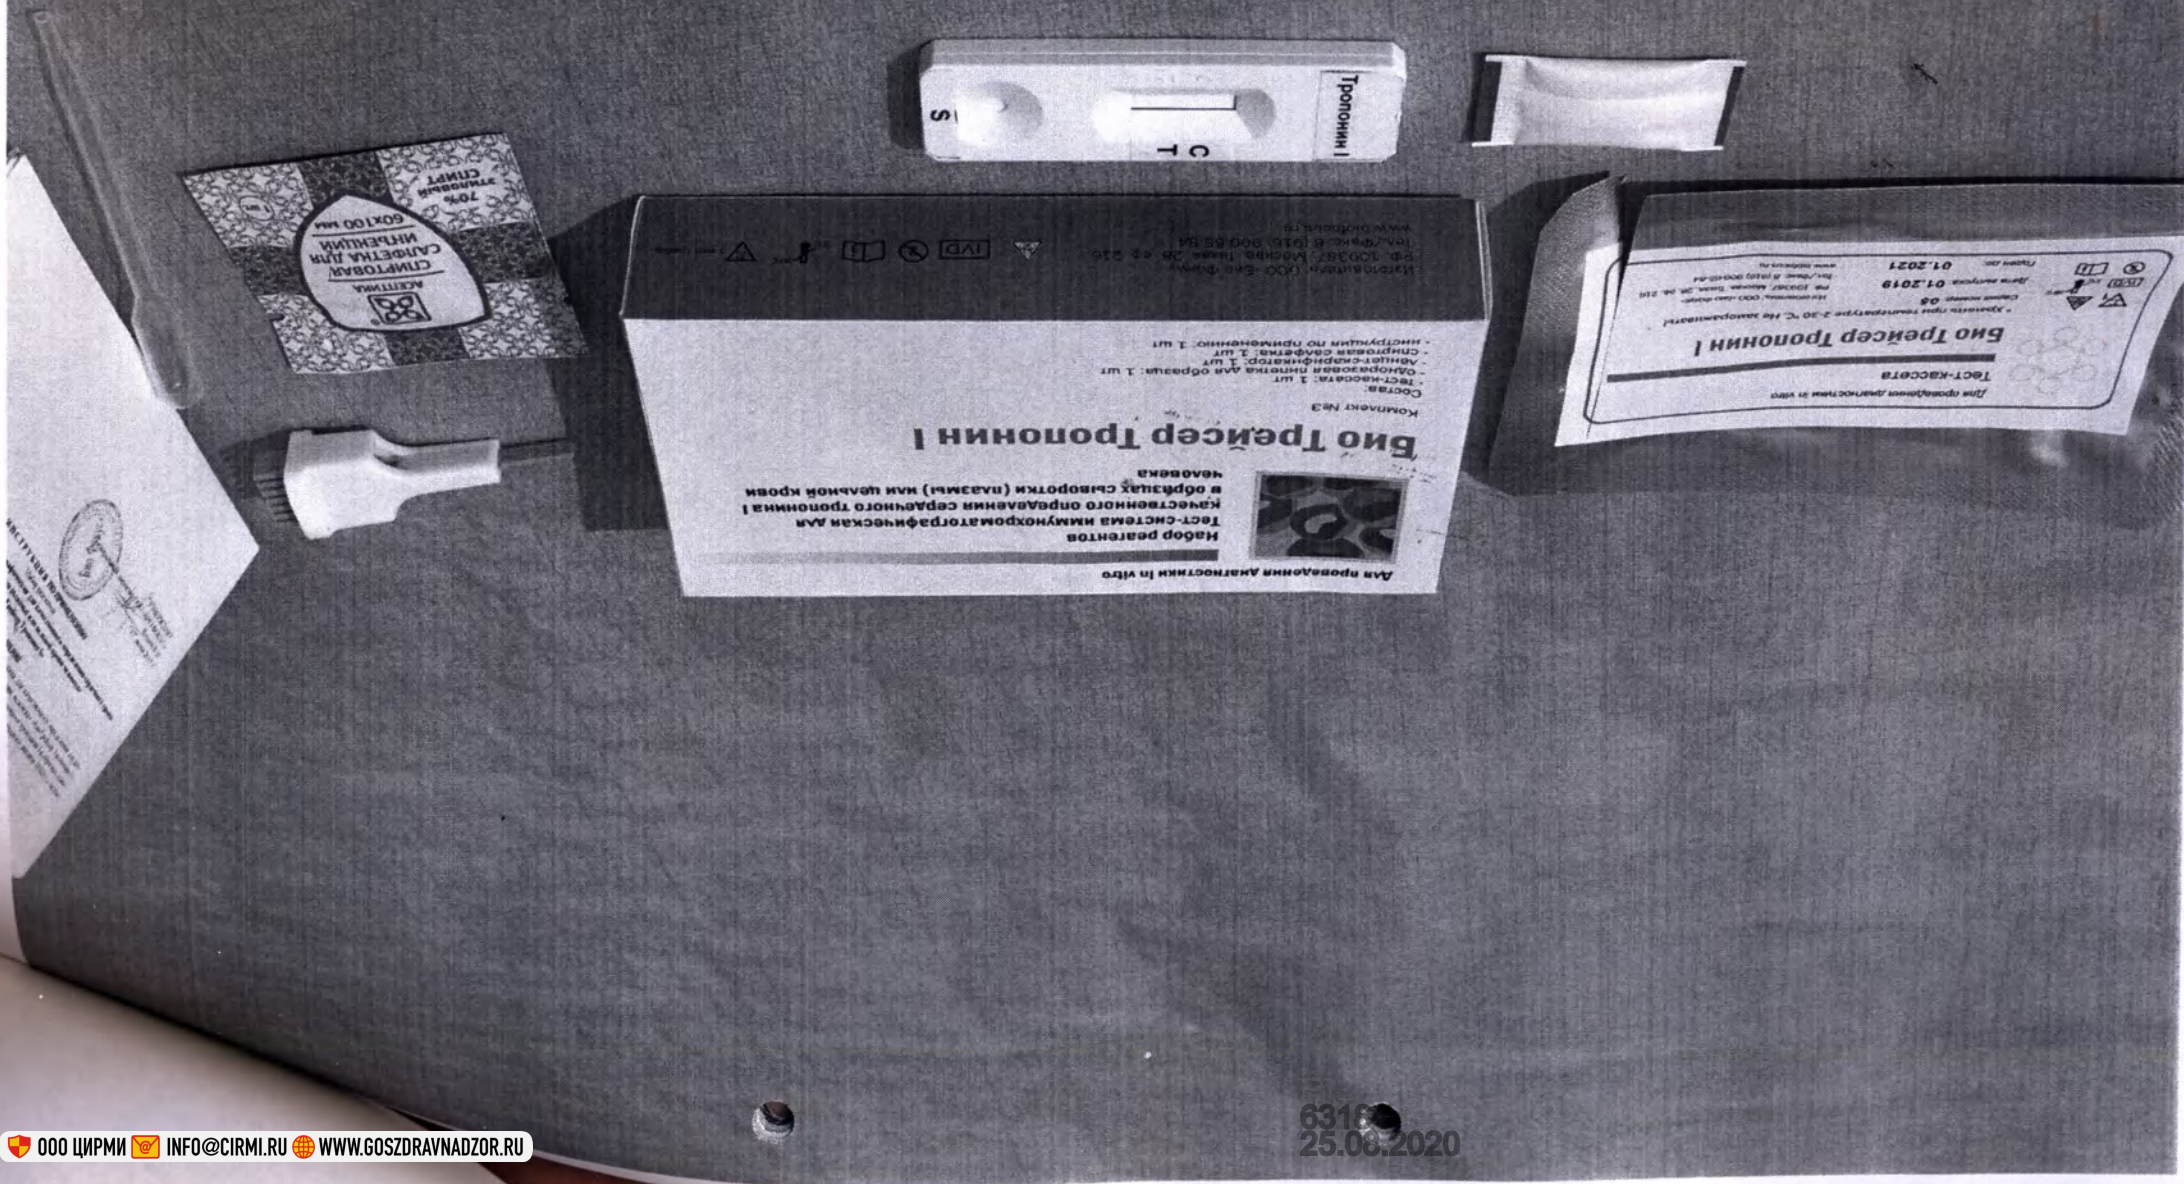

Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для
качественного определения сербачного тропонина I
в образцах сыворотки (плазмы) или цельной крови
человека

Био Трейсер Тропонин I

Комплект №3

- Состава: 1 шт
- Тест-кассета: 1 шт
- Одноразовая пилетка для образца: 1 шт
- Контейнер-корпус: 1 шт
- Сигурная салфетка: 1 шт
- Инструкция по применению: 1 шт

Импортер: ООО «Био Трейсер»
РФ, 109387, Москва, Тимирязевский район, д. 20, стр. 210
Тел./Факс: 8 (495) 900 65 84
www.biotraser.ru

Для проведения исследования in vitro

Тест-кассета

Био Трейсер Тропонин I

«Адаптирована для температуры 2-30 °C. Не замораживать!»

Срок годности: 05

Дата выпуска: 01.2019

Импортёр: ООО «Био Трейсер»
РФ, 109387, Москва, Тимирязевский район, д. 20, стр. 210
www.biotraser.ru

АСЕТИМ
СИГНОВАЯ
ПИЛЕТКА ДЛЯ
ТРОПОНИНА
70%
ЭТАНОЛОВАЯ
СМЕСЬ
60x100 мм

Набор реагентов

Тест-система иммунохроматографическая для
качественного определения сердечного тропонина I
в образцах сыворотки (плазмы) или цельной крови
человека




Био-Трейсер Тропонин I

Хранить при температуре 2-30 °С. Не замораживать!
Пожалуйста, прочтите инструкцию по применению перед использованием
Каталожный номер комплекта: 1213

Серия номер: 05
Дата выпуска: 01.2019
Годен до: 01.2021

ТУ 21.20.23.004.1556.090.0019
РР И

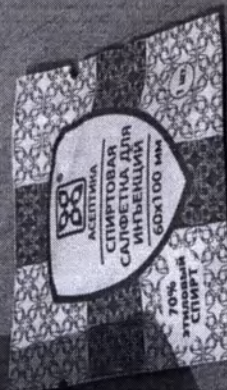

Для проведения диагностики в целях
ТЕСТ-ЛАБОР

Био-Трейсер Тропонин I

* Хранить при температуре 2-30 °С. Не замораживать!

Серия номер: 05
Дата выпуска: 01.2019
Годен до: 01.2021

Исполнитель: ООО «Био-Трейд»
РФ 11503067, Москва, Баски 28 стр. 21а
Вид/номер: В 01.01.00 9030-05.04
www.bioreid.ru

01.2019
01.2021

HAYDON & SONS, CO. - Fire & Marine Insurance
 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340, 342, 344, 346, 348, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 374, 376, 378, 380, 382, 384, 386, 388, 390, 392, 394, 396, 398, 400, 402, 404, 406, 408, 410, 412, 414, 416, 418, 420, 422, 424, 426, 428, 430, 432, 434, 436, 438, 440, 442, 444, 446, 448, 450, 452, 454, 456, 458, 460, 462, 464, 466, 468, 470, 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484, 486, 488, 490, 492, 494, 496, 498, 500, 502, 504, 506, 508, 510, 512, 514, 516, 518, 520, 522, 524, 526, 528, 530, 532, 534, 536, 538, 540, 542, 544, 546, 548, 550, 552, 554, 556, 558, 560, 562, 564, 566, 568, 570, 572, 574, 576, 578, 580, 582, 584, 586, 588, 590, 592, 594, 596, 598, 600, 602, 604, 606, 608, 610, 612, 614, 616, 618, 620, 622, 624, 626, 628, 630, 632, 634, 636, 638, 640, 642, 644, 646, 648, 650, 652, 654, 656, 658, 660, 662, 664, 666, 668, 670, 672, 674, 676, 678, 680, 682, 684, 686, 688, 690, 692, 694, 696, 698, 700, 702, 704, 706, 708, 710, 712, 714, 716, 718, 720, 722, 724, 726, 728, 730, 732, 734, 736, 738, 740, 742, 744, 746, 748, 750, 752, 754, 756, 758, 760, 762, 764, 766, 768, 770, 772, 774, 776, 778, 780, 782, 784, 786, 788, 790, 792, 794, 796, 798, 800, 802, 804, 806, 808, 810, 812, 814, 816, 818, 820, 822, 824, 826, 828, 830, 832, 834, 836, 838, 840, 842, 844, 846, 848, 850, 852, 854, 856, 858, 860, 862, 864, 866, 868, 870, 872, 874, 876, 878, 880, 882, 884, 886, 888, 890, 892, 894, 896, 898, 900, 902, 904, 906, 908, 910, 912, 914, 916, 918, 920, 922, 924, 926, 928, 930, 932, 934, 936, 938, 940, 942, 944, 946, 948, 950, 952, 954, 956, 958, 960, 962, 964, 966, 968, 970, 972, 974, 976, 978, 980, 982, 984, 986, 988, 990, 992, 994, 996, 998, 1000, 1002, 1004, 1006, 1008, 1010, 1012, 1014, 1016, 1018, 1020, 1022, 1024, 1026, 1028, 1030, 1032, 1034, 1036, 1038, 1040, 1042, 1044, 1046, 1048, 1050, 1052, 1054, 1056, 1058, 1060, 1062, 1064, 1066, 1068, 1070, 1072, 1074, 1076, 1078, 1080, 1082, 1084, 1086, 1088, 1090, 1092, 1094, 1096, 1098, 1100, 1102, 1104, 1106, 1108, 1110, 1112, 1114, 1116, 1118, 1120, 1122, 1124, 1126, 1128, 1130, 1132, 1134, 1136, 1138, 1140, 1142, 1144, 1146, 1148, 1150, 1152, 1154, 1156, 1158, 1160, 1162, 1164, 1166, 1168, 1170, 1172, 1174, 1176, 1178, 1180, 1182, 1184, 1186, 1188, 1190, 1192, 1194, 1196, 1198, 1200, 1202, 1204, 1206, 1208, 1210, 1212, 1214, 1216, 1218, 1220, 1222, 1224, 1226, 1228, 1230, 1232, 1234, 1236, 1238, 1240, 1242, 1244, 1246, 1248, 1250, 1252, 1254, 1256, 1258, 1260, 1262, 1264, 1266, 1268, 1270, 1272, 1274, 1276, 1278, 1280, 1282, 1284, 1286, 1288, 1290, 1292, 1294, 1296, 1298, 1300, 1302, 1304, 1306, 1308, 1310, 1312, 1314, 1316, 1318, 1320, 1322, 1324, 1326, 1328, 1330, 1332, 1334, 1336, 1338, 1340, 1342, 1344, 1346, 1348, 1350, 1352, 1354, 1356, 1358, 1360, 1362, 1364, 1366, 1368, 1370, 1372, 1374, 1376, 1378, 1380, 1382, 1384, 1386, 1388, 1390, 1392, 1394, 1396, 1398, 1400, 1402, 1404, 1406, 1408, 1410, 1412, 1414, 1416, 1418, 1420, 1422, 1424, 1426, 1428, 1430, 1432, 1434, 1436, 1438, 1440, 1442, 1444, 1446, 1448, 1450, 1452, 1454, 1456, 1458, 1460, 1462, 1464, 1466, 1468, 1470, 1472, 1474, 1476, 1478, 1480, 1482, 1484, 1486, 1488, 1490, 1492, 1494, 1496, 1498, 1500, 1502, 1504, 1506, 1508, 1510, 1512, 1514, 1516, 1518, 1520, 1522, 1524, 1526, 1528, 1530, 1532, 1534, 1536, 1538, 1540, 1542, 1544, 1546, 1548, 1550, 1552, 1554, 1556, 1558, 1560, 1562, 1564, 1566, 1568, 1570, 1572, 1574, 1576, 1578, 1580, 1582, 1584, 1586, 1588, 1590, 1592, 1594, 1596, 1598, 1600, 1602, 1604, 1



COCKLES: 1 lot
TROT-ROCKETS: 1 lot
OAT-ROCKETS: 1 lot
ANOTHER OAT-ROCKETS: 1 lot
CHICKEN-ROCKETS: 1 lot

СПИРТОВАЯ
САЛФЕТКА ДЛЯ
ИНЪЕКЦИЙ
60x100 mm

Для проведения диагностики in vitro



Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для
качественного определения сердечного тропонина I
в образцах сыворотки (плазмы) или цельной крови
человека

Бино Трейсер Тропонин I

Комплект №3

Состав:

- тест-кассета: 1 шт
- одноразовая пипетка для образца: 1 шт
- ланцет-скарификатор: 1 шт
- стерильная салфетка: 1 шт
- инструкция по применению: 1 шт

Импортер: ООО «Био Фокус»
РФ, 109387 Москва, Тихая, 25, оф. 216.
Тел./Факс: 8 (916) 900 65 84
www.biofocus.ru



Серия номер: 05
Дата выпуска: 01.2019
Годен до: 01.2021

ТУ 21.20.23-004-15580960-2019

РУ №

Для проведения диагностики in vitro



Набор реагентов





**Тест-система иммунохроматографическая для
качественного определения сердечного тропонина I
в образцах сыворотки (плазмы) или цельной крови
человека**

Био Трейсер Тропонин I

Комплект №3

Состав:

- тест-кассета: 1 шт
- одноразовая пипетка для образца: 1 шт
- ланцет-скарификатор: 1 шт
- спиртовая салфетка: 1 шт
- инструкция по применению: 1 шт

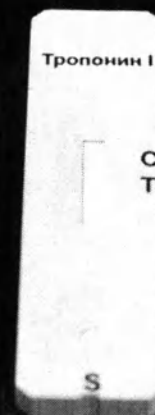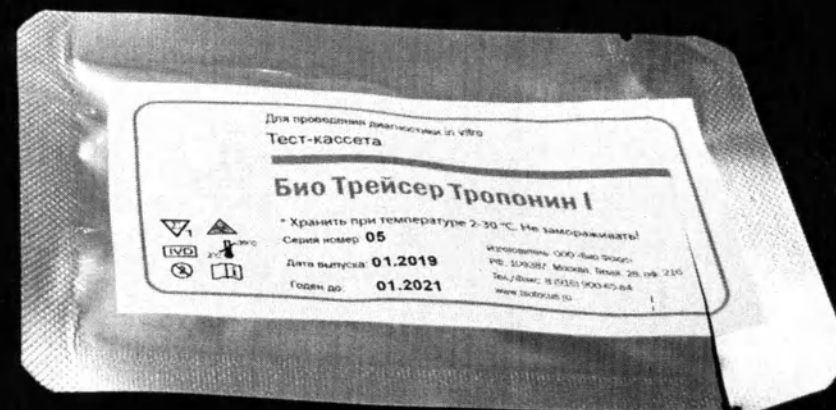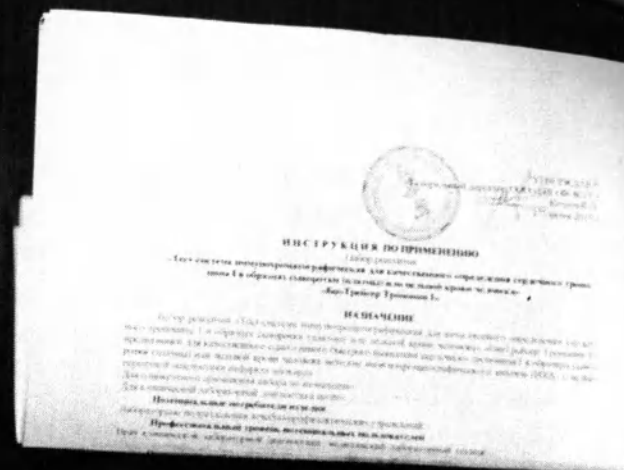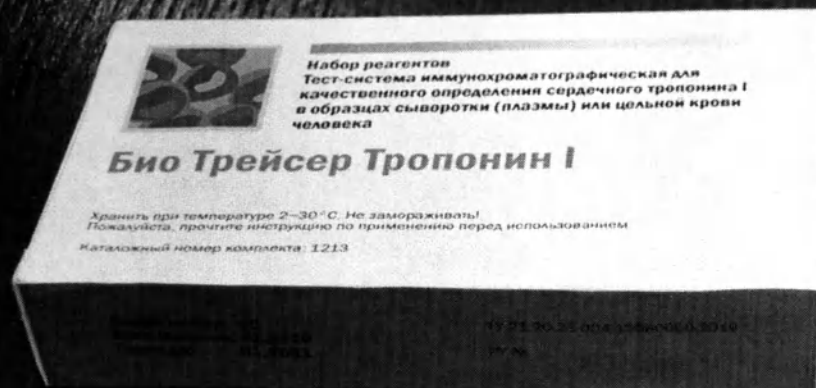

Серия номер: 06
Дата выпуска: 01.2019
Годен до: 01.2021

TU 21.20.23-004-155809-0-2019
PV №

Для проведения диагностики *in vitro*









Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для
качественного определения сердечного тропонина I
в образцах сыворотки (плазмы) или цельной крови
человека

Био Трейсер Тропонин I

Комплект №3

Состав:
- тест-кассета: 1 шт
- одноразовая пипетка для образца: 1 шт
- ланцет-скарификатор: 1 шт
- спиртовая салфетка: 1 шт
- инструкция по применению: 1 шт

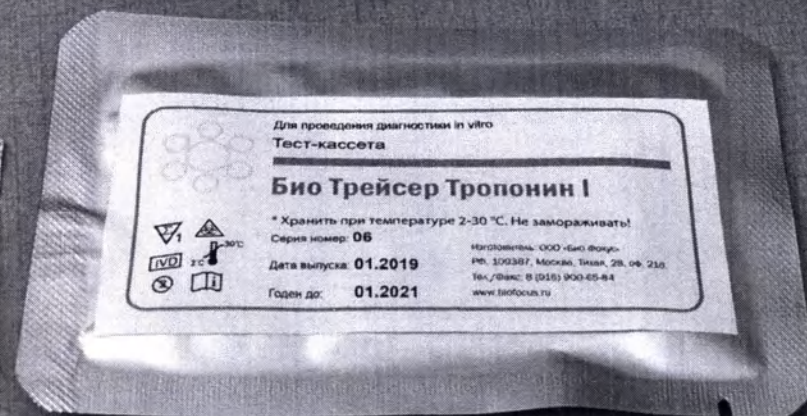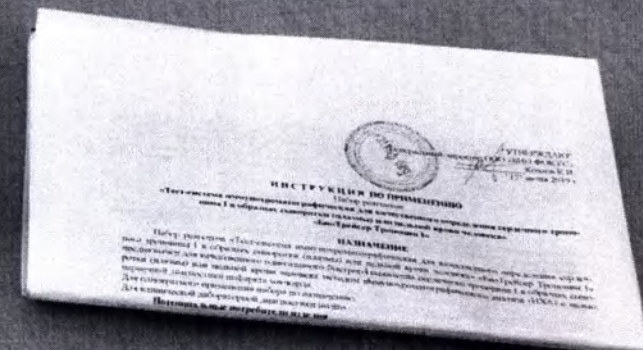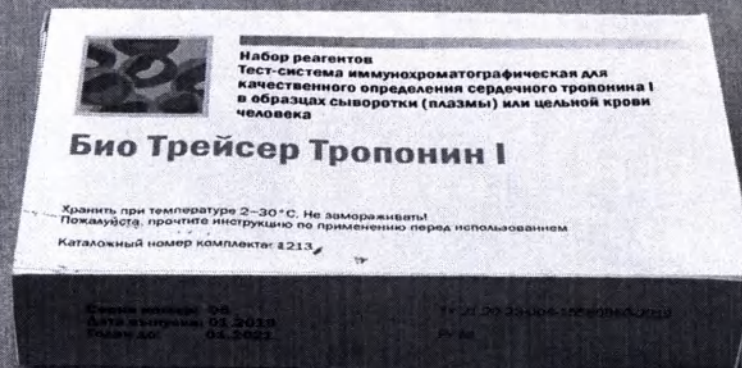

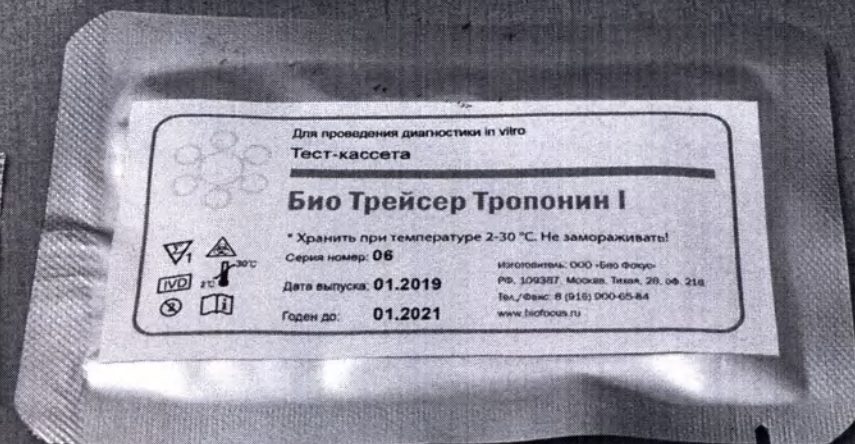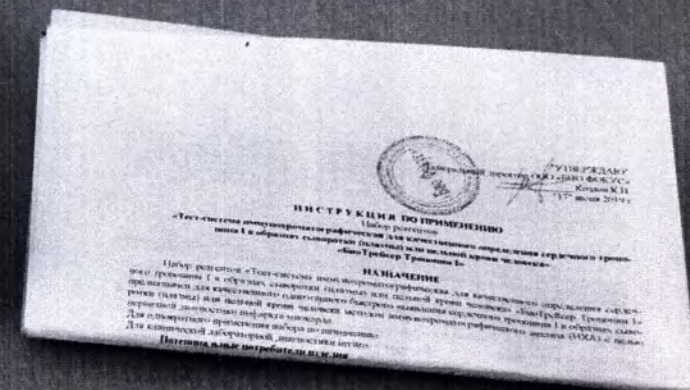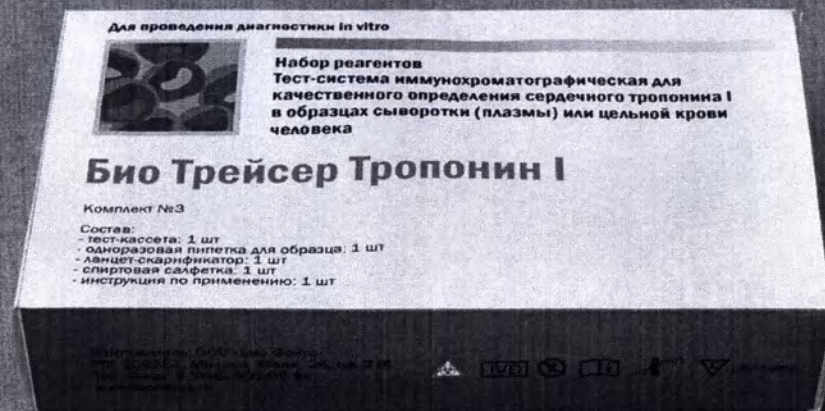

Для проведения диагностики in vitro



Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для
качественного определения сердечного тропонина I
в образцах сыворотки (плазмы) или цельной крови
человека

Био Трейсер Тропонин I

Комплект №3


Состав:

- тест-кассета: 1 шт
- одноразовая пипетка для образца: 1 шт
- ланцет-скарификатор: 1 шт
- спиртовая салфетка: 1 шт
- инструкция по применению: 1 шт

Изготовитель: ООО «Био Фокус»
РФ, 109387, Москва, Тихая, 28, оф. 216.
Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84
www.biofocus.ru



Изготовитель: ООО «Био Фокус»
РФ, 109387, Москва, Тихая, 28, оф. 216
Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84
www.biofocus.ru









Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для
качественного определения сердечного тропонина I
в образцах сыворотки (плазмы) или цельной крови
человека

Био Трейсер Тропонин I

Хранить при температуре 2-30°C. Не замораживать!
Пожалуйста, прочтите инструкцию по применению перед использованием

Каталожный номер комплекта: 1213

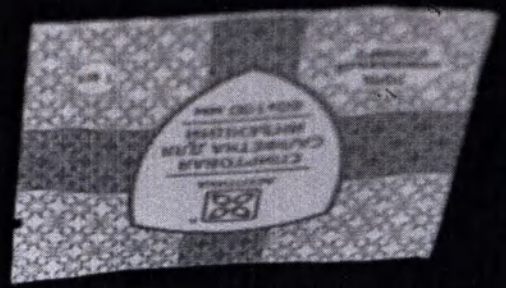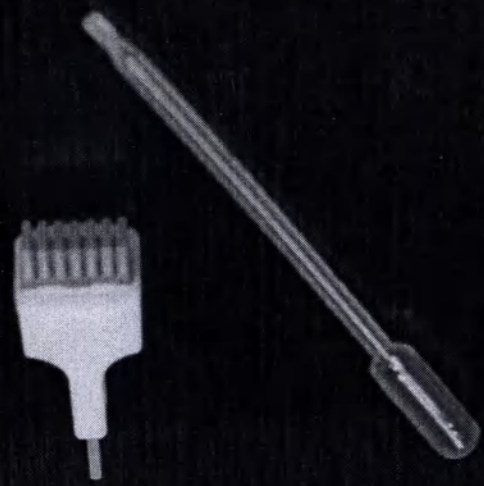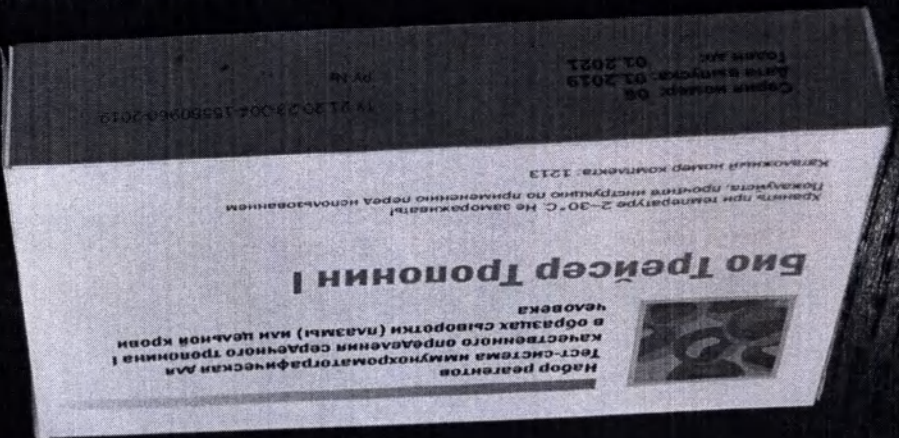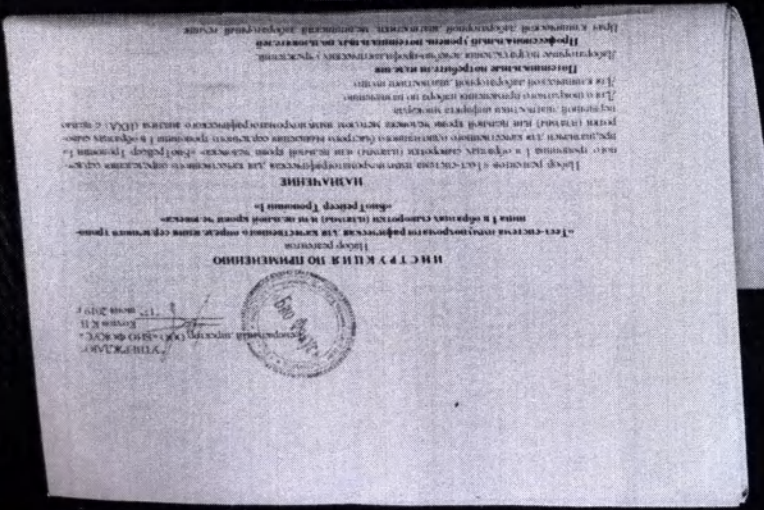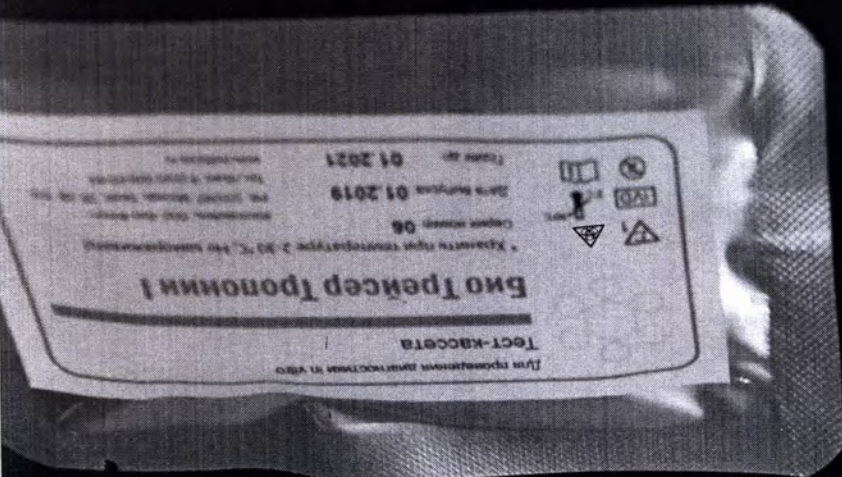

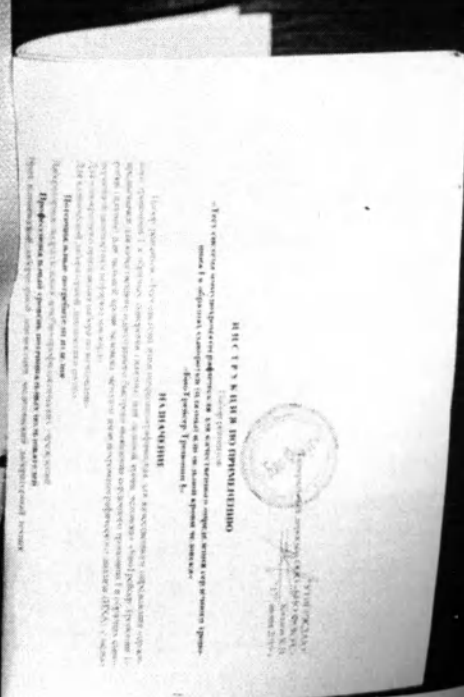

Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для
качественного определения сывороточного тропонина I
в образцах сыворотки (плазмы) натальной крови
человека

Хранить при температуре 2-30 °С. Не замораживать!
 Помечать, проследить и регистрировать по предопределенному номеру, номером партии.
 Каталожный номер компонента: 3213

Срок годности: 01.2019
 Дата выпуска: 01.2021

Для проведения деятельности in vivo
Тест-кассета

Био Трейсер Тропонин I

Хранить при температуре 2-30 °С. Не замораживать!
 Серийный номер: 06

Дата выпуска: 01.2019
 Срок годности: 01.2021

Исполнитель, ООО «Био Трейсер»
 Идентификационный номер: 28 (9) 216
 Контактный телефон: 8 (915) 993-07-64
 Сайт: bio-traser.ru

ИСТУХИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Цель: провести иммунохроматографический тест для качественного определения сывороточного тропонина I в образцах натальной крови человека.

НАЗНАЧЕНИЕ

Используется для проведения иммунохроматографического теста для качественного определения сывороточного тропонина I в образцах натальной крови человека.

Используется для проведения иммунохроматографического теста для качественного определения сывороточного тропонина I в образцах натальной крови человека.

АСЕПТИКА
СПИРТОВАЯ
САЛФЕТКА ДЛЯ
ИНЪЕКЦИЙ
60x100 мм

70%
 Спирт

1 шт.





Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
53 листов
Генеральный директор
«ВНО ФОКУС» Козлов К.В.