

Руководитель группы регистрации
ООО «Сименс Здравоохранение»

« 14 » апреля 2020 г.
Горшкова Н.А.



Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики in vitro

Набор реагентов для определения мочевой кислоты на анализаторах биохимических
серии Atellica (Atellica CH Uric Acid (Atellica CH UA))



Рисунок 1 Набор реагентов для определения мочевой кислоты на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica CH Uric Acid (Atellica CH UA)) : общий вид изделия

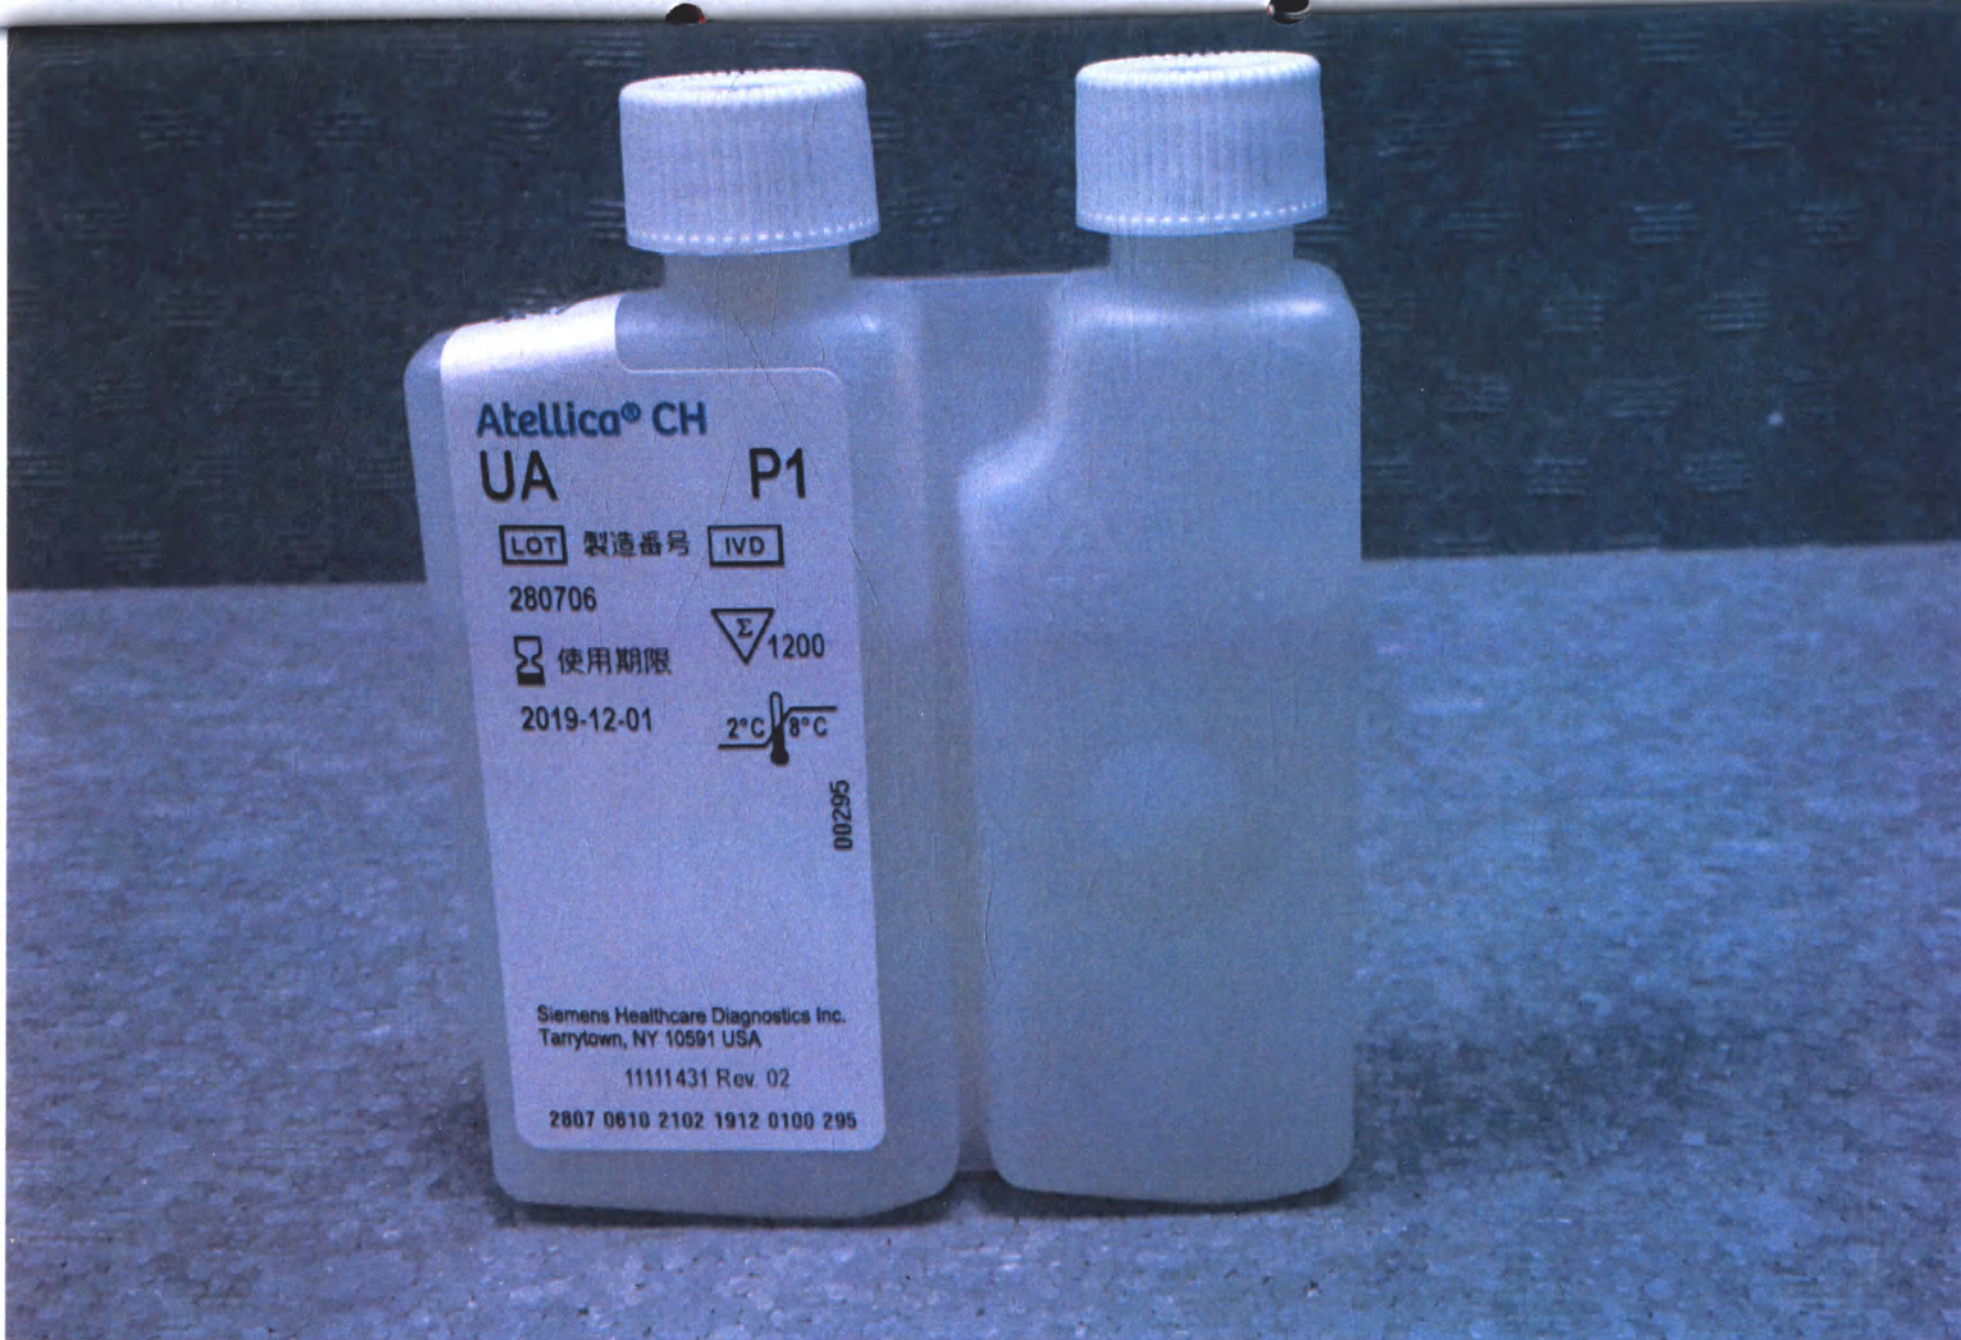


Рисунок 2 Набор реагентов для определения мочевой кислоты на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica CH Uric Acid (Atellica CH UA)) : флаконы с реагентами, общий вид, упаковка 1

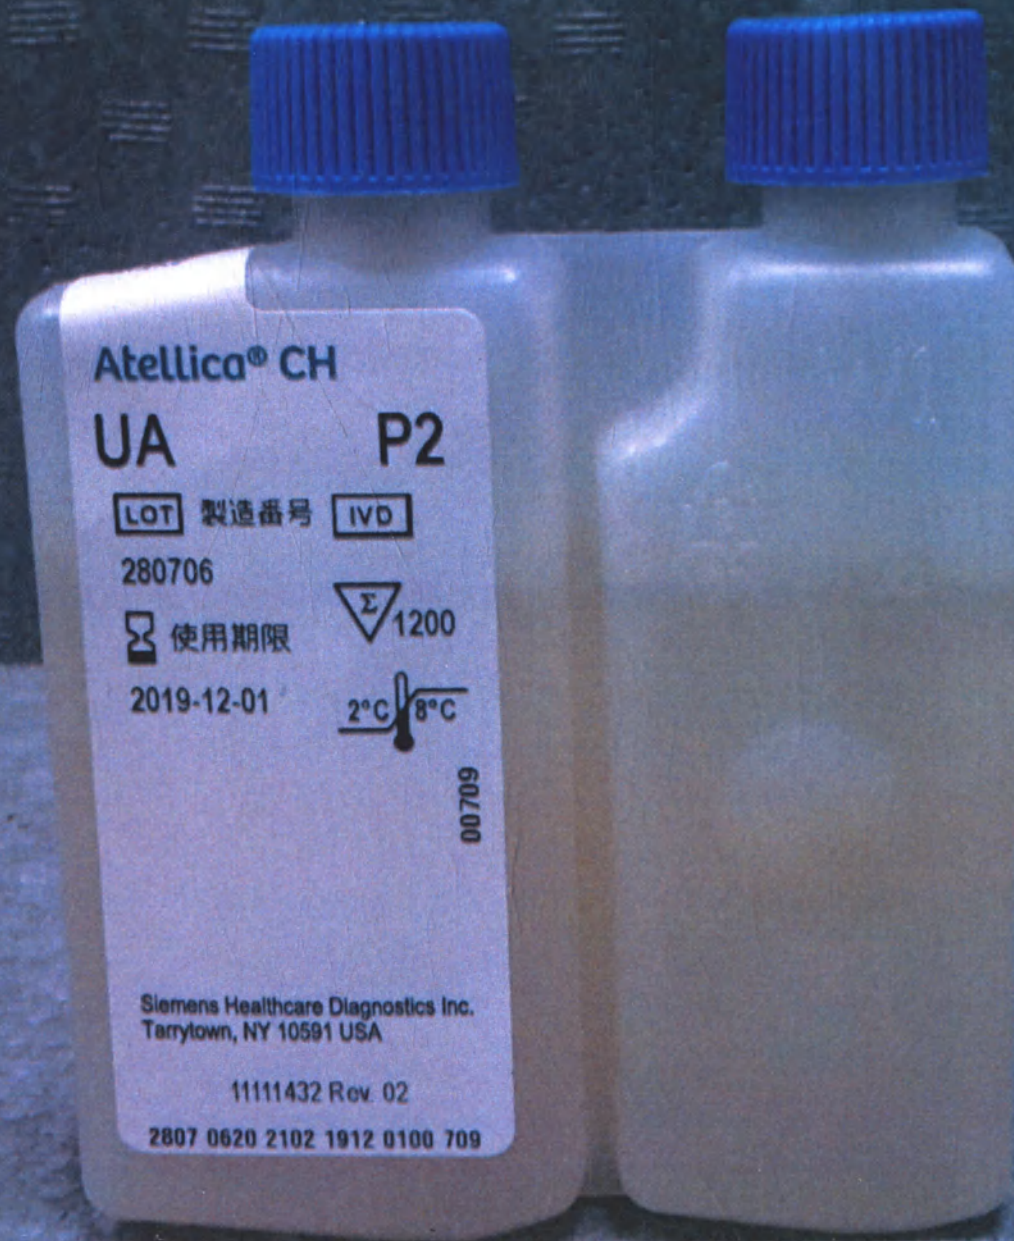


Рисунок 3 Набор реагентов для определения мочевой кислоты на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica CH Uric Acid (Atellica CH UA)) : флаконы с реагентами, общий вид, упаковка 2.

Всего прошито и пронумеровано 4 листа (ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»

