

Руководитель группы регистрации
ООО «Сименс Здравоохранение»



Пичугова Н.А.

2021 г.

Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики in vitro

Набор реагентов для определения прямого билирубина на анализаторах
биохимических серии Atellica (Atellica CH Direct Bilirubin 2 (Atellica CH DBil_2))

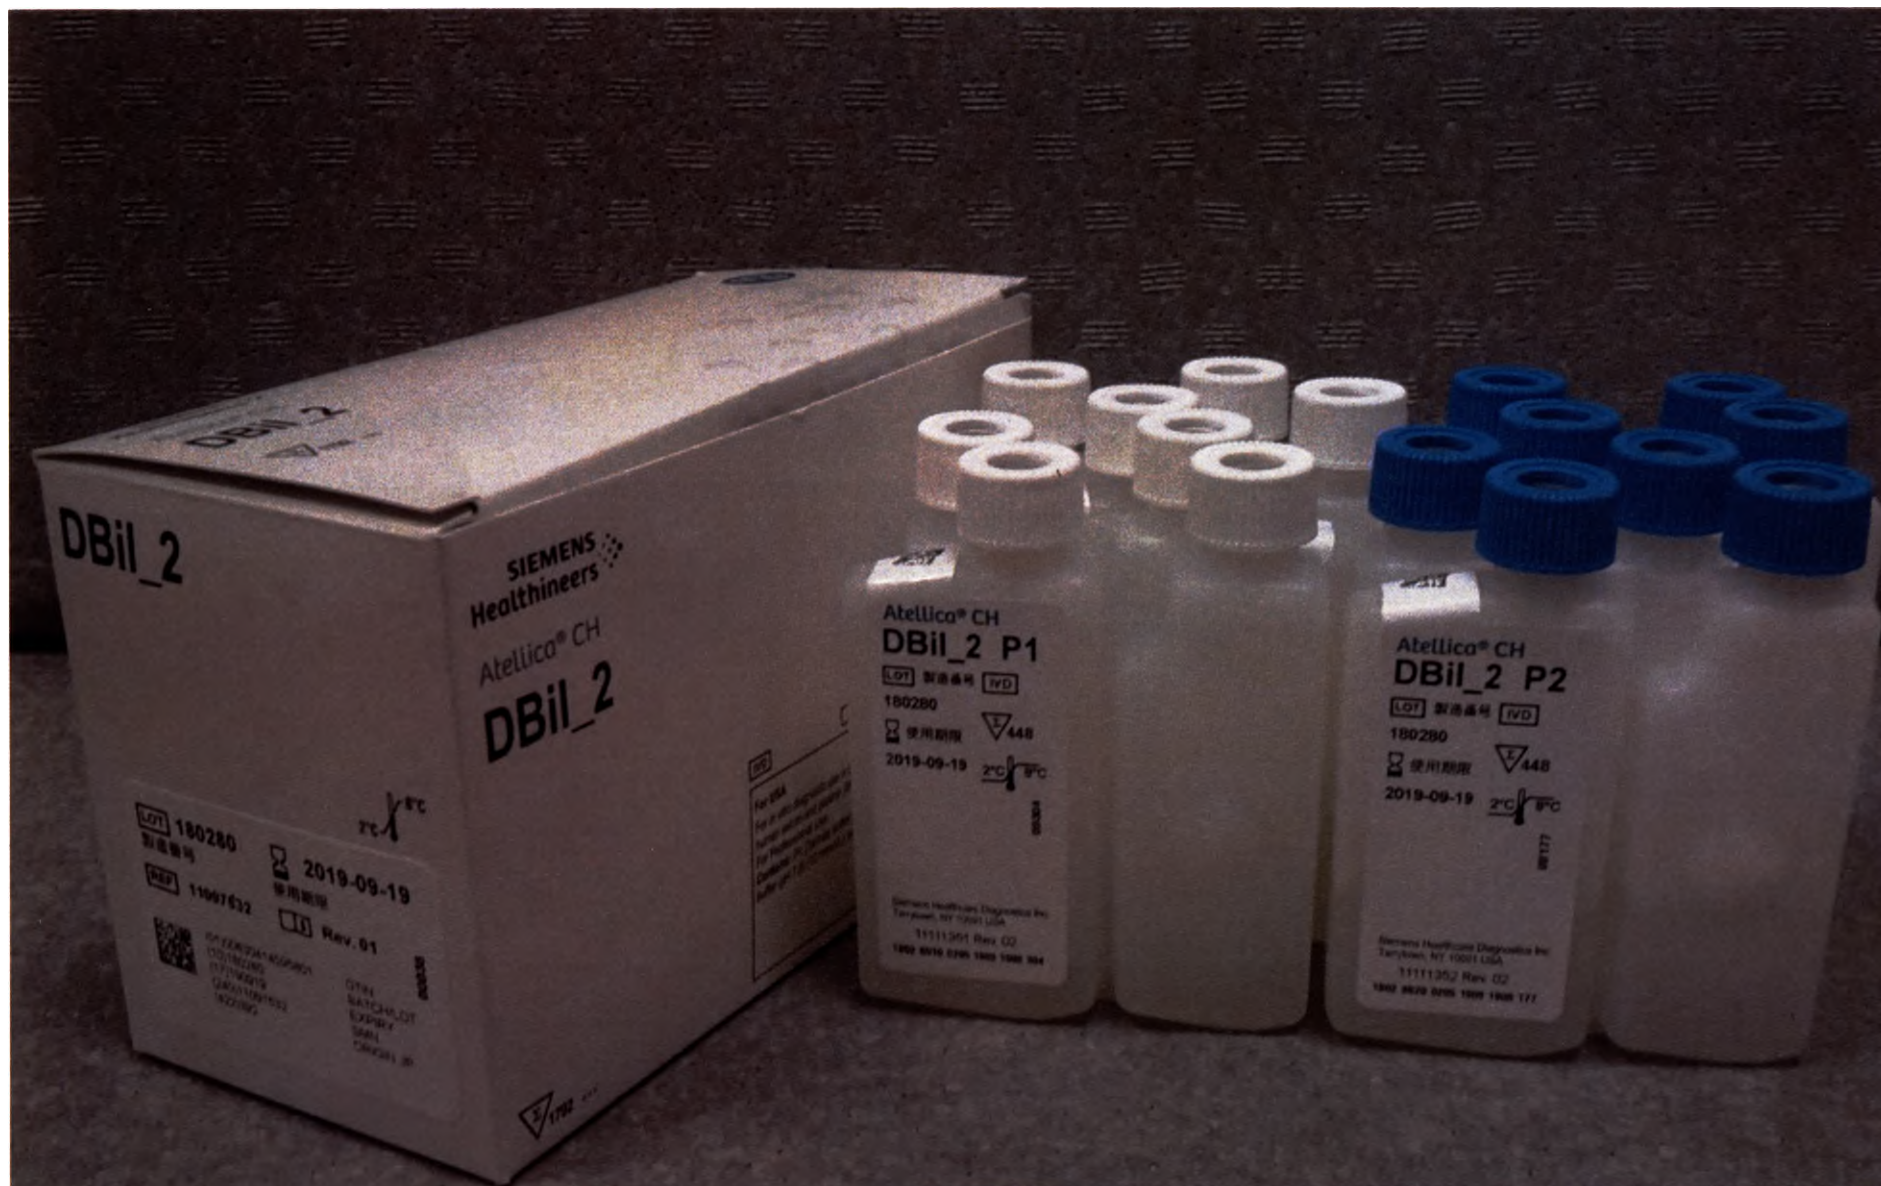


Рисунок 1. Набор реагентов для определения прямого билирубина на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica CH Direct Bilirubin 2 (Atellica CH DBil_2)); общий вид изделия

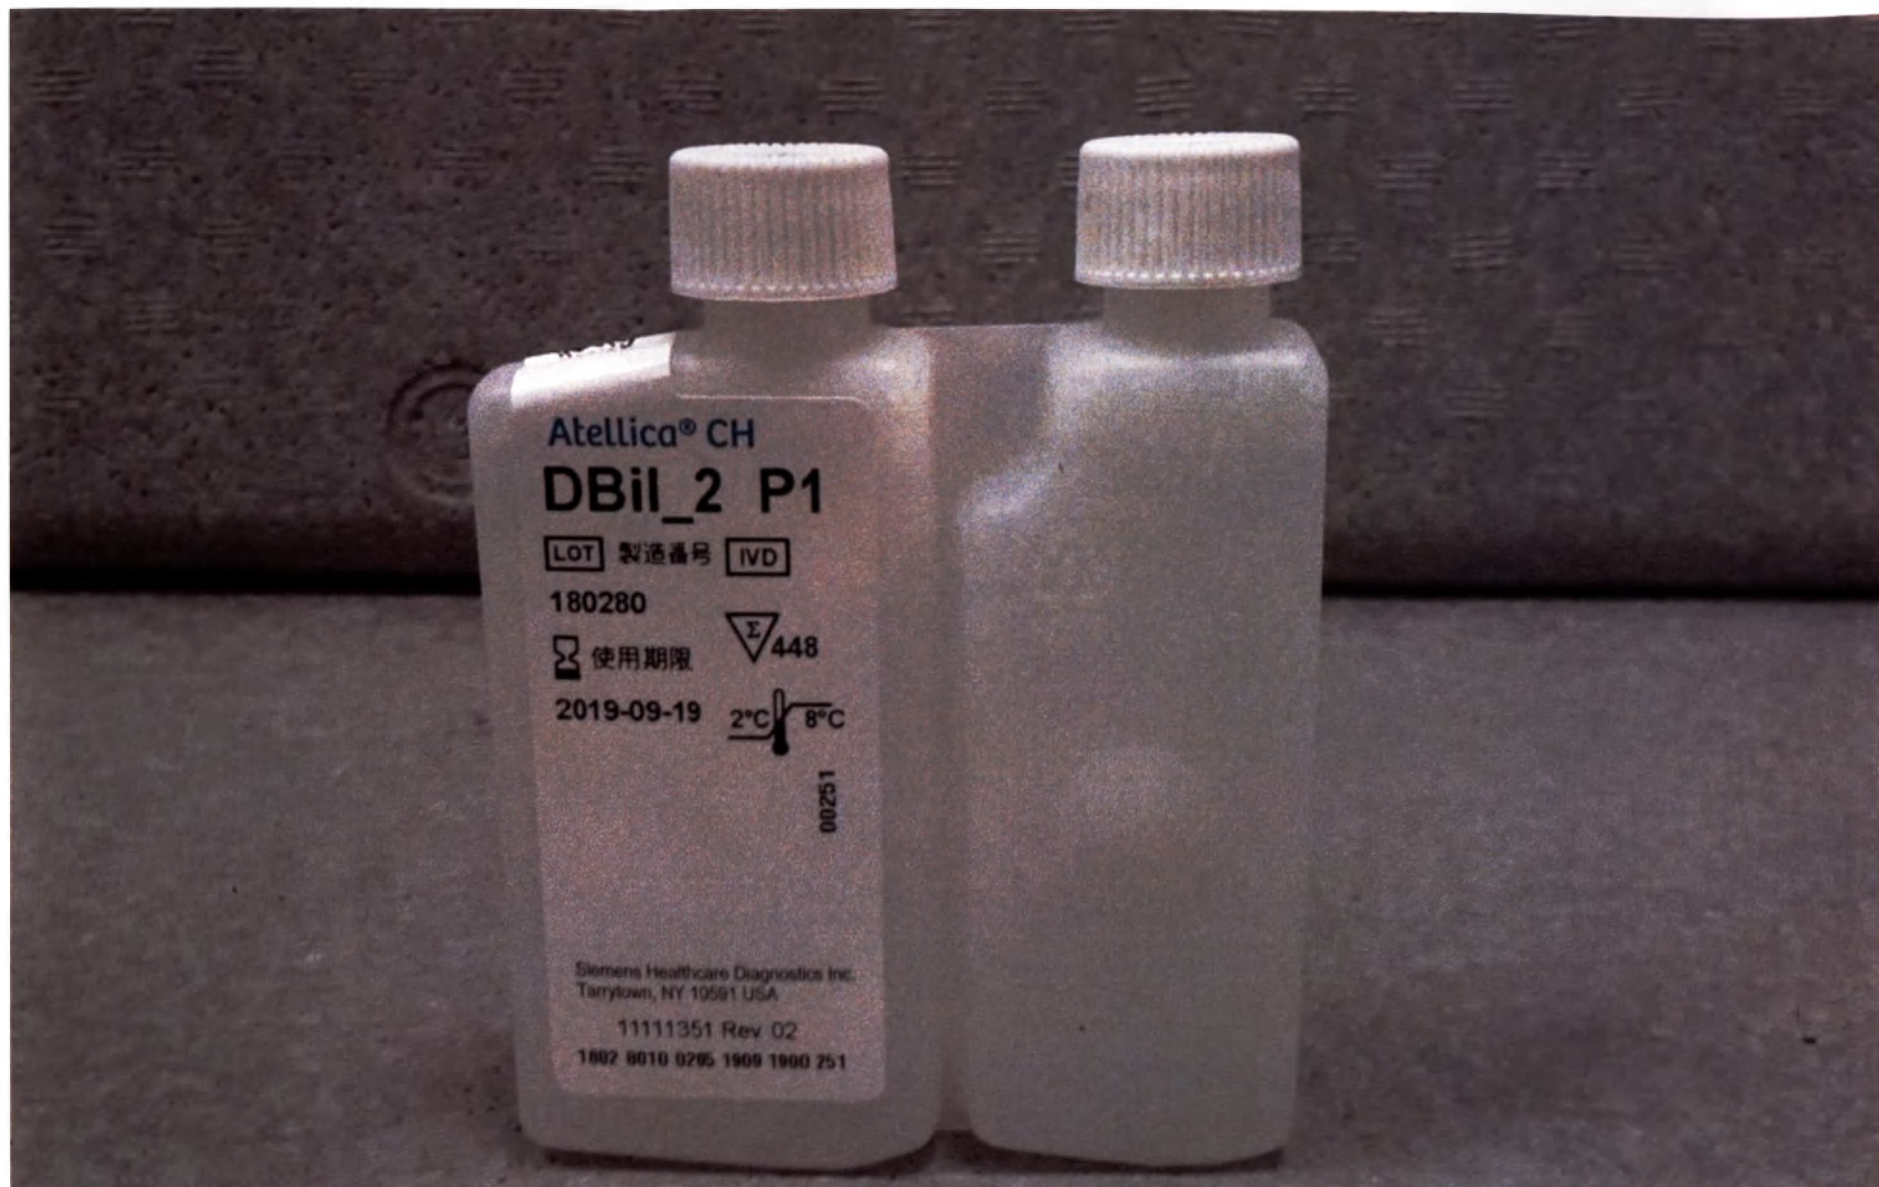


Рисунок 2. Набор реагентов для определения прямого билирубина на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica CH Direct Bilirubin 2 (Atellica CH DBil_2)): флаконы с реагентами, общий вид, упаковка 1

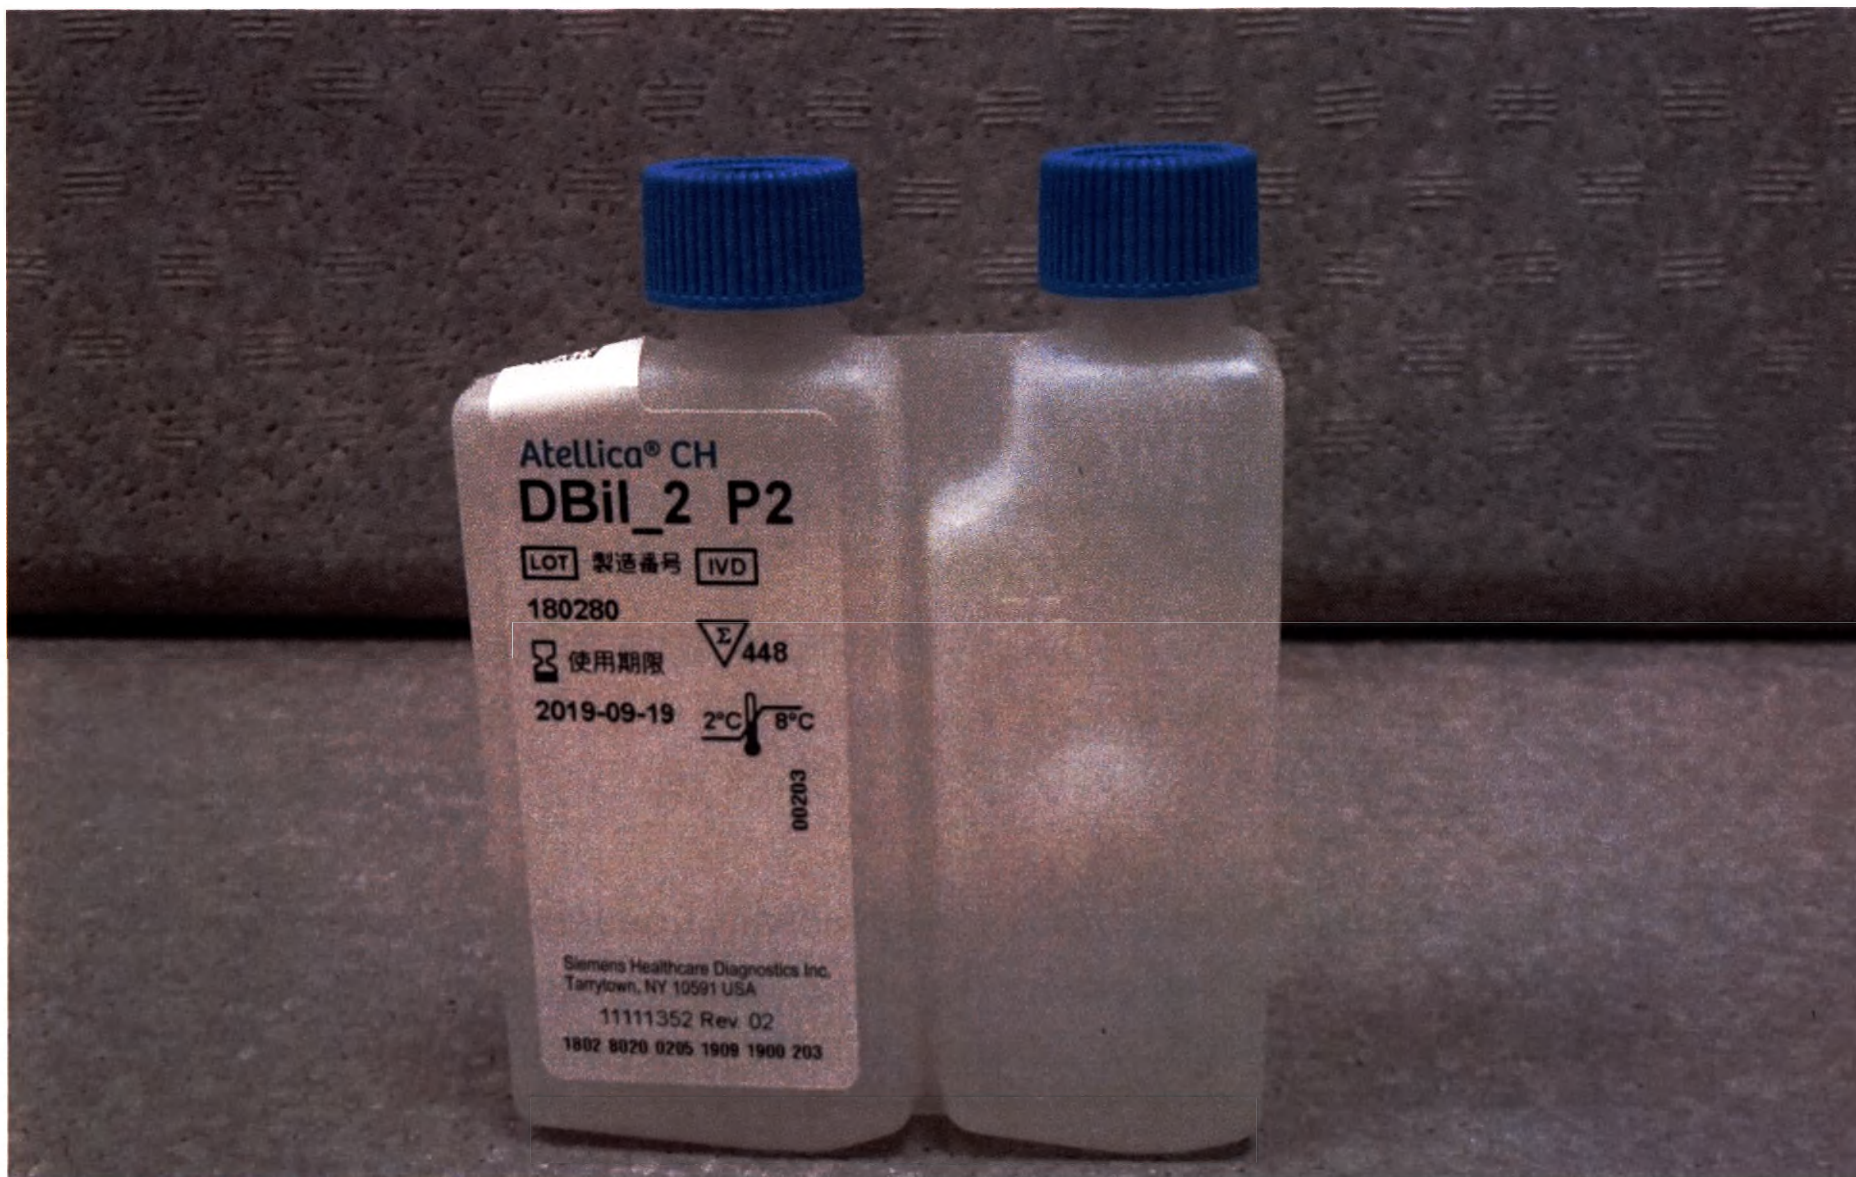


Рисунок 3. Набор реагентов для определения прямого билирубина на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica CH Direct Bilirubin 2 (Atellica CH DBil_2)): флаконы с реагентами, общий вид, упаковка 2.

11097532 Набор реагентов для определения прямого билирубина на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica CH Direct Bilirubin 2 (Atellica CH DBil_2))

Информация о производителе и стране производства: **Регистрационное удостоверение:**
см. на упаковке № РЗН 2020/11083 от _____

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на оригинальной упаковке

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению
Авторизованный представитель производителя на территории Российской Федерации:
ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96

Рисунок 4. Набор реагентов для определения прямого билирубина на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica CH Direct Bilirubin 2 (Atellica CH DBil_2)); макет маркировки для Российской Федерации



Всего прошито и пронумеровано
_____ листа (ов).

ООО «Сиенс Здоровоохранение»