

Индикатор автономный биологический одноразовый для контроля стерилизации парами перекиси водорода (плазменной стерилизации) «БиоТЕСТ-ПЛАЗМА-ВИНАР»



183

Индикатор автономный биологический одноразовый для контроля стерилизации
парами перекиси водорода (плазменной стерилизации) «БиоТЕСТ-ПЛАЗМА-ВИНАР»



Индикатор автономный биологический одноразовый для контроля стерилизации парами перекиси водорода (плазменной стерилизации) «БиоТЕСТ-ПЛАЗМА-ВИНАР»



ВИНАР
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

[VH202]

БиоТЕСТ-ПЛАЗМА-ВИНАР

Индикатор автономный биологический одноразовый для контроля стерилизации парами перекиси водорода (плазменной стерилизации)

Тест-микроорганизм: *Geobacillus stearothermophilus* ВКМ В-718

Число спор на носителе $n \cdot 10^5$ - $n \cdot 10^6$

Количество индикаторов 24 штуки

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «НГР» «ВИНАР»
В.С. Андреев

Индикатор биологический одноразовый для контроля стерилизации
парами перекиси водорода (плазменной стерилизации) «БиоТЕСТ-ПЛАЗМА1-ВИНАР»

Транспортирование индикаторов может производиться любым
видом закрытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки
грузов, действующими на данном виде транспорта.
Утилизация согласно прилагаемой инструкции.




VH2O2

БиоТЕСТ-ПЛАЗМА1-ВИНАР

индикатор биологический одноразовый для контроля стерилизации
парами перекиси водорода (плазменной стерилизации)

Тест-микроорганизм: *Geobacillus stearothermophilus* ВКМ В-718
Число спор на носителе $n \cdot 10^3 - n \cdot 10^4$

Количество индикаторов 6 штук

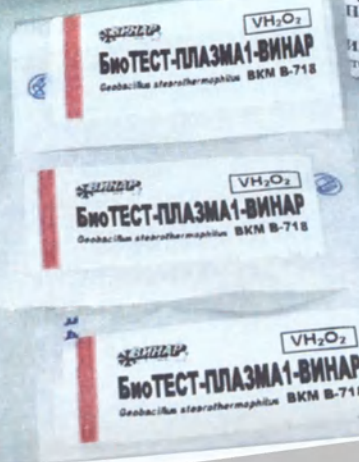


УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «НПФ «ВИНАР»
В.С. Андреев

№ 154.573.13 ИП
ор биологических одноразовых
перекиси водорода (плазменной стерилизации)
ПЛАЗМА1-ВИНАР»


ИМЕНЕНИЮ
стерилизации параами перекиси водорода (плазменной сте-
терилизации параами перекиси водорода (плазменной сте-
терилизации параами перекиси водорода (плазменной сте-

195


Индикатор биологический одноразовый для контроля стерилизации
парами перекиси водорода (плазменной стерилизации) «БиоТЕСТ-ПЛАЗМА2-ВИНАР»

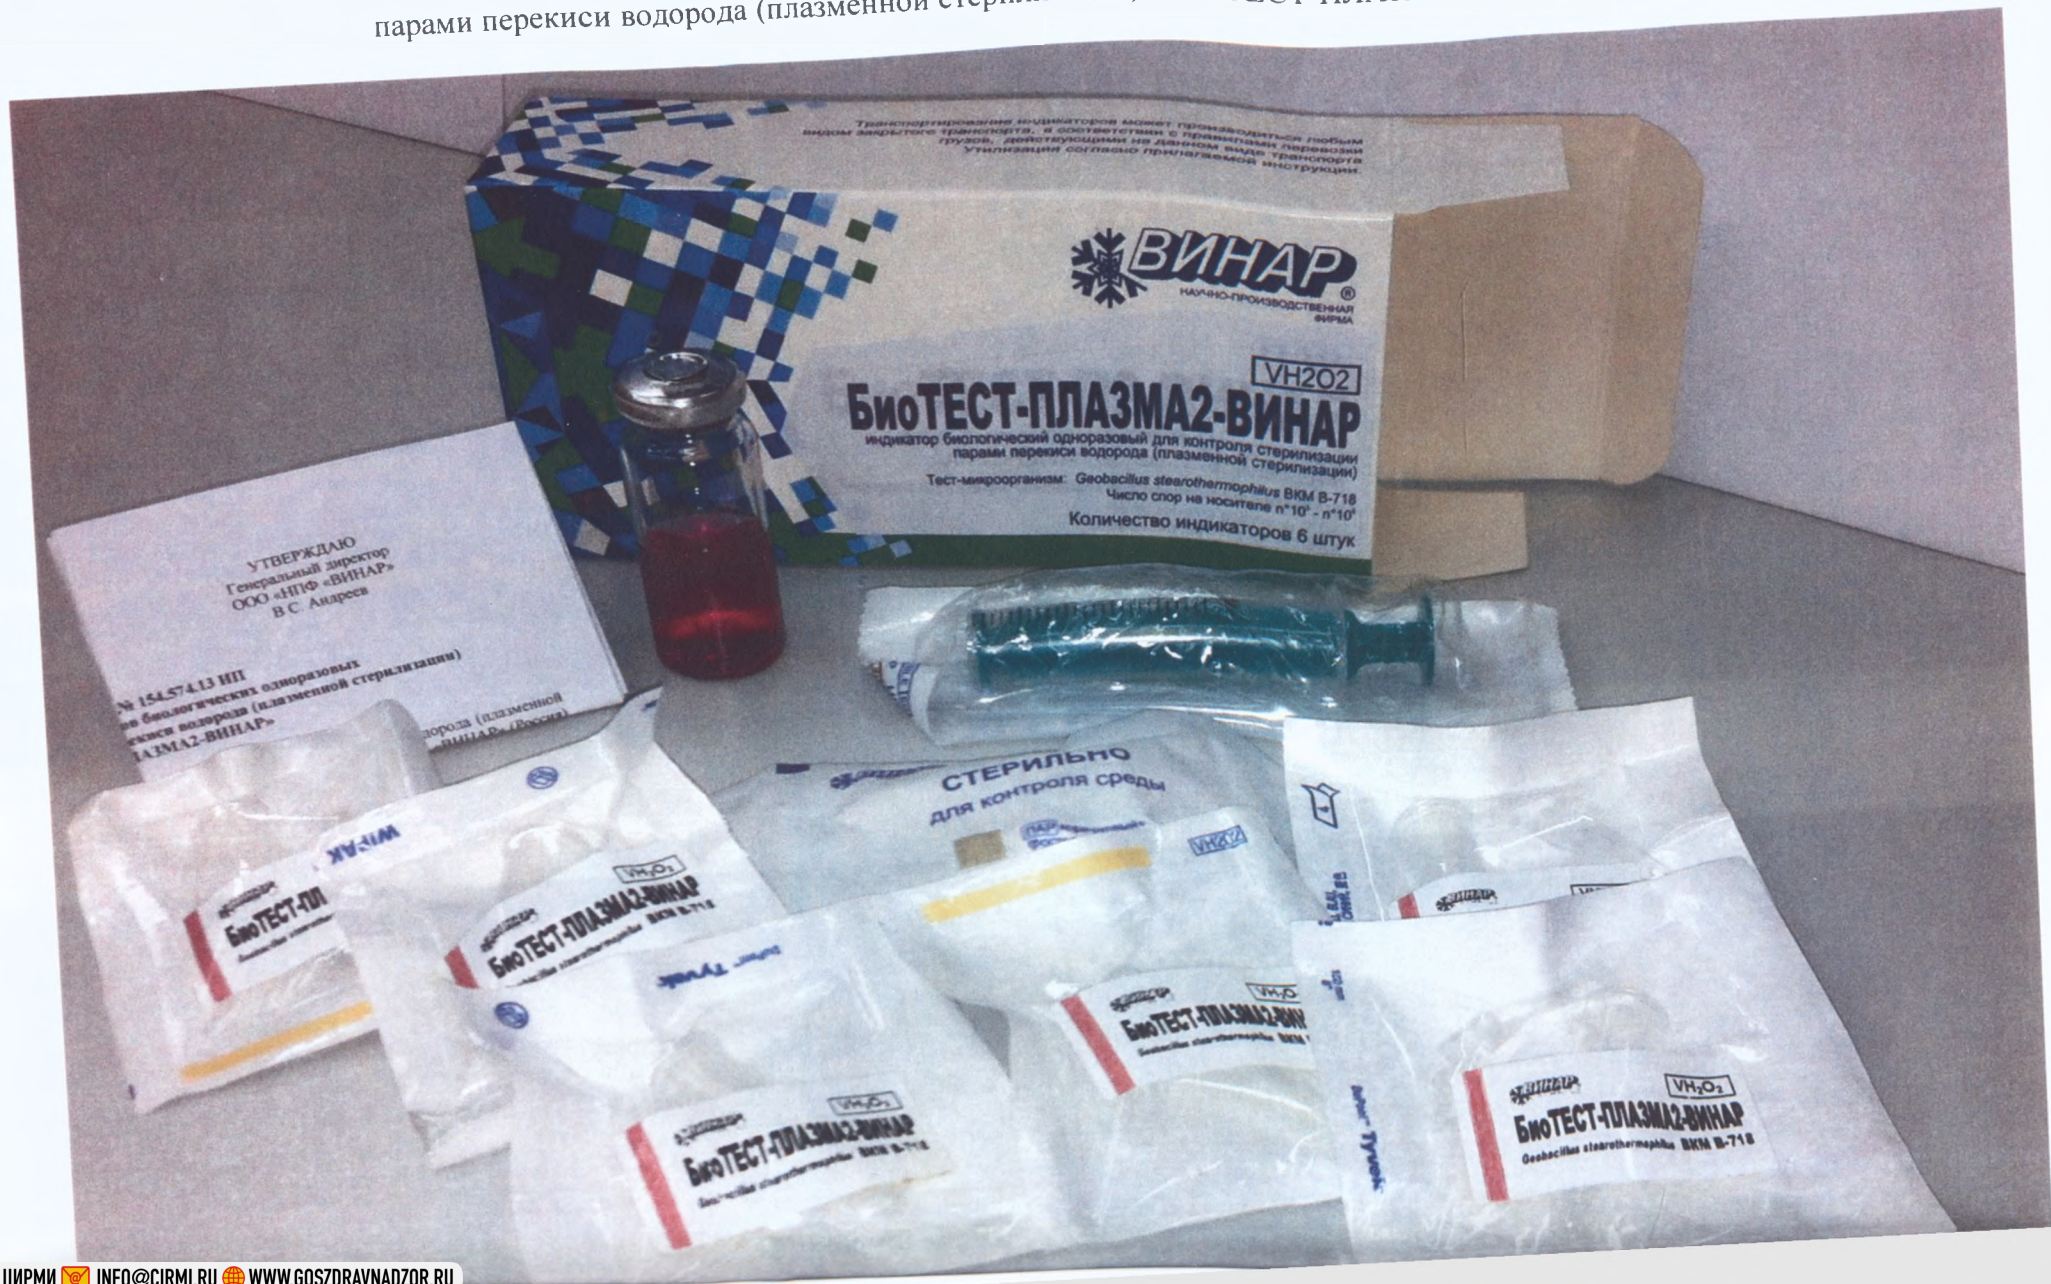


Индикатор биологический одноразовый для контроля стерилизации
парами перекиси водорода (плазменной стерилизации) «БиоТЕСТ-ПЛАЗМА2-ВИНАР»

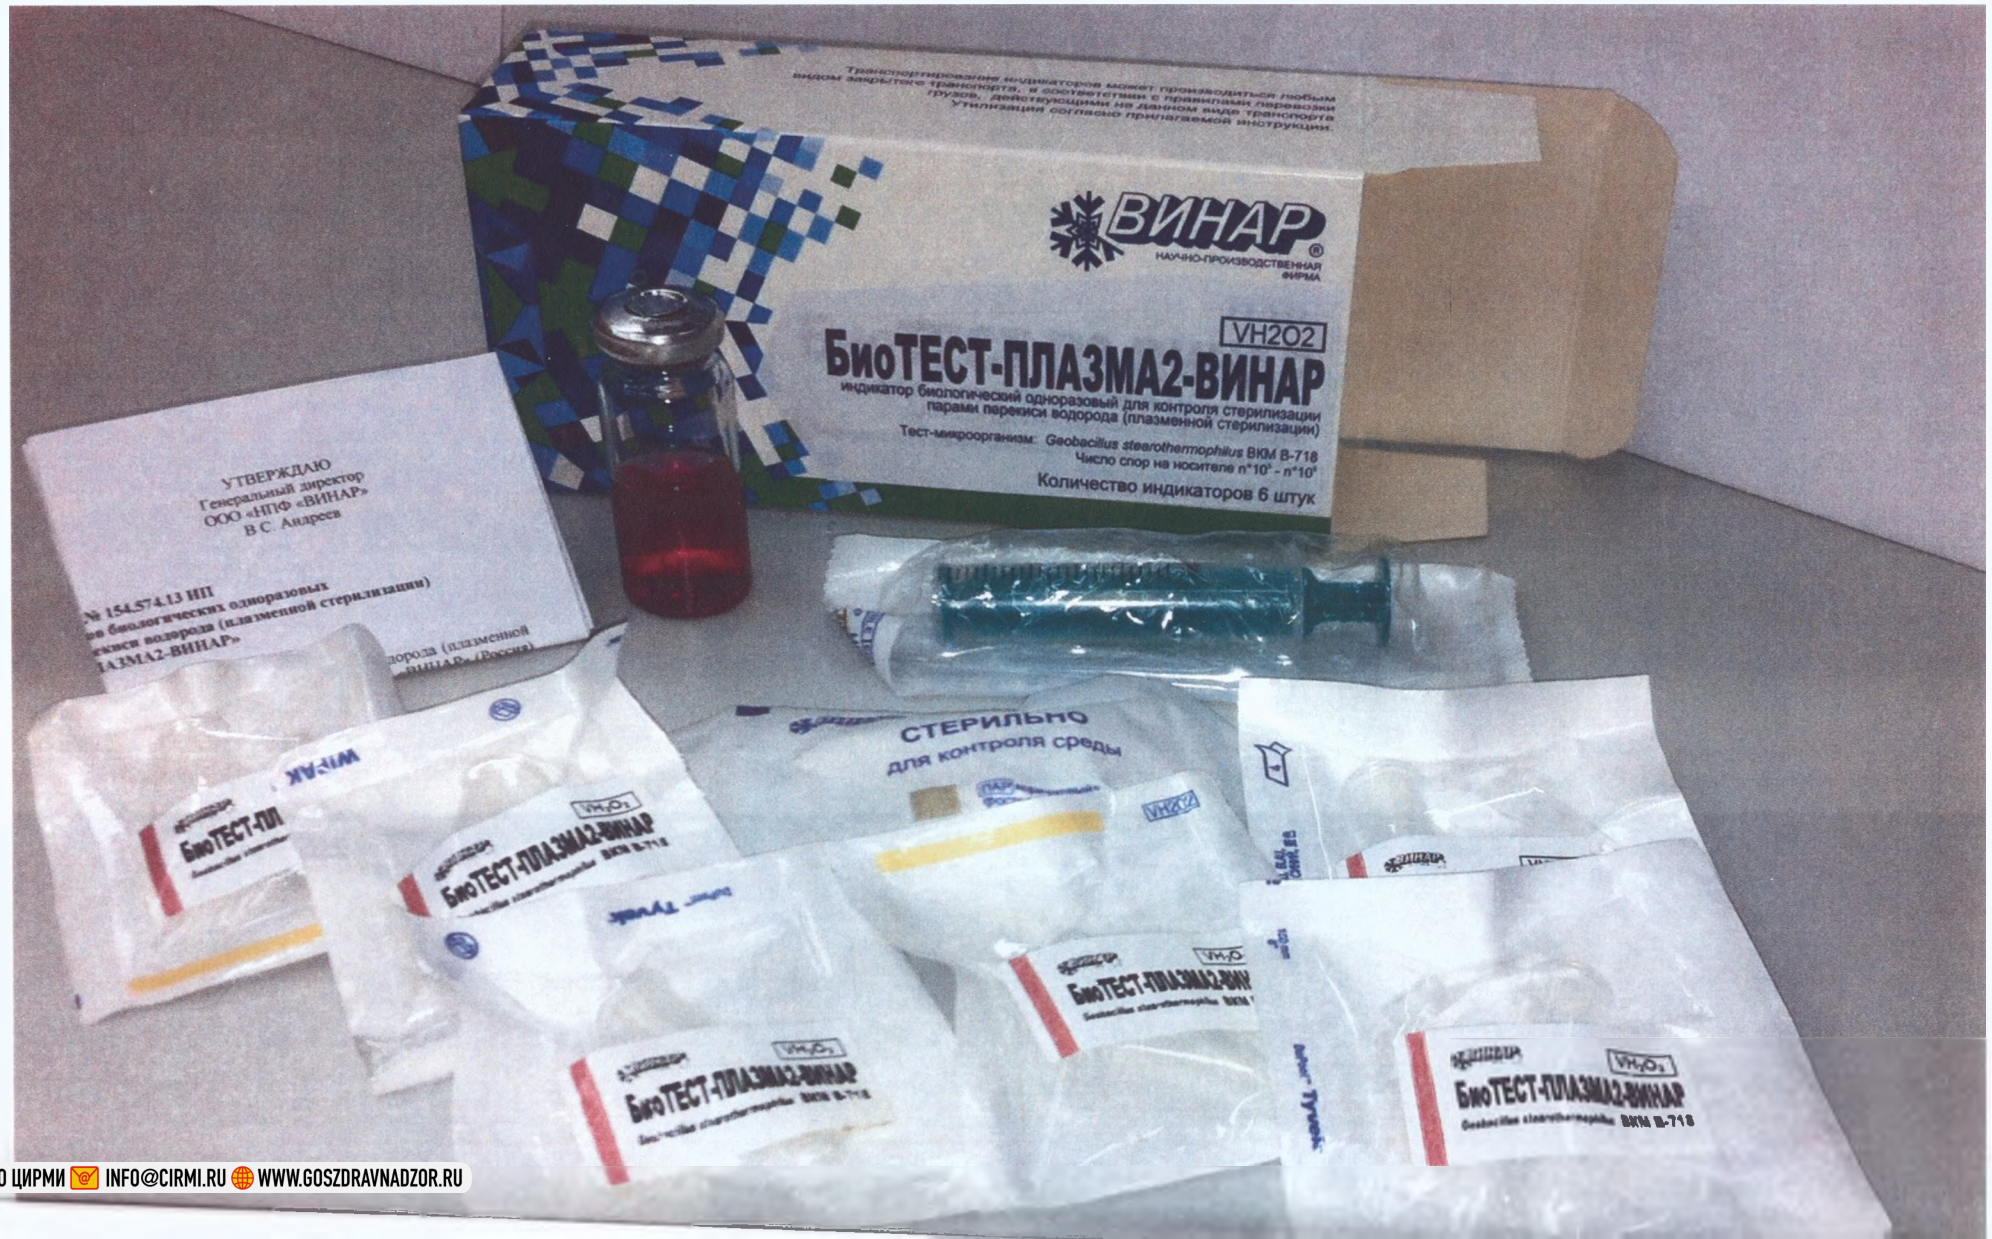


Индикатор биологический одноразовый для контроля стерилизации
парами перекиси водорода (плазменной стерилизации) «БиоТЕСТ-ПЛАЗМА2-ВИНАР»

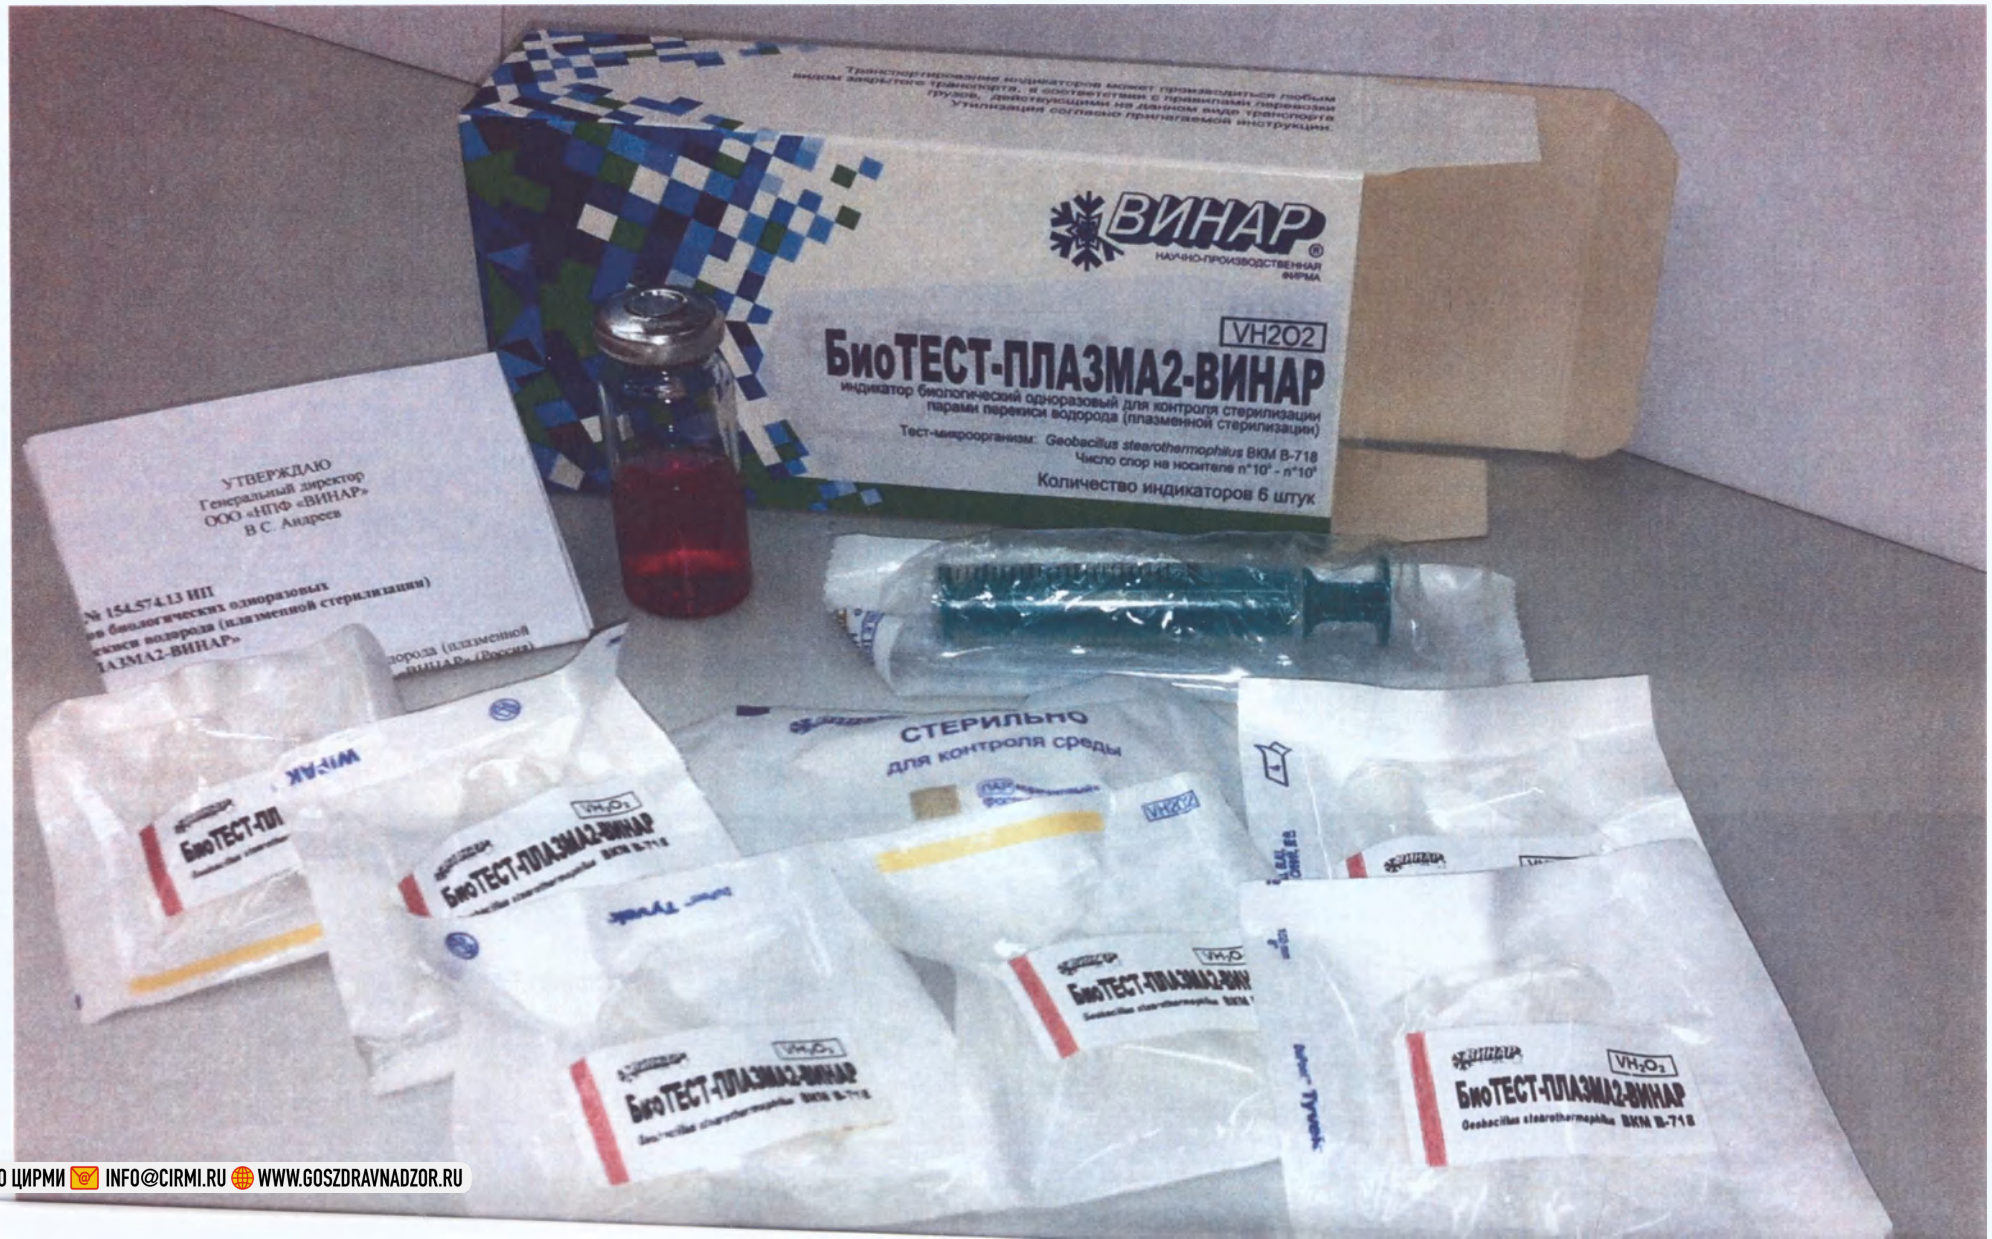


Индикатор биологический одноразовый для контроля стерилизации
парами перекиси водорода (плазменной стерилизации) «БиоТЕСТ-ПЛАЗМА2-ВИНАР»

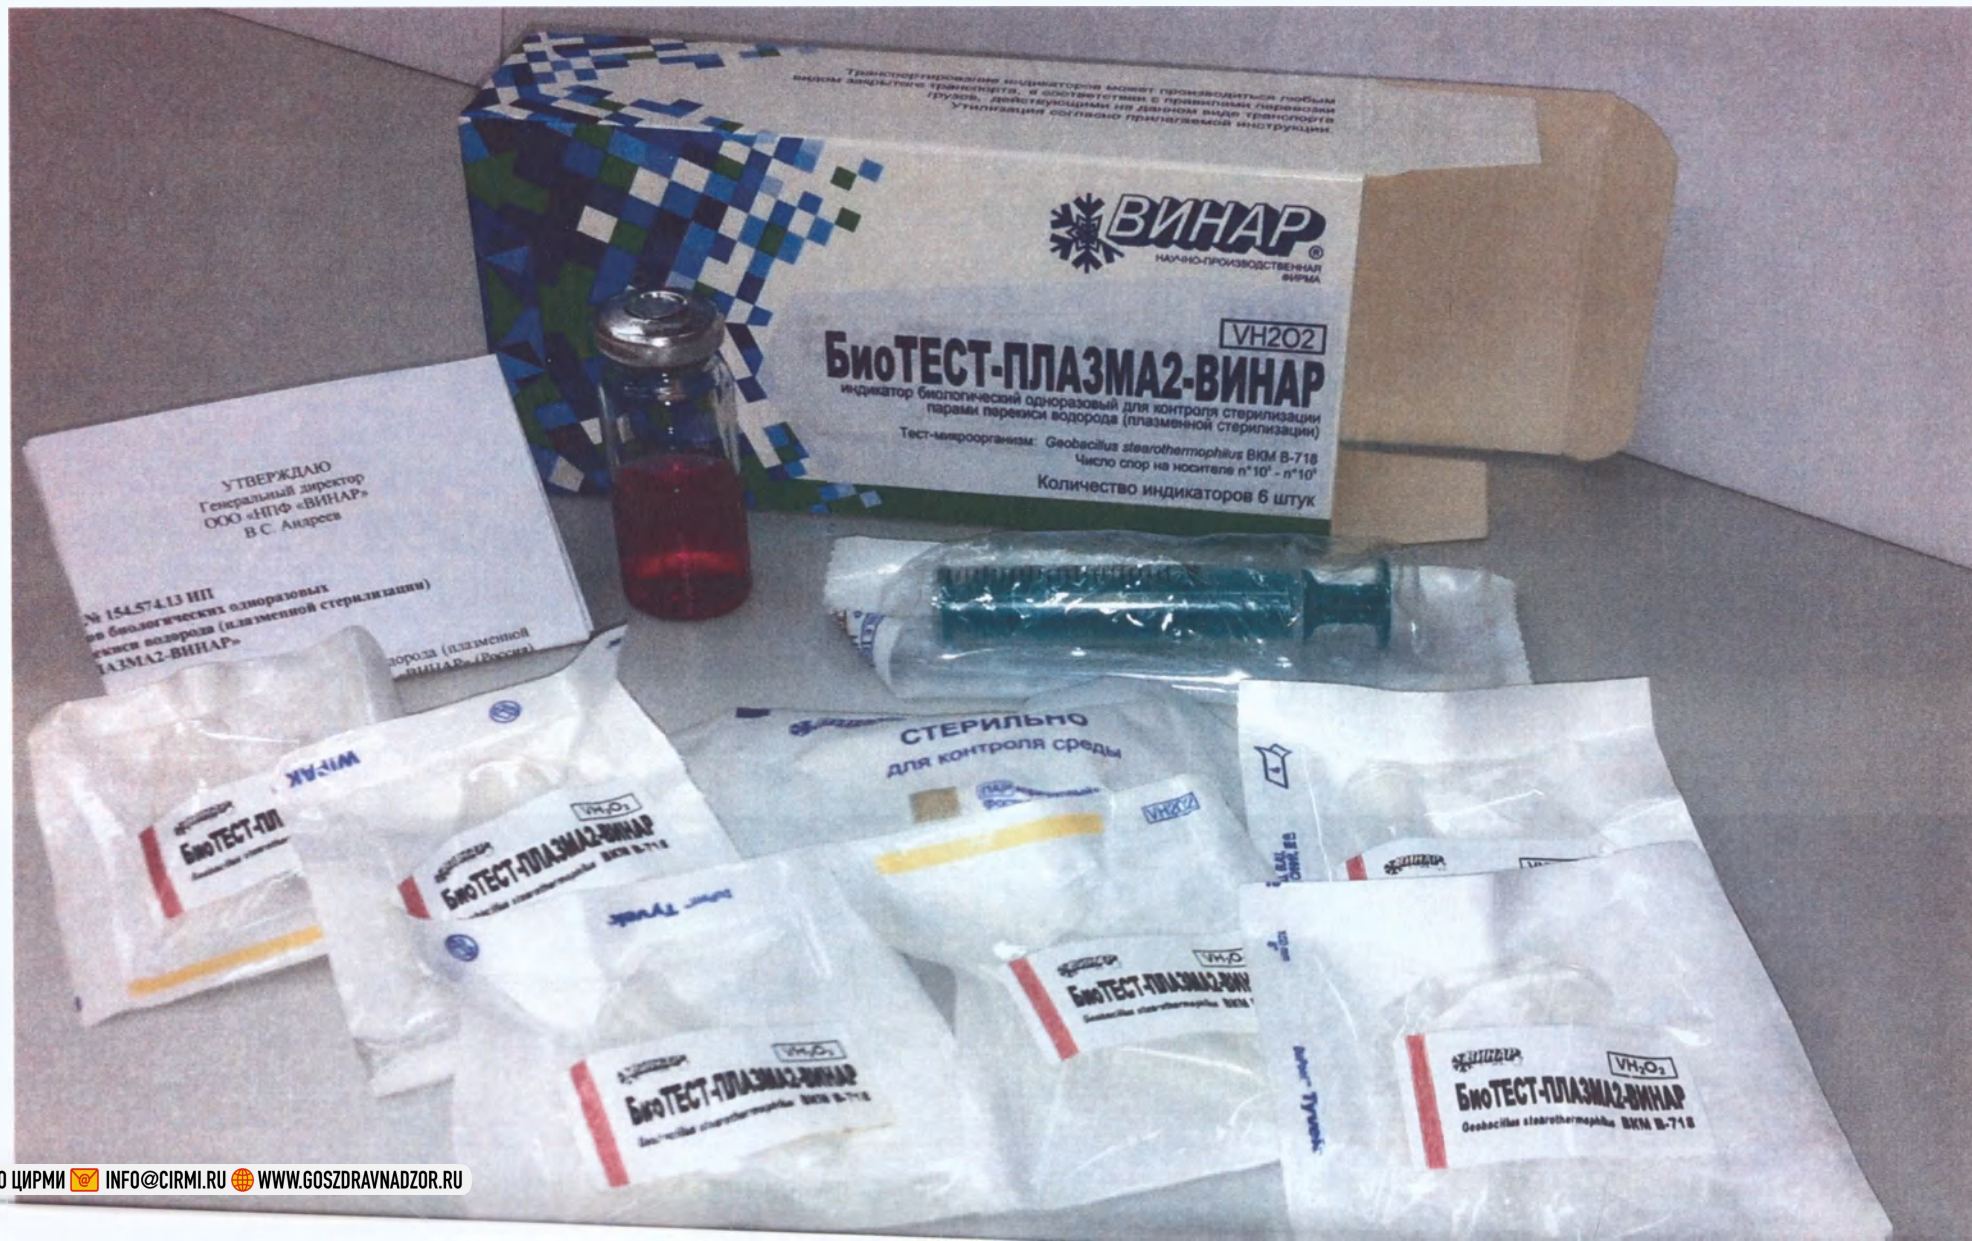


Индикатор биологический одноразовый для контроля стерилизации
парами перекиси водорода (плазменной стерилизации) «БиоТЕСТ-ПЛАЗМА2-ВИНАР»

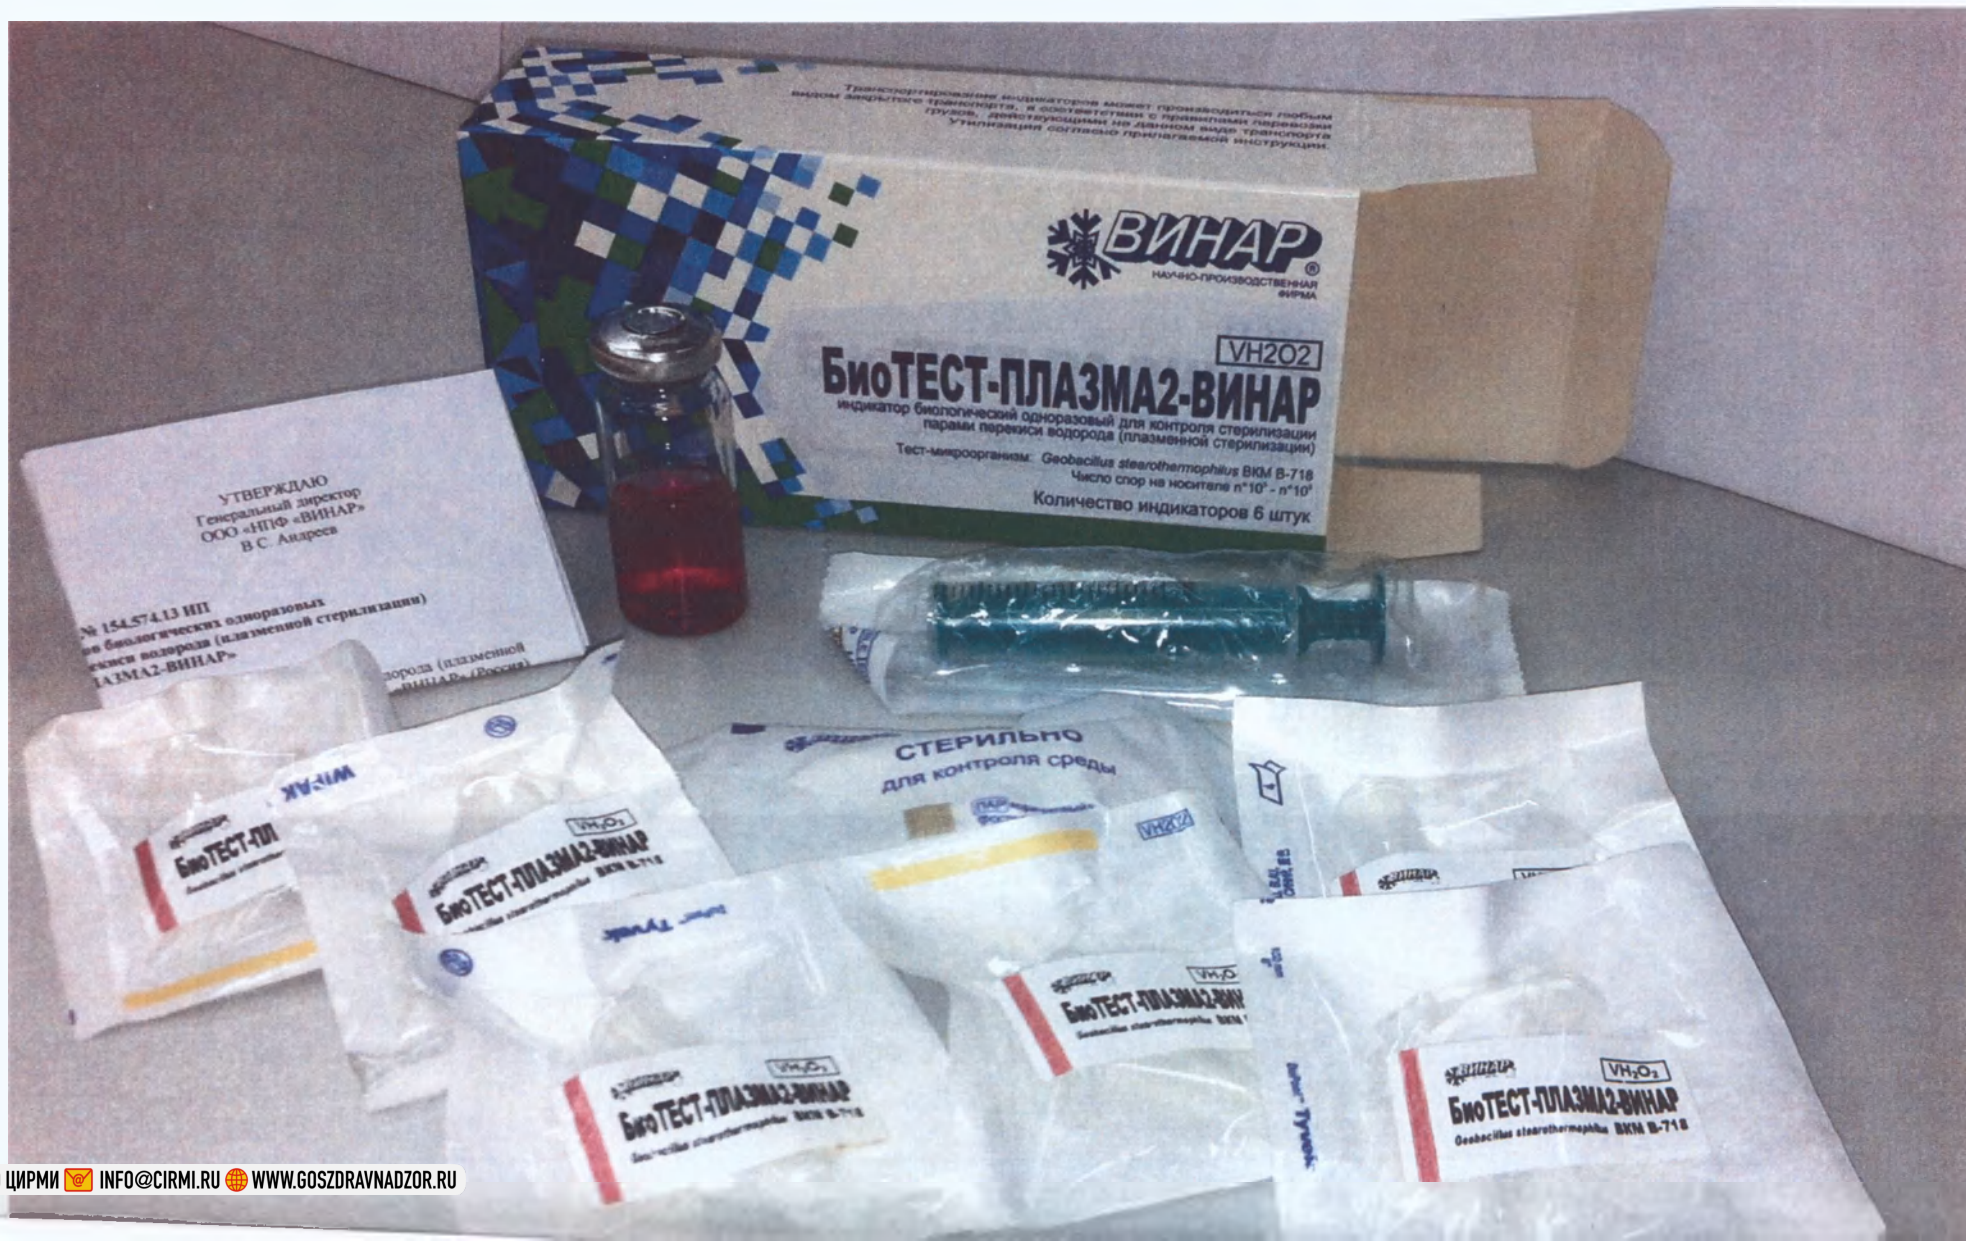


Индикатор биологический одноразовый для контроля стерилизации
парами перекиси водорода (плазменной стерилизации) «БиоТЕСТ-ПЛАЗМА2-ВИНАР»

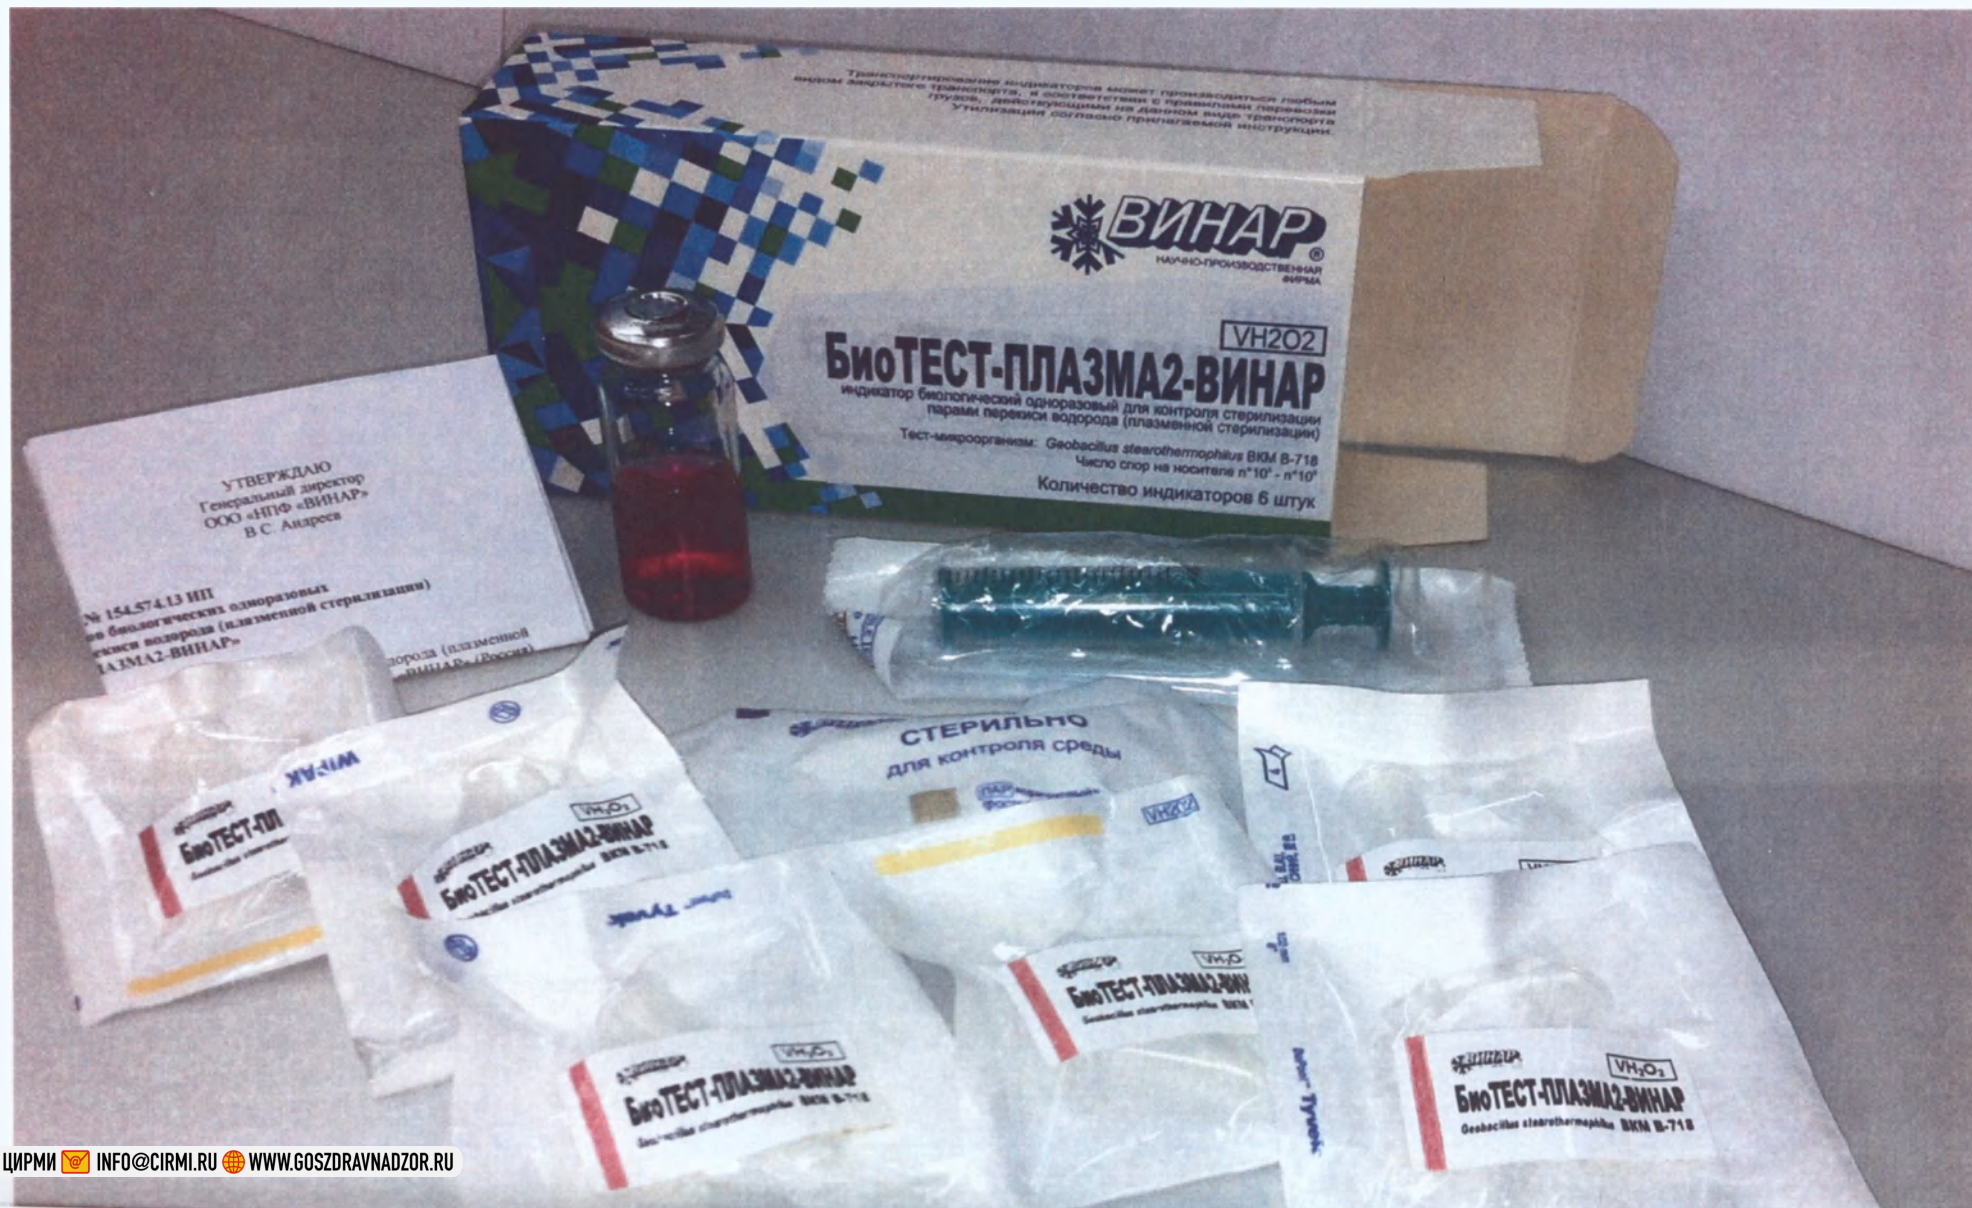


Индикатор биологический одноразовый для контроля стерилизации
парами перекиси водорода (плазменной стерилизации) «БиоТЕСТ-ПЛАЗМА2-ВИНАР»

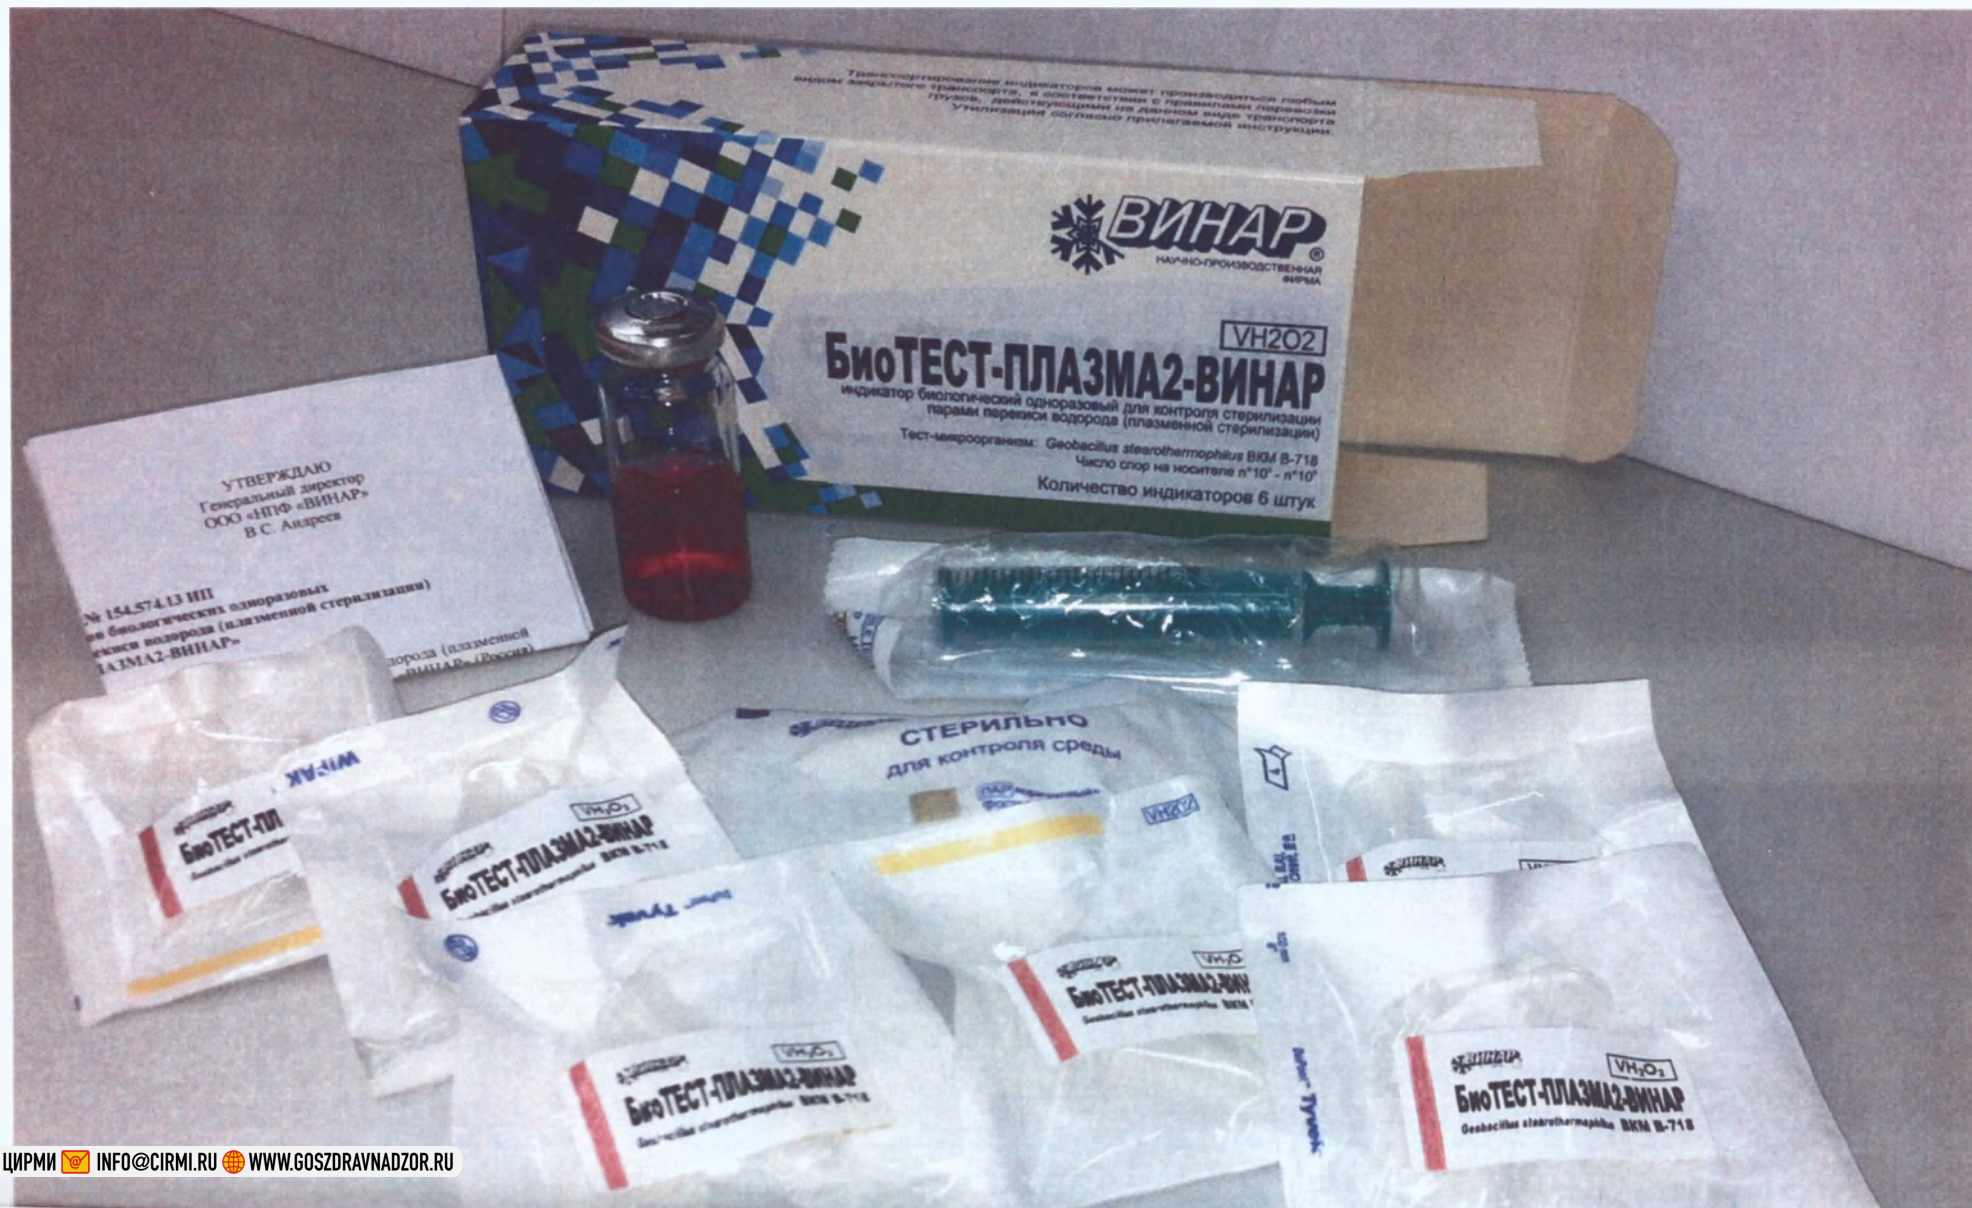

Индикатор биологический одноразовый для контроля стерилизации
парами перекиси водорода (плазменной стерилизации) «БиоТЕСТ-ПЛАЗМА2-ВИНАР»

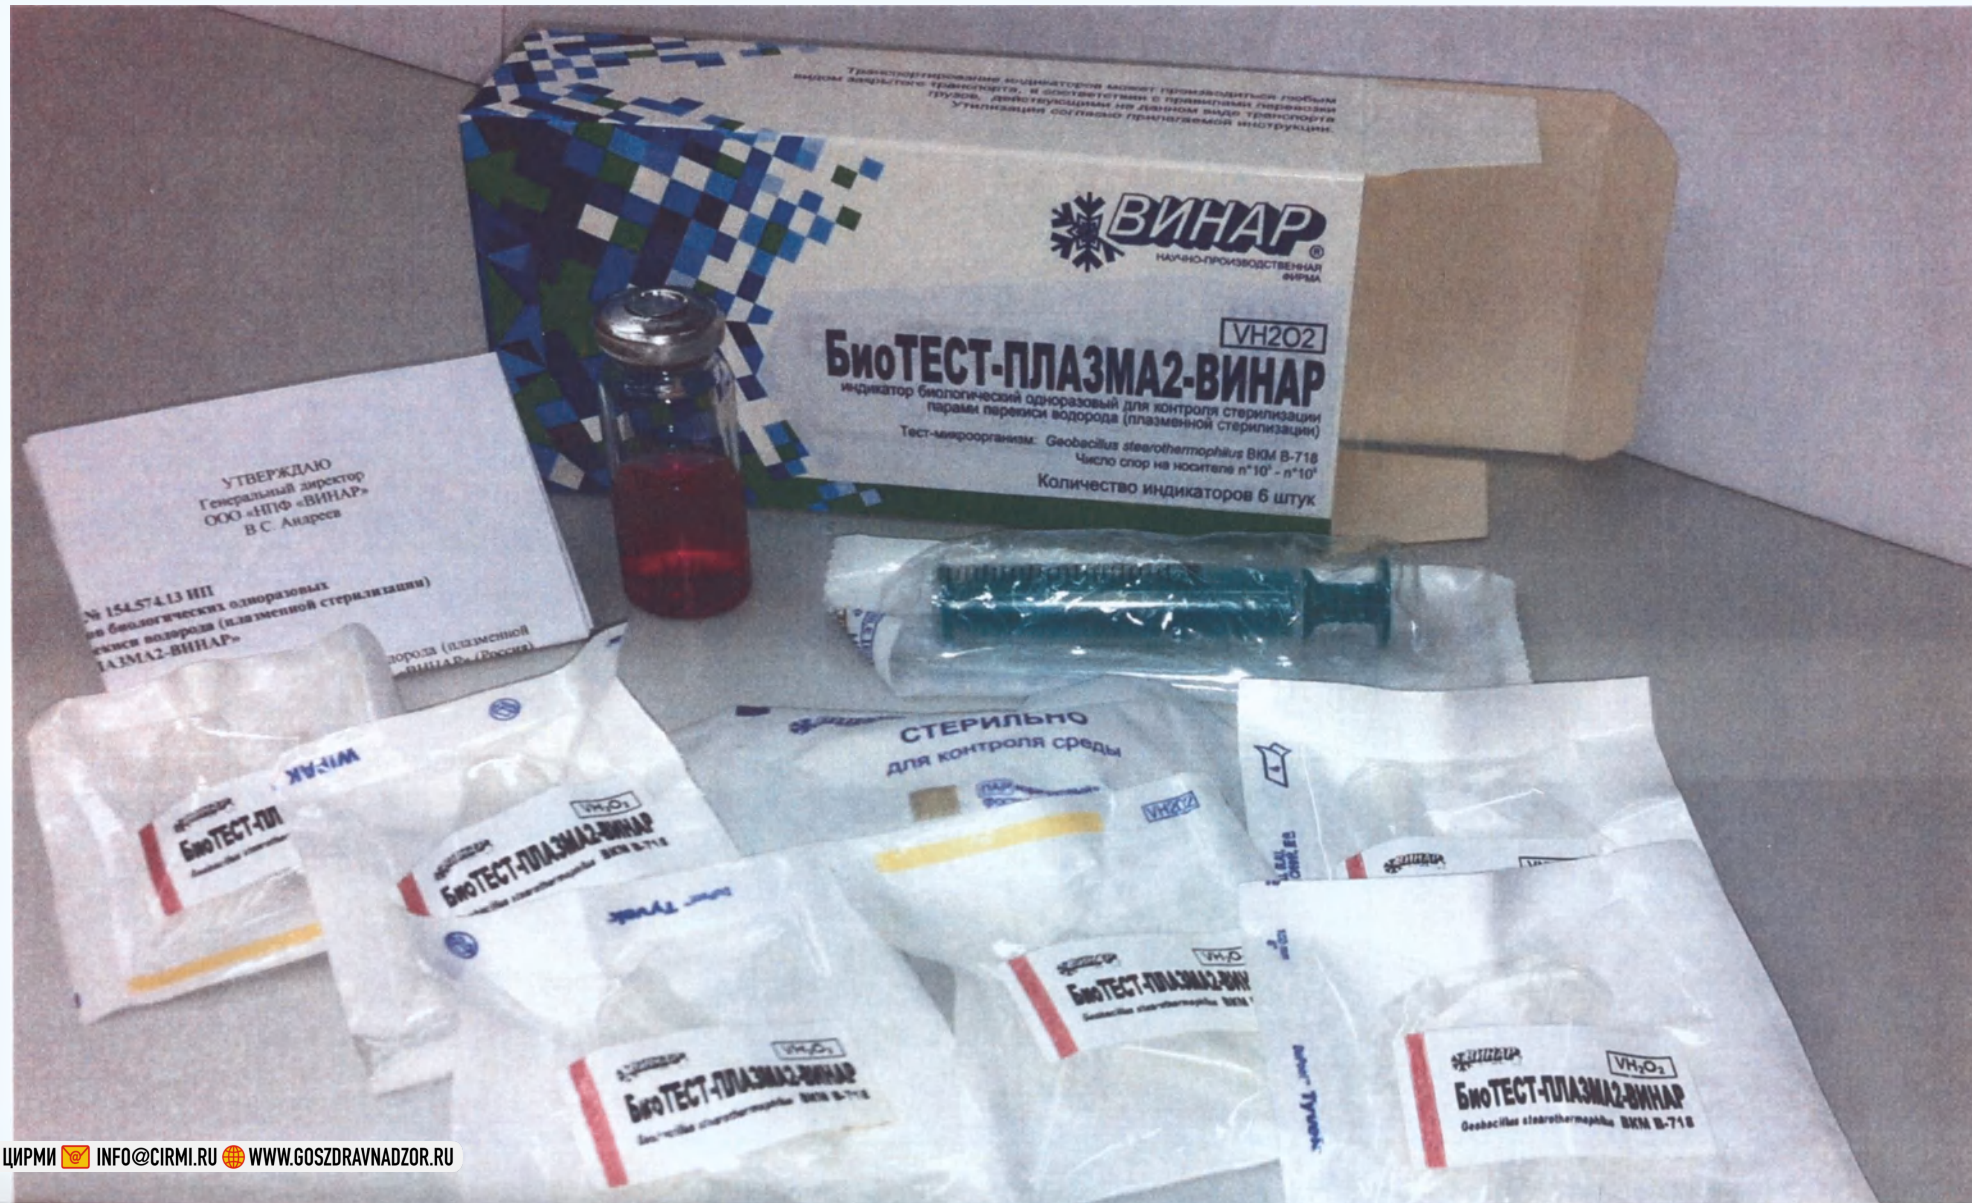


Индикатор биологический одноразовый для контроля стерилизации
парами перекиси водорода (плазменной стерилизации) «БиоТЕСТ-ПЛАЗМА2-ВИНАР»

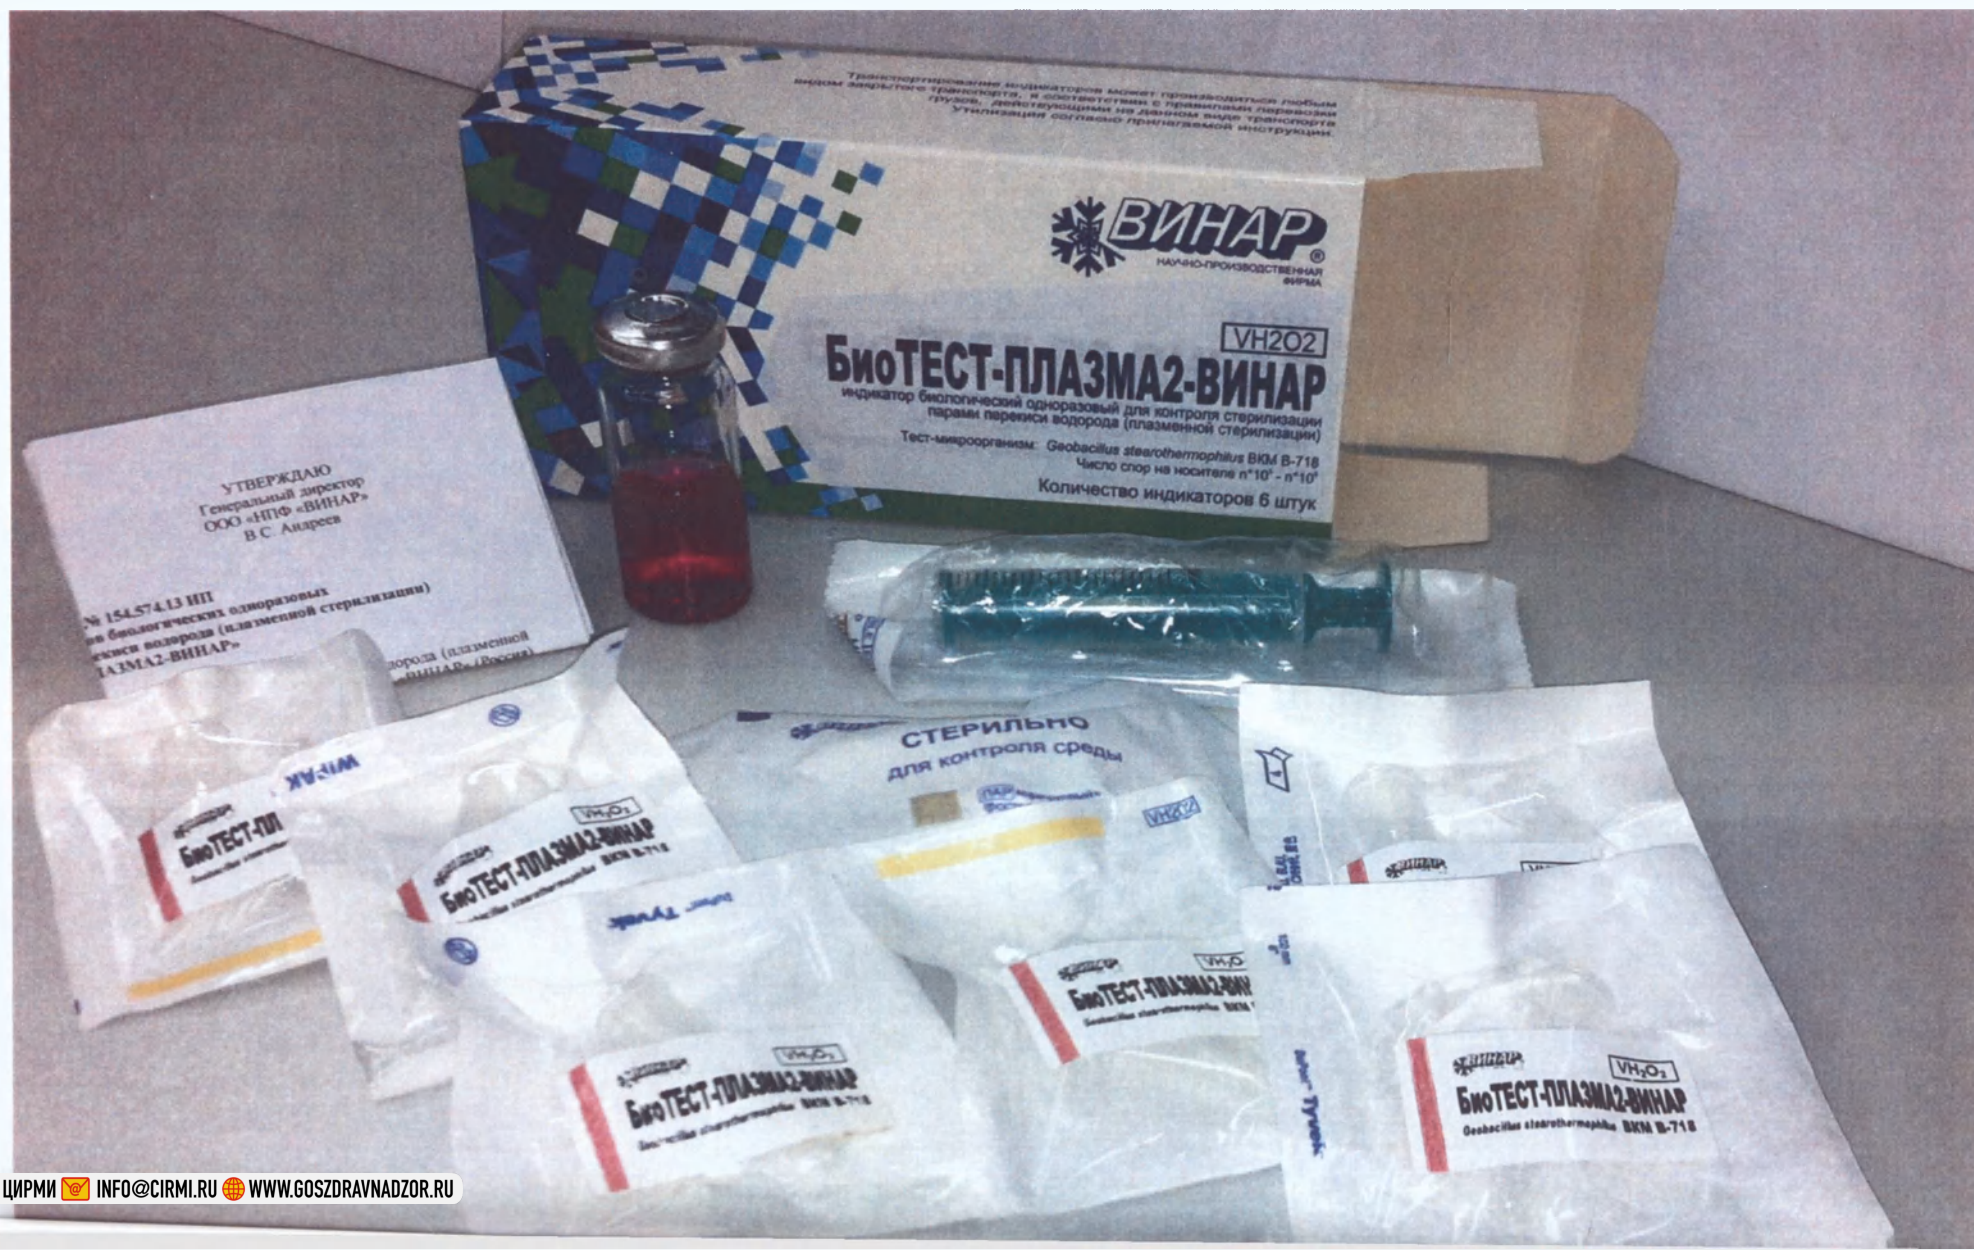

Индикатор автономный биологический одноразовый для контроля стерилизации оксидом этилена «БиоТЕСТ-ЭО-ВИНАР»



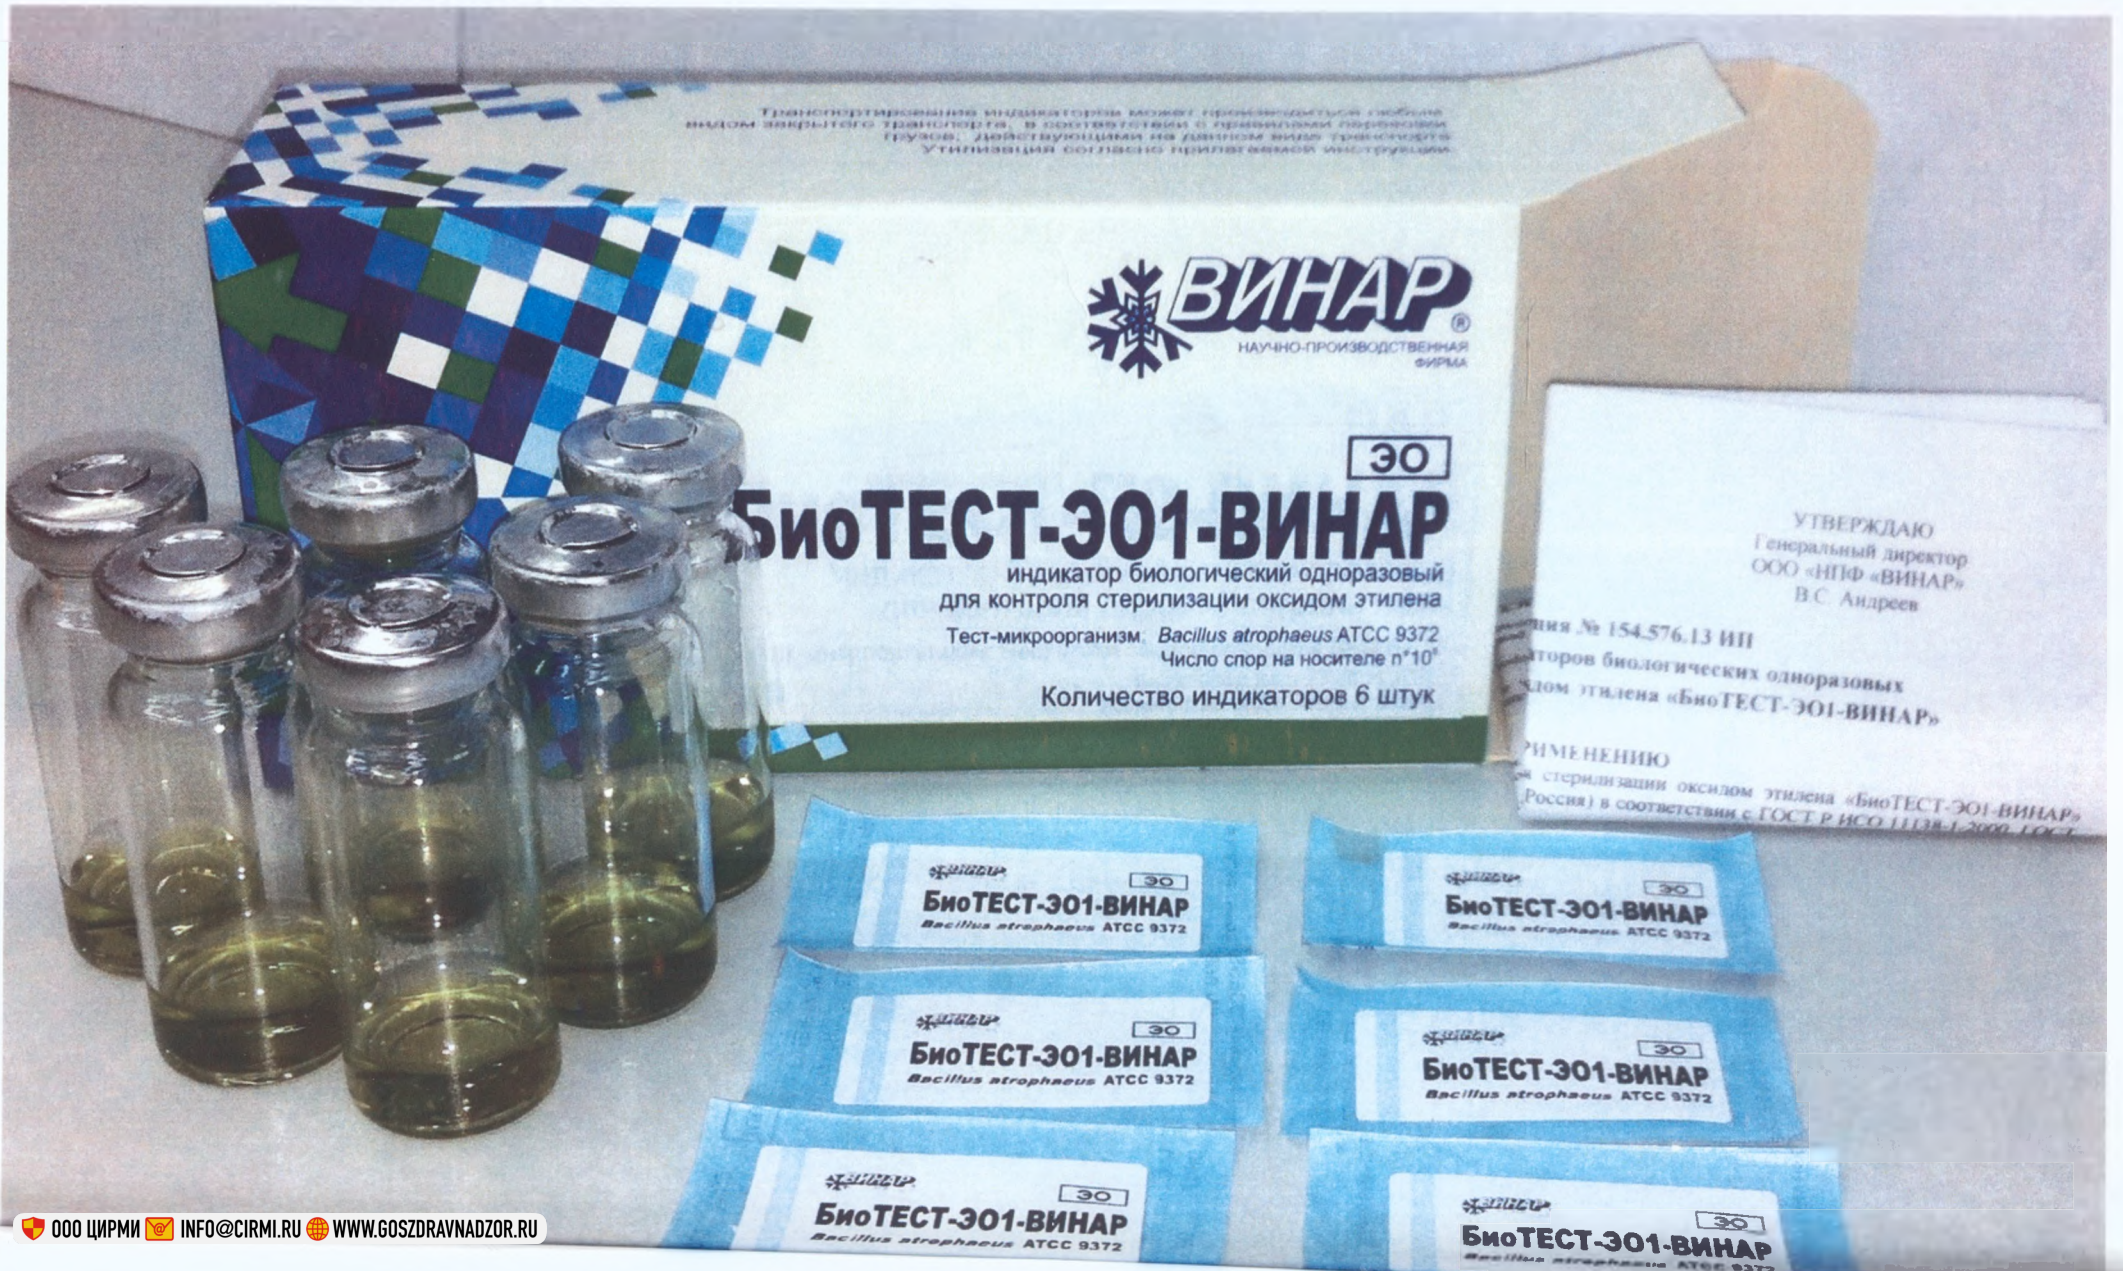

Индикатор биологический одноразовый для контроля стерилизации оксидом этилена «БиоТЕСТ-ЭО2-ВИНАР»



Индикатор биологический одноразовый для контроля стерилизации оксидом этилена «БиоТЕСТ-ЭО2-ВИНАР»



Индикатор биологический одноразовый для контроля стерилизации оксидом этилена «БиоТЕСТ-ЭО2-ВИНАР»

