

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО «ХЕМА»

Лебедин Ю.С.

М.П.

« 18 » марта 2020 г.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ ГРУППОВОЙ УПАКОВКИ (ТРАНСПОРТНОЙ ТАРЫ)

Набора реагентов для иммунохроматографического выявления
антител к вирусу SARS-CoV-2 в сыворотке (плазме) крови
«ХЕМАТест анти-SARS-CoV-2»



Набор реагентов для иммунохроматографического выявления антител к вирусу
SARS-CoV-2 в сыворотке (плазме) крови «ХЕМАТест анти-SARS-CoV-2»

REF K153 LOT Серия: XXX



Количество _____

Изготовлен



ГГГГ/ММ

Годен до



ГГГГ/ММ

Масса нетто _____

Масса брутто _____

Масса нетто потребительской упаковки _____



+2-30°C



IVD

ИТО
ИЧЕСТВЕ ЛИ
льный директор ООО «
Лебедин

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО «ХЕМА»

Лебедин Ю.С.

« 18 » марта 2020 г.



МАКЕТ МАРКИРОВКИ

**Набора реагентов для иммунохроматографического выявления
антител к вирусу SARS-CoV-2 в сыворотке (плазме) крови
«ХЕМАТест анти-SARS-CoV-2»**

ООО «ХЕМА» 125319, Москва, 4-я улица
Восьмого Марта, д. 3, стр. 3, пом. 2
PO Box 58, 105043 Moscow, Russia
☎ (495) 737-3936, 737-0040, 510-5707

**Набор реагентов для иммунохроматографического выявления
антител к вирусу SARS-CoV-2 в сыворотке (плазме) крови
«ХЕМАТест анти-SARS-CoV-2»**

REF X153 LOT A2004 Изготовлен  2020-03-30 Годен до  2023-03-30

Состав набора:

		CONT	LOT
Кассета	20 шт/pcs	X153Z	A2004
Буфер для образца	1 x 4,0 мл/ml	DIL	A2004
Инструкция по применению	1 шт/pcs	X153IR	A2004

 МО, г. Балашиха, ул. Трубецкая, 2В IVD  +2-30°C ∑ 20    

ТУ 21.20.23-153-18619450-2020 РУ _____ от _____

ООО «ХЕМА»

«ХЕМАТест анти-SARS-CoV-2»

Кассета **REF** X153Z

ГОТОВА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

 2023-03-30 **LOT** A2004

 +2-30°C **IVD**  

ООО «ХЕМА»

«ХЕМАТест анти-SARS-CoV-2» **REF** S153Z

БУФЕР ДЛЯ ОБРАЗЦА **DIL**

ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 4,0 мл/ml

 2023-03-30 **LOT** A2004

 +2-30°C **IVD**

ПРОШИТО
В КОЛИЧЕСТВЕ 4 ЛИСТОВ
Генеральный директор ООО «ХЕМА»
Ю.С. Лебедин



«УТВЕРЖДАЮ»


Генеральный директор ООО «ХЕМА»

Ю.С. Лебедин

« 18 » марта 2020 г.

Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия и его компонентов

«Набор реагентов для иммунохроматографического выявления антител
к вирусу SARS-CoV-2 в сыворотке (плазме) крови
«ХЕМАТест анти-SARS-CoV-2»»

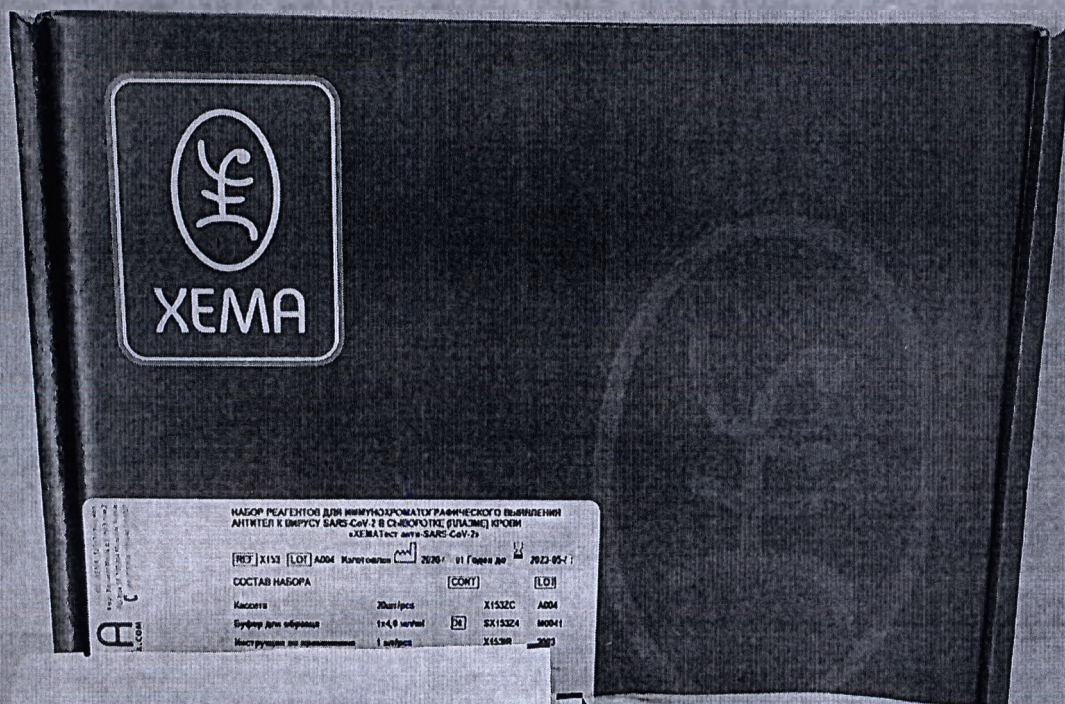

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО ВЫЯВЛЕНИЯ
АНТИТЕЛ К ВИРУСУ SARS-CoV-2 В СЫВОРОТКЕ (ПЛАЗМЕ) КРОВИ
«XEMATest анти-SARS-CoV-2»

REF: X153 LOT: A004 Маркировка: 2020-01-01 Гаражи до: 2022-05-17

СОСТАВ НАБОРА

Комп.	КОМ.	ЛОТ
Масштаб	20шт/лос	X1532C A004
Буфер для обработки	1x4, 6 шт/лос	EX1532A M0041
Инструкция по применению	1 шт/лос	X153BR 2003

XEMATEST
www.xematest.com

XEMATEST
www.xematest.com



ИНСТРУКЦИЯ

по применению Набора реагентов для иммунохроматографического выявления антител к вирусу
SARS-CoV-2 в сыворотке (плазме) крови
«XEMATest анти-SARS-CoV-2»

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.


1.1. Назначение.

Набор реагентов для иммунохроматографического выявления антител к вирусу SARS-CoV-2 человека «XEMATest анти-SARS-CoV-2» предназначен для качественного раздельного выявления IgG и IgM антител к антигенам вируса SARS-CoV-2 в сыворотке (плазме) крови.


1.2. Введение.

Коронавирусы типов α и β являются патогенными только для млекопитающих; вирусы типа

8

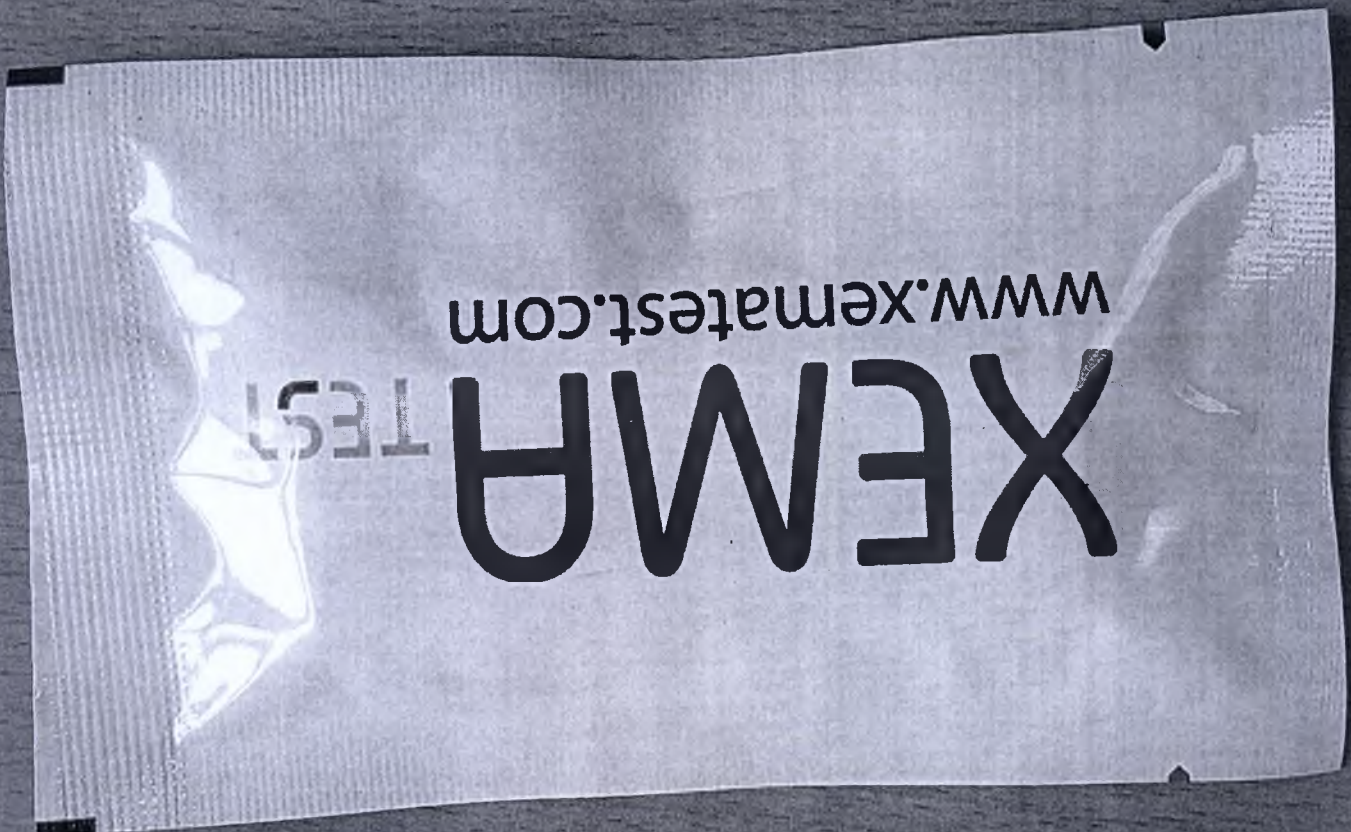

h

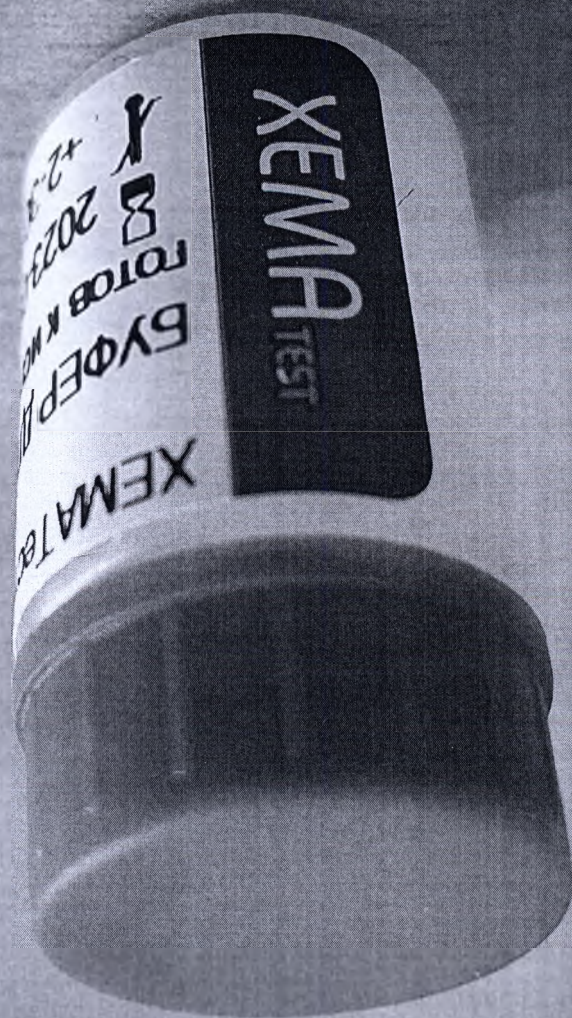

ПРОШИТО
В КОЛИЧЕСТВЕ 4 ЛИСТОВ
Генеральный директор ООО «ХЕМА»
Ю.С. Лебедин

