

ПОДТВЕРЖДАЮ
Руководитель группы по регистрации продукции
для in vitro диагностики, иммунохимия,
гематология и гемостаз

ООО «Сименс Здравоохранение»

Чигринец Е.А.
2023 г.

Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики in vitro

«Система для количественного определения белков Atellica NEPH 630, с принадлежностями»

производства «Сименс Хелскеа Диагностикс Продактс ГмбХ» (Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH), Германия



Рисунок 1 Система для количественного определения белков Atellica NEPH 630, с принадлежностями: общий вид изделия



Рисунок 2 Кабель электропитания – 1 шт.

SIEMENS
Healthineers

05/04/15 0249 61/10/15



SL0002420249

СУДИК

Major Terminal www.sip.ru #1800 732 6006



11210758

Система Atellica NERN 630

Руководство

Редакция: 1.3, дата выпуска: 2018-04

[siemens.com / healthineers](http://siemens.com/healthineers)



Рисунок 4 Программное обеспечение на электронных носителях.

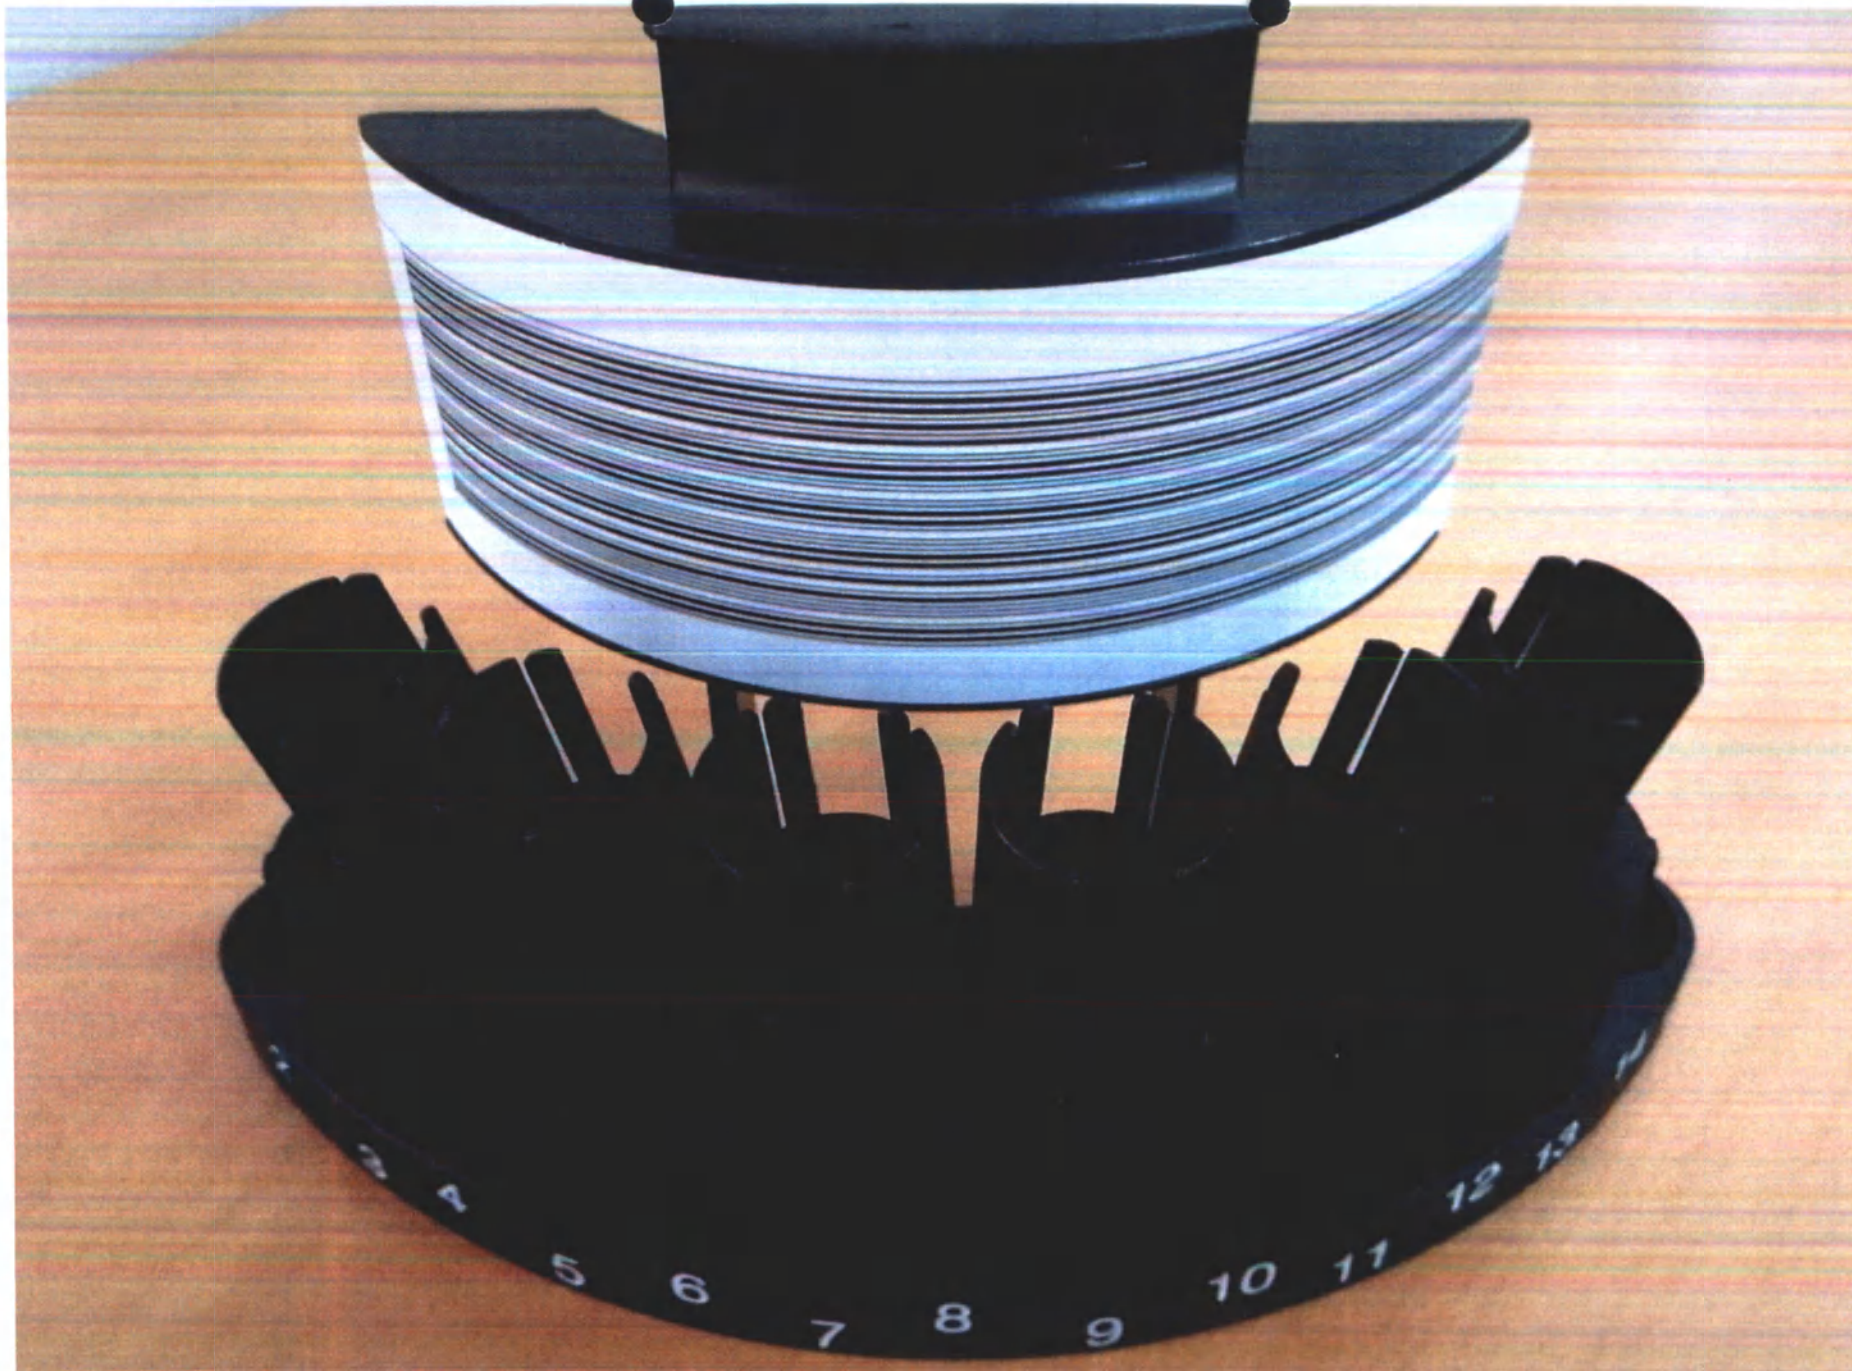


Рисунок 5 Сегмент ротора проб для контролей и калибраторов, не более 10 шт.

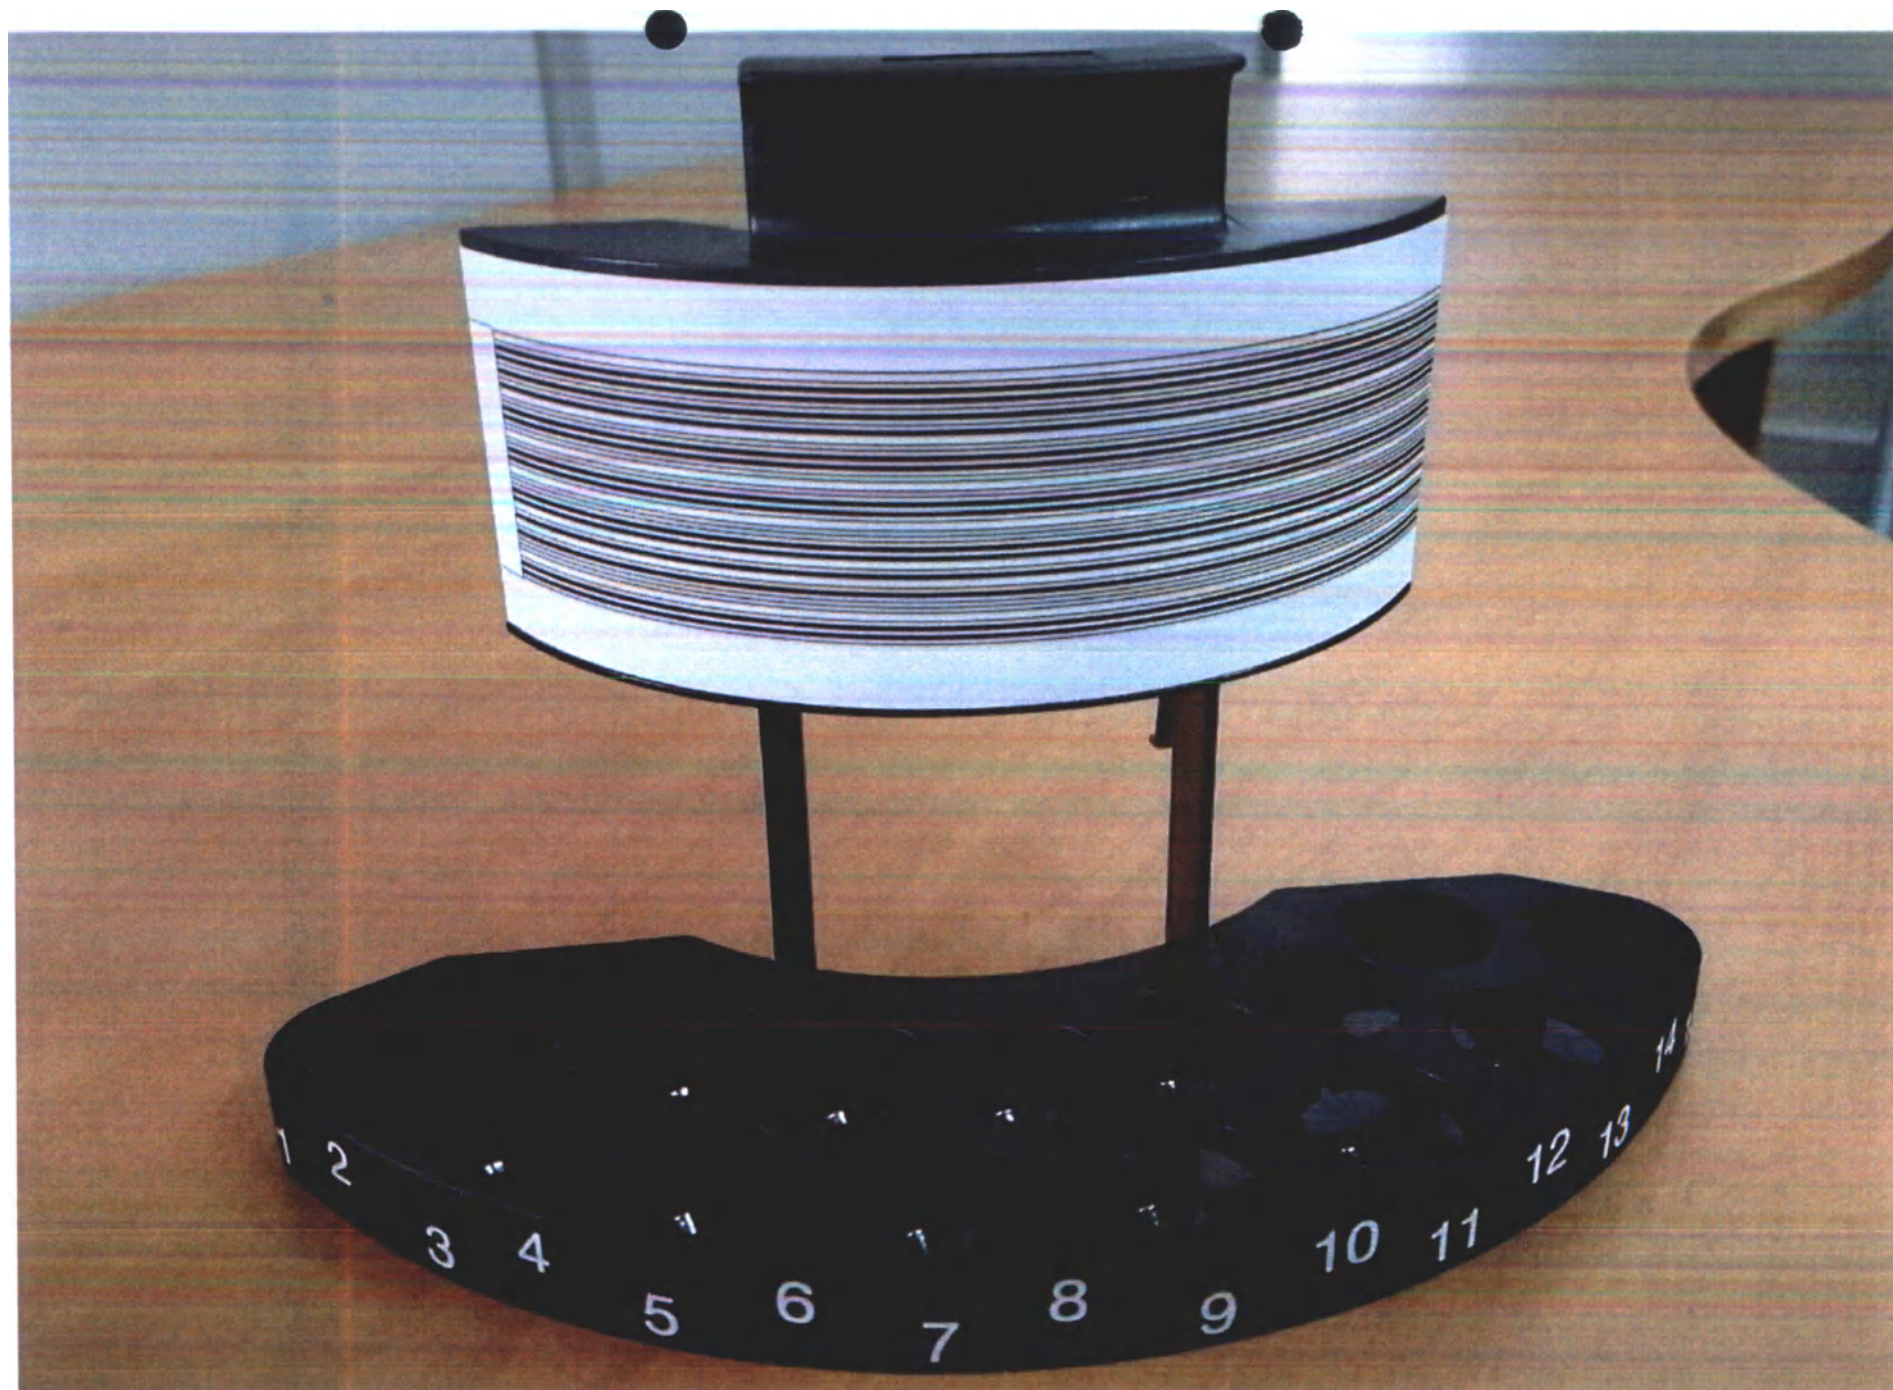


Рисунок 6 Сегмент ротора проб, не более 5 шт.



Рисунок 7 Сегмент ротора реагентов - 12 шт.



Рисунок 8 Сегмент ротора реагентов для контролей - 3 шт.

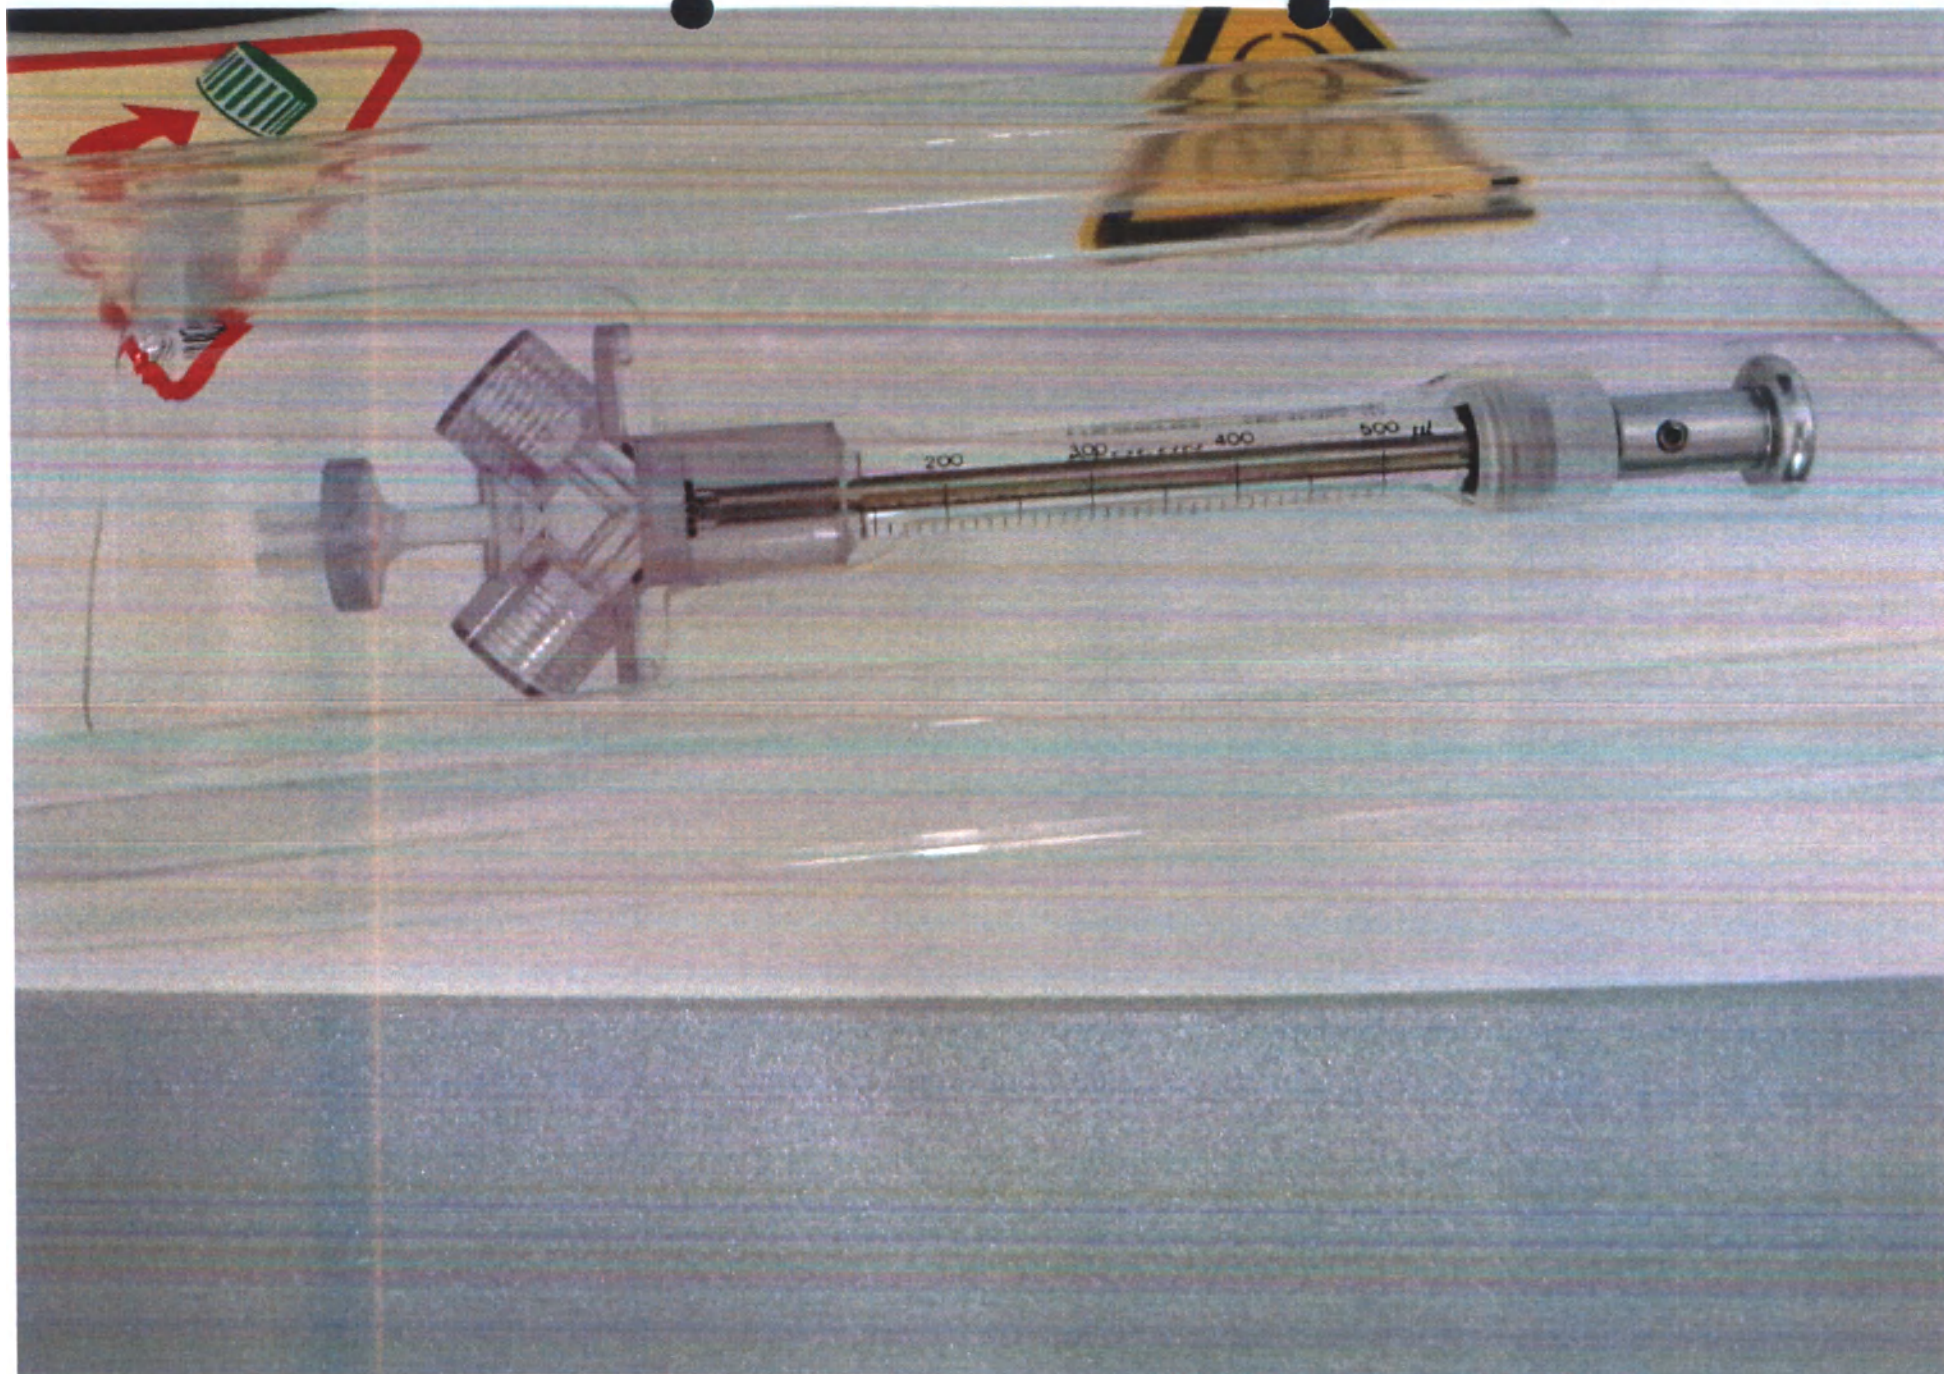


Рисунок 5 Дозирующий шприц 500 мл - 1 шт.

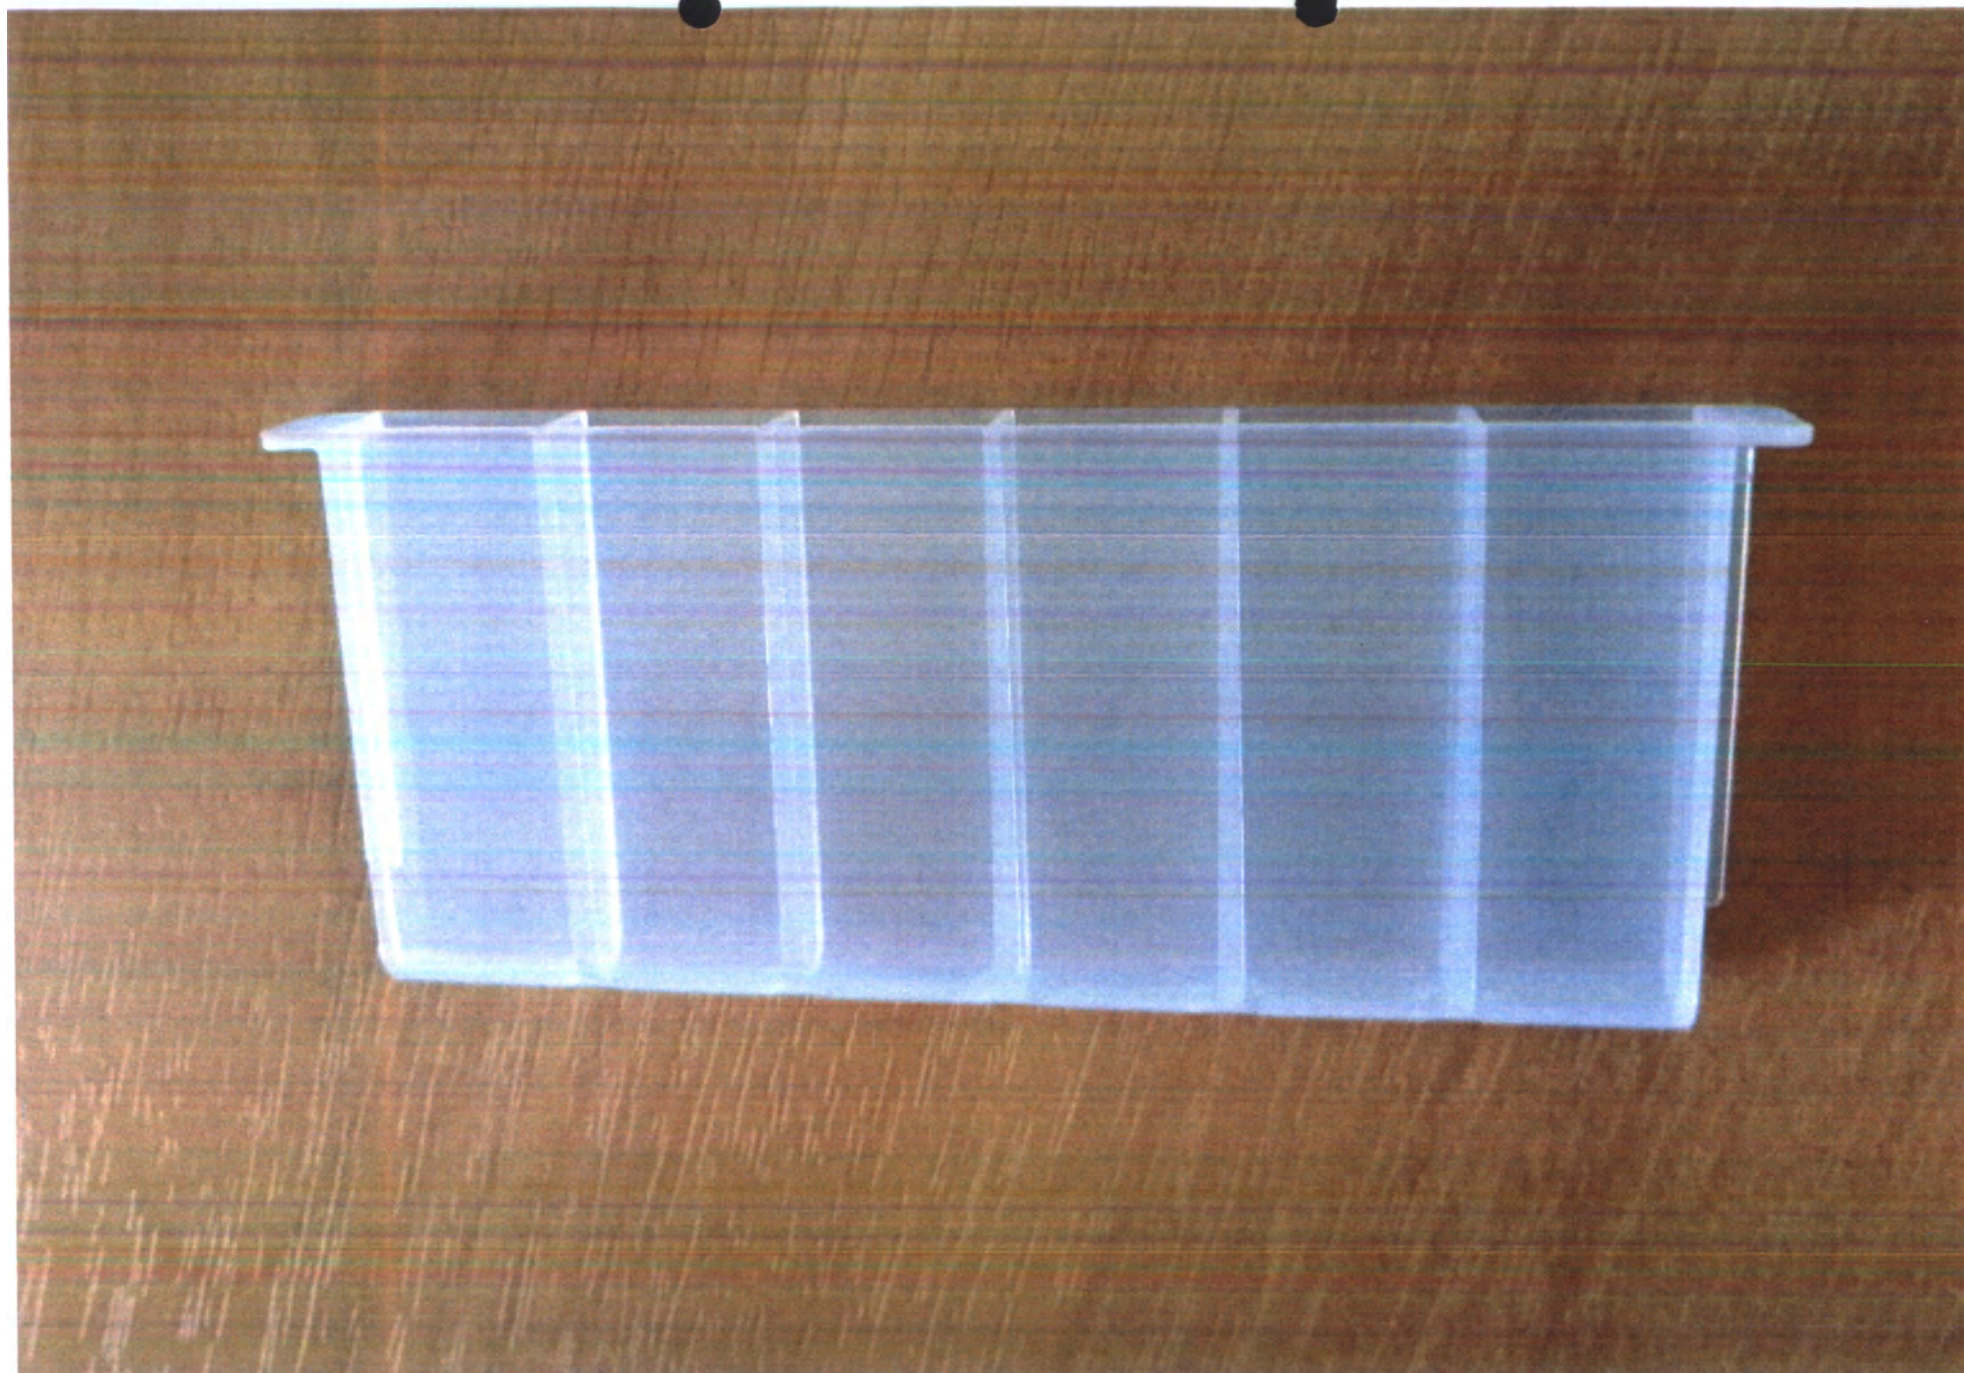


Рисунок 10 Пробирки для разведения, не более 8000 шт.

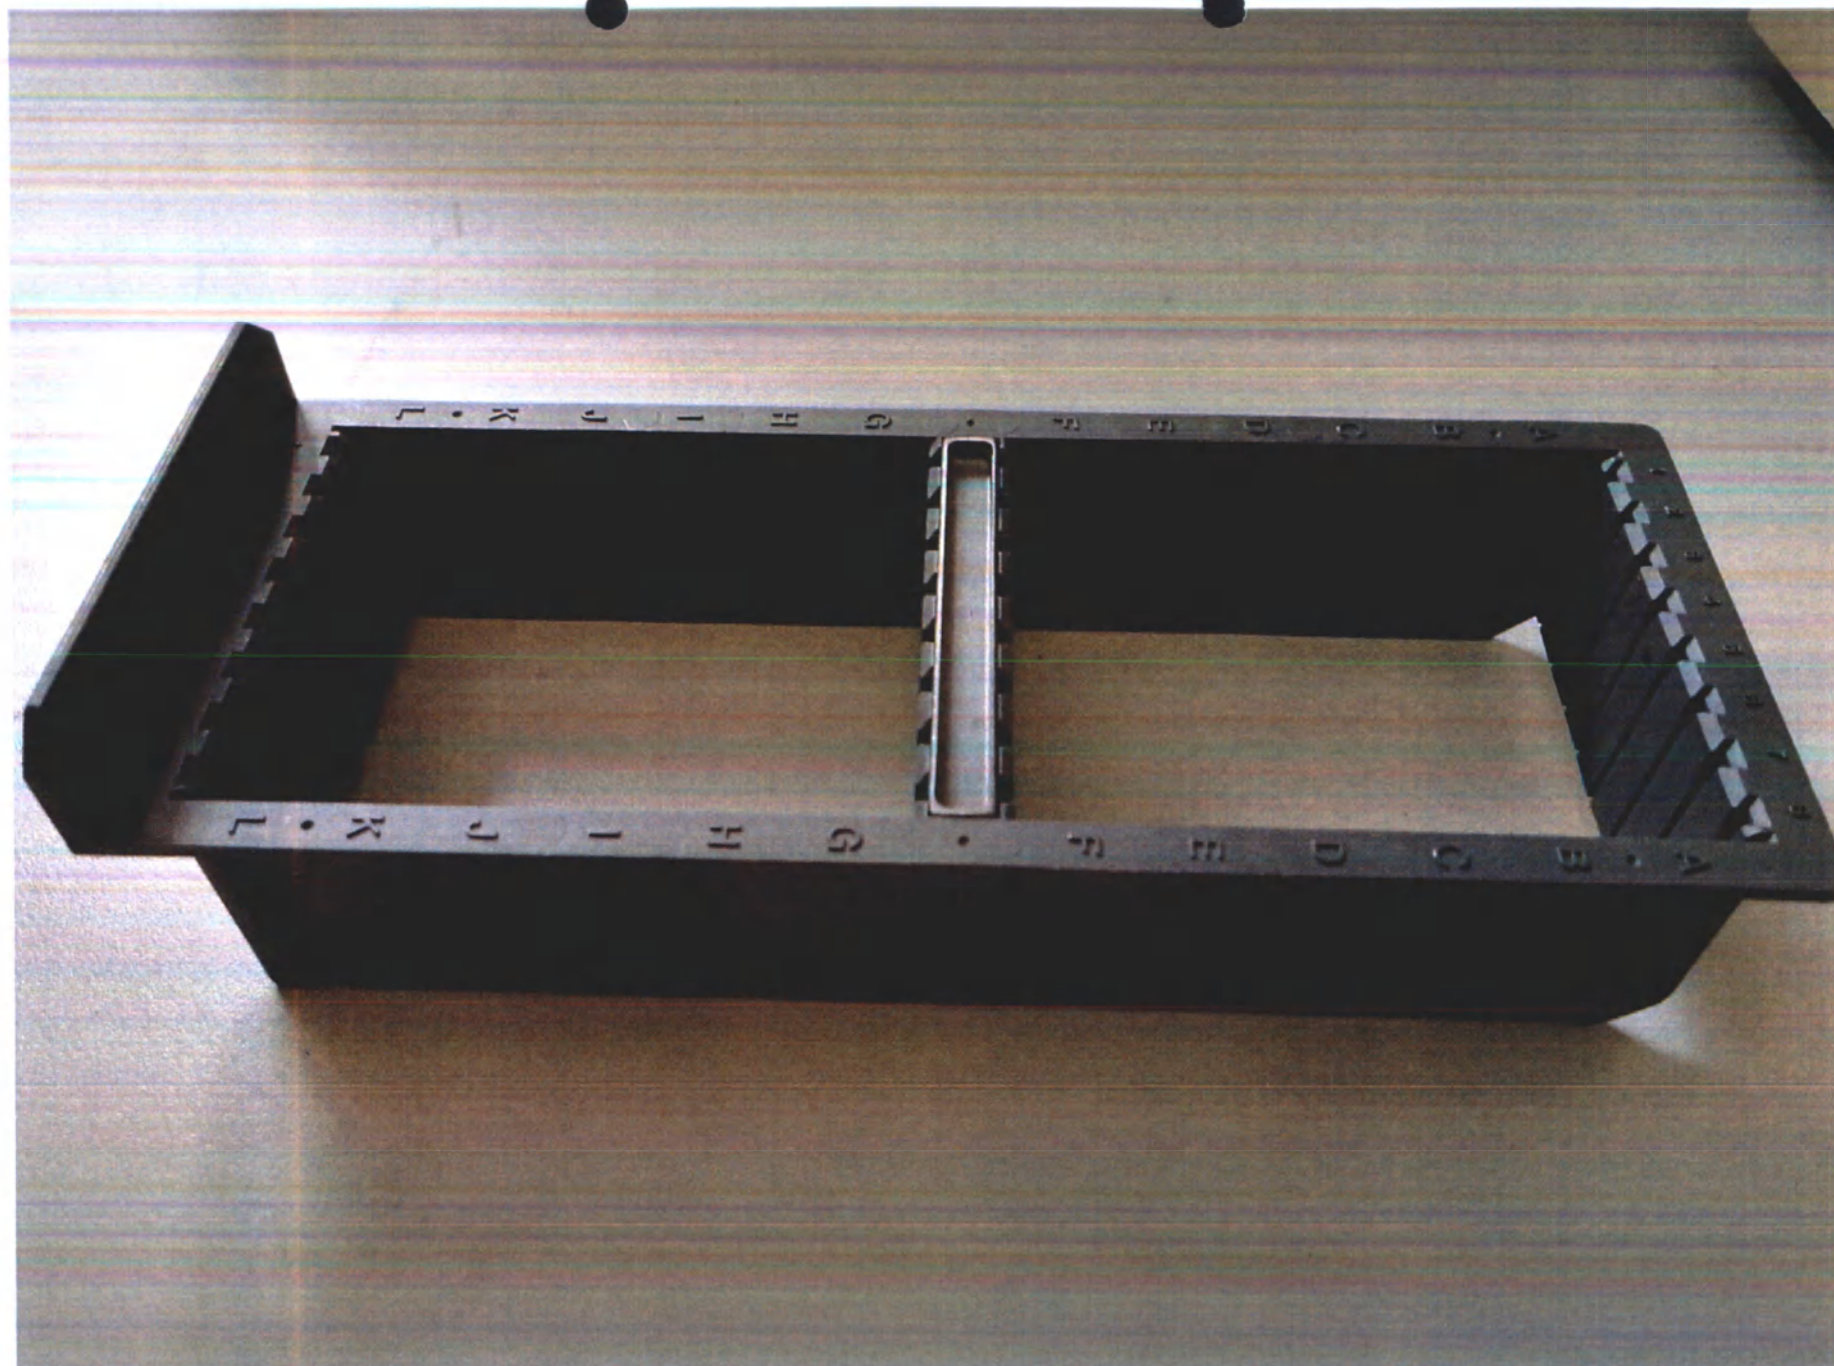


Рисунок 11 Рамка для разбавления - 1 шт.

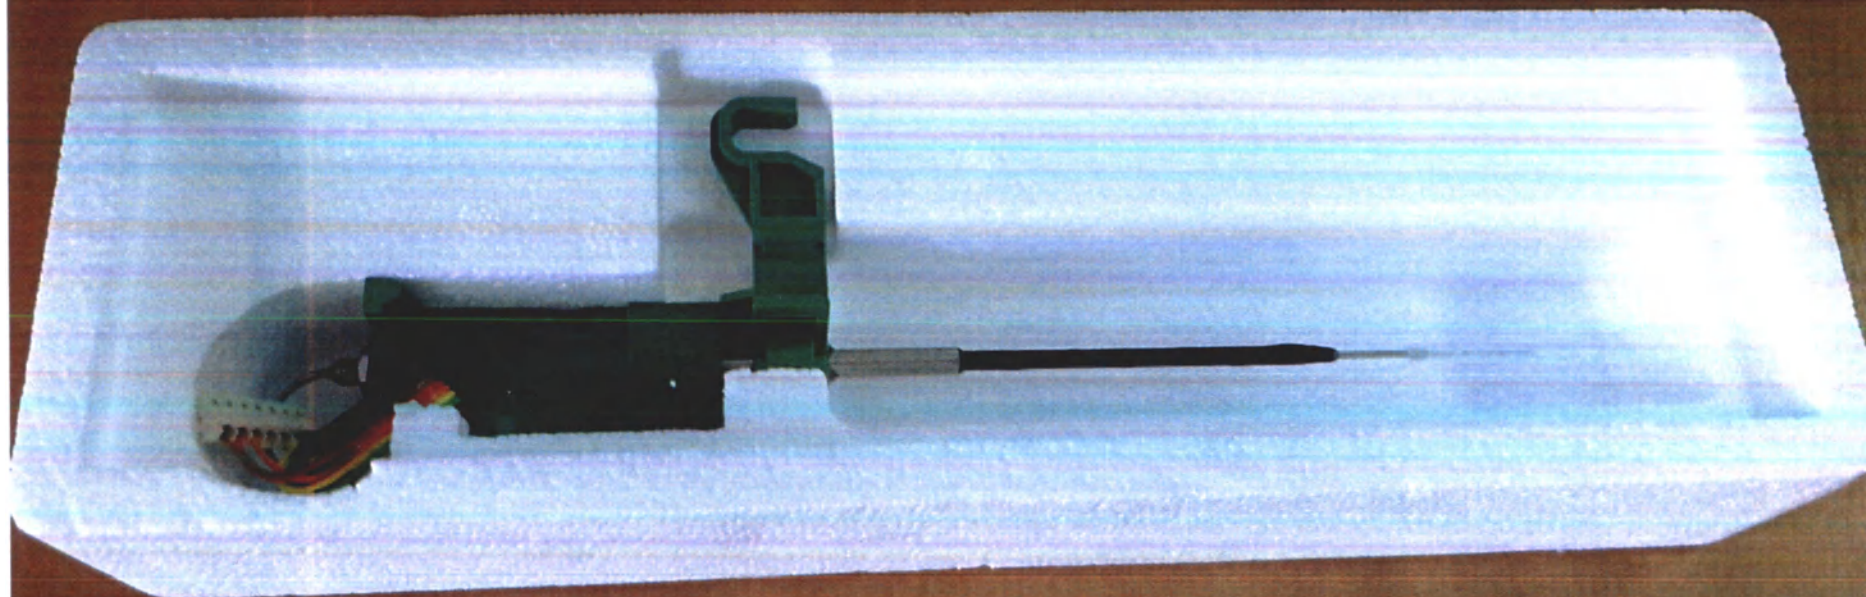


Рисунок 12 Пробозаборник - 1 шт.

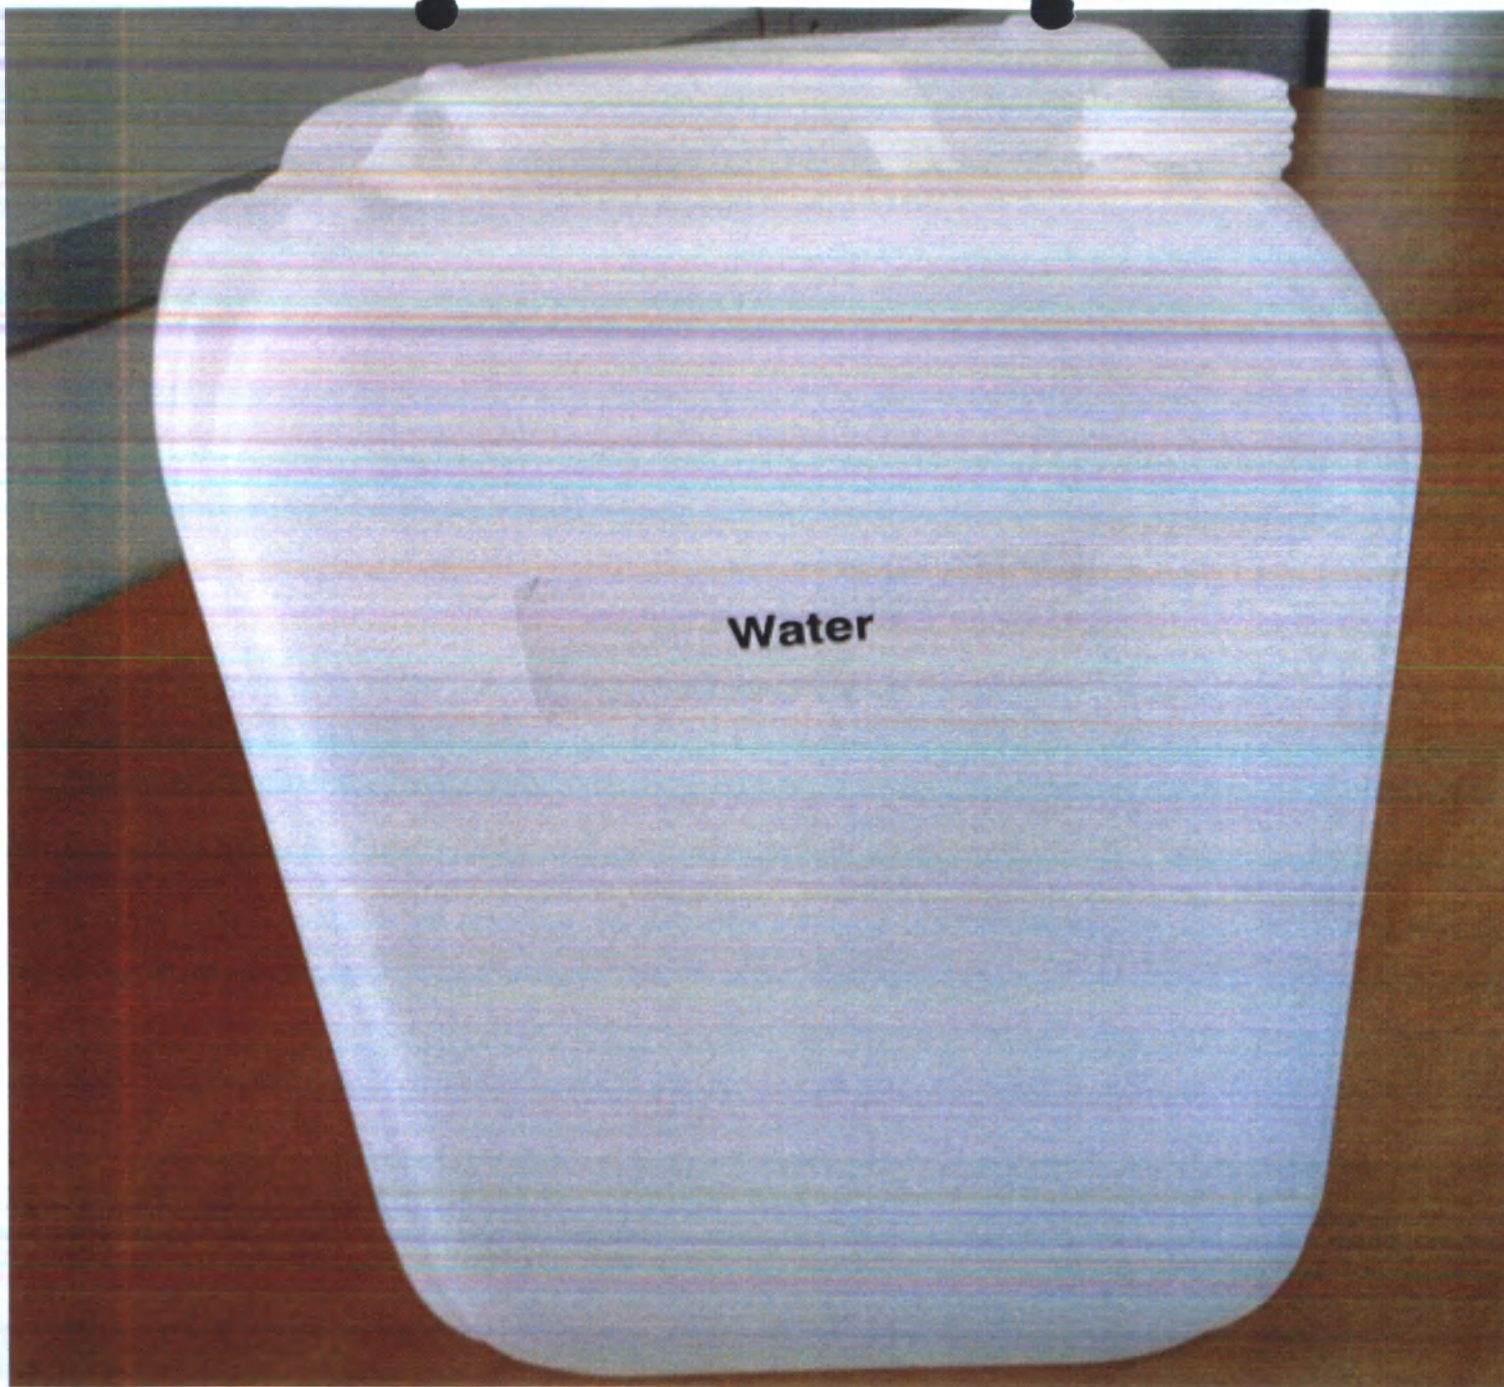


Рисунок 63 Канистра для воды 10 л, не более 2 шт.



Рисунок 14 Канистра для отходов 10 л, не более 3 шт.



Рисунок 15 Сенсор уровня жидкости (с трубкой, рис.23) - 4 шт.

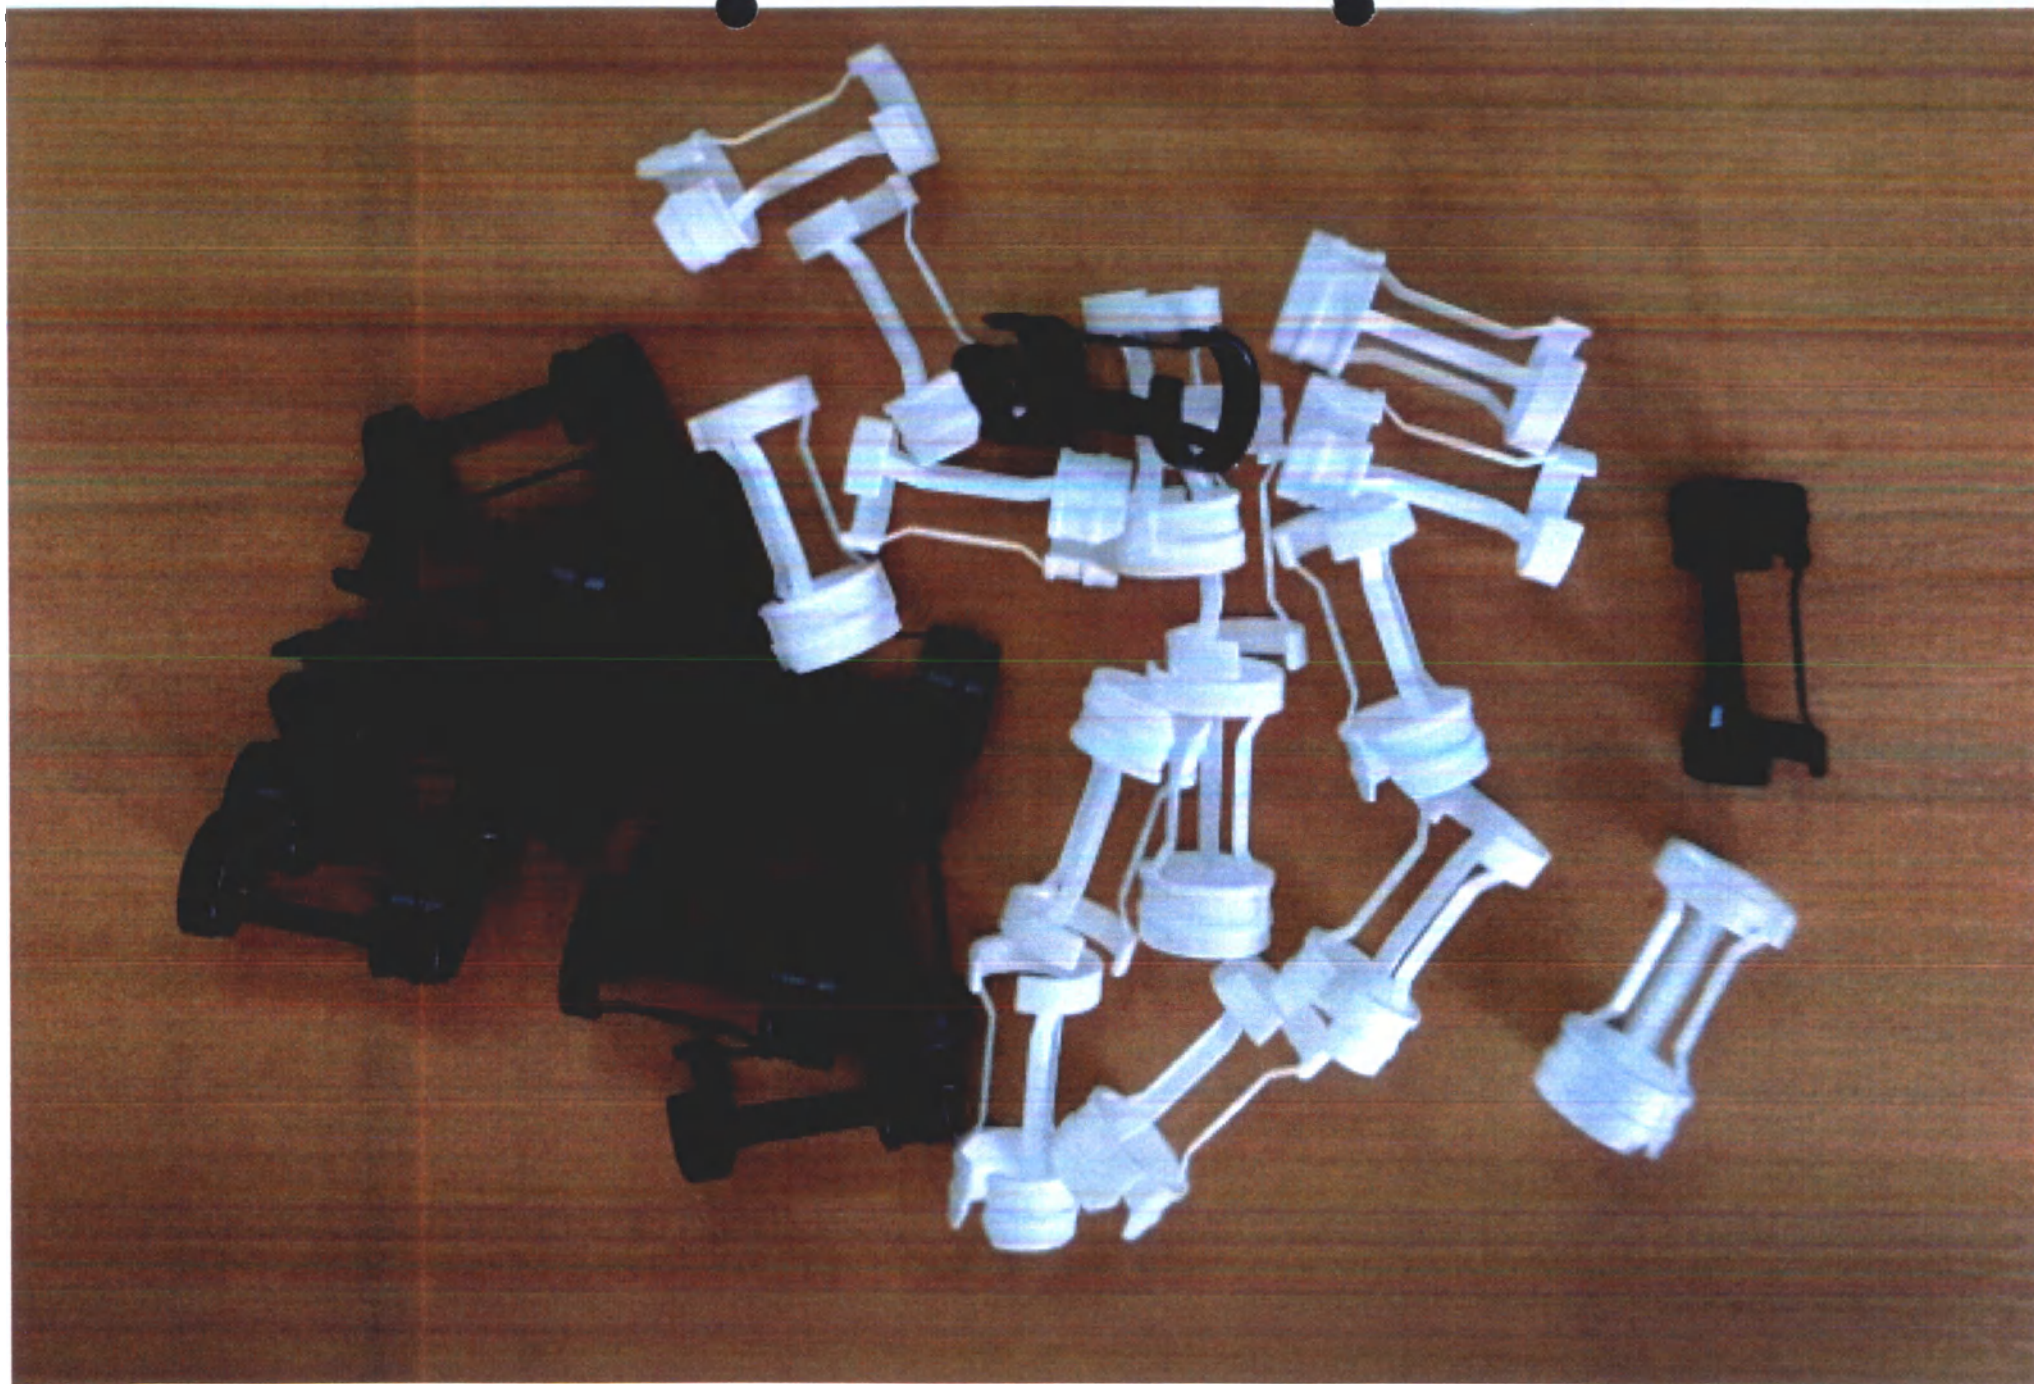


Рисунок 16 Адаптеры для проб, не более 10 уп.



Рисунок 17 Блок управления и обработки данных с соединительным кабелем - 1 шт.

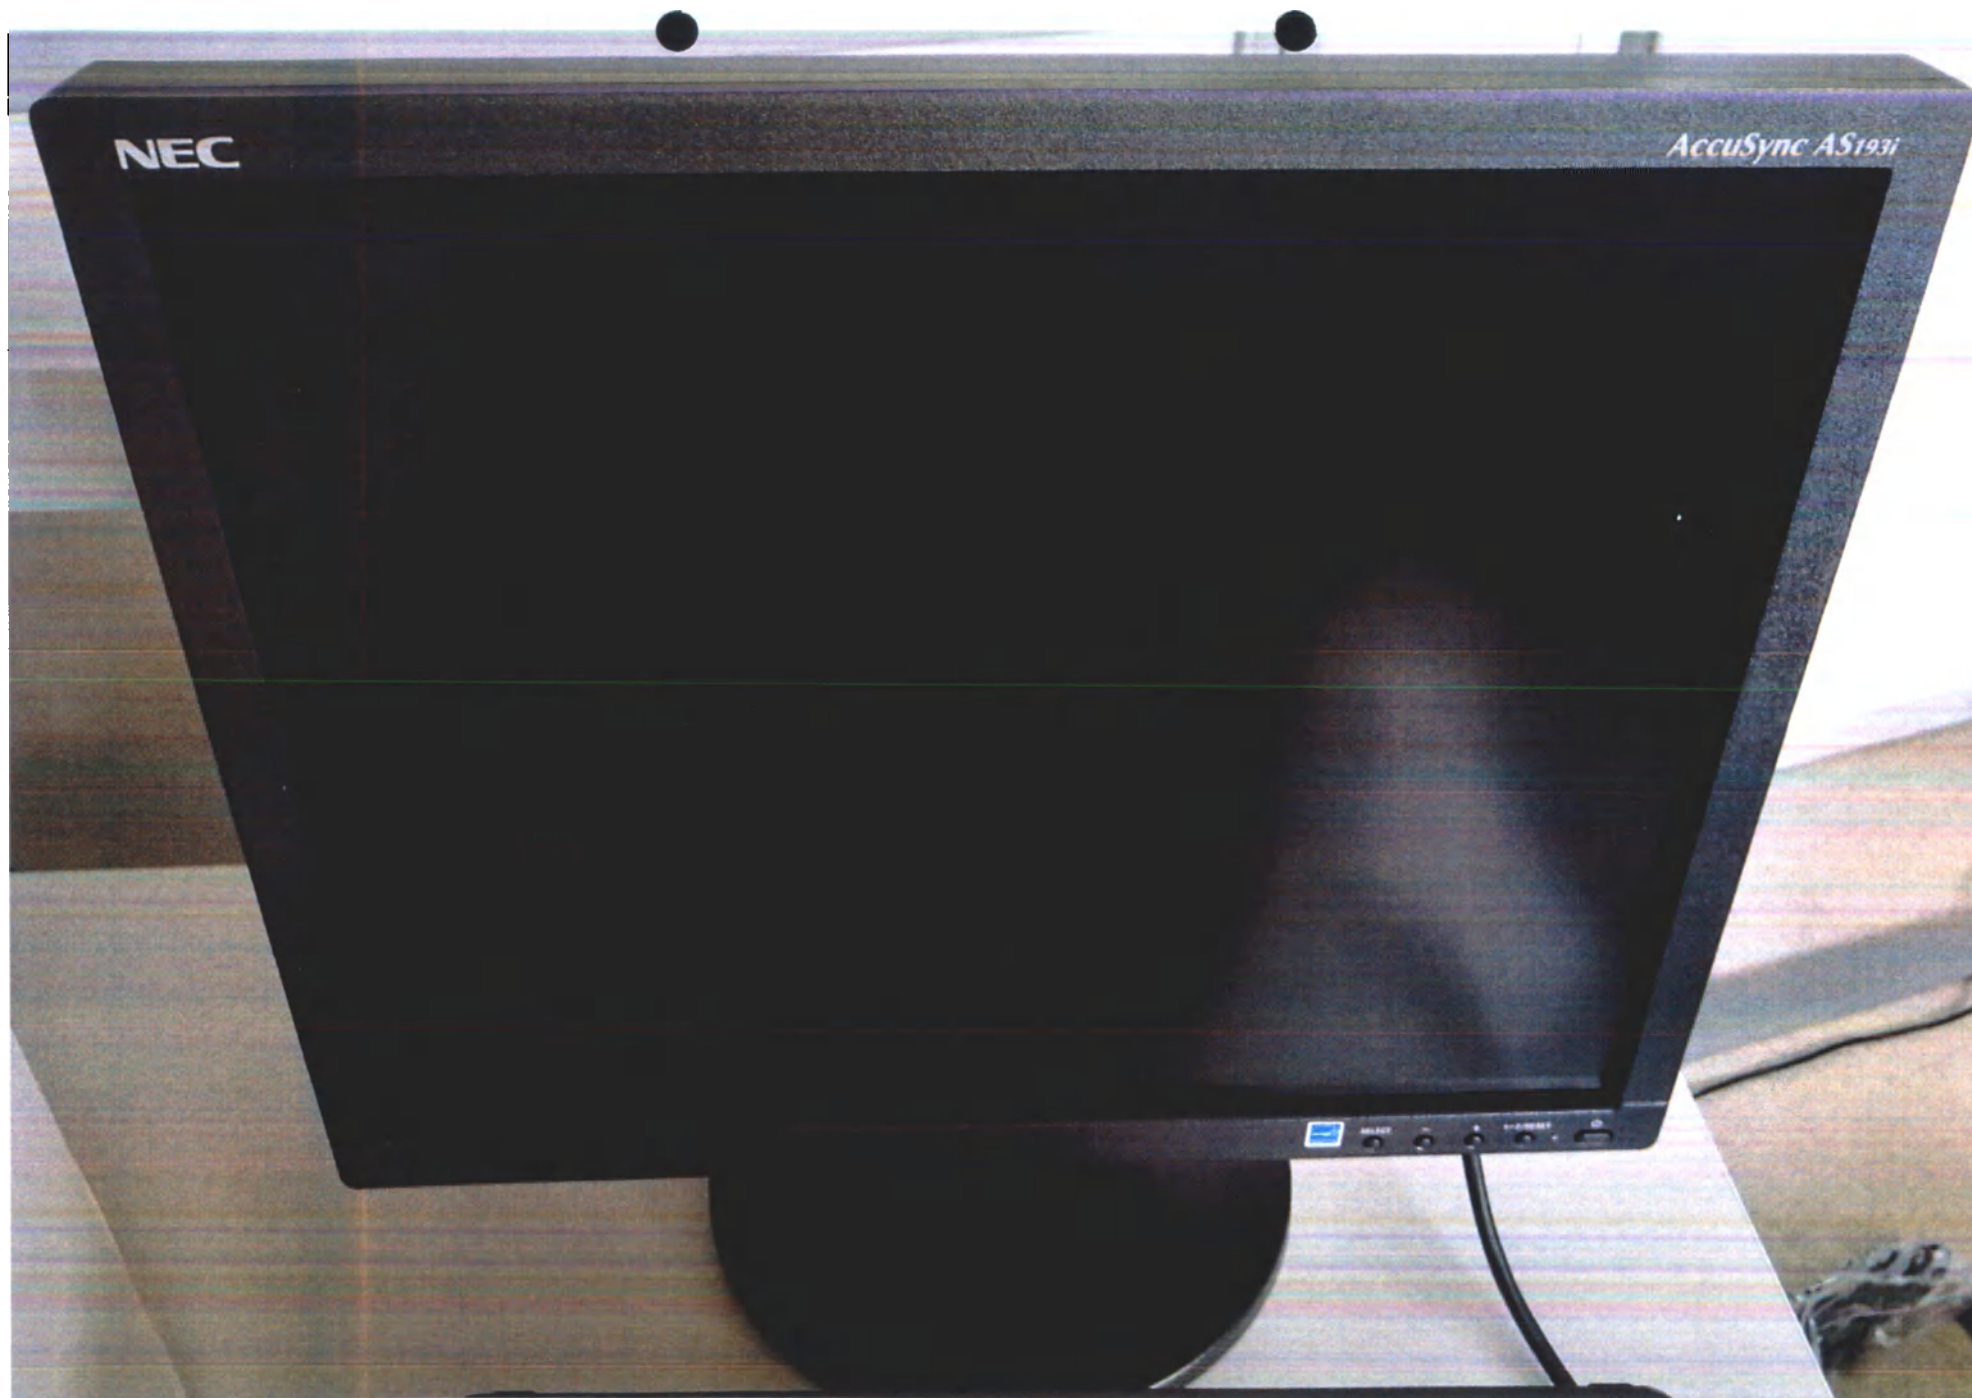


Рисунок 18 Монитор с кабелем питания - 1 шт.

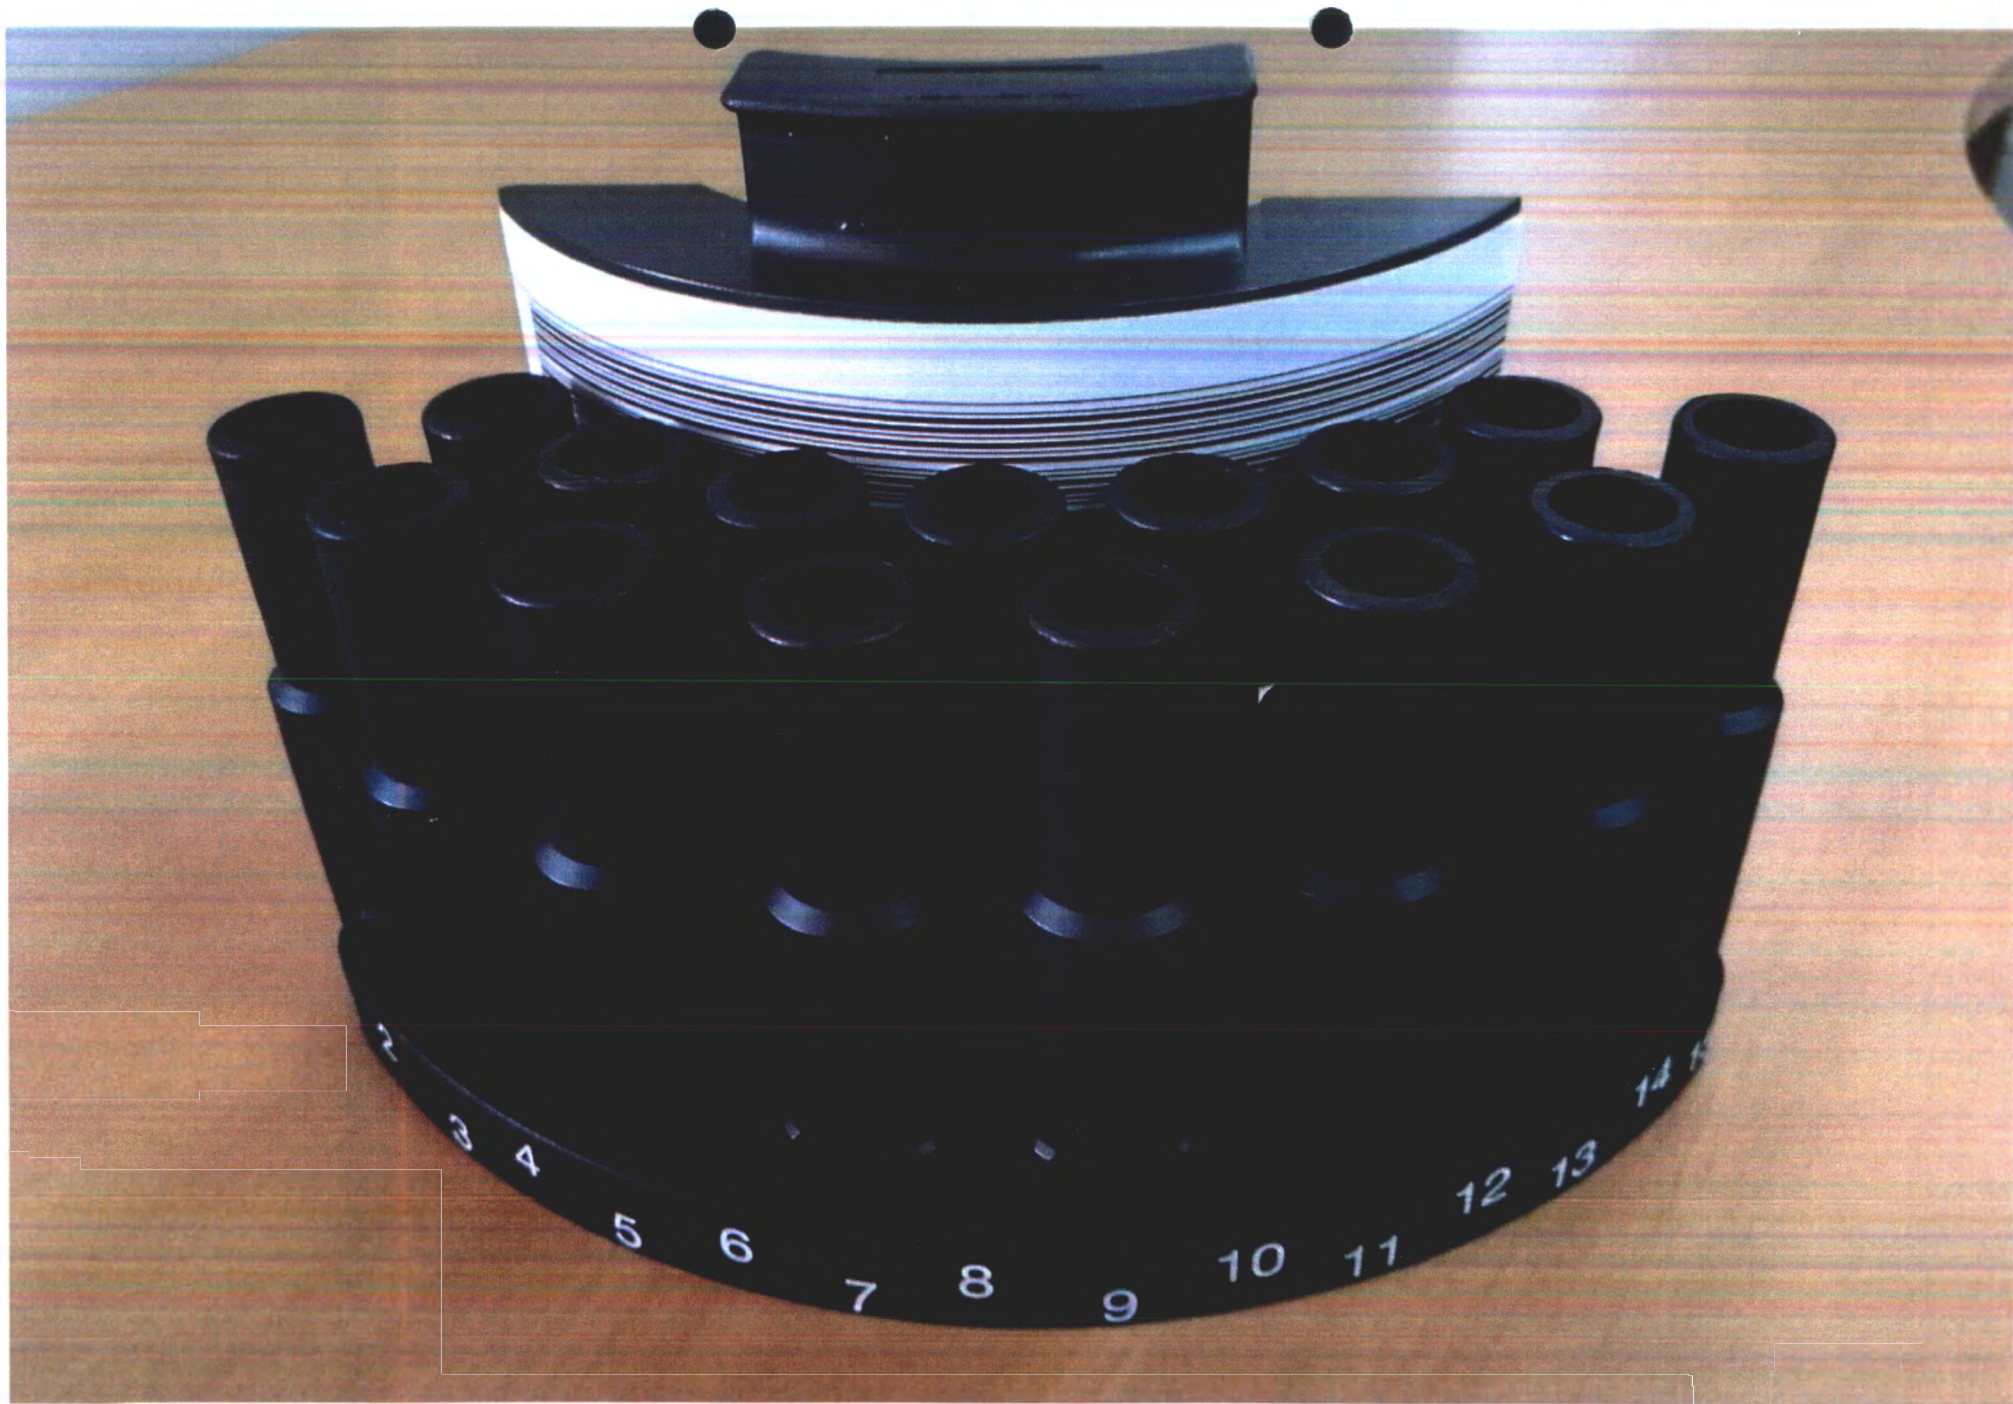


Рисунок 19 Сегмент ротора проб для микропробирок – не более 500 шт.

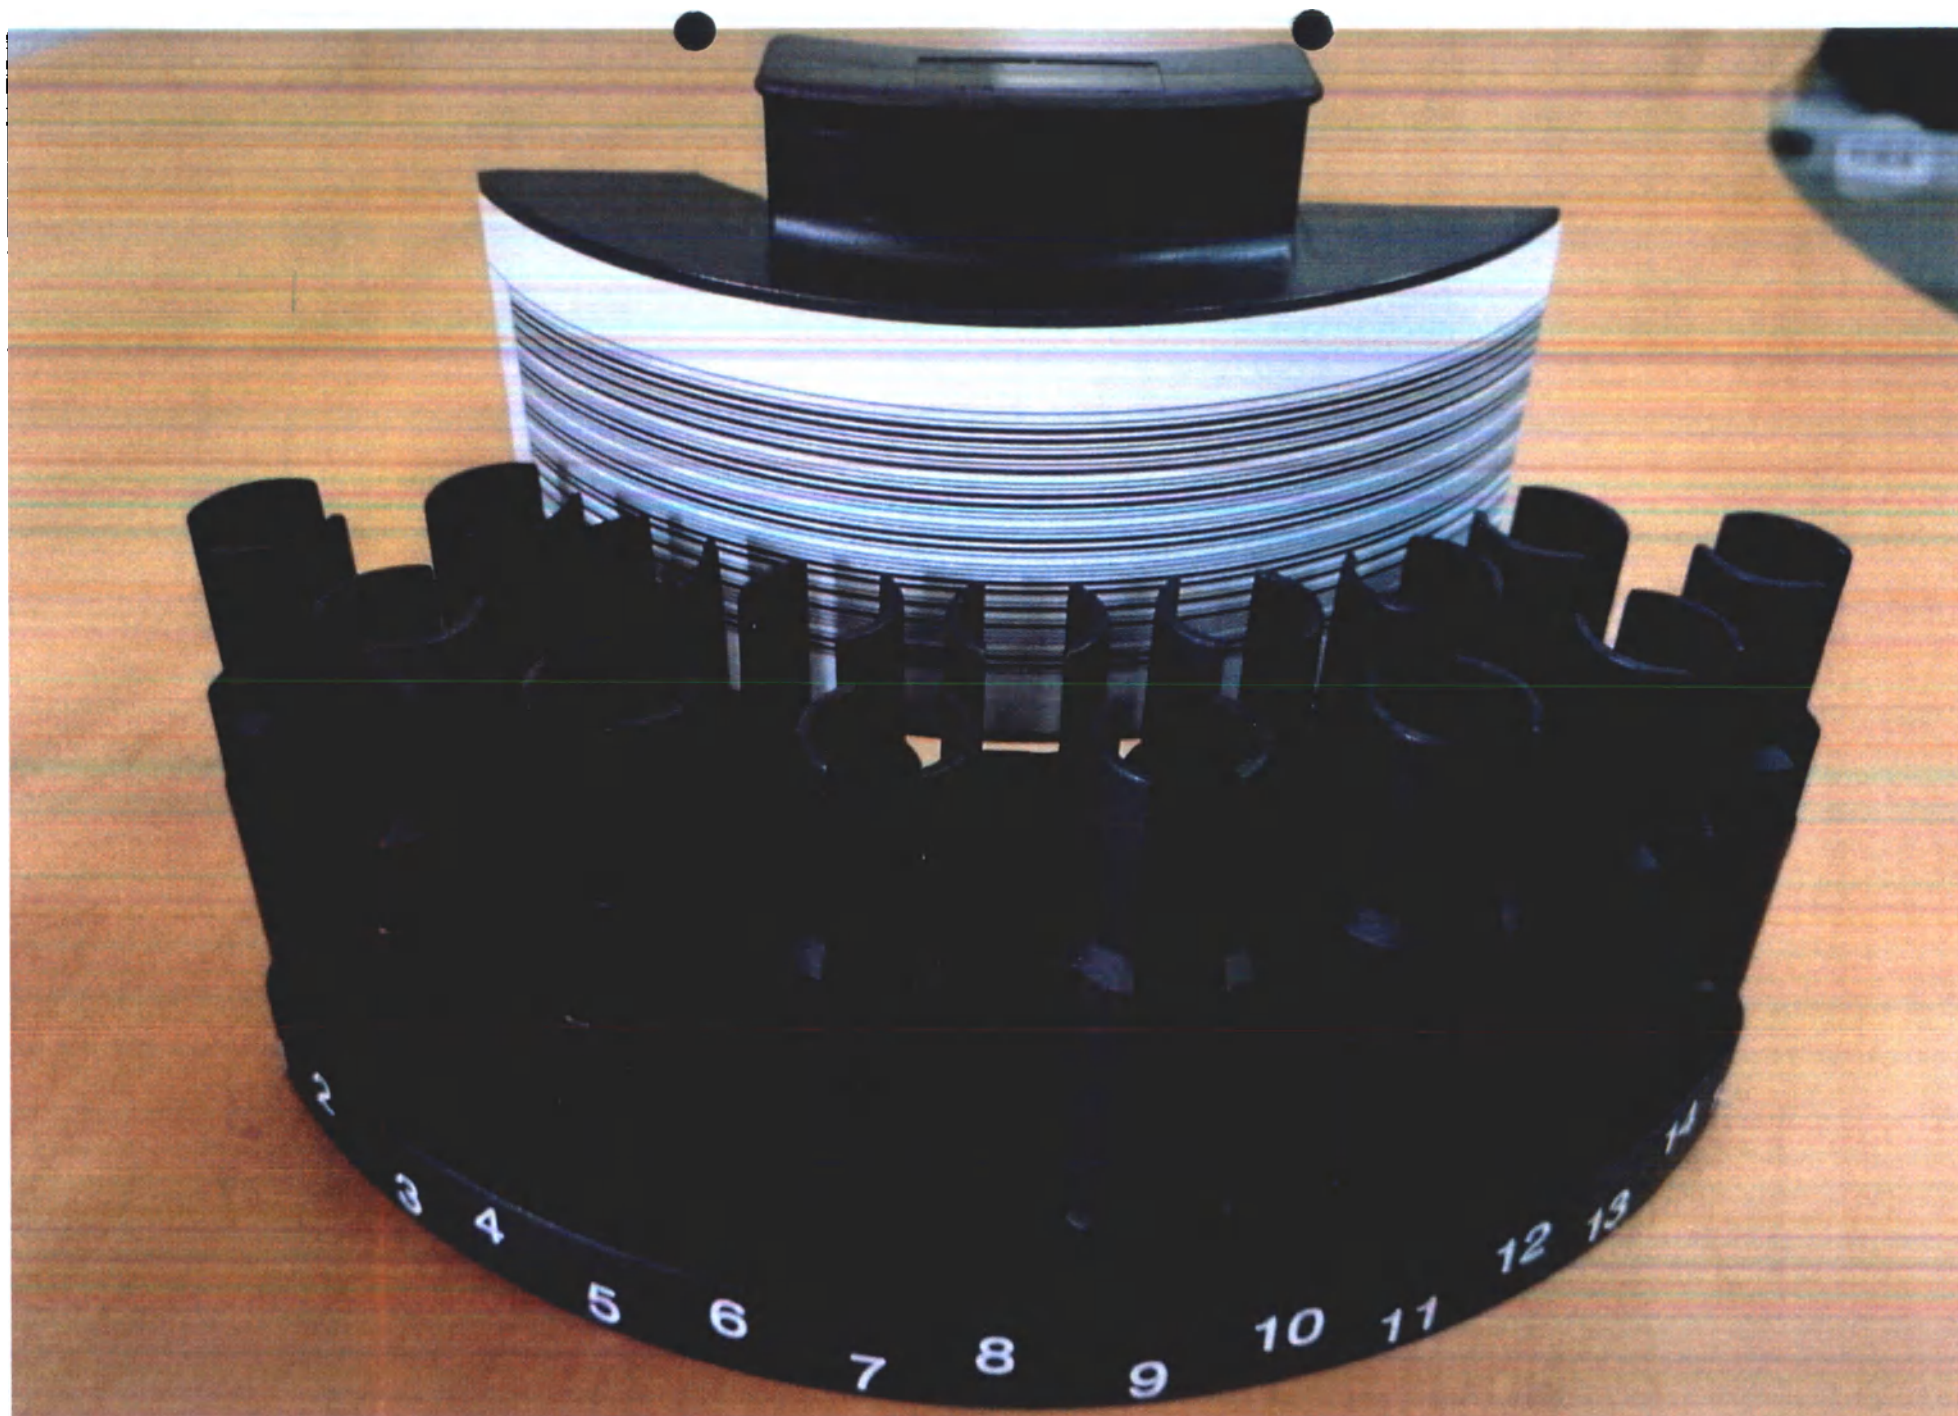


Рисунок 20 Сегмент ротора проб для чашечек – не более 500 шт.

SIEMENS Healthineers

LOT 11263501 **CONTENTS** 5 L

REF OUMT65 **04**
siemens.com/latu

UDI (01)00942768011436 GTIN
(10)11263501 BATCH/LOT
(17)231119 EXPIRY
(240)10446457 SMN
(422)276 ORIGIN DE

N Diluent

N DILUENT

For USA **RxOnly**

Intended Use: N Diluent is a solution for preparing dilutions for immunochemical determinations with the BN II and BN ProSpec® System.

Ingredients: Phosphate buffered saline.

Siemens Healthcare
Diagnostics Products GmbH
Emil-von-Behring-Str. 76
35041 Marburg/Germany
siemens-healthineers.com

11527365

11527365

15°C - 25°C IVD
CE

Рисунок 21 N системный разбавитель - 5 л.

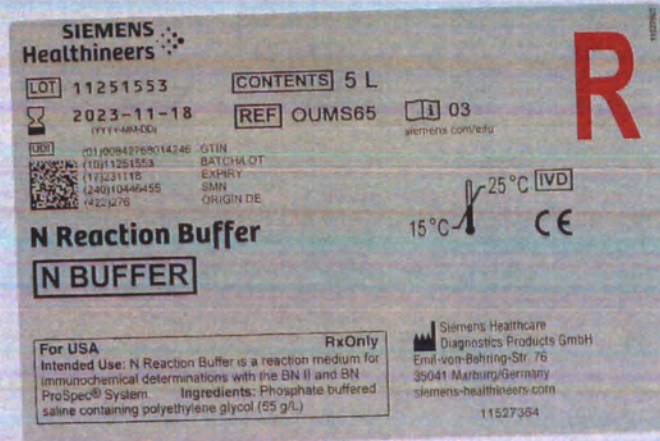


Рисунок 22 N реакционный буфер - 5 л.



Рисунок 23 Раствор очистительный SCS (6 флаконов по 5 мл), не более 50 шт.

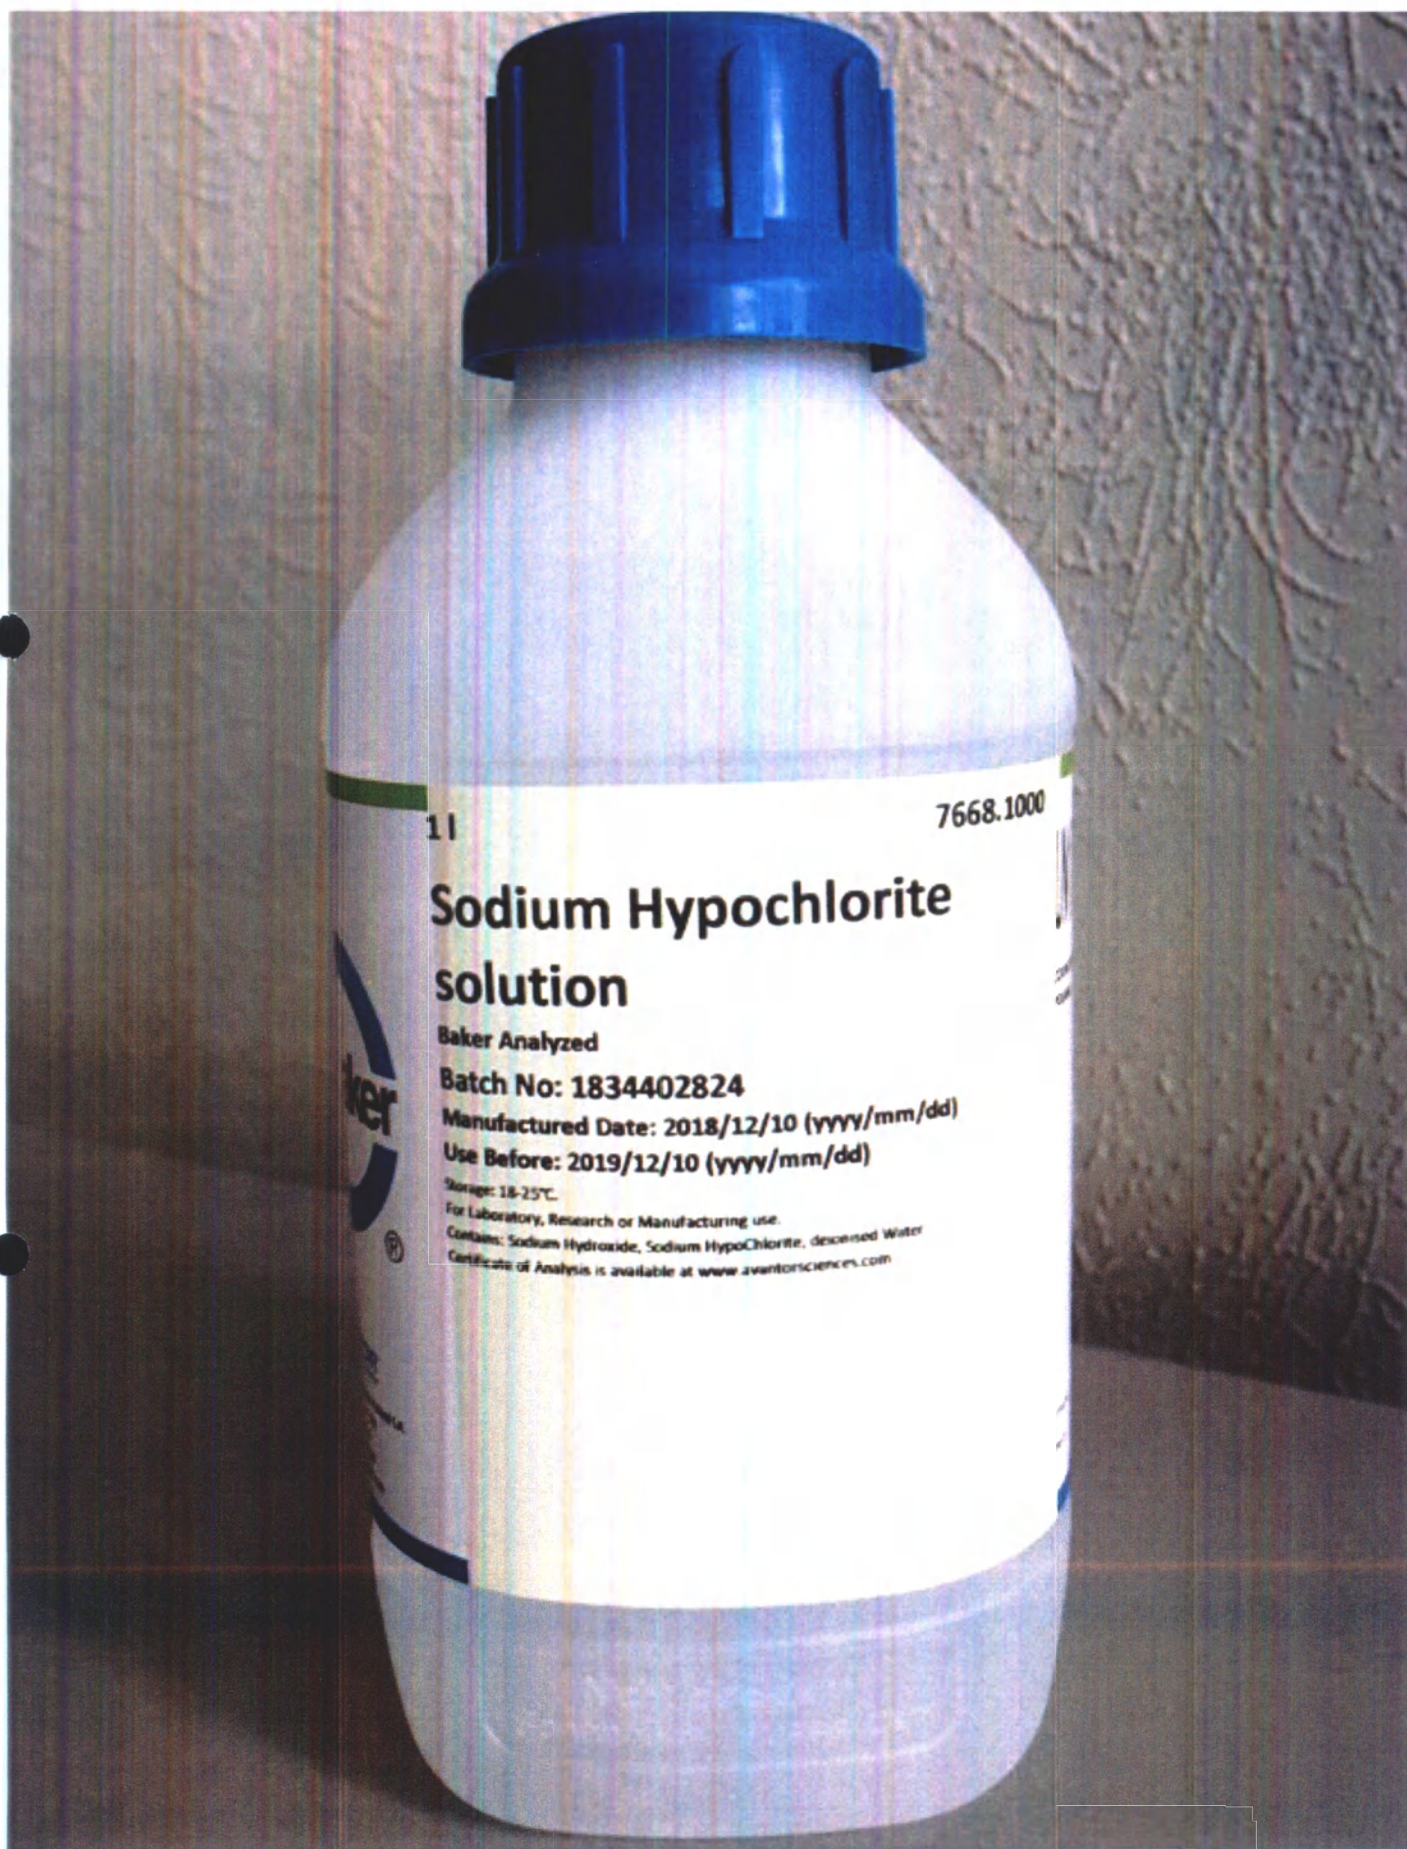


Рисунок 24 Раствор гипохлорита натрия - 1 л.



Принадлежности. Рисунок 1 Клавиатура - 1 шт.



Рисунок 27 Мышь компьютерная - 1 шт.

Datei:SIEME1, Satz:619-624
BIT ANALY #71888792
"51040"- "51030"



51 01



51 02



51 03



51 04



51 05



51 06

Рисунок 3 Лист со штрих-кодами - 1 шт.



Рисунок 4 Предохранители, не более 10 уп.

Ручной 5 Трѣм, не более 100 шт.



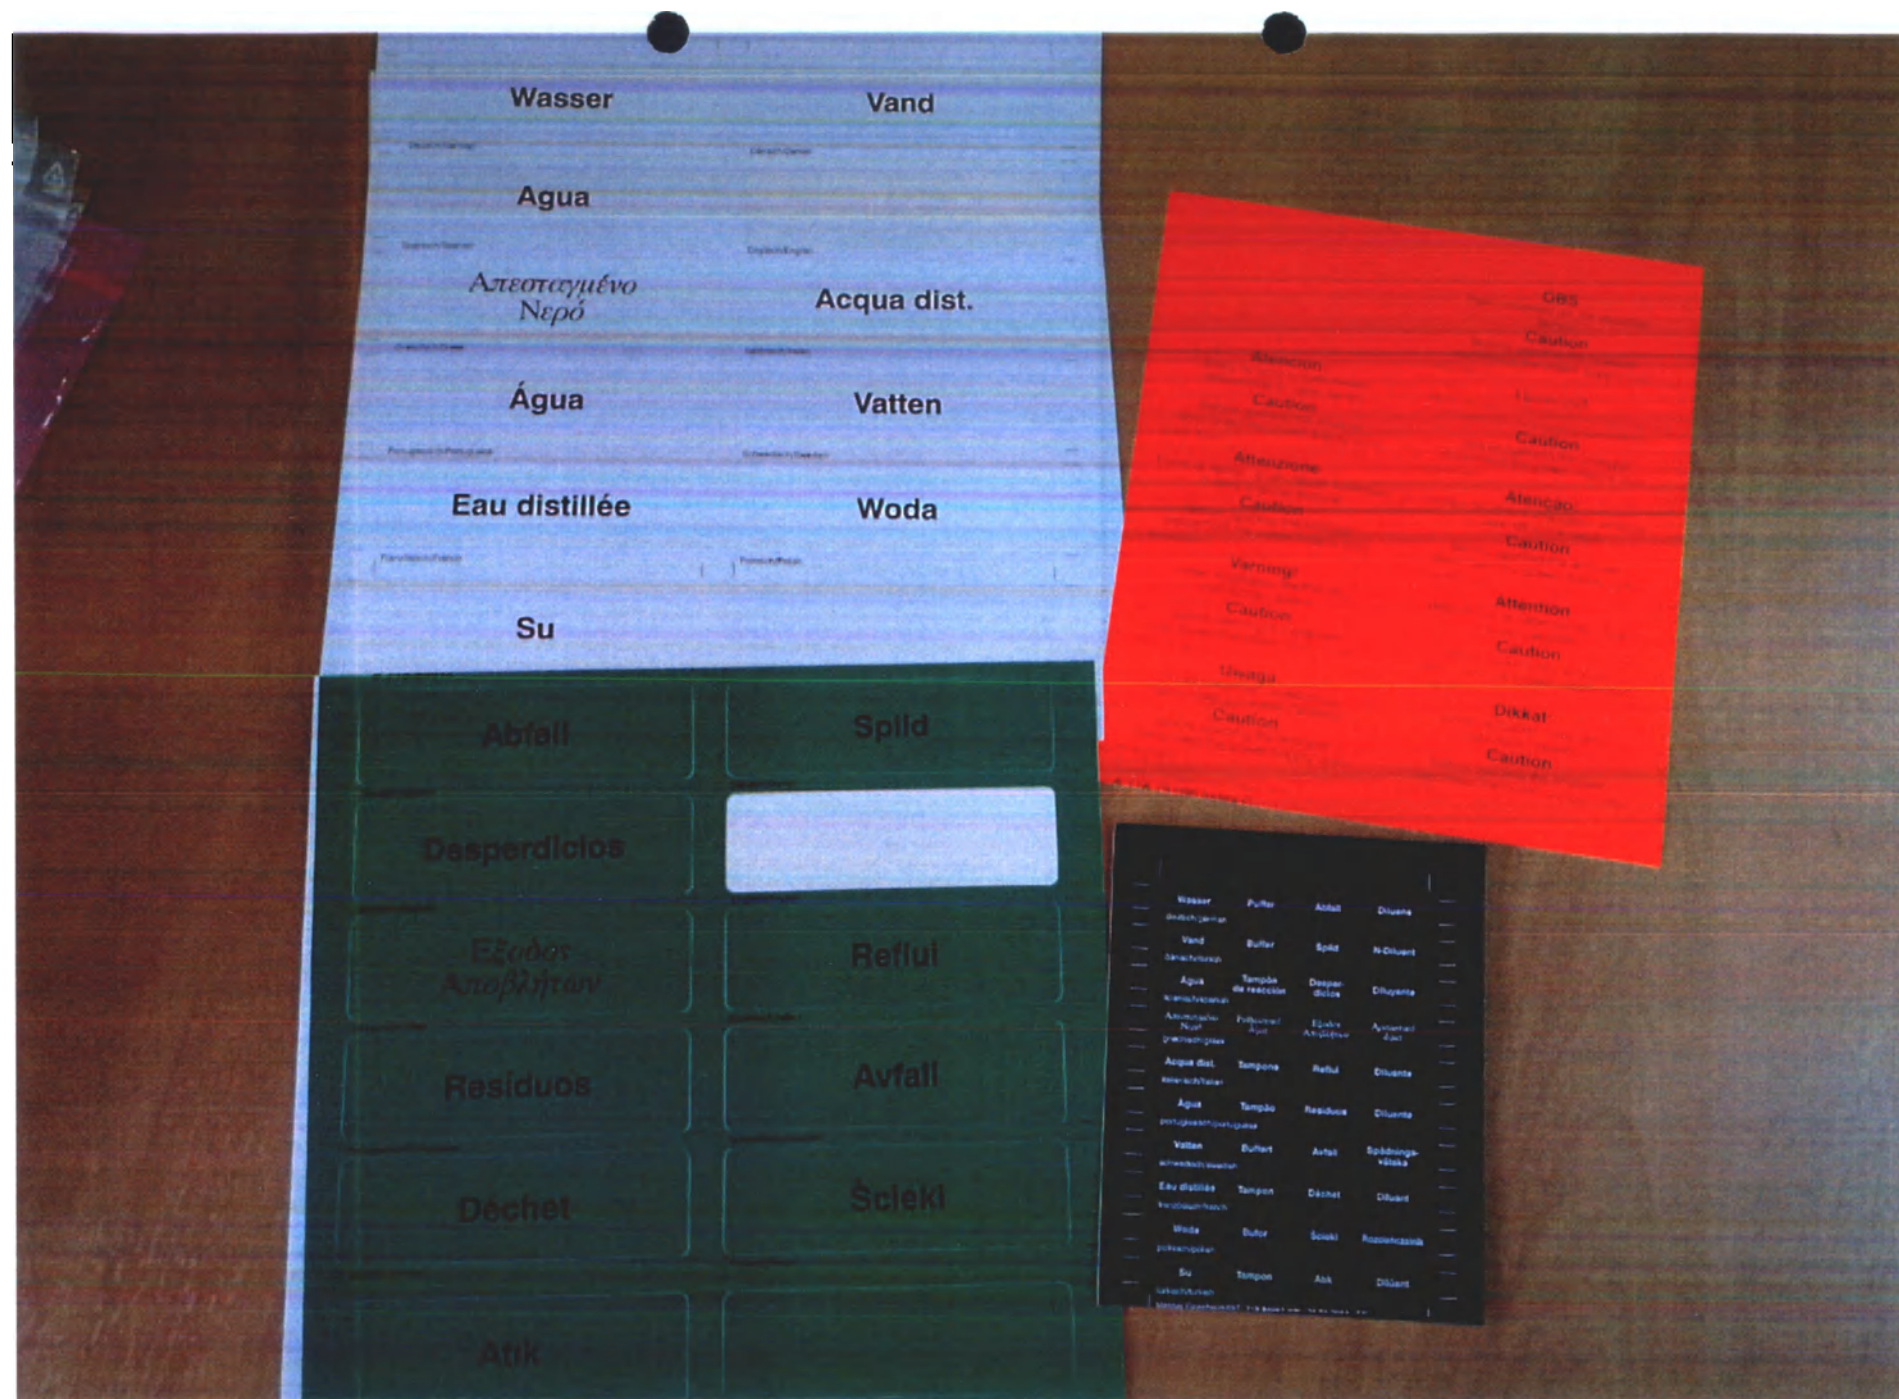


Рисунок 6 Предупреждающие наклейки, не более 300 шт.



Рисунок 7 Кюветные сегменты, не более 4000 шт.

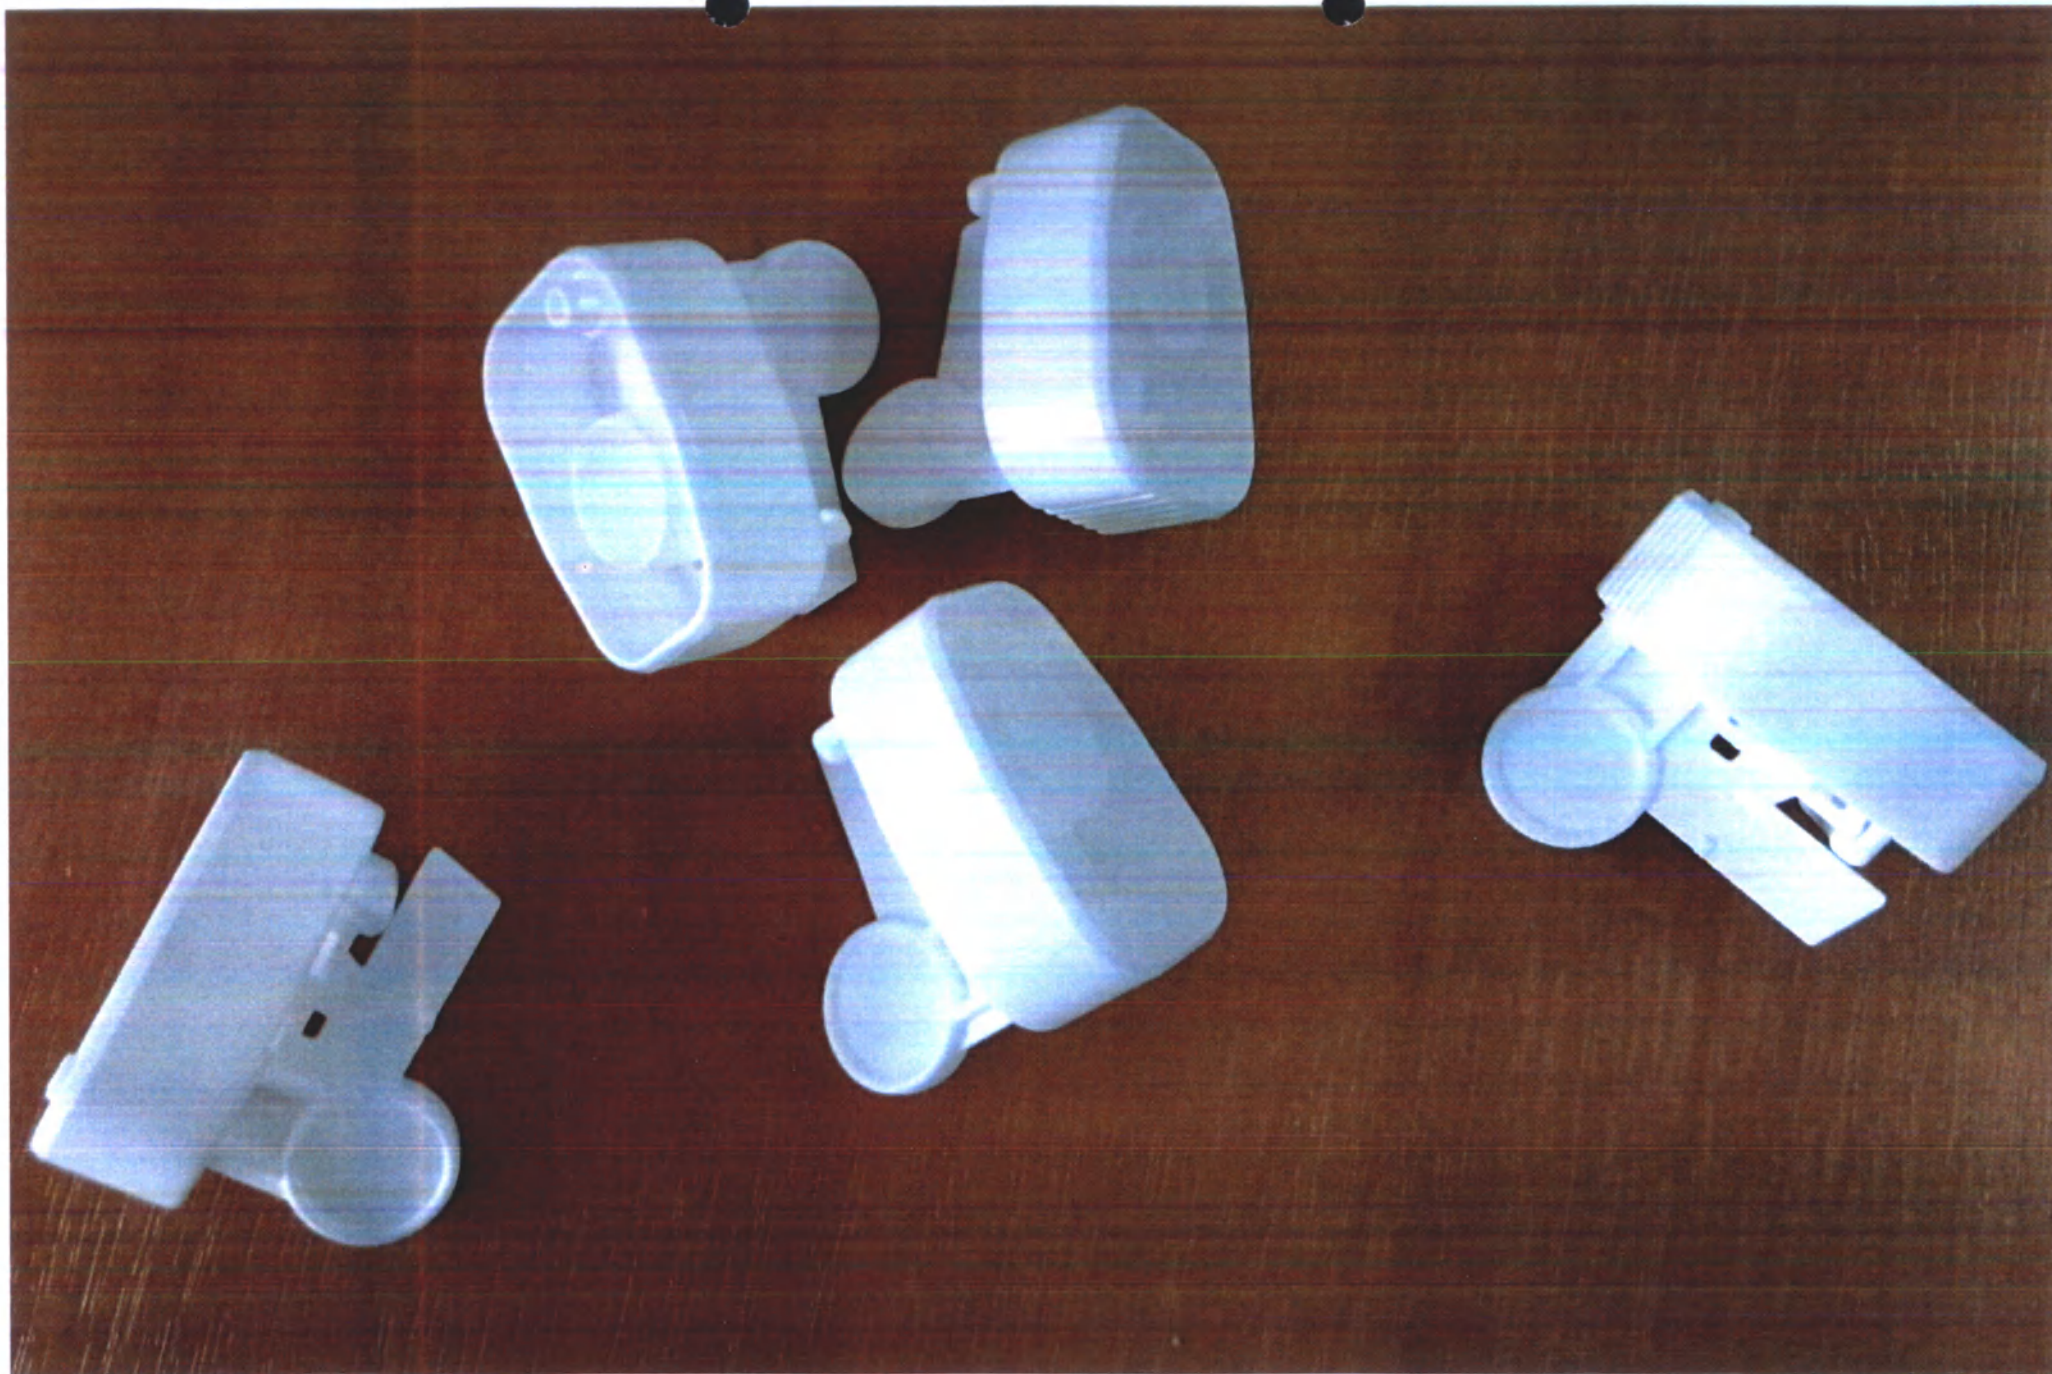


Рисунок 8 Крышки противоиспарительные для флаконов с реагентами - 100 шт.



Рисунок 9 Крышки противоиспарительные для флаконов с контрольными материалами - 50 шт.

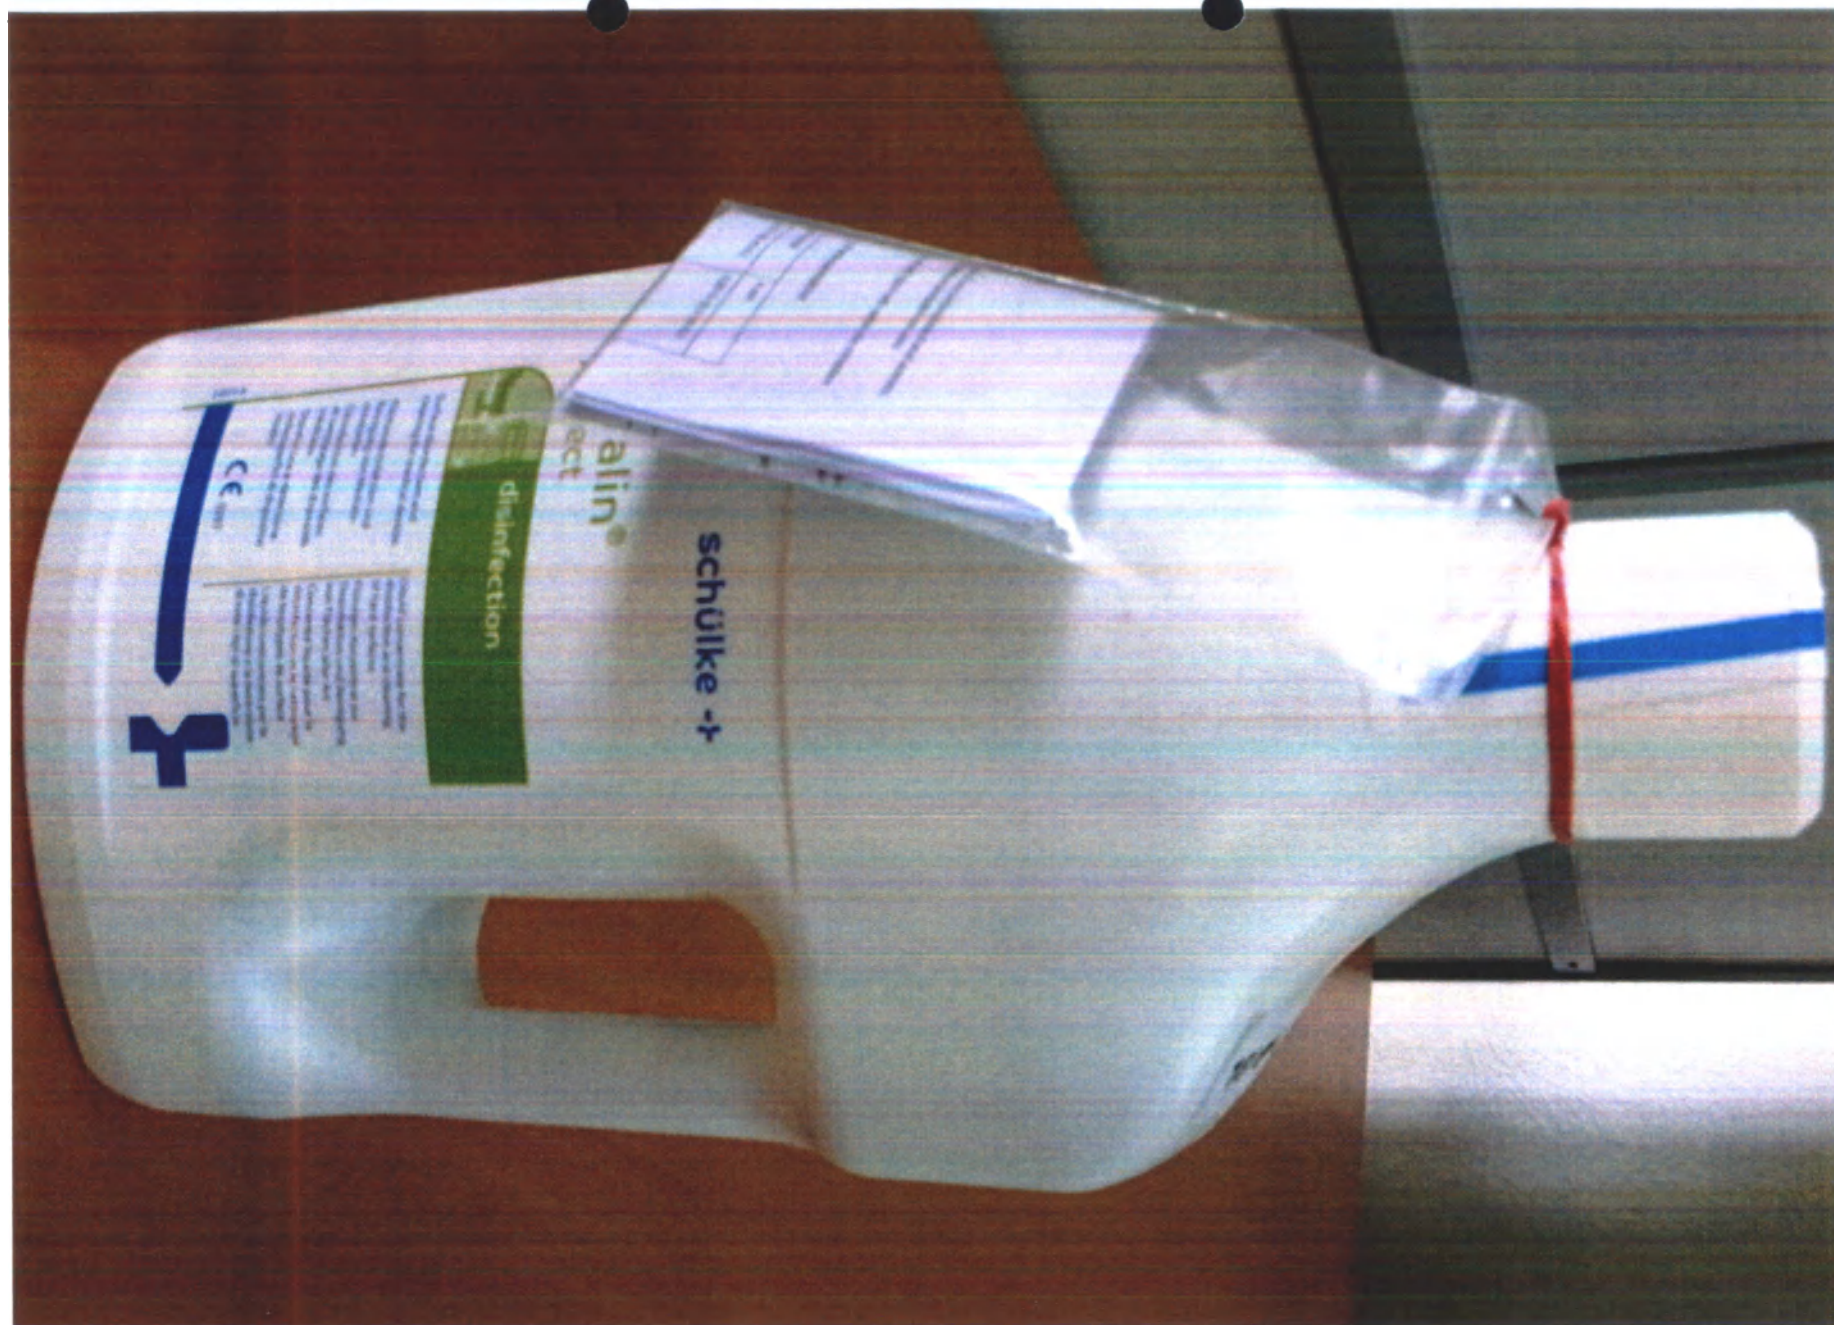


Рисунок 10 Раствор дезинфицирующий Терралин протект (свидетельство о государственной регистрации RU.77.99.88.002.E.021309.06.11 от 20.06.2011 г.)



Рисунок 11 Регулировочный инструмент для настройки оптического узла – 1 шт.

SIEMENS

Gerätebegleitstandard
Solid Standard

Instrument: BNP

Seriennummer :

191188

Bitwert in Dec :

8370



Рисунок 12 Твердый нефелометрический стандарт – 1 шт.

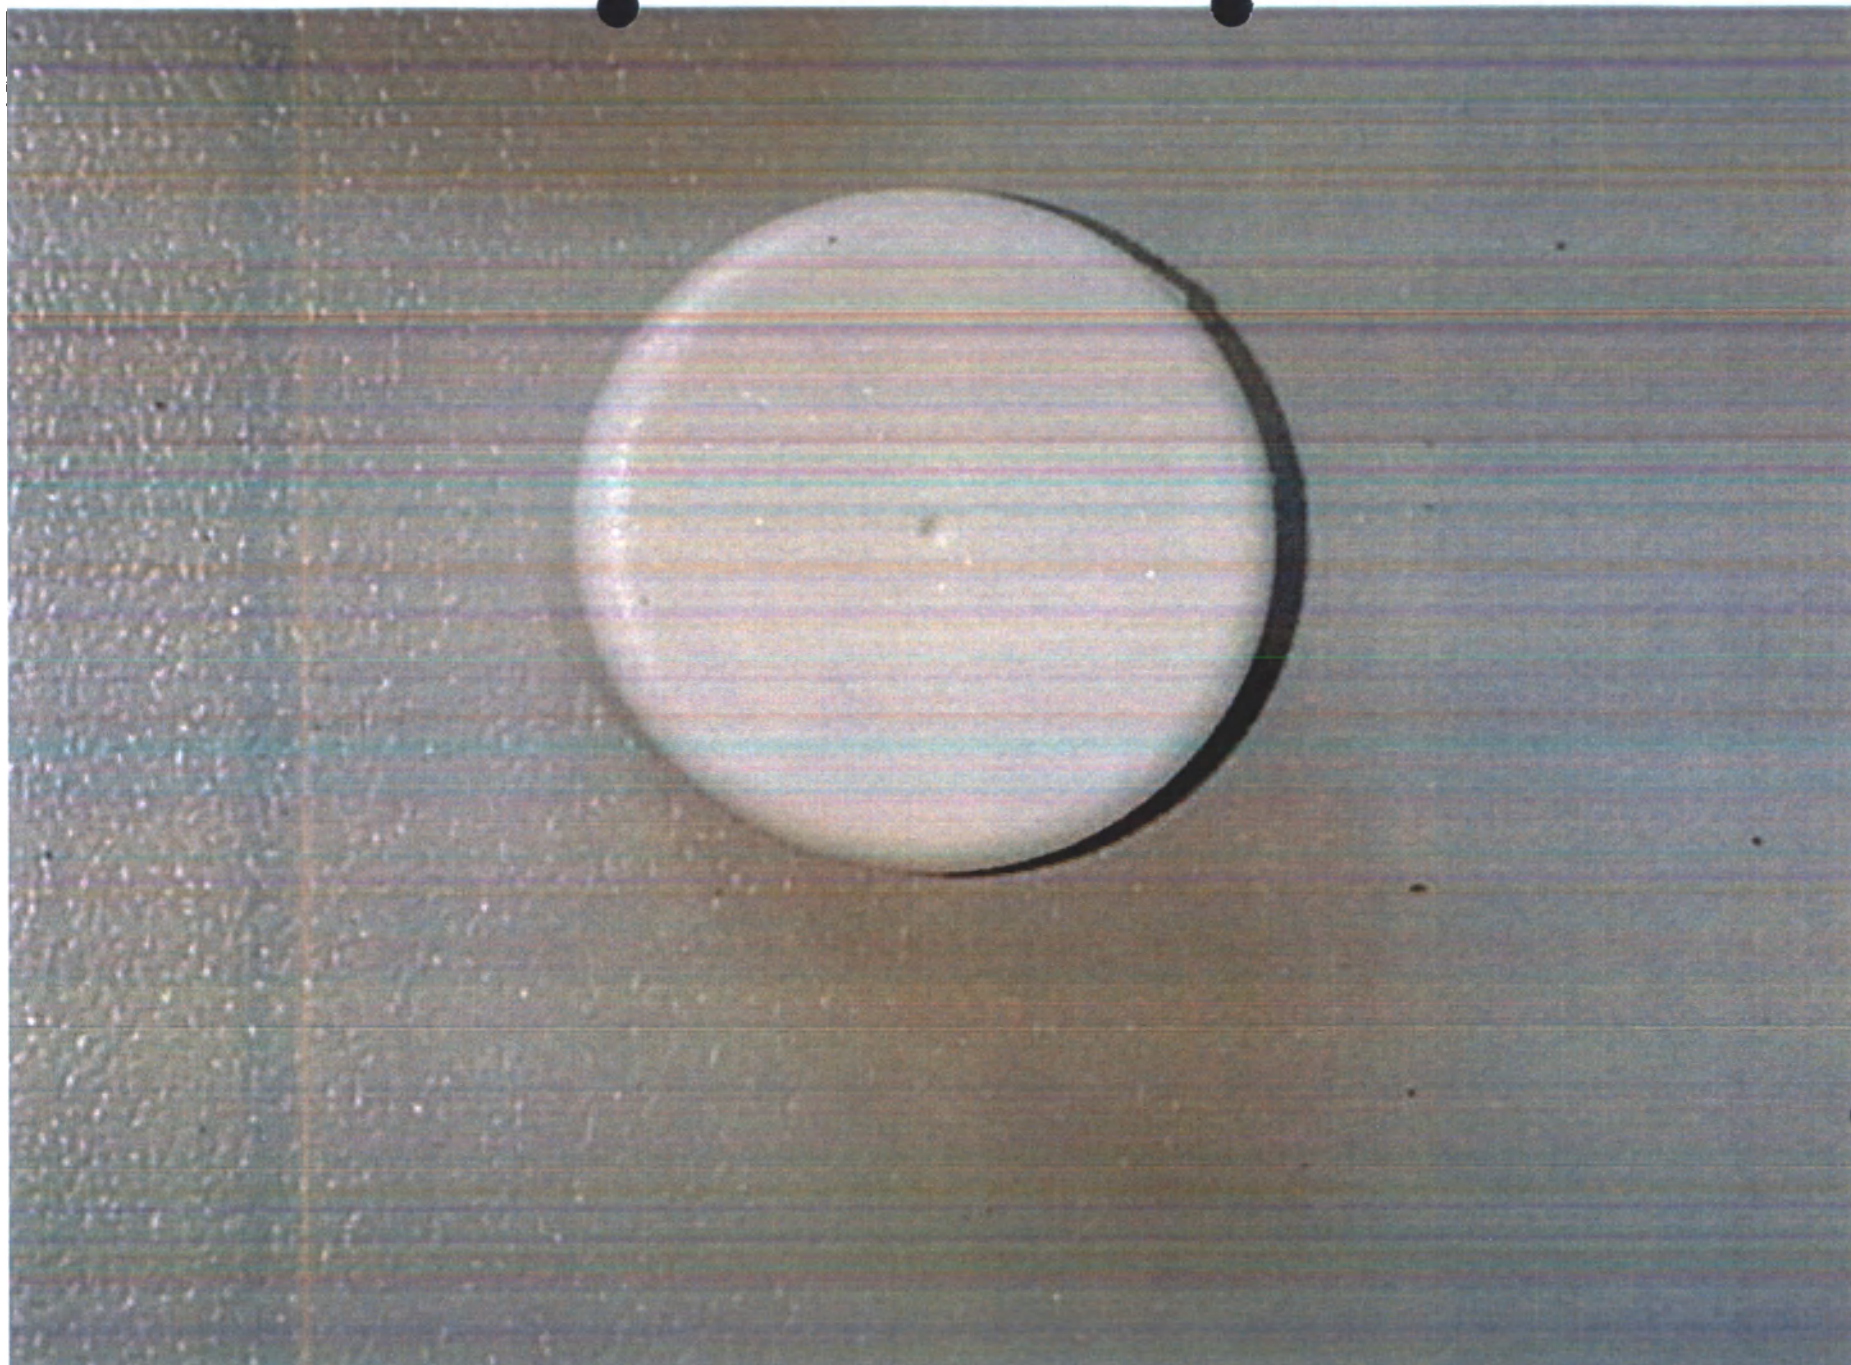


Рисунок 13 Регулировочный инструмент для помещения в сегмент ротора образцов - 2 шт.

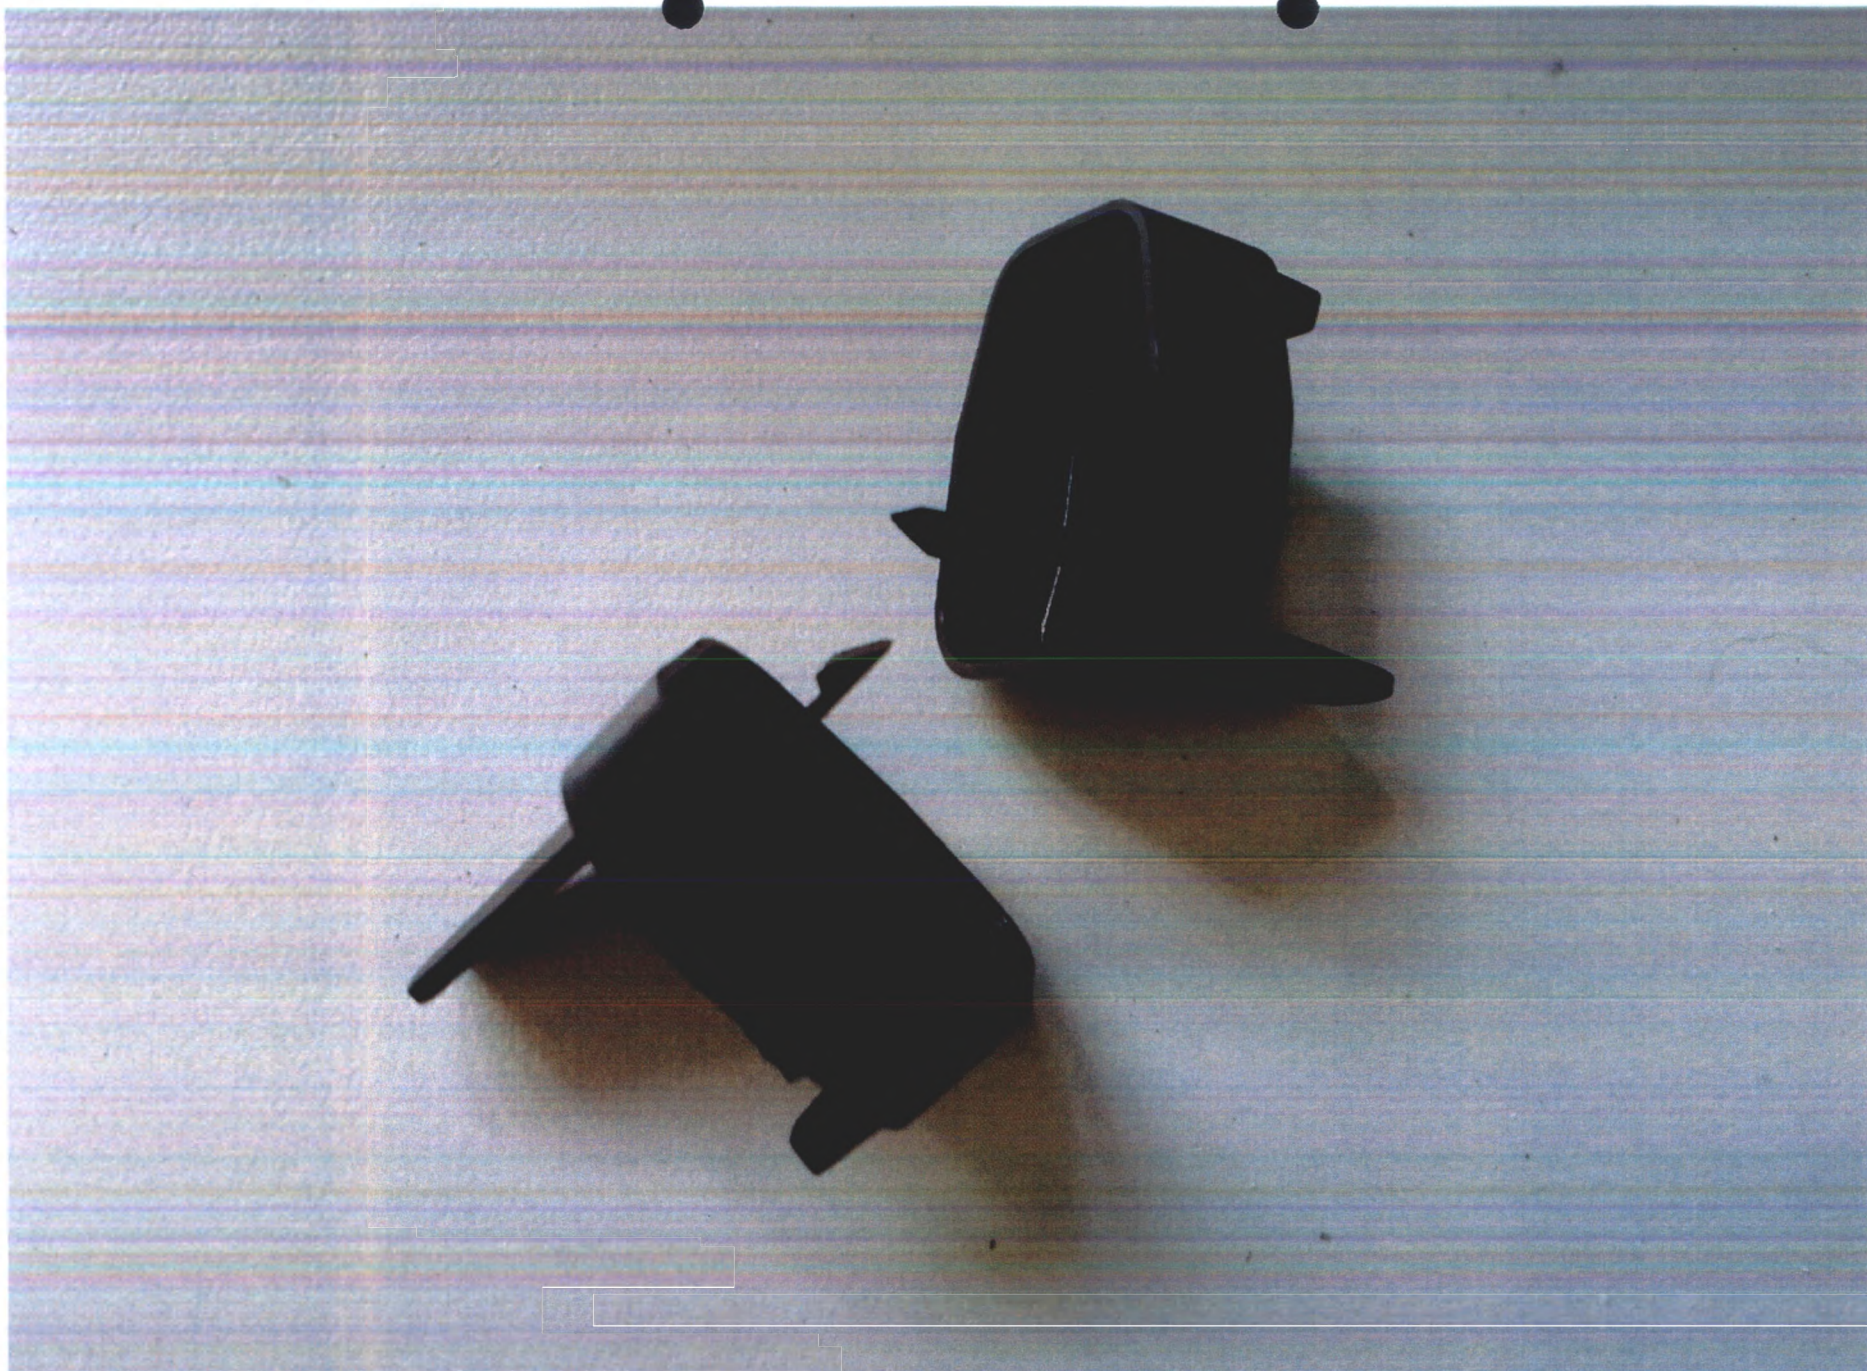


Рисунок 14 Регулировочный инструмент для помещения в сегмент ротора реагентов – 2 шт.



Рисунок 15 Кабели соединительные для подключения системы к периферийным устройствам, не более 25 шт.

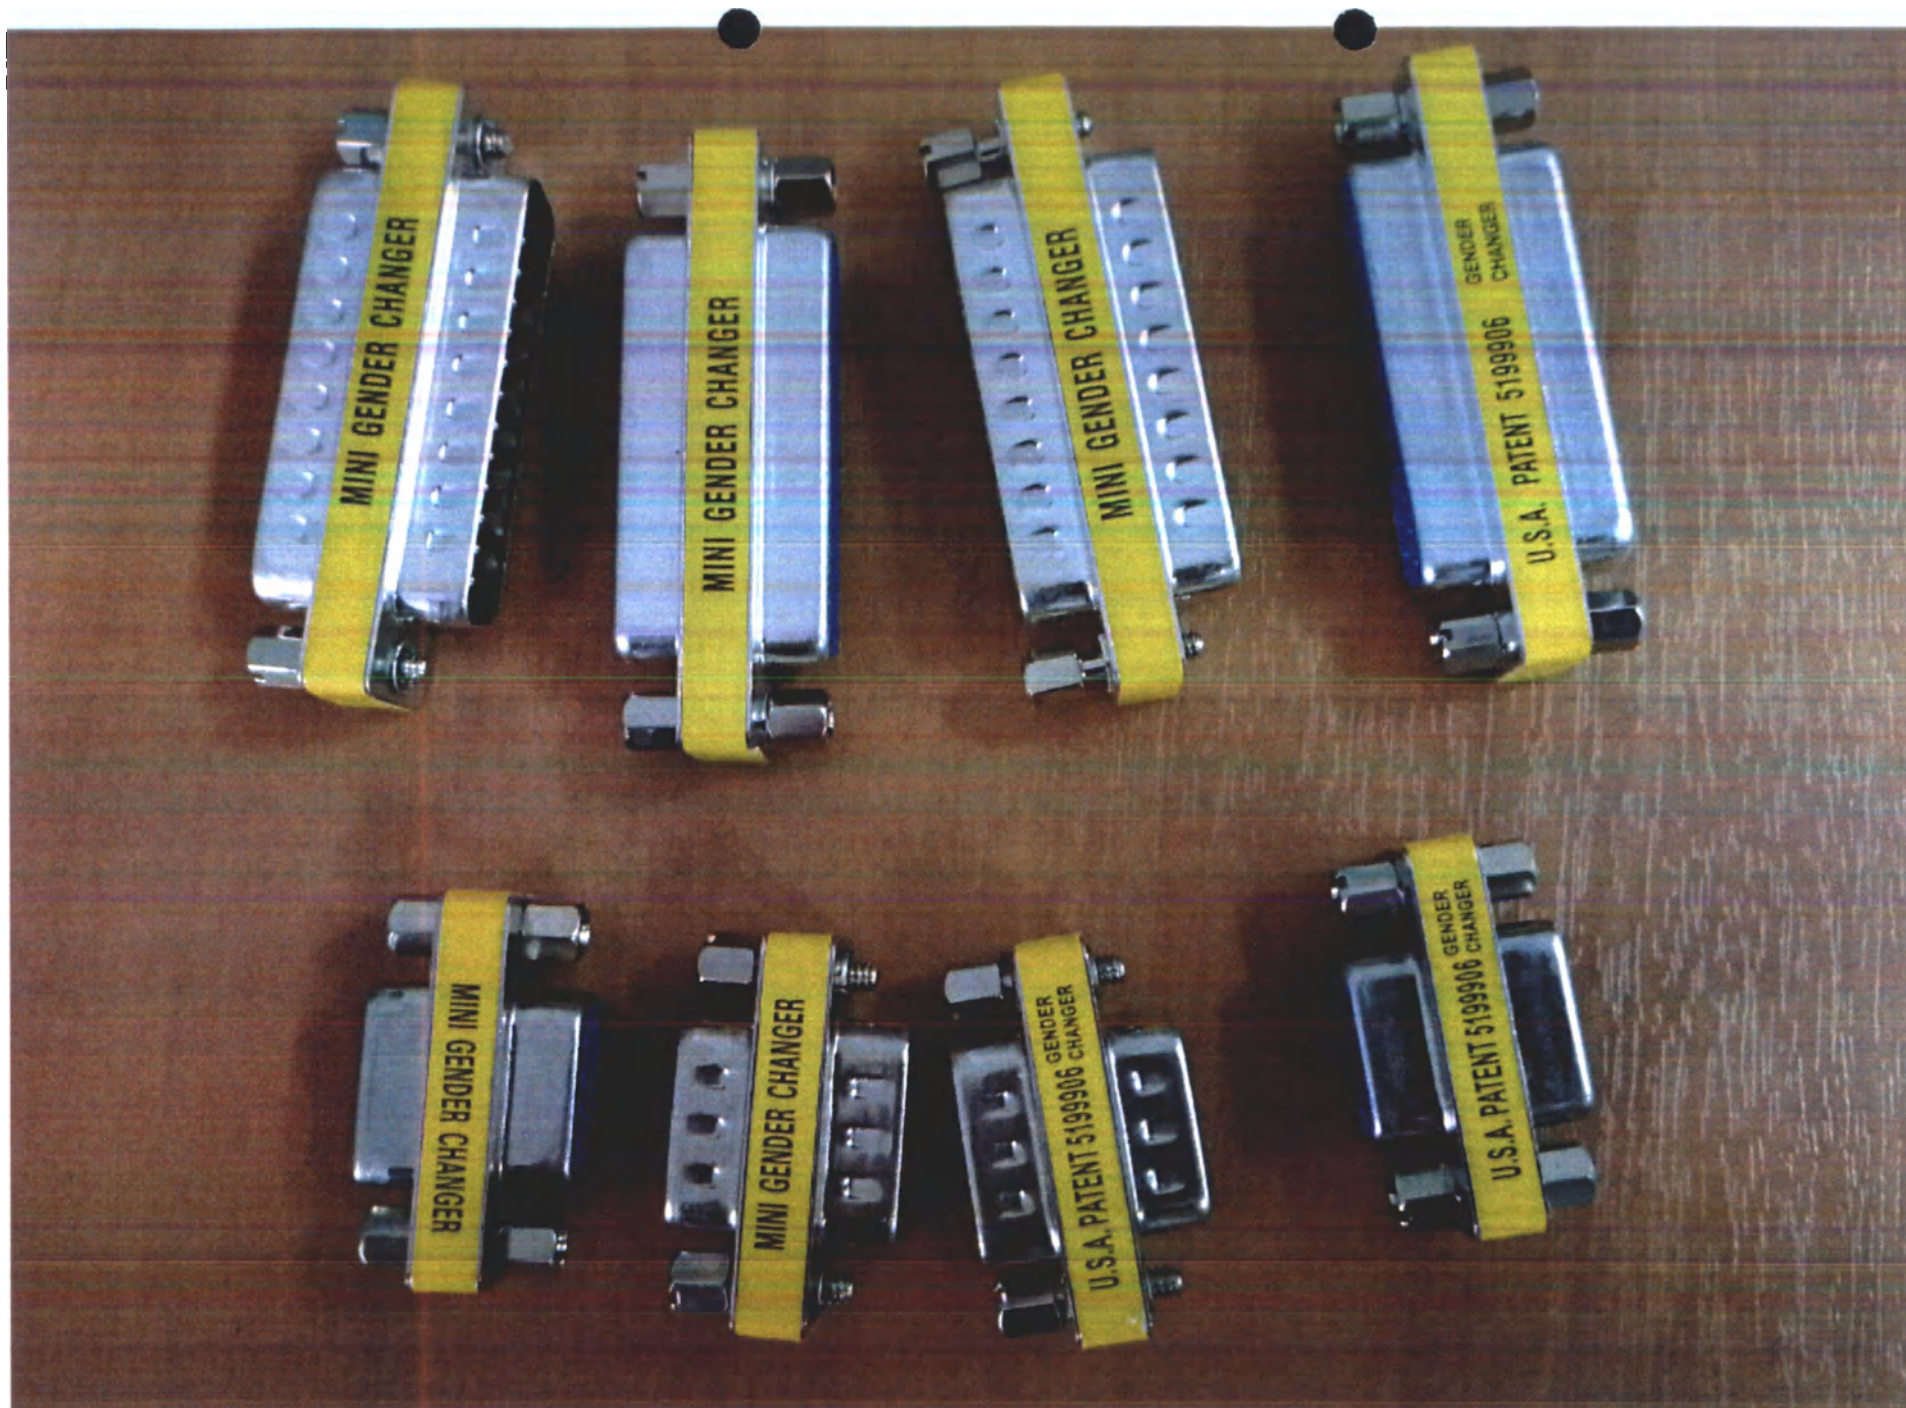


Рисунок 16 Дополнительные адаптеры для кабелей соединительных, не более 25 шт.

SIEMENS
Healthineers

SMN 11239861

REF OVLI02

Atellica® NEPH 630 System

SYSTEM

1/2

CONTENTS

1 x ANALYZER

Made in Germany

Siemens Healthcare
Diagnostics Products GmbH
Emil-von-Behring Str. 76
35041 Marburg
Germany
siemens-healthineers.com

2021-10

11418324_000_00



Atellica NEPH 630™ System

2023-05-02



(01) 00630414006239
(20) 01
(21) 231851
(240) 11239861
(422) 276

GTIN
REV A
SERIAL SN
SMN
ORIGIN DE



Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH
Emil-von-Behring Str. 76, 35041 Marburg, Germany
Made in Germany

11352705 Rev. B

Упаковка. Рисунок 1 Фото маркировки транспортной упаковки (1/2)

231851

SIEMENS
Healthineers

SMN 11239861

Atellica® NEPH 630 System

REF OVLI02

SYSTEM

2/2

CONTENTS

1 x COMPUTER

1 x MANUALS

ACCESSORIES

Made in Germany
Siemens Healthcare
Diagnostics Products GmbH
Emil-von-Behring Str. 76
35041 Marburg
Germany
siemens-healthineers.com



2021-10

11418325_000_00

Рисунок 2 Фото маркировки транспортной упаковки (2/2)

Система для количественного определения белков Atellica NEPH 630, с принадлежностями

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2020/11966 от 18.09.2020


Страна производства: Германия

Производитель, дата производства, серийный номер и др.
символы указаны на основной маркировке изделия

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 96

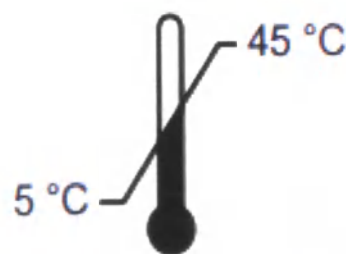

100/120/230 В

500 В А

50/60 Гц

Маркировка. Рисунок 1 Макет маркировки для Российской Федерации, который будет наноситься на медицинское изделие «Система для количественного определения белков Atellica NEPH 630, с принадлежностями»

Всего прошито и пронумеровано
44 листа (ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»

