

УТВЕРЖДАЮ

Супервайзер по евразийской
процедуре регистрации

ООО «Джонсон & Джонсон»
Рыбакова А.Н.



«20» декабря 2023 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

Раствор многофункциональный дезинфицирующий ACUVUE® RevitaLens

2023 г.

SEE YOUR EYE CARE
PROFESSIONAL ANNUALLY



Lens case care instructions inside.

Ask your eye care professional what
makes ACUVUE™ RevitaLens a great
choice for exceptional disinfection and
all-day comfort.

Product of China
Manufactured By:
Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.
Santa Ana, CA 92705 USA
Questions or comments?
Please call us at 1-800-347-5005
www.acuvue.com

© Johnson & Johnson Vision Care
Companies 2020



2. Раствор многофункциональный дезинфицирующий ACUVUE® RevitaLens в комплекте с контейнером для линз, объем 60 мл –потребительская упаковка (вид сбоку).

ACUVUE™ RevitaLens ADVANTAGES



DUAL-DISINFECTING TECHNOLOGY
effectively kills harmful bacteria.



ALL-DAY COMFORT



GREAT MATCH WITH LEADING CONTACT LENSES
Including ACUVUE® Contact Lenses.



EASY-USE FLIP CAP!

3. Раствор многофункциональный дезинфицирующий ACUVUE® RevitaLens в комплекте с контейнером для линз, объем 60 мл –потребительская упаковка (вид сзади).

See insert for full instructions and safety information.

WARNING: Keep out of reach of children. Failure to discard solution from lens case after each use or use of water to care for your lenses may lead to contamination, resulting in eye injury and potential loss of vision. See accompanying instructions for additional important safety information.

TAMPER EVIDENT: For your protection, every bottle has a safety seal around the bottle cap and neck. Do not use product if seal is damaged or missing at time of purchase. Remove seal before use.

PRECAUTIONS: Avoid exposure to water when wearing and caring for your contact lenses. Keep cap closed when not in use. Use before expiration date printed on carton and bottle. Discard any remaining solution 90 days after opening.

INGREDIENTS: ACUVUE™ RevitaLens Solution is a sterile, buffered aqueous solution with alexidine dihydrochloride 0.00016% and polyquaternium-1 0.0003% as preservatives/ disinfectants, boric acid, sodium borate, TETRONIC 904, edetate disodium, sodium citrate, sodium chloride and purified water.

CONTRAINDICATION: If you are allergic to any ingredient in this product, DO NOT USE.

Store at room temperature. Do not freeze.

TETRONIC is a trademark of BASF Corporation

No. 94267HZ

4. Раствор многофункциональный дезинфицирующий ACUVUE® RevitaLens в комплекте с контейнером для линз, объем 60 мл –потребительская упаковка (вид сбоку).

USE ONLY IF SAFETY SEAL ON BOTTLE IS INTACT

ACUVUE
RevitaLens

MULTI-PURPOSE
DISINFECTING
SOLUTION

2 FL OZ (60 ML)
STERILE SOLUTION

**VALUABLE
COUPON
INSIDE**

LOT/EXP.:

ZJ04354
2024-01-09


5. Раствор многофункциональный дезинфицирующий ACUVUE® RevitaLens в комплекте с контейнером для линз, объем 60 мл –потребительская упаковка (вид сверху).



6. Раствор многофункциональный дезинфицирующий ACUVUE® RevitaLens в комплекте с контейнером для линз, объем 60 мл – общий вид флакона с крышкой FTC



7. Раствор многофункциональный дезинфицирующий ACUVUE® RevitaLens в комплекте с контейнером для линз, объем 60 мл – контейнер для линз (вид сверху)

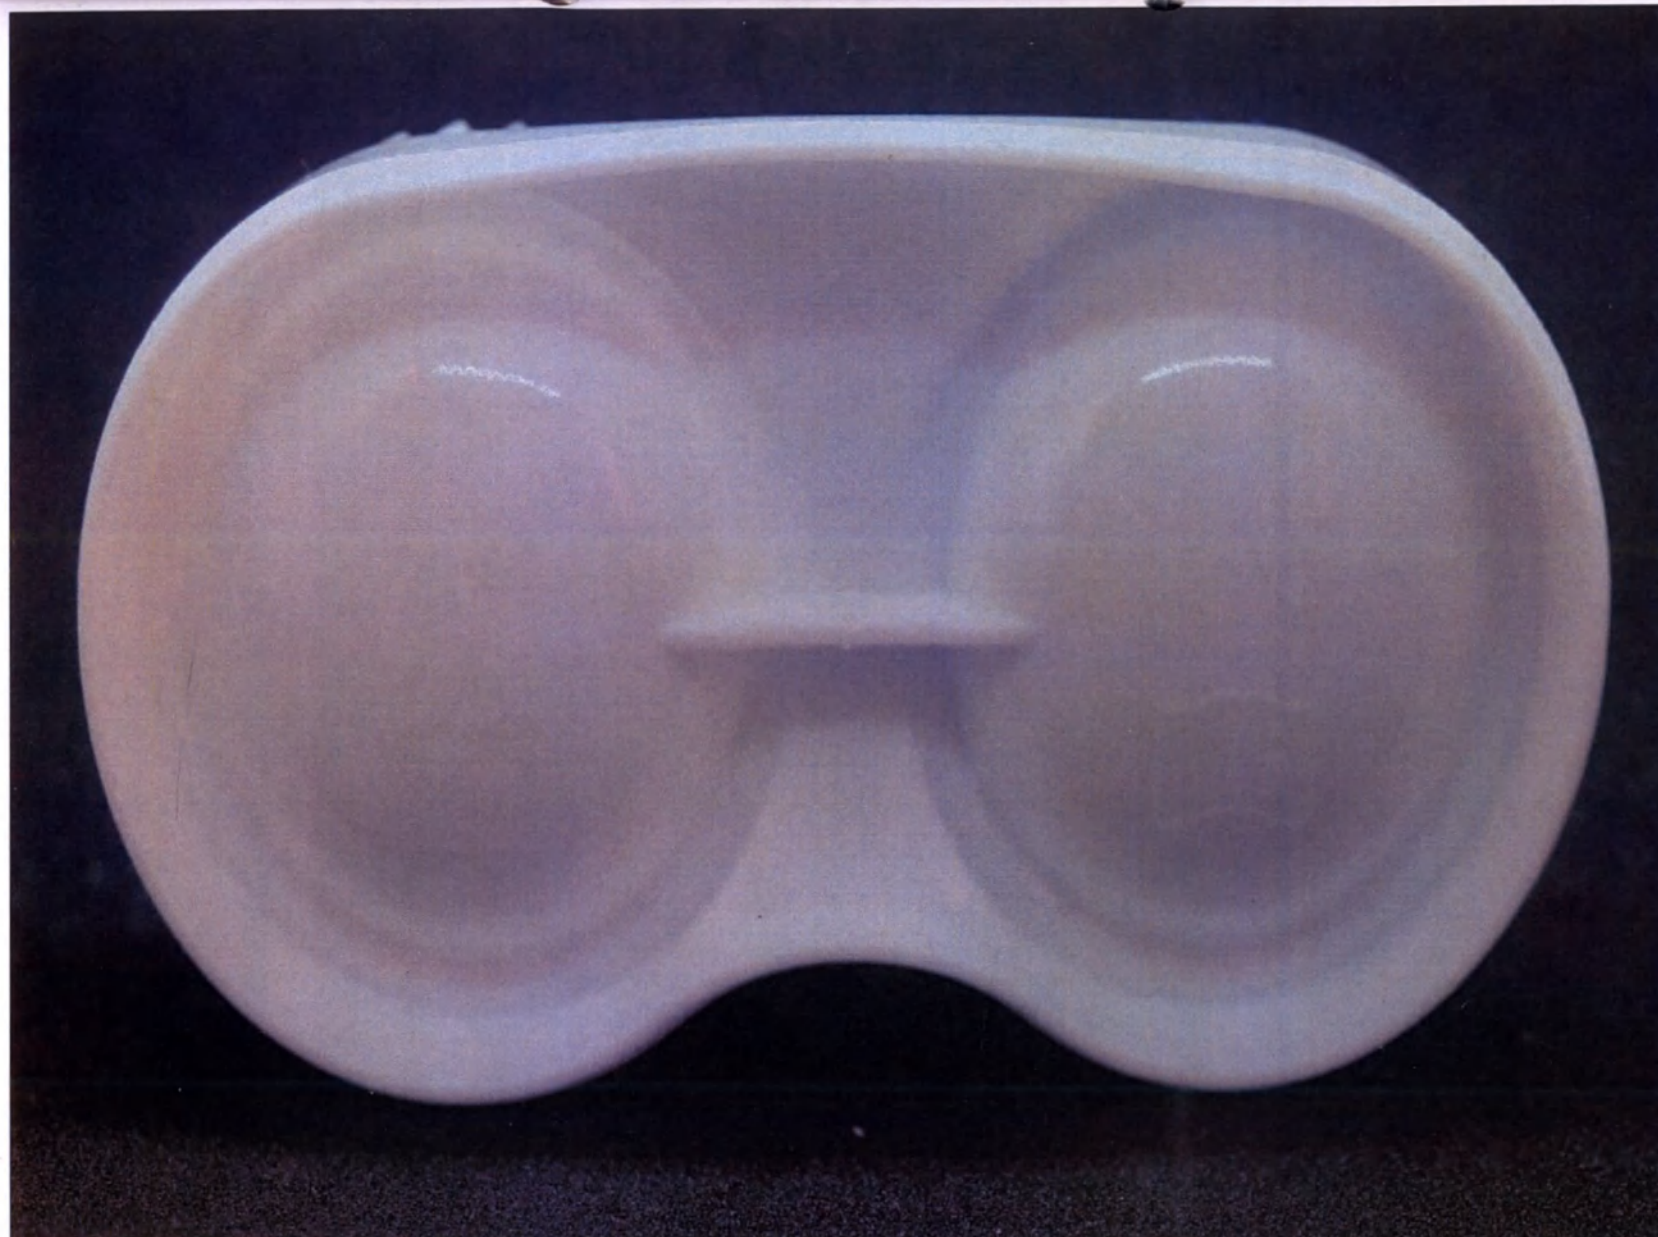

8. Раствор многофункциональный дезинфицирующий ACUVUE® RevitaLens в комплекте с контейнером для линз, объем 60 мл – контейнер для линз (вид снизу)

Просим распространить фотографические изображения «**Раствор многофункциональный дезинфицирующий ACUVUE® RevitaLens в комплекте с контейнером для линз, объем 60 мл**» на следующие варианты исполнения:

1. Раствор многофункциональный дезинфицирующий ACUVUE® RevitaLens в комплекте с контейнером для линз, объем 100 мл;
2. Раствор многофункциональный дезинфицирующий ACUVUE® RevitaLens в комплекте с контейнером для линз, объем 300 мл.
3. Раствор многофункциональный дезинфицирующий ACUVUE® RevitaLens в комплекте с контейнером для линз, объем 360 мл.

Рег.уд. № ФСЗ 2011/10818 от XX.XX.XXXX

STERILE A



5°C



Производитель



“АМО Ирландия”, Ирландия

AMO Ireland, Ireland

Block B, Liffey Valley Office Campus, Quarryvale
Co.Dublin, Ireland

Уполномоченный представитель производителя

ООО «Джонсон & Джонсон»

121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, к. 2


Тел. +7(495)580-7777, Факс: +7(495)580-7878

Адрес места производства

АМО (Ханчжоу) Ко., Лтд., 200, 4-я Авеню, зона
экономических и технологических разработок
Ханчжоу, 310018, Ханчжоу, Чжэцзян, КНР

AMO (Hangzhou) Co., Ltd., 200, 4th Avenue,
Hangzhou Economic & Technological Development Zone,
310018, Hangzhou, Zhejiang, People's Republic of China

9. Раствор многофункциональный дезинфицирующий ACUVUE® RevitaLens – макет
маркировки потребительской упаковки

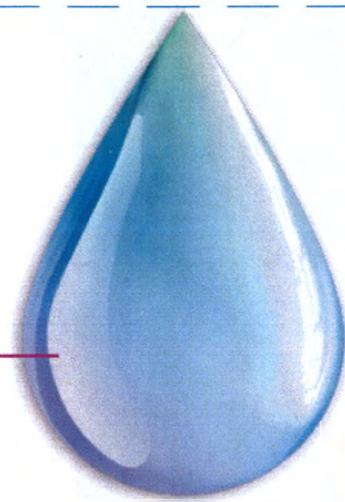

ACUVUE®

RevitaLens

Раствор многофункциональный
дезинфицирующий

ОТЛИЧНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТА
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ

Для всех типов мягких контактных линз,
включая силикон-гидрогелевые

60 мл

RU Для всех типов мягких контактных линз,
включая силикон-гидрогелевые

Меры предосторожности: Прочтите и сохраните инструкцию по
применению, в которой приведены все меры предосторожности.

- Не используйте, если защитное кольцо на флаконе повреждено или отсутствует.
- Храните при температуре 5-25°C.
- Не промывайте линзы или контейнер для линз водопроводной водой.

Состав: алексидин 0,00016 %, поликватерниум-1 0,0003 %, борная кислота, натрия борат декагидрат, тетроник 904, динатрия эдетат (ЭДТА), тринатрия цитрат дигидрат, натрия хлорид, вода очищенная.

Рег.уд. № ФСЗ 2011/10818 от XX.XX.XXXX

STERILE A



5°C



Производитель

"АМО Ирландия" Ирландия
AMO Ireland, Ireland, Block B, Liffey Valley Office Campus
Quarryvale, Co.Dublin, Ireland


Уполномоченный представитель производителя

ООО «Джонсон & Джонсон»
121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, к. 2
Тел. +7(495)580-7777, Факс: +7(495)580-7878


LOT



10. Раствор многофункциональный дезинфицирующий ACUVUE® RevitaLens в комплекте с контейнером для линз, объем 60 мл – макет маркировки флакона с крышкой FTC

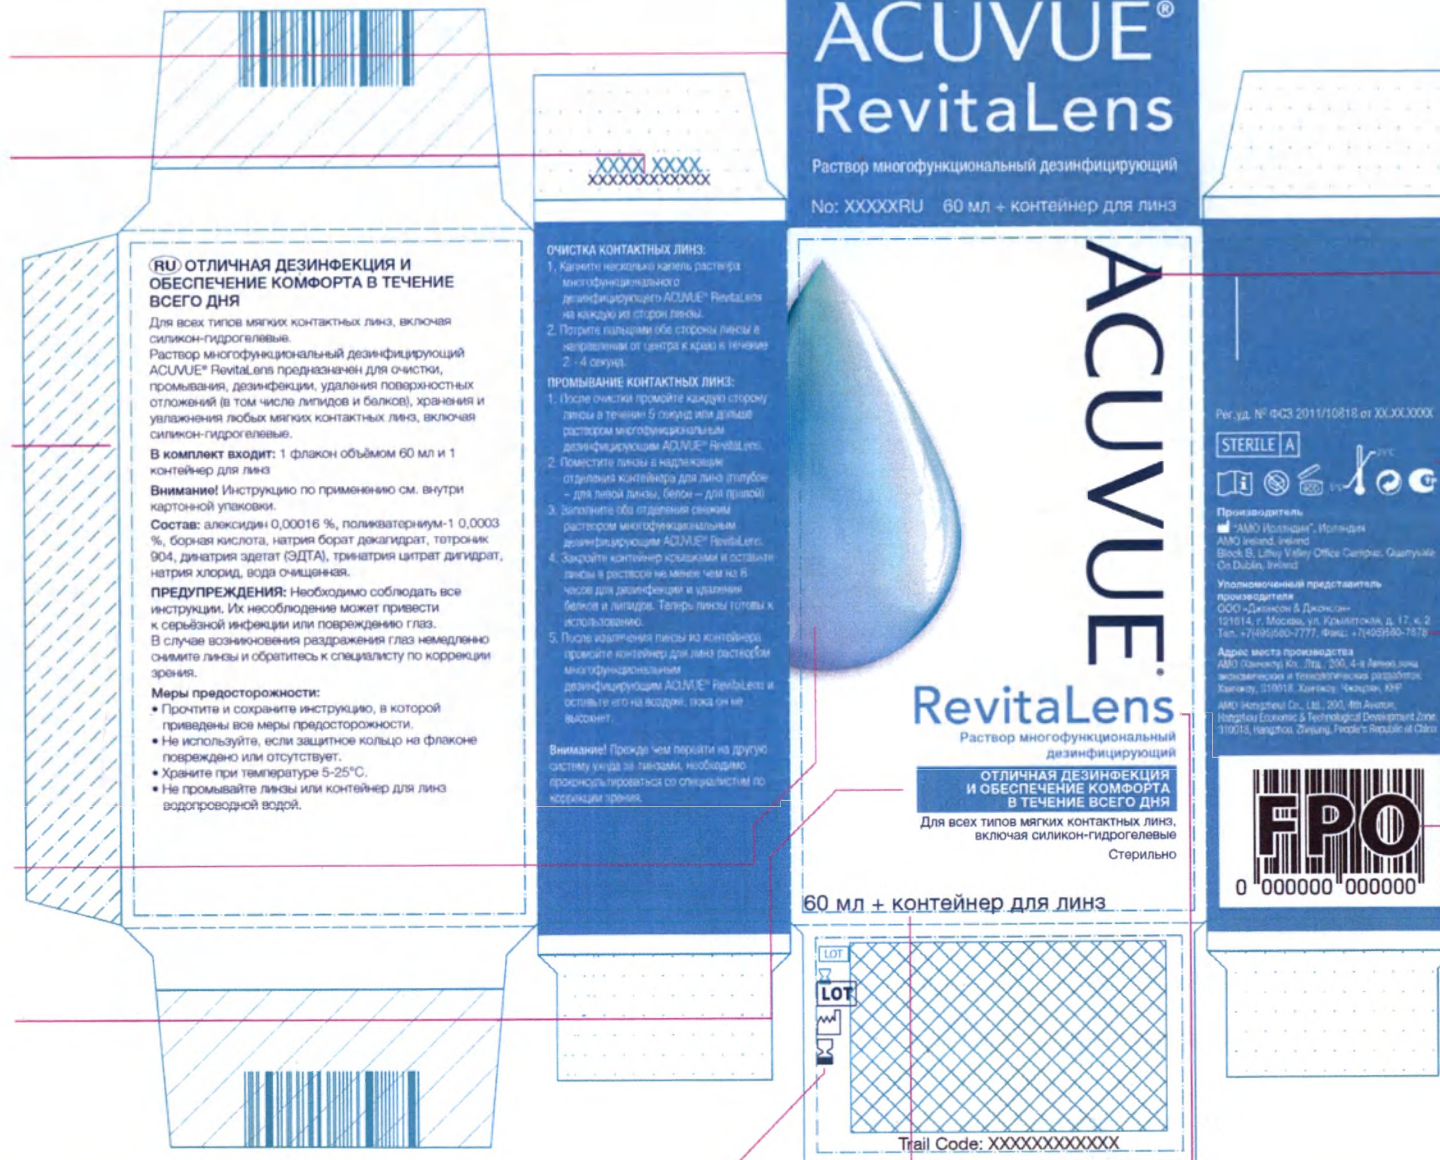

11. Раствор многофункциональный дезинфицирующий ACUVUE® RevitaLens в комплекте с контейнером для линз, объем 60 мл - макет потребительской упаковки (флакона с крышкой FTC)

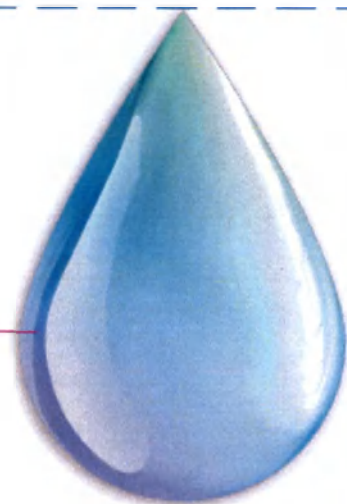

ACUVUE

RevitaLens

Раствор многофункциональный
дезинфицирующий

**ОТЛИЧНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТА
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ**

Для всех типов мягких контактных линз,
включая силикон-гидрогелевые

100 мл


RU Для всех типов мягких контактных линз, включая
силикон-гидрогелевые

Меры предосторожности:

- Прочтите и сохраните инструкцию по применению, в которой приведены все меры предосторожности.
- Не используйте, если защитное кольцо на флаконе повреждено или отсутствует.
- Храните при температуре 5-25°C.
- Не промывайте линзы или контейнер для линз водопроводной водой.

Состав: алексидин 0,00016 %, поликватерниум-1 0,0003 %, борная кислота, натрия борат декагидрат, тетроник 904, динатрия эдетат (ЭДТА), тринатрия цитрат дигидрат, натрия хлорид, вода очищенная.

Рег.уд. № ФСЗ 2011/10818 от XX.XX.XXXX



Производитель


■ "АМО Ирландия", Ирландия
AMO Ireland, Ireland, Block B, Liffey Valley Office Campus
Quarryvale, Co.Dublin, Ireland

**Уполномоченный представитель
производителя**


ООО «Джонсон & Джонсон»
121614, г. Москва, ул. Крылатская,
д. 17, к. 2

Тел. +7(495)680-7777,
Факс: +7(495)680-7878

XXXXXXXXXXXX

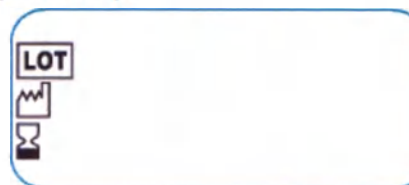

12. Раствор многофункциональный дезинфицирующий ACUVUE® RevitaLens в комплекте с контейнером для линз, объем 100 мл – макет маркировки флакона с крышкой FTC

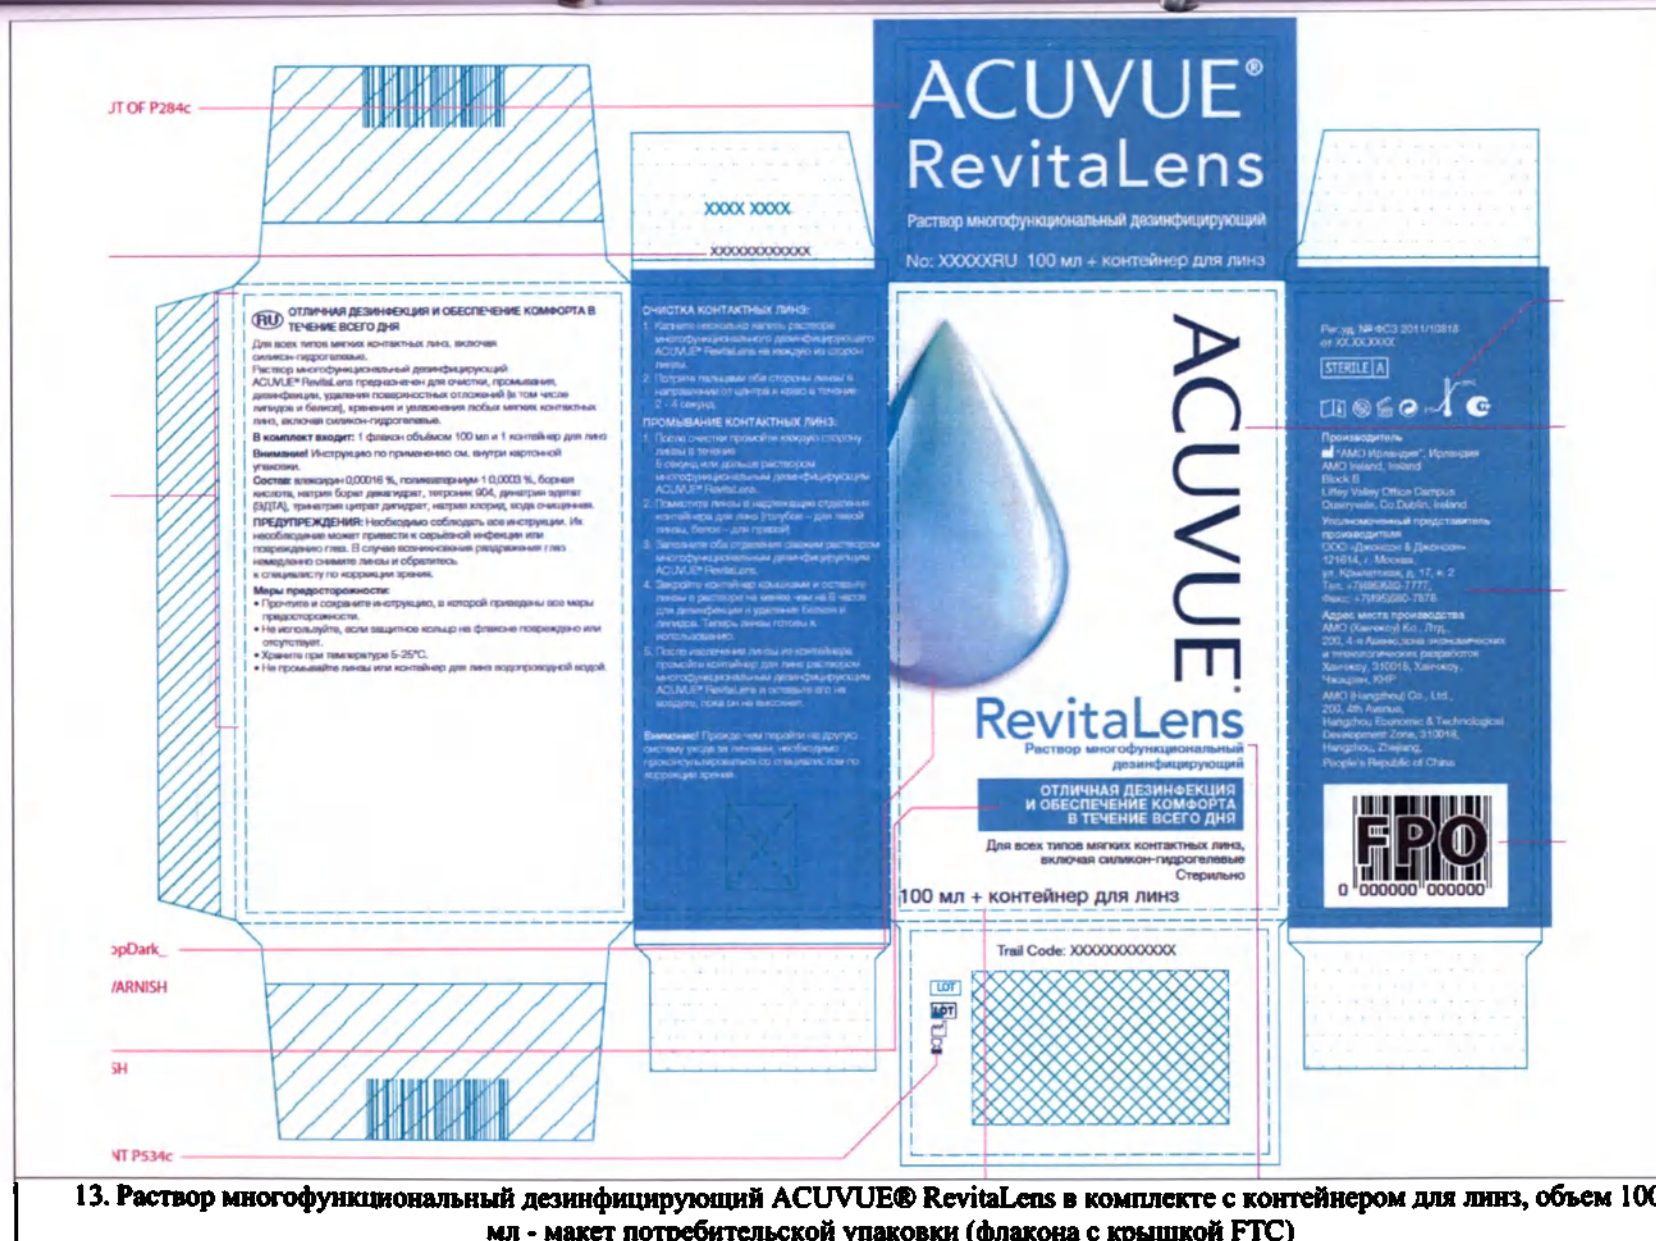

13. Раствор multifunctional дезинфицирующий ACUVUE® RevitaLens в комплекте с контейнером для линз, объем 100 мл - макет потребительской упаковки (флакона с крышкой FTC)



ACUVUE

RevitaLens

Раствор многофункциональный
дезинфицирующий

**ОТЛИЧНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТА
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ**

Для всех типов мягких контактных линз,
включая силикон-гидрогелевые

300 мл

ОТЛИЧНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТА В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ

RU Для всех типов мягких контактных линз, включая
силикон-гидрогелевые

Меры предосторожности:

- Прочтите и сохраните инструкцию по применению, в которой приведены все меры предосторожности.
- Не используйте, если защитное кольцо на флаконе повреждено или отсутствует.
- Храните при температуре 5-25°C.
- Не промывайте линзы или контейнер для линз водопроводной водой.

Состав: алексидин 0,00016 %, поликватерниум-1 0,0003 %, борная кислота, натрия борат декагидрат, тетроник 904, динатрия эдетат (ЭДТА), тринатрия цитрат дигидрат, натрия хлорид, вода очищенная.

Рег.уд. № ФСЗ 2011/10818 от XX.XX.XXXX

STERILE A

Производитель

«АМО Ирландия», Ирландия

AMO Ireland, Ireland

Block B, Liffey Valley Office Campus

Quarryvale, Co.Dublin, Ireland

Уполномоченный представитель


производителя

ООО «Джонсон & Джонсон»

121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, к. 2

Тел. +7(495)580-7777, Факс: +7(495)580-7878

XXXXXXXXXXXX

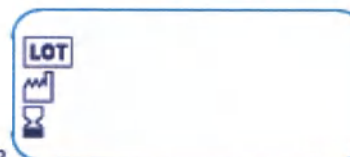

14. Раствор многофункциональный дезинфицирующий ACUVUE® RevitaLens в комплекте с контейнером для линз, объем 300 мл – макет маркировки флакона с крышкой FTC

ACUVUE® RevitaLens

Раствор многофункциональный
дезинфицирующий

№: XXXXXXRU 300 мл + контейнер для линз

XXXX XXXX
XXXXXXXXXXXX

ОДНУ ОТЛИЧНУЮ ДЕЗИНФЕКЦИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТА В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ

Для всех типов мягких контактных линз, включая
силикон-гидрогелевые.

Раствор многофункциональный дезинфицирующий
ACUVUE® RevitaLens предназначен для очистки, промывания,
дезинфекции, удаления поверхностных отложений (в том
числе белков и жиров), хранения и увлажнения любых
мягких контактных линз, включая силикон-гидрогелевые.

В комплект входит 1 флакон объемом 300 мл и 1 контейнер
для линз.

Внимательно изучите инструкцию по применению см. внутри картонной
упаковки.

Состав: гипохлорит 0,00016 %, поливинилпирролидон-1 0,0003 %,
борная кислота, натрия борат дигидрат, глицерин, DCA,
дигидрат адипат (DITA), триэтилен гликоль дигерат, натрия
хлорид, вода очищенная.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Необходимо соблюдать все
инструкции. Их несоблюдение может привести к серьезной
инфекции или повреждению глаз. В случае возникновения
раздражения глаз немедленно снимите линзы и обратитесь
к специалисту по коррекции зрения.

Меры предосторожности:

- Прочтите и соблюдайте инструкцию, в которой приведены все
меры предосторожности.
- Не используйте, если защитное кольцо на флаконе
повреждено или отсутствует.
- Храните при температуре 5-25°C.
- Не промывайте линзы или контейнер для линз
водопроводной водой.

ОЧИСТКА КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ:


1. Капните несколько капель раствора многофункционального
дезинфицирующего ACUVUE® RevitaLens на каждую из
сторон линзы.
2. Потрите линзы обе стороны линзы в направлении от
центра к краю в течение 2 - 4 секунд.

ПРОМЫВАНИЕ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ:

1. После очистки промойте каждую сторону линзы в течение
3 секунд или дольше раствором многофункционального
дезинфицирующего ACUVUE® RevitaLens.
2. Поместите линзы в надлинзную отделение контейнера для
линз фронталь - для левой линзы, задняя - для правой.
3. Заполните обе отделения своего раствором
многофункционального дезинфицирующего
ACUVUE® RevitaLens.

4. Закройте контейнер крышками и оставьте линзы в растворе
не менее чем на 6 часов для дезинфекции и увлажнения
белков и жиров. Теперь линзы готовы к использованию.
5. После извлечения линзы из контейнера промойте
контейнер для линз раствором многофункционального
дезинфицирующего ACUVUE® RevitaLens и оставьте его на
воздухе, пока он не высохнет.

Внимание! Прокладки не перенести на другую систему ухода за
линзами, необходимо проконсультироваться со специалистом
по коррекции зрения.

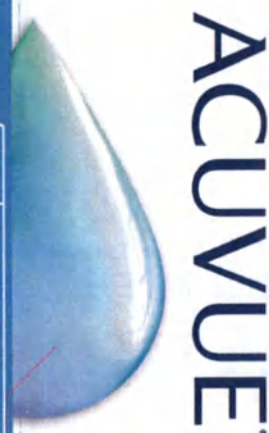

RevitaLens

Раствор многофункциональный
дезинфицирующий


ОТЛИЧНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТА В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ

Для всех типов мягких контактных линз,
включая силикон-гидрогелевые

Стерильно

300 мл + контейнер для линз

Trail Code: XXXXXXXXXX



Рег. №: RU.003.01110018 от XXXX.XXXX



Производитель:

ACUVUE Advanced Care, Inc.
1700 N. 1st St., Suite 100
Cincinnati, OH 45219, USA

Уполномоченный представитель:

ООО «Доктор А. Дюжон»
170014, г. Москва
ул. Архитектора В. М., к. 2
Тел: +7 (495) 680-7777
Факс: +7 (495) 680-7878

Адрес места производства:

4300 Чувашский ул., стр. 200, 4-й этаж
или законченный в Чувашском республике
310019, Чувашская область, г. Чебоксары
4300 Чувашский ул., стр. 200, 4-й этаж
или законченный в Чувашском республике
310019, Чувашская область, г. Чебоксары

15. Раствор многофункциональный дезинфицирующий ACUVUE® RevitaLens в комплекте с
контейнером для линз, объем 300 мл - макет потребительской упаковки (флакона с
крышкой FTC)



ACUVUE

RevitaLens

Раствор многофункциональный
дезинфицирующий

ОТЛИЧНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТА
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ

Для всех типов мягких контактных линз,
включая силикон-гидрогелевые

360 мл

ОТЛИЧНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТА В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ

(RU) Для всех типов мягких контактных линз, включая
силикон-гидрогелевые

Меры предосторожности:

- Прочтите и сохраните инструкцию по применению, в которой приведены все меры предосторожности.
- Не используйте, если защитное кольцо на флаконе повреждено или отсутствует.
- Храните при температуре 5-25°C.
- Не промывайте линзы или контейнер для линз водопроводной водой.

Состав: алексидин 0,00016 %, поликватерниум-1 0,0003 %, борная кислота, натрия борат декагидрат, тетроник 904, динатрия эдетат (ЭДТА), тринатрия цитрат дигидрат, натрия хлорид, вода очищенная.

Рег.уд. № ФСЗ 2011/10818 от XX.XX.XXXX

STERILE A

Производитель

«AMO Ирландия», Ирландия
AMO Ireland, Ireland
Block B, Liffey Valley Office Campus
Quarryvale, Co.Dublin, Ireland


Уполномоченный представитель
производителя

ООО «Джонсон & Джонсон»
121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, к. 2
Тел. +7(495)580-7777, Факс: +7(495)580-7878

XXXXXXXXXXXX



16. Раствор многофункциональный дезинфицирующий ACUVUE® RevitaLens в комплекте с контейнером для линз, объем 360 мл – макет маркировки флакона с крышкой FTC

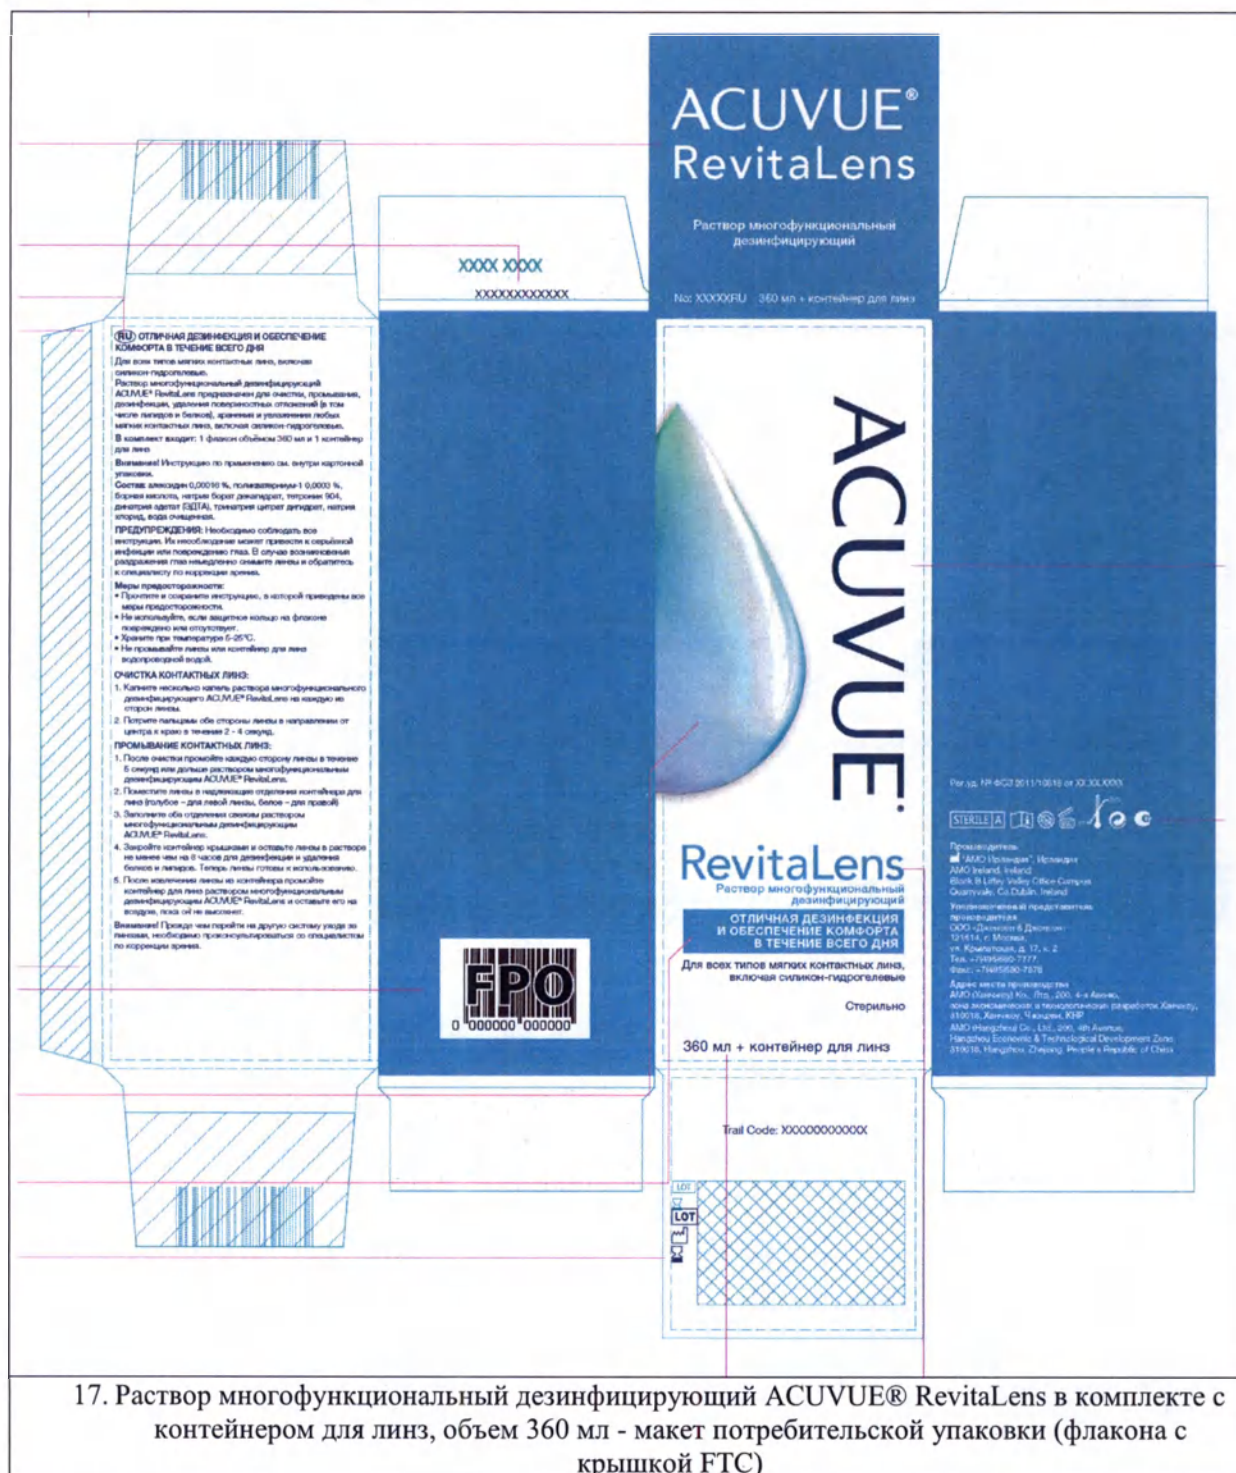

17. Раствор многофункциональный дезинфицирующий ACUVUE® RevitaLens в комплекте с контейнером для линз, объем 360 мл - макет потребительской упаковки (флакона с крышкой FTC)



АСУВУЕ

RevitaLens
 Раствор многофункциональный
 дезинфицирующий

**ОТЛИЧНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ
 И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТА
 В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ**

Для всех типов мягких контактных линз,
 включая силикон-гидрогелевые

© XXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX

60 мл

RU Для всех типов мягких контактных линз, включая силикон-гидрогелевые

Меры предосторожности:

- Прочтите и сохраните инструкцию по применению, в которой приведены все меры предосторожности.
- Не используйте, если защитное кольцо на флаконе повреждено или отсутствует.
- Храните при температуре 5-25°C.
- Не промывайте линзы или контейнер для линз водопроводной водой.

Состав: алексидин 0,00016 %, поликватерниум-1 0,0003 %, борная кислота, натрия борат декагидрат, тетроник 904, динатрия эдетат (ЭДТА), тринатрия цитрат дигидрат, натрия хлорид, вода очищенная.

Рег.уд. № ФСЗ 2011/10818 от xx.xx.xxxx

STERILE A



5°C



25°C



Производитель

«АМО Ирландия», Ирландия
 AMO Ireland, Ireland, Block B, Liffey Valley Office Campus
 Quarryvale, Co.Dublin, Ireland

Уполномоченный представитель производителя

ООО «Джонсон & Джонсон»
 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, к. 2
 Тел. +7(495)580-7777, Факс: +7(495)580-7878

LOT



18. Раствор многофункциональный дезинфицирующий ACUVUE® RevitaLens в комплекте с контейнером для линз, объем 60 мл – общий вид флакона с крышкой BTC



19. Раствор многофункциональный дезинфицирующий ACUVUE® RevitaLens в комплекте с контейнером для линз, объем 60 мл – макет маркировки флакона с крышкой ВТС
 *Новинка от бренда ACUVUE®! – временная надпись



RU Для всех типов мягких контактных линз, включая силикон-гидрогелевые

Меры предосторожности:

- Прочтите и сохраните инструкцию по применению, в которой приведены все меры предосторожности.
- Не используйте, если защитное кольцо на флаконе повреждено или отсутствует.
- Храните при температуре 5-25°C.
- Не промывайте линзы или контейнер для линз водопроводной водой.

Состав: алексидин 0,00016 %, поликватерниум-1 0,0003 %, борная кислота, натрия борат декагидрат, тетраник 904, динатрия эдетат (ЭДТА), тринатрия цитрат дигидрат, натрия хлорид, вода очищенная.

Рег.уд. № ФСЗ 2011/10818 от XX.XX.XXXX



Производитель

«АМО Ирландия», Ирландия
AMO Ireland, Ireland, Block B, Liffey Valley Office Campus
Quarryvale, Co.Dublin, Ireland

Уполномоченный представитель производителя

ООО «Джонсон & Джонсон»
121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, к. 2
Тел. +7(495)580-7777, Факс: +7(495)580-7878

XXXXXXXXXXXX



LOT

LOT

LOT

LOT

LOT

LOT

LOT


LOT

20. Раствор многофункциональный дезинфицирующий ACUVUE® RevitaLens в комплекте с контейнером для линз, объем 100 мл – макет маркировки флакона с крышкой BTC

PICAL)



21. Раствор многофункциональный дезинфицирующий ACUVUE® RevitaLens в комплекте с контейнером для линз, объем 100 мл - макет потребительской упаковки (флакона с крышкой BTC)
***Новинка от бренда ACUVUE®! - временная надпись**

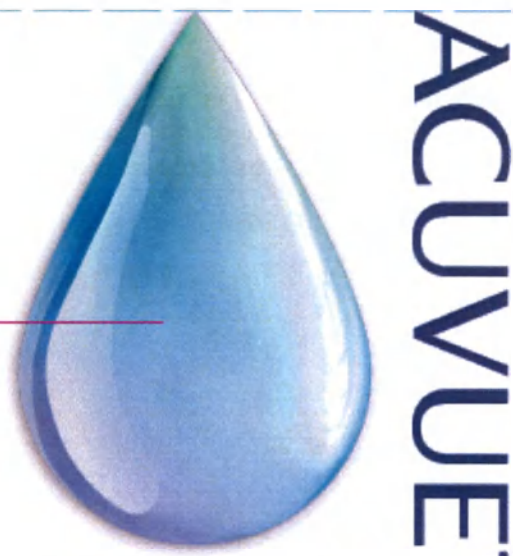

ACUVUE

RevitaLens

Раствор многофункциональный
дезинфицирующий

**ОТЛИЧНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТА
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ**

Для всех типов мягких контактных линз,
включая силикон-гидрогелевые

300 мл

ОТЛИЧНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТА В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ

RU Для всех типов мягких контактных линз, включая
силикон-гидрогелевые

Меры предосторожности:

- Прочтите и сохраните инструкцию по применению, в которой приведены все меры предосторожности.
- Не используйте, если защитное кольцо на флаконе повреждено или отсутствует.
- Храните при температуре 5-25°C.
- Не промывайте линзы или контейнер для линз водопроводной водой.

Состав: алексидин 0,00016 %, поликватерниум-1 0,0003 %, борная кислота, натрия борат декагидрат, тетроник 904, динатрия эдетат (ЭДТА), тринатрия цитрат дигидрат, натрия хлорид, вода очищенная.

Рег. уд. № ФСЗ 2011/10818 от XX.XX.XXXX

STERILE A

Производитель
«AMO Ирландия», Ирландия
AMO Ireland, Ireland
Block B, Liffey Valley Office Campus
Quattwale, Co.Dublin, Ireland
Уполномоченный представитель
производителя

ООО «Джонсон & Джонсон»
121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, к. 2
Тел. +7(495)580-7777, Факс: +7(495)580-7878
XXXXXXXXXXXX



22. Раствор многофункциональный дезинфицирующий ACUVUE® RevitaLens в комплекте с контейнером для линз, объем 300 мл – макет маркировки флакона с крышкой BTC



23. Раствор многофункциональный дезинфицирующий ACUVUE® RevitaLens в комплекте с контейнером для линз, объем 300 мл - макет потребительской упаковки (флакона с крышкой BTC)

*Новинка от бренда ACUVUE®! – временная надпись



ACUVUE

RevitaLens

Раствор многофункциональный
дезинфицирующий

**ОТЛИЧНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТА
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ**

Для всех типов мягких контактных линз,
включая силикон-гидрогелевые

360 мл

ОТЛИЧНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТА В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ

RU Для всех типов мягких контактных линз, включая
силикон-гидрогелевые

Меры предосторожности:

- Прочтите и сохраните инструкцию по применению, в которой приведены все меры предосторожности.
- Не используйте, если защитное кольцо на флаконе повреждено или отсутствует.
- Храните при температуре 5-25°C.
- Не промывайте линзы или контейнер для линз водопроводной водой.

Состав: алексидин 0,00016 %, поликватерниум-1 0,0003 %, борная кислота, натрия борат декагидрат, тетроник 904, динатрия эдетат (ЭДТА), тринатрия цитрат дигидрат, натрия хлорид, вода очищенная.

Рег.уд. № ФСЗ 2011/10818 от XX.XX.XXXX

STERILE A

Производитель

«АМО Ирландия», Ирландия

AMO Ireland, Ireland

Block B, Liffey Valley Office Campus

Quarryvale, Co.Dublin, Ireland

Уполномоченный представитель

производителя

ООО «Джонсон & Джонсон»

121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, к. 2

Тел. +7(495)580-7777, Факс: +7(495)580-7878

XXXXXXXXXXXX



24. Раствор многофункциональный дезинфицирующий ACUVUE® RevitaLens в комплекте с контейнером для линз, объем 360 мл – макет маркировки флакона с крышкой BTC



Всего прому-
ровано, прому-
ровано, скреплено
печатью 14
листов.



Handwritten signature in blue ink.