


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Компания «БиВи»
Носова Т.А.


21 апреля 2020 г.



Фотографические изображения изделия:

Набор калибраторов для количественного определения ракового антигена 125 (cancer antigen 125 (CA125 CAL)) иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. («Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.»), Китай

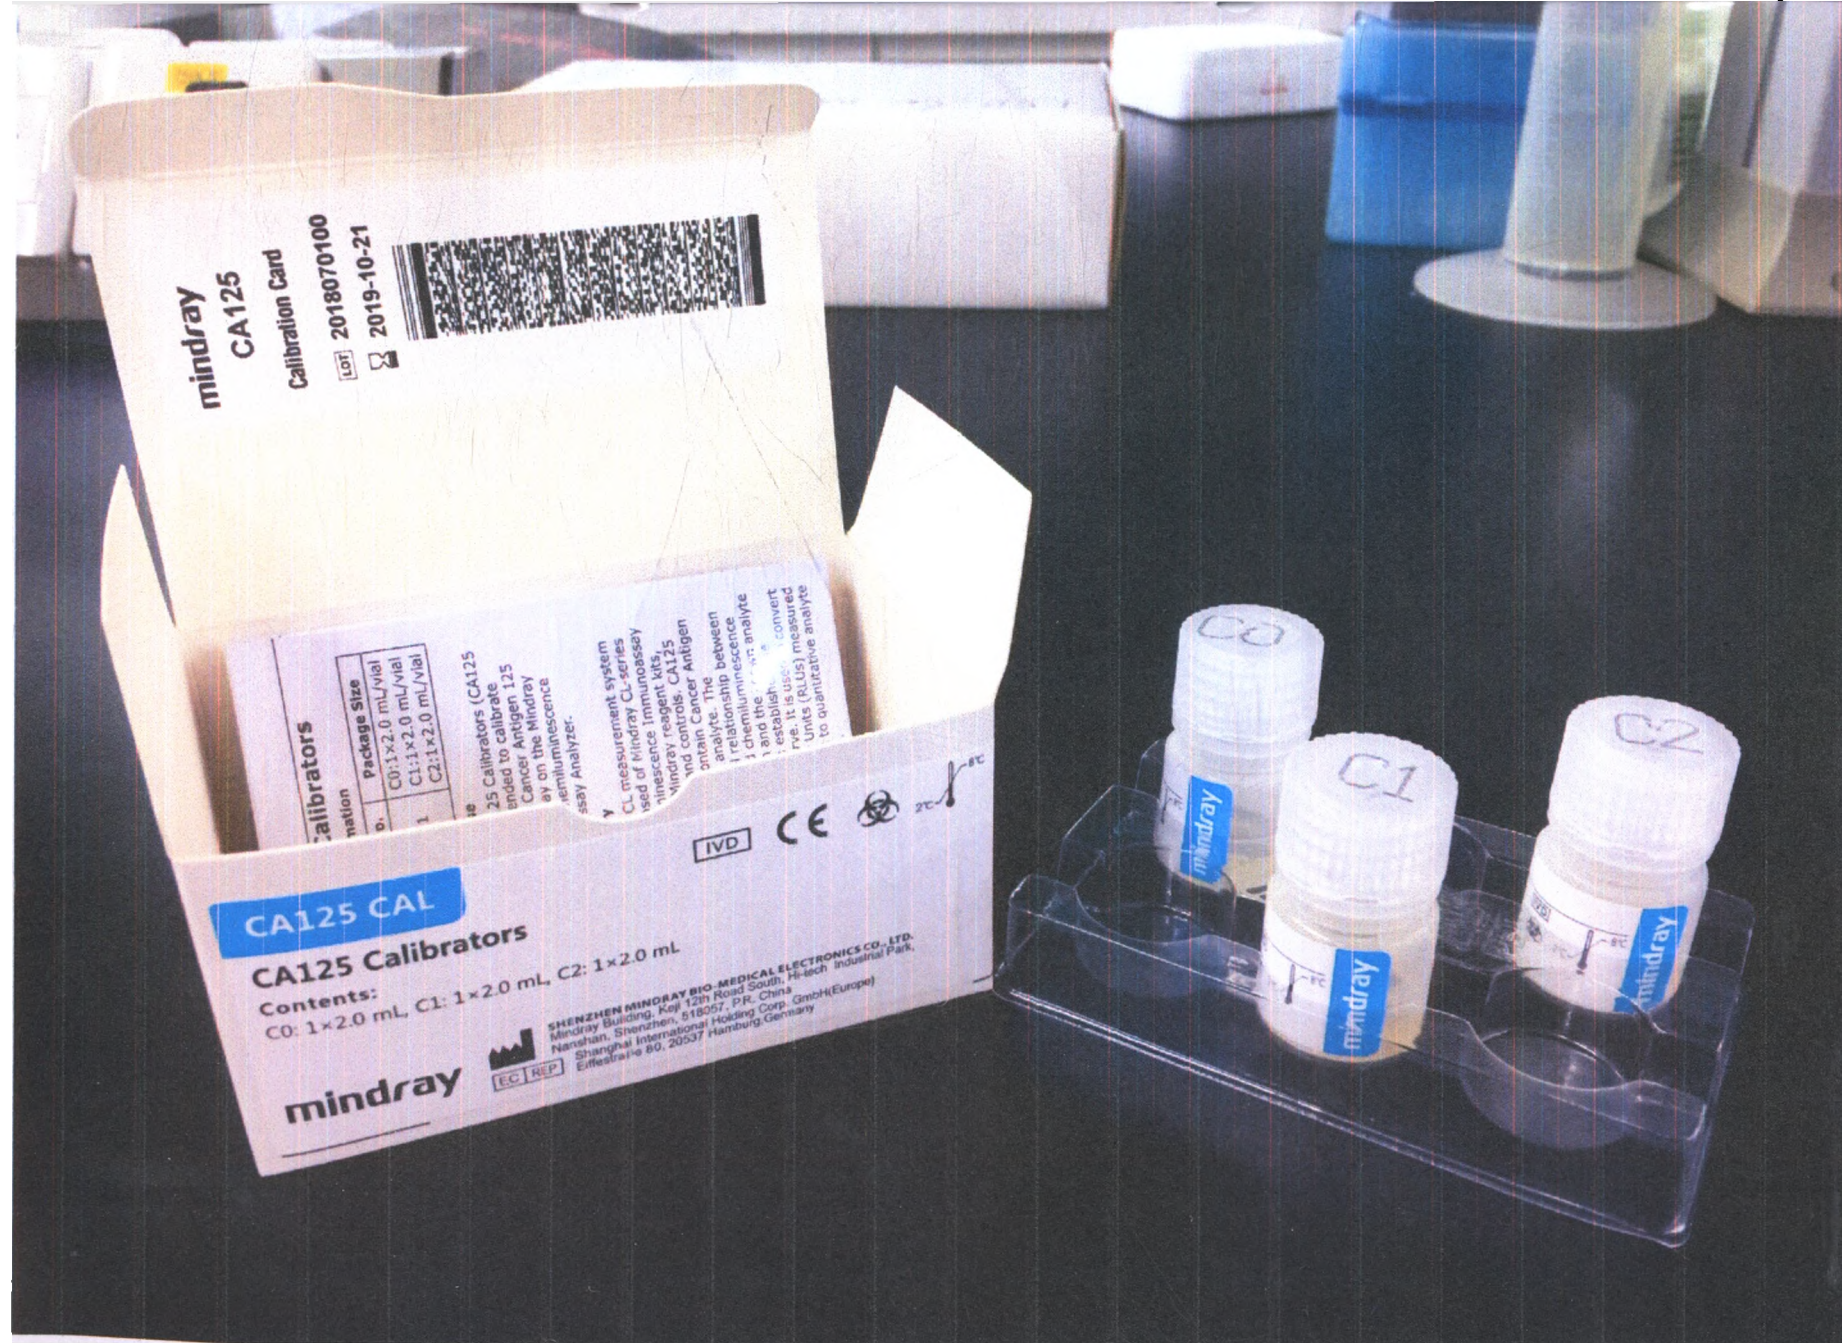

Общий вид медицинского изделия (Набор калибраторов для количественного определения ракового антигена 125 (cancer antigen 125 (CA125 CAL)) иммунохемилюминесцентным оптическом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro, в варианте исполнения CA125211)

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 2 листа (-ов)

Генеральный Директор Носова / Носова Т.А.
М.П.

0