



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Скайлаб»

И.В. Якушева

«26» апреля 2020 г.




Фотографические изображения медицинского изделия

Автосамплер для твердофазной экстракции с карт «Сухих пятен крови»
«CAMAG DBS-MS 500».



Фотографическое изображение 1 – Основной блок автосамплера для твердофазной экстракции с карт «Сухих пятен крови» «CAMAG DBS-MS 500»

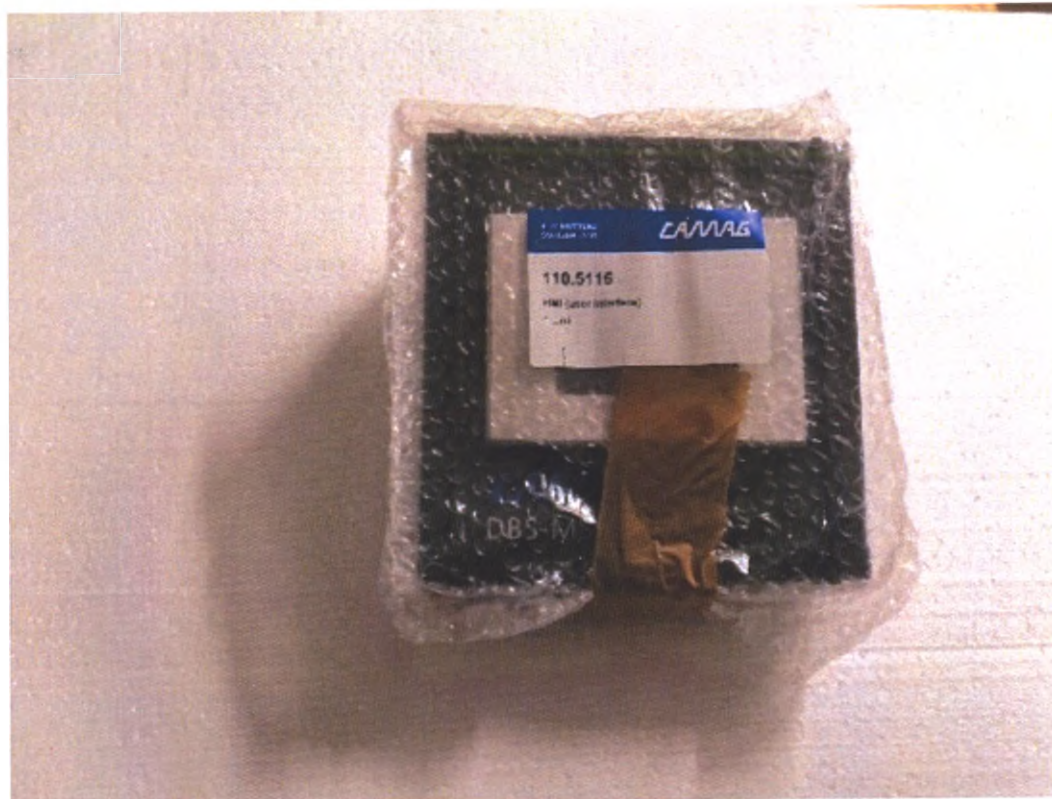


Фотографическое изображение 2 – Внешний блок управления с предустановленным ПО HMI



Фотографическое изображение 3 – Штатив для карт




Фотографическое изображение 4 – Подставка для бутылей

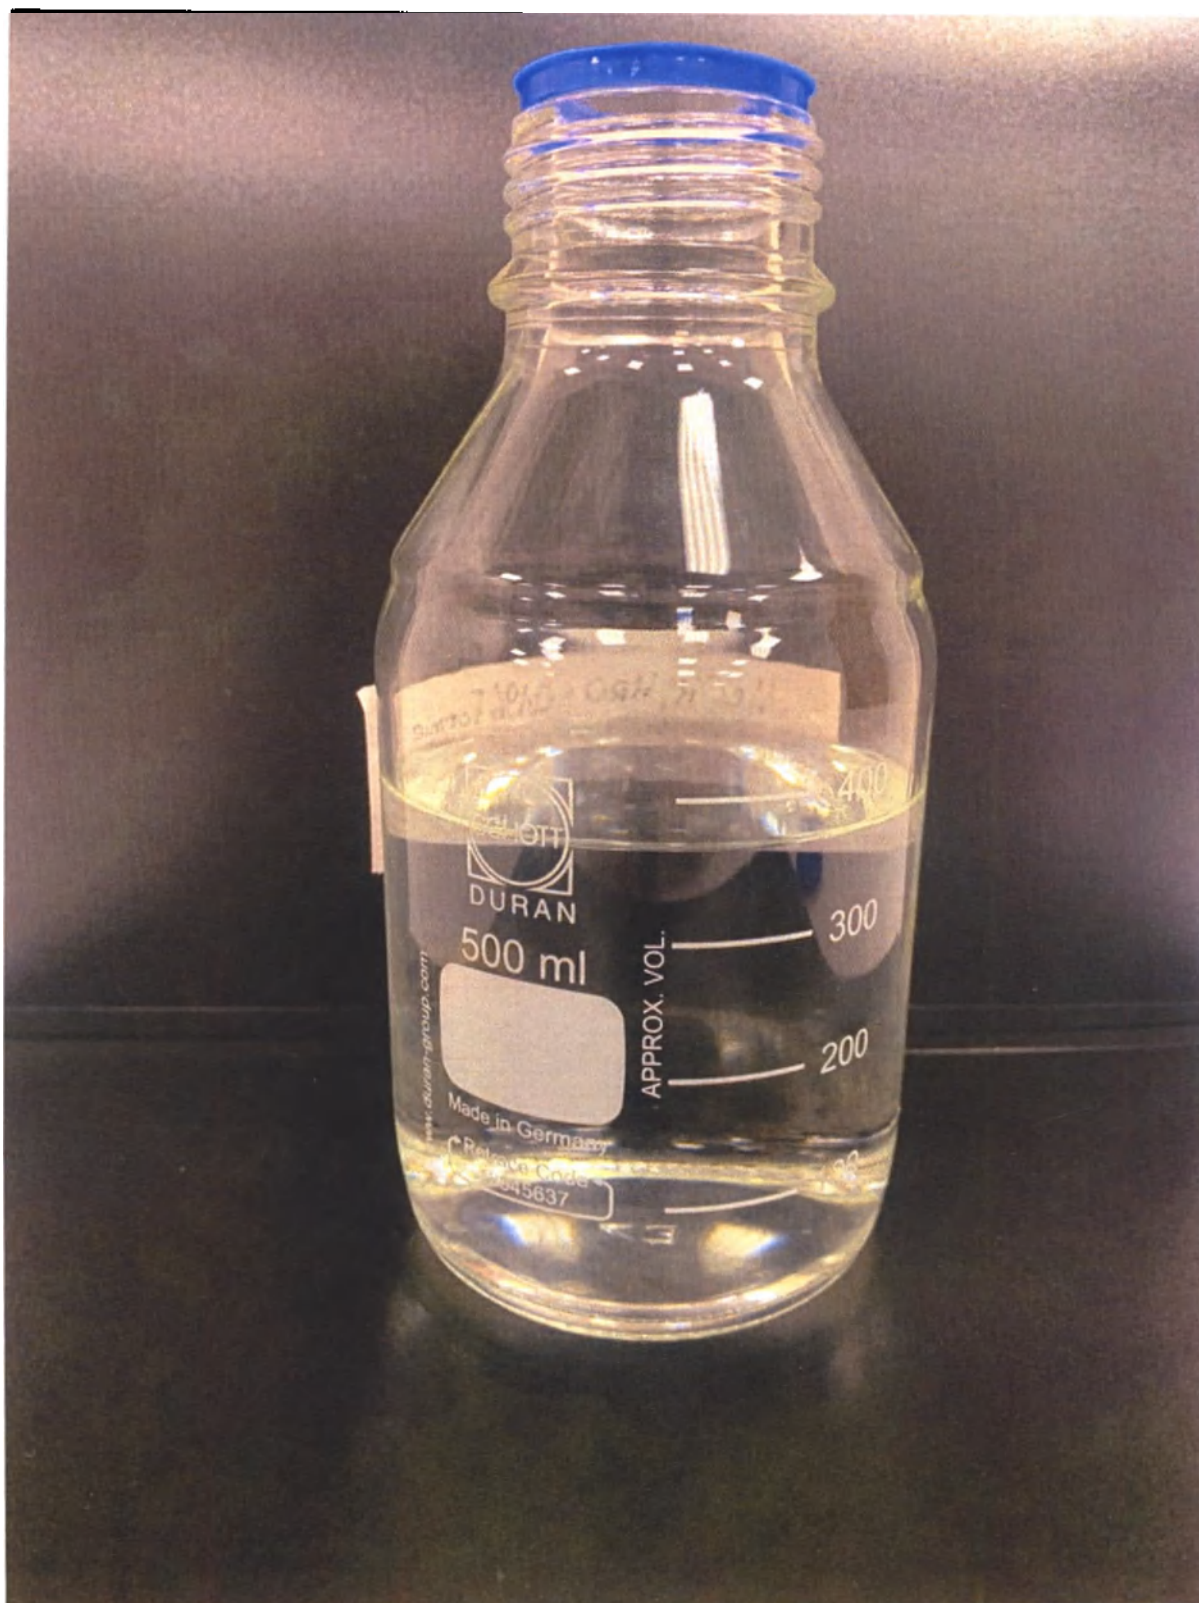

Фотографическое изображение 5 – Бутыль для экстрагирующего раствора, 500 мл




Фотографическое изображение 6 – Бутыль для промывочного раствора, 1000 мл

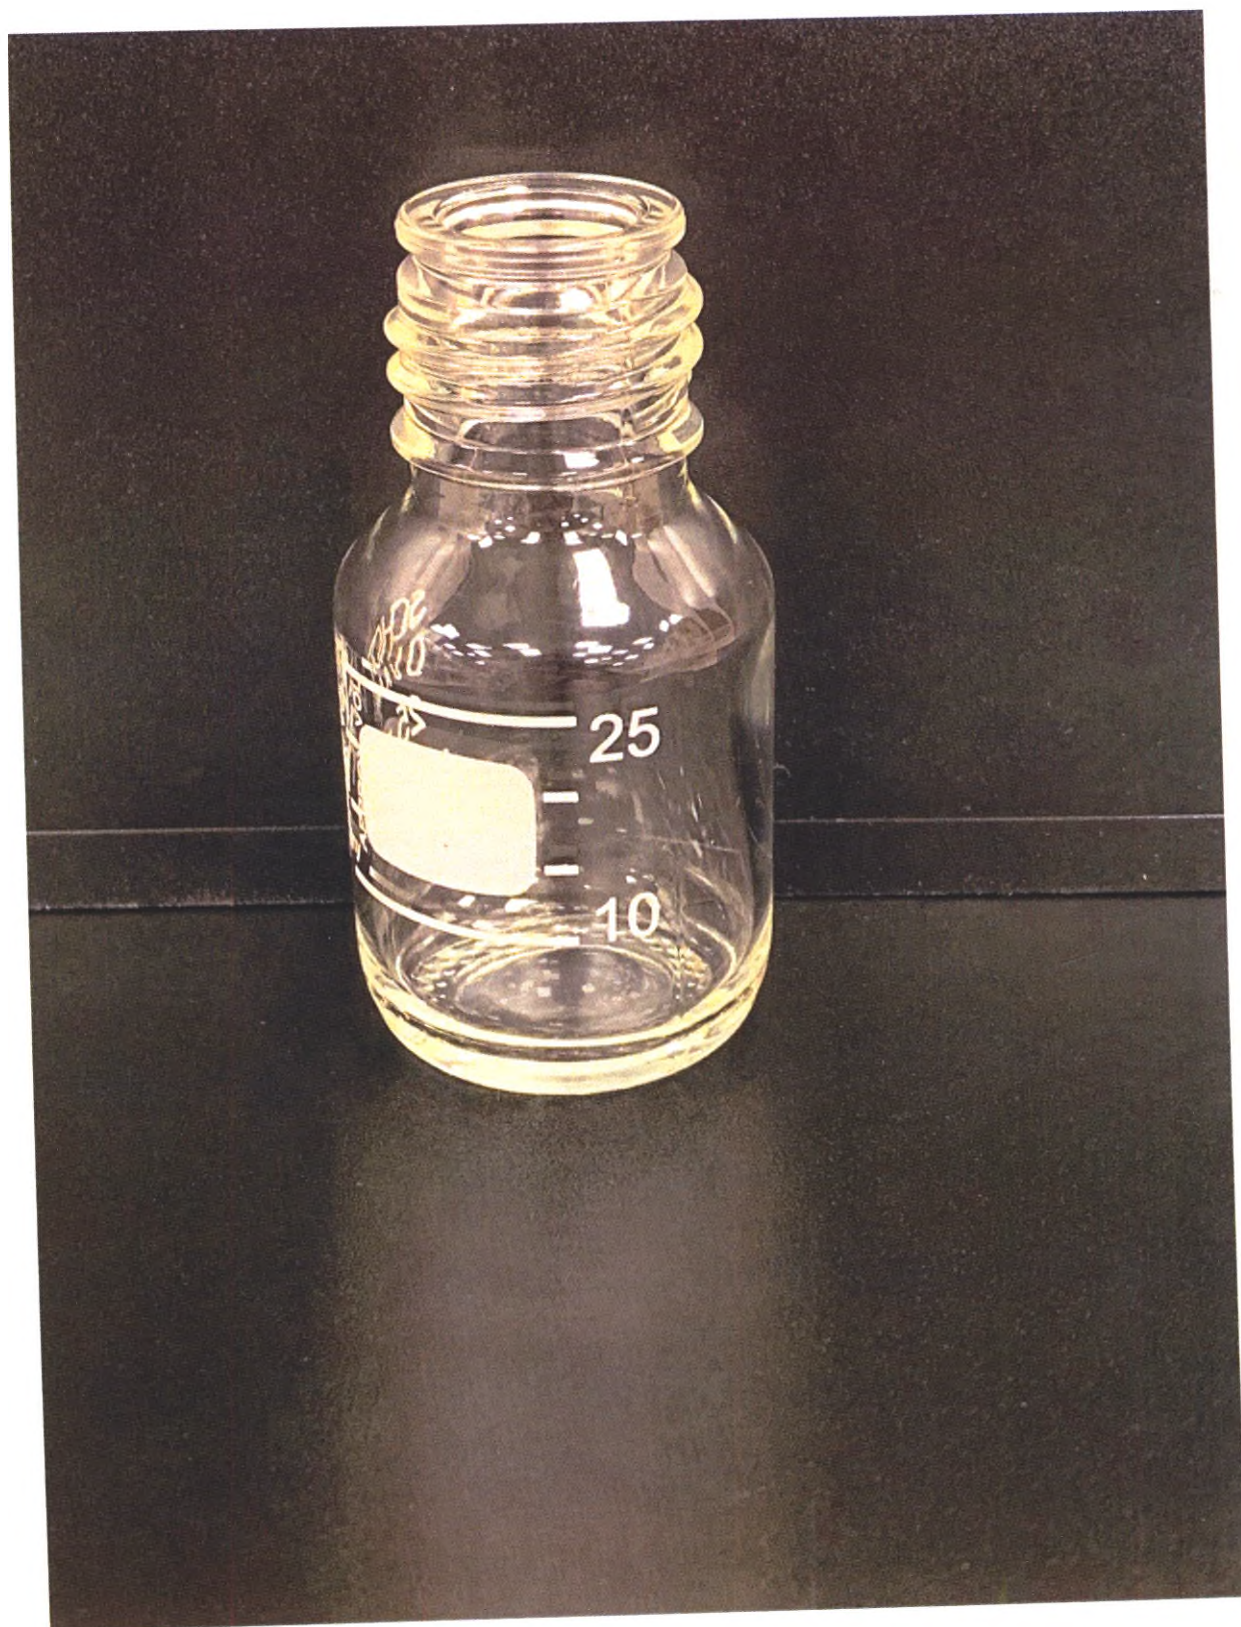

Фотографическое изображение 7 – Бутыль для внутреннего стандарта, 25 мл



Фотографическое изображение 8 – Бутыль для промывочного раствора внутреннего стандарта, 250 мл

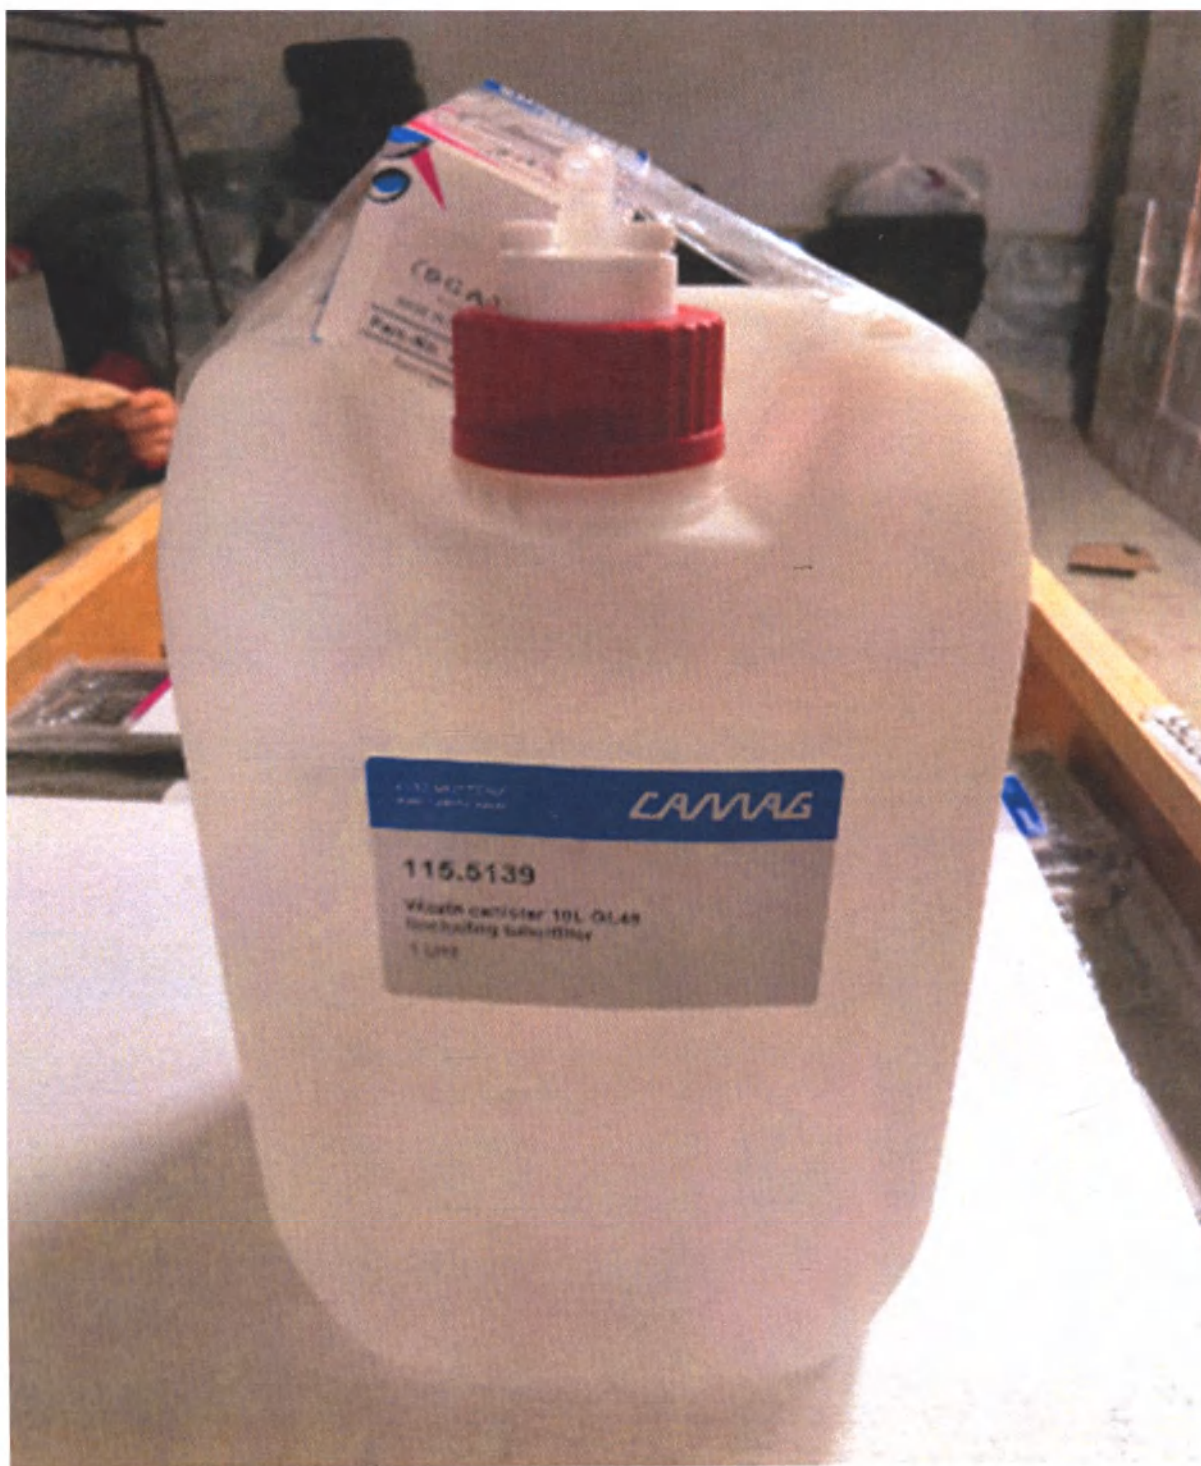


Фотографическое изображение 9 – Канистра для слива с винтовой крышкой GL45 с трубкой/фильтром, 10 л



Фотографическое изображение 10 – Трубка из полиуретана (для сжатого воздуха), 3 м



Фотографическое изображение 11 – Трубка из поливинилхлорида (к канистре для отходов), 1 м

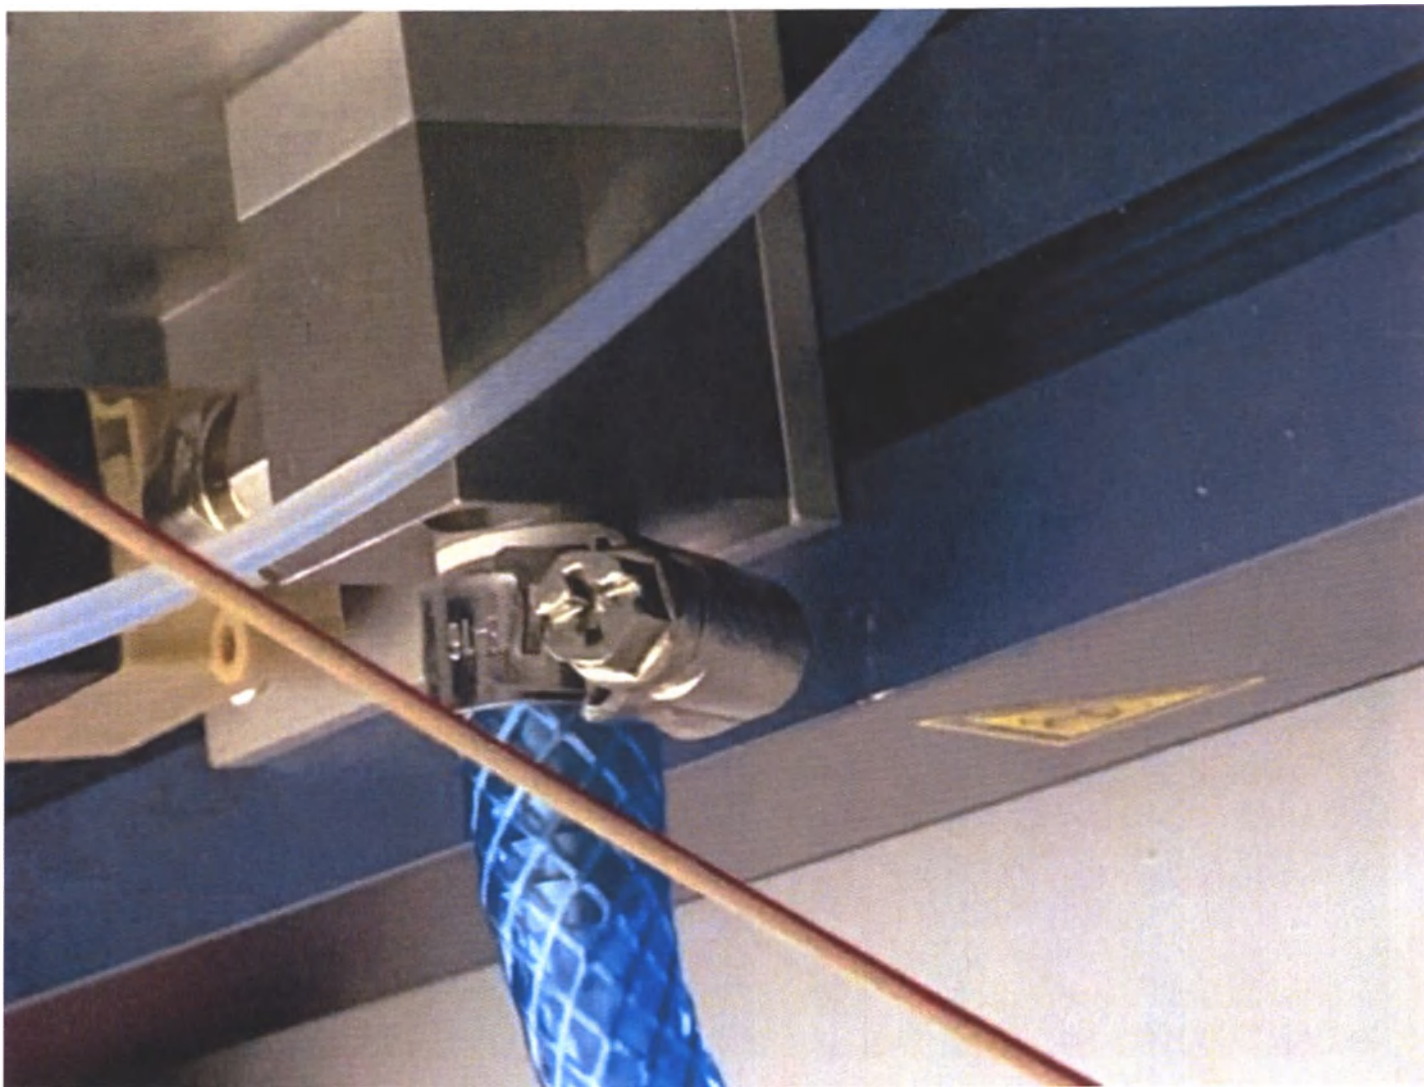

Фотографическое изображение 12 – Хомут



Фотографическое изображение 13 Адаптер для установки шланга для слива



Фотографическое изображение 14 – Винт РЕЕК длинный




Фотографическое изображение 15 – Кабель для внешнего блока управления



Фотографическое изображение 16 – Кабель для подсоединения к ВЭЖХ-МС/МС системе




Фотографическое изображение 17 – Кабель электропитания с Евровилкой

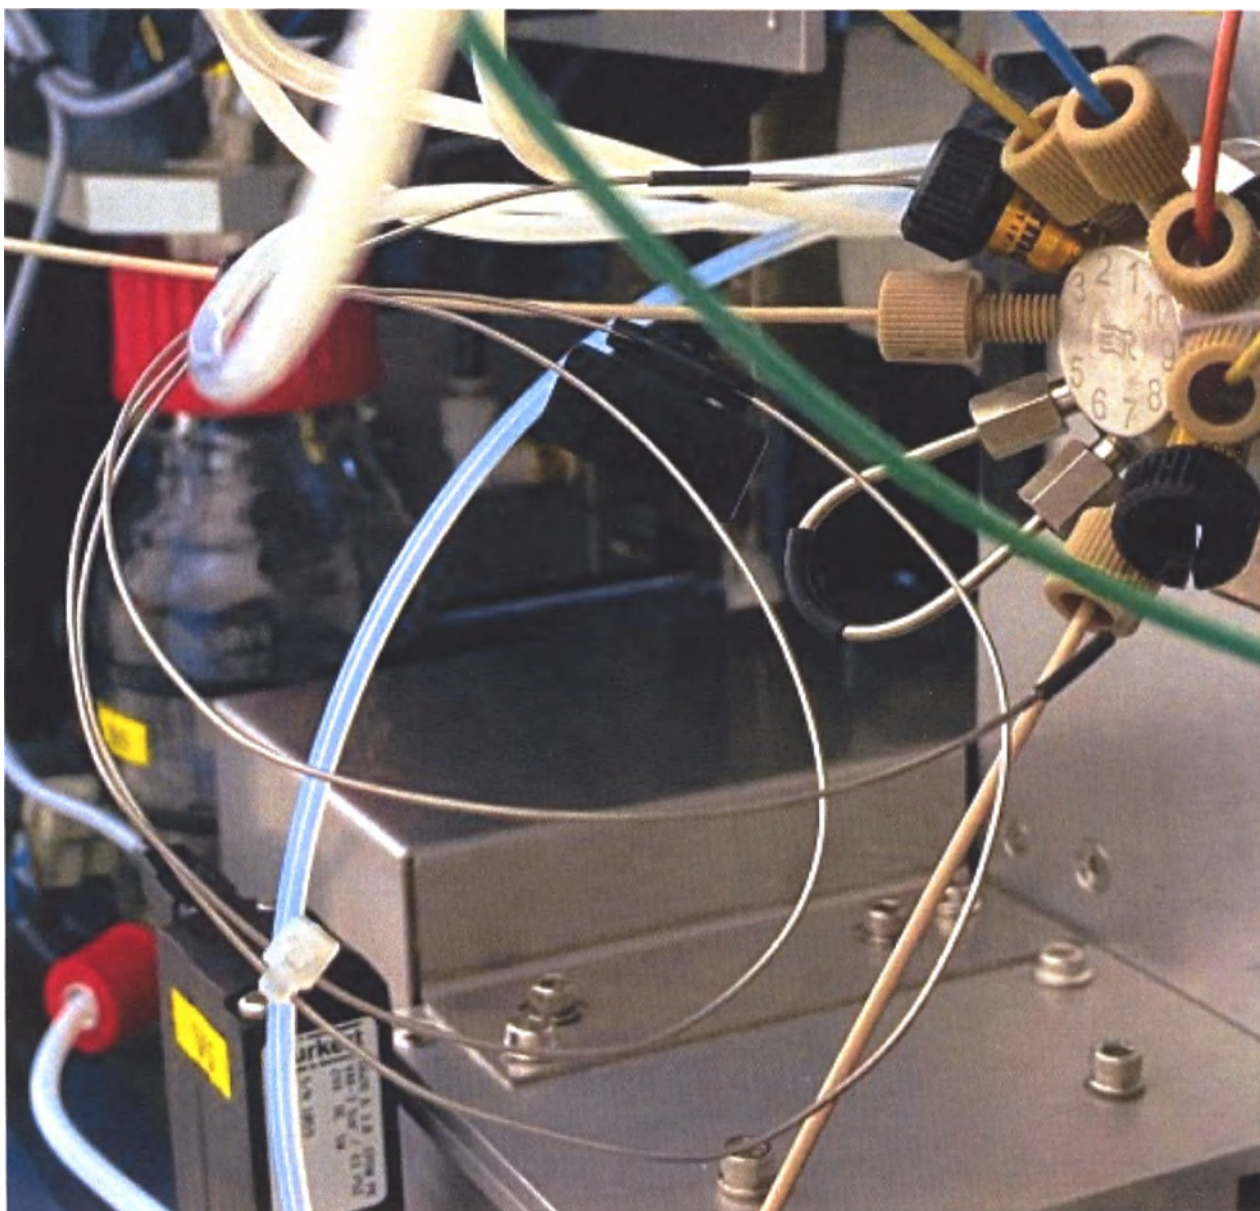

Фотографическое изображение 18 – Петля на 20 мкл (установленная)



Фотографическое изображение 19 – Упаковка карт «Сухих пятен крови»

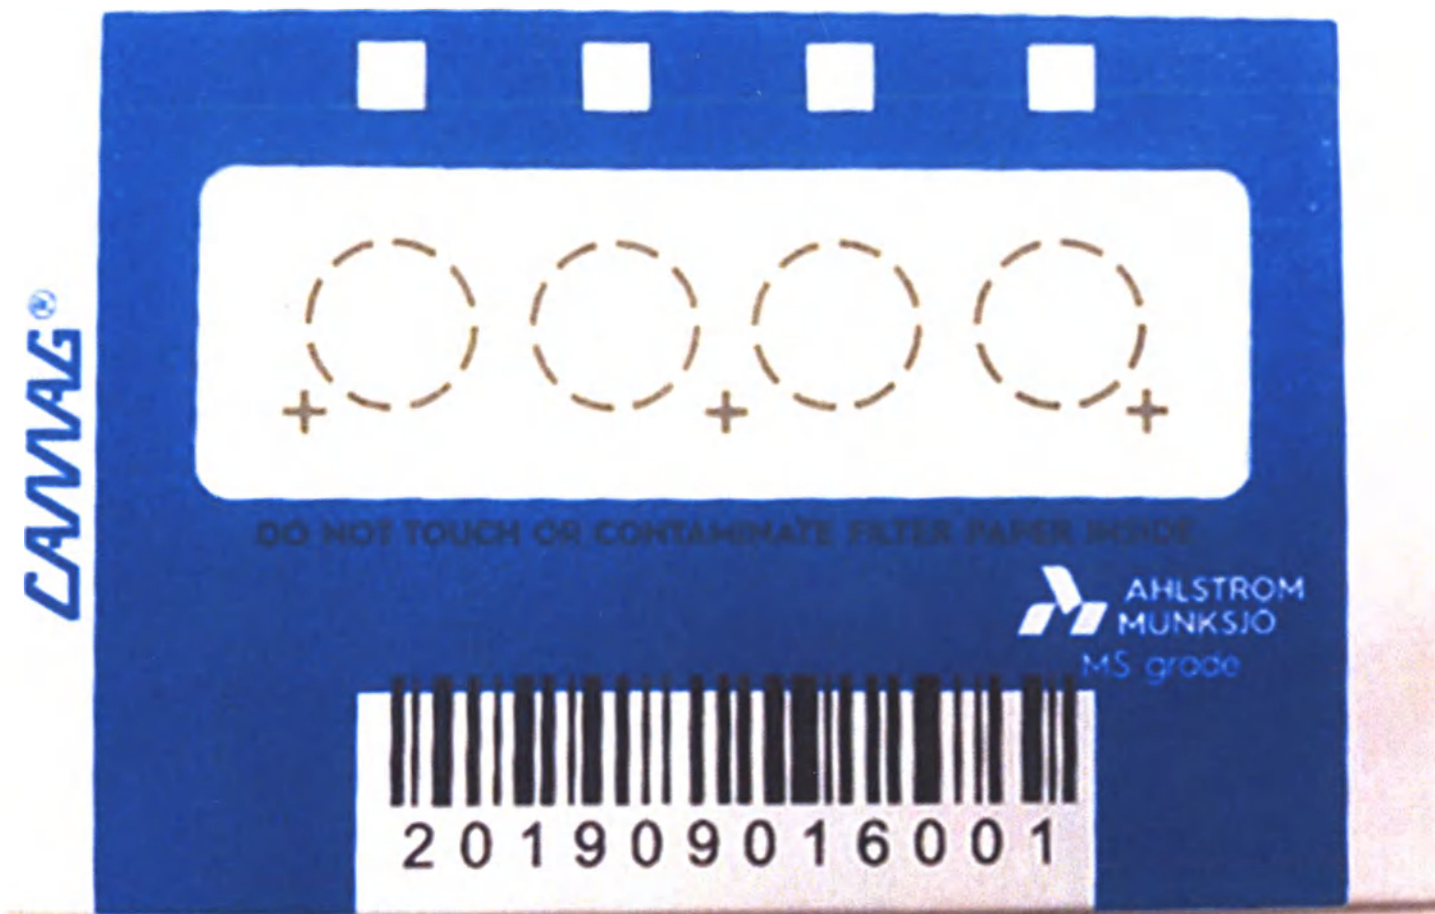


Фотографическое изображение 22 – Карта «Сухих пятен крови» (сторона нанесения образцов)




Фотографическое изображение 23 – Карта «Сухих пятен крови»



Фотографическое изображение 24 – Маркировка основного блока Автосамплера
«CAMAG DBS-MS 500»

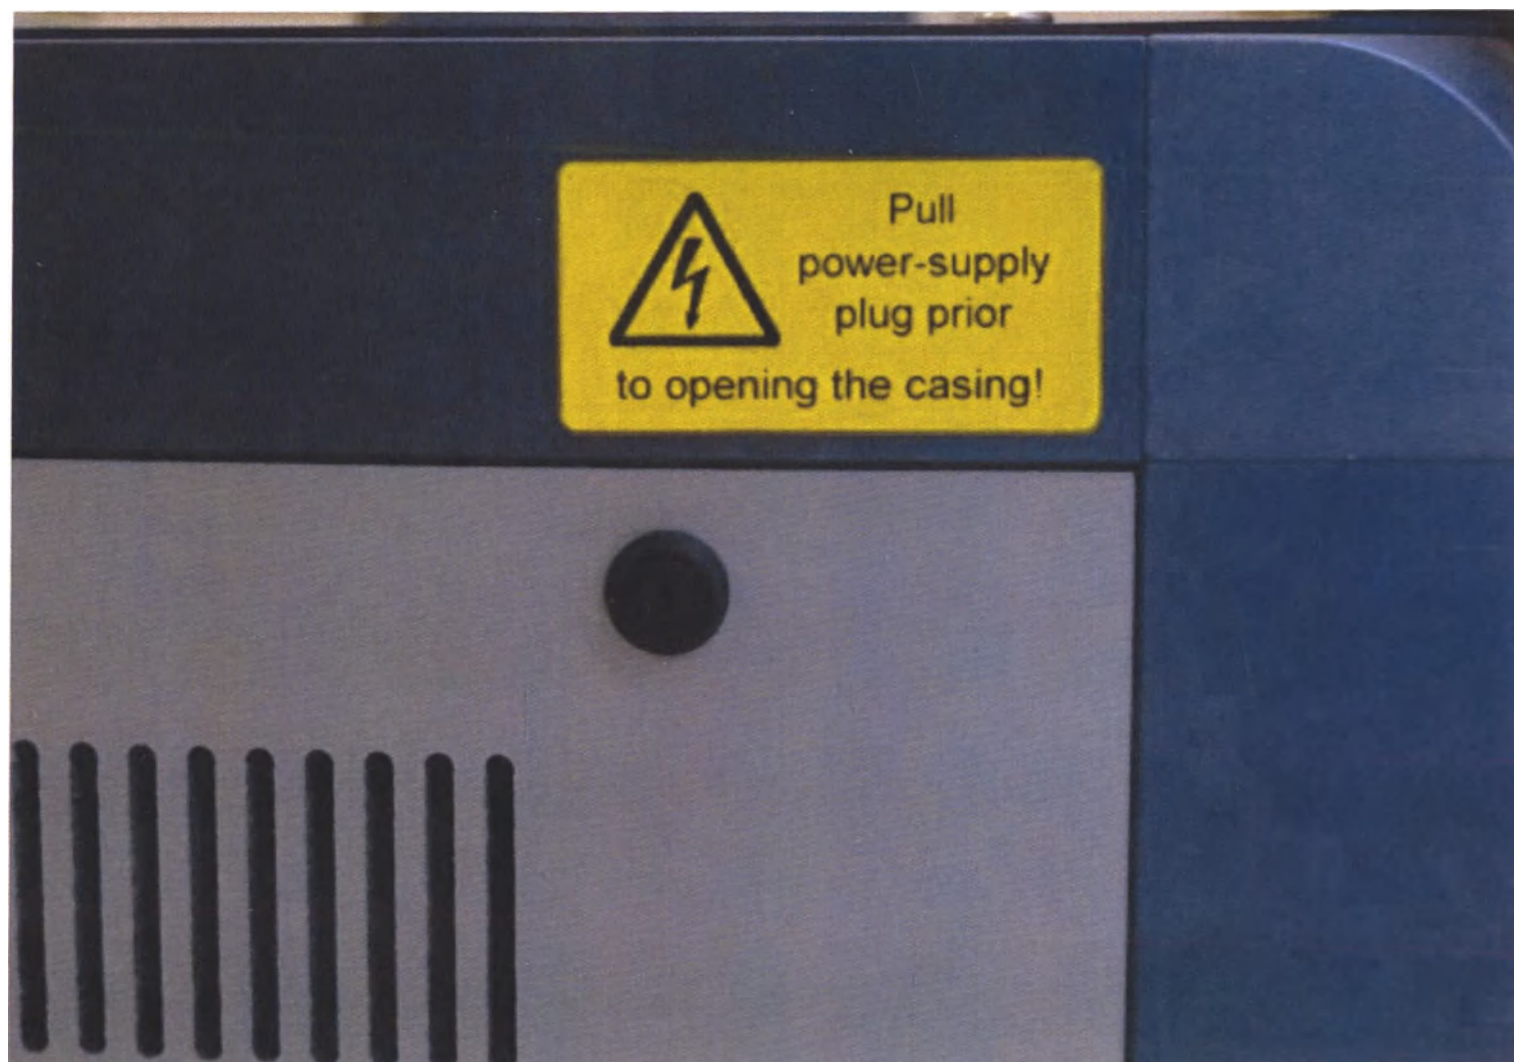

Фотографическое изображение 25 – Символ «Осторожно! Напряжение»

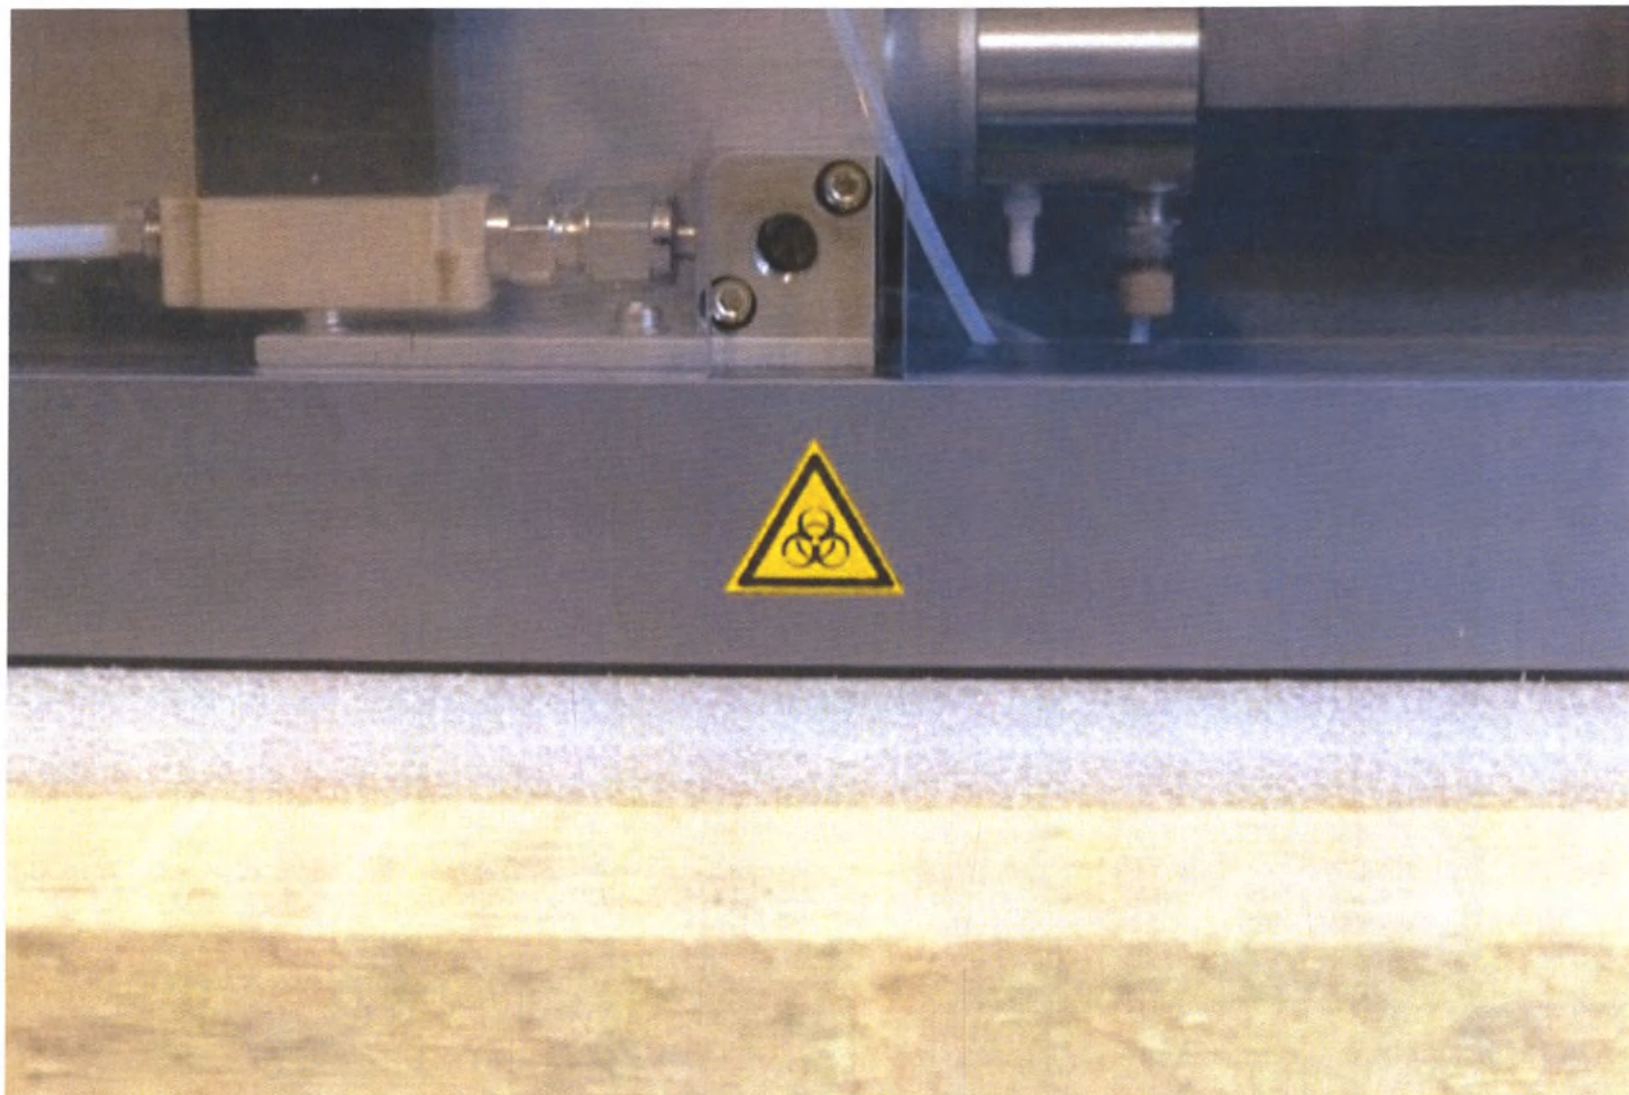

Фотографическое изображение 26 – Символ «Биологическая опасность»




Фотографическое изображение 27 – Транспортная упаковка Автосамплера для твердофазной экстракции с карт «Сухих пятен крови»
«CAMAG DBS-MS 500»

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
27 (двадцать семь) листов.

Генеральный директор

ООО «Скайлаб»

Якушева Ирина Владимировна



(подпись)

М.П.

