

Генеральный директор
ООО «Синерджи Консалтинг»
Горская О.А.

Генеральный директор
ООО «Синерджи Консалтинг»
Горская О.А.

Итд.», Австралия
NSW 2140 Australia

Ітд.», Австралія
NSW 2140 Australia

Стимулятор Microrase для диагностической электрокардиостимуляции с принадлежностями, вариант исполнения:

I. Стимулятор Microrase EPS320 для диагностической электрокардиостимуляции в составе:

1. Блок генератора стимулов с принадлежностями, в составе:

- генератор стимулов импульсный;
- компьютер Bona Lite PC;
- источник питания компьютера Bona Lite PC;
- изоляционный трансформатор
- клавиатура;
- принадлежности;
- эксплуатационная документация.

2. Монитор с сенсорным экраном в составе:

- монитор с сенсорным экраном;
- кабель питания;
- эксплуатационная документация.

3. Набор для замены компьютерного модуля для EPS320/StimLab, StimCor (при необходимости), в составе:

- компьютер Bona Lite PC;
- источник питания компьютера Bona Lite PC;
- кабель последовательного интерфейса RS232, 2м;
- клавиатура.

4. Комплект для установки (при необходимости), в составе:

- кабельные стяжки - 4 шт.;
- одиночный телефонный штекер 6,5 мм на разъем RCA - 2шт.;
- переходник с разъема BNC на штекер RCA - 2шт.;
- тестовые электроды LED - 1шт.;
- клеящийся анкер кабельной стяжки - 1шт.

Принадлежности:

1. Соединительный модуль четырехканальный (Мультиплексор стимулирующих импульсов четырехканальный).

2. Кабель управления SM-блока.

3. Комплект оборудования StimLink для обмена данными с регистратором электрофизиологических параметров, в составе:

- соединительный кабель StimLink с разъемами DB25 – DB9;
- соединительный кабель StimLink для подключения ЭФИ системы.

4. Удлинительный кабель для стимулирующих импульсов для соединительного модуля, длиной 8м, 13м и 17 м.

5. Удлинительный кабель мультиплексора стимулирующих импульсов, длиной 15 м, 27 м.


6. Удлинительный кабель последовательного порта RS232 (с радиочастотным фильтром), длиной 12м, 25м.

7. Тестовые электроды LED.

8. Компактный блок цифровой клавиатуры.

9. Кабель сигнальный с переходником от штырькового разъёма к телефонному штекеру 3м.

10. Батарея аккумуляторная на 12В.
11. Батарея литиевая на 9В.
12. Источник питания для БГС.
13. Соединительный кабель StimLink с разъемами DB25 – DB9.
14. Соединительный кабель StimLink для подключения ЭФИ системы.
15. Соединительный кабель для ЭКГ-сигнала с разъемом 6.5 Phone - 2.5 Phone.
16. Изолированный сетевой кабель, IEC, 3 × 2 контакта, для ЕС.
17. Изолированный сетевой кабель, IEC, 3 × 3 контакта.
18. Кабель последовательного интерфейса RS232, 2м.
19. Кабель питания изолирующего трансформатора.
20. Распределитель питания изолированный (Isolated IEC Power Distribution Board).
21. Монитор жидкокристаллический MicroPace NEC.
22. Блок соединения с пациентом 2-канальный с фильтром высоких частот.
23. Фиксатор кабеля питания изоляционного трансформатора MP3181.
24. Кабель передачи данных RS232 «папа-мама», длина 7.5м (25ft), 15м (50ft), 30м (100ft).

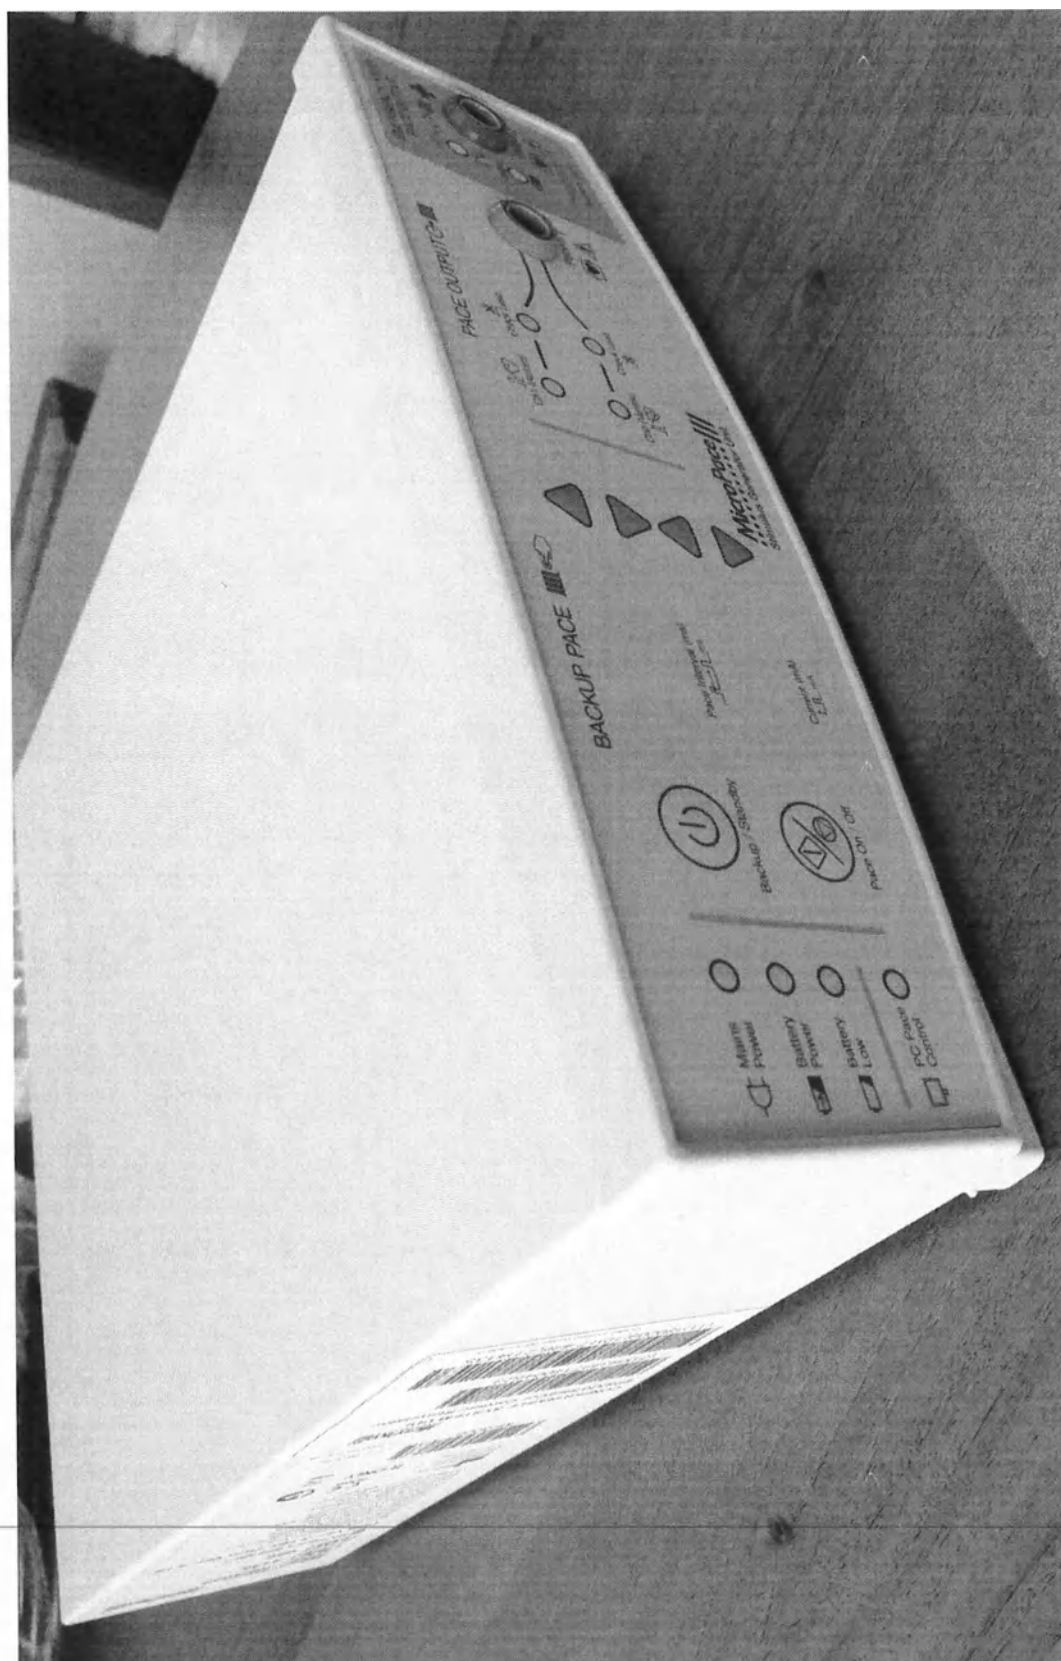

Генератор стимулов импульсный. Общий вид изделия

MicroPace///

Catalogue No.

REF MP3008

SN 4135

LOT 059

€ Micropace EPS320™

PCB Ver. 3.16d Firm Ver. 4.76

Stimulus Generator Unit

Groupe électrogène de stimulation,

Stimulus Generator Einheit,

Gruppo generatore di stimoli,

Grupo electrógeno Estimulo,

Teşvik Jeneratör Ünitesi,

Ερέθισμα γεννήτρια ασφαλείας,

Stimulační generátor pole,


Warsztat Generator Box,

Стимул блока генератора,

Inger-generátor egység,

Stimul Unitatea de generator,

Unidade estimulo gerador.



Micropace Pty Ltd,
41/159 Arthur Street
Homebush West
NSW 2140 Australia
Ph: +61 2 9718 1746

CE
0086



Rx ONLY



MP3008

2017-12

CL3008-V5.2-1116

MicroPace///

CONFIGURABLE SYSTEM UDI
EPS320/StimCor Cardiac Stimulator




(01)09349714004623



(11)180209(10)17-496(21)4135

CL3462_EPS320 System UDI-V1.0-0615

Генератор стимулов импульсный. Маркировка изделия.

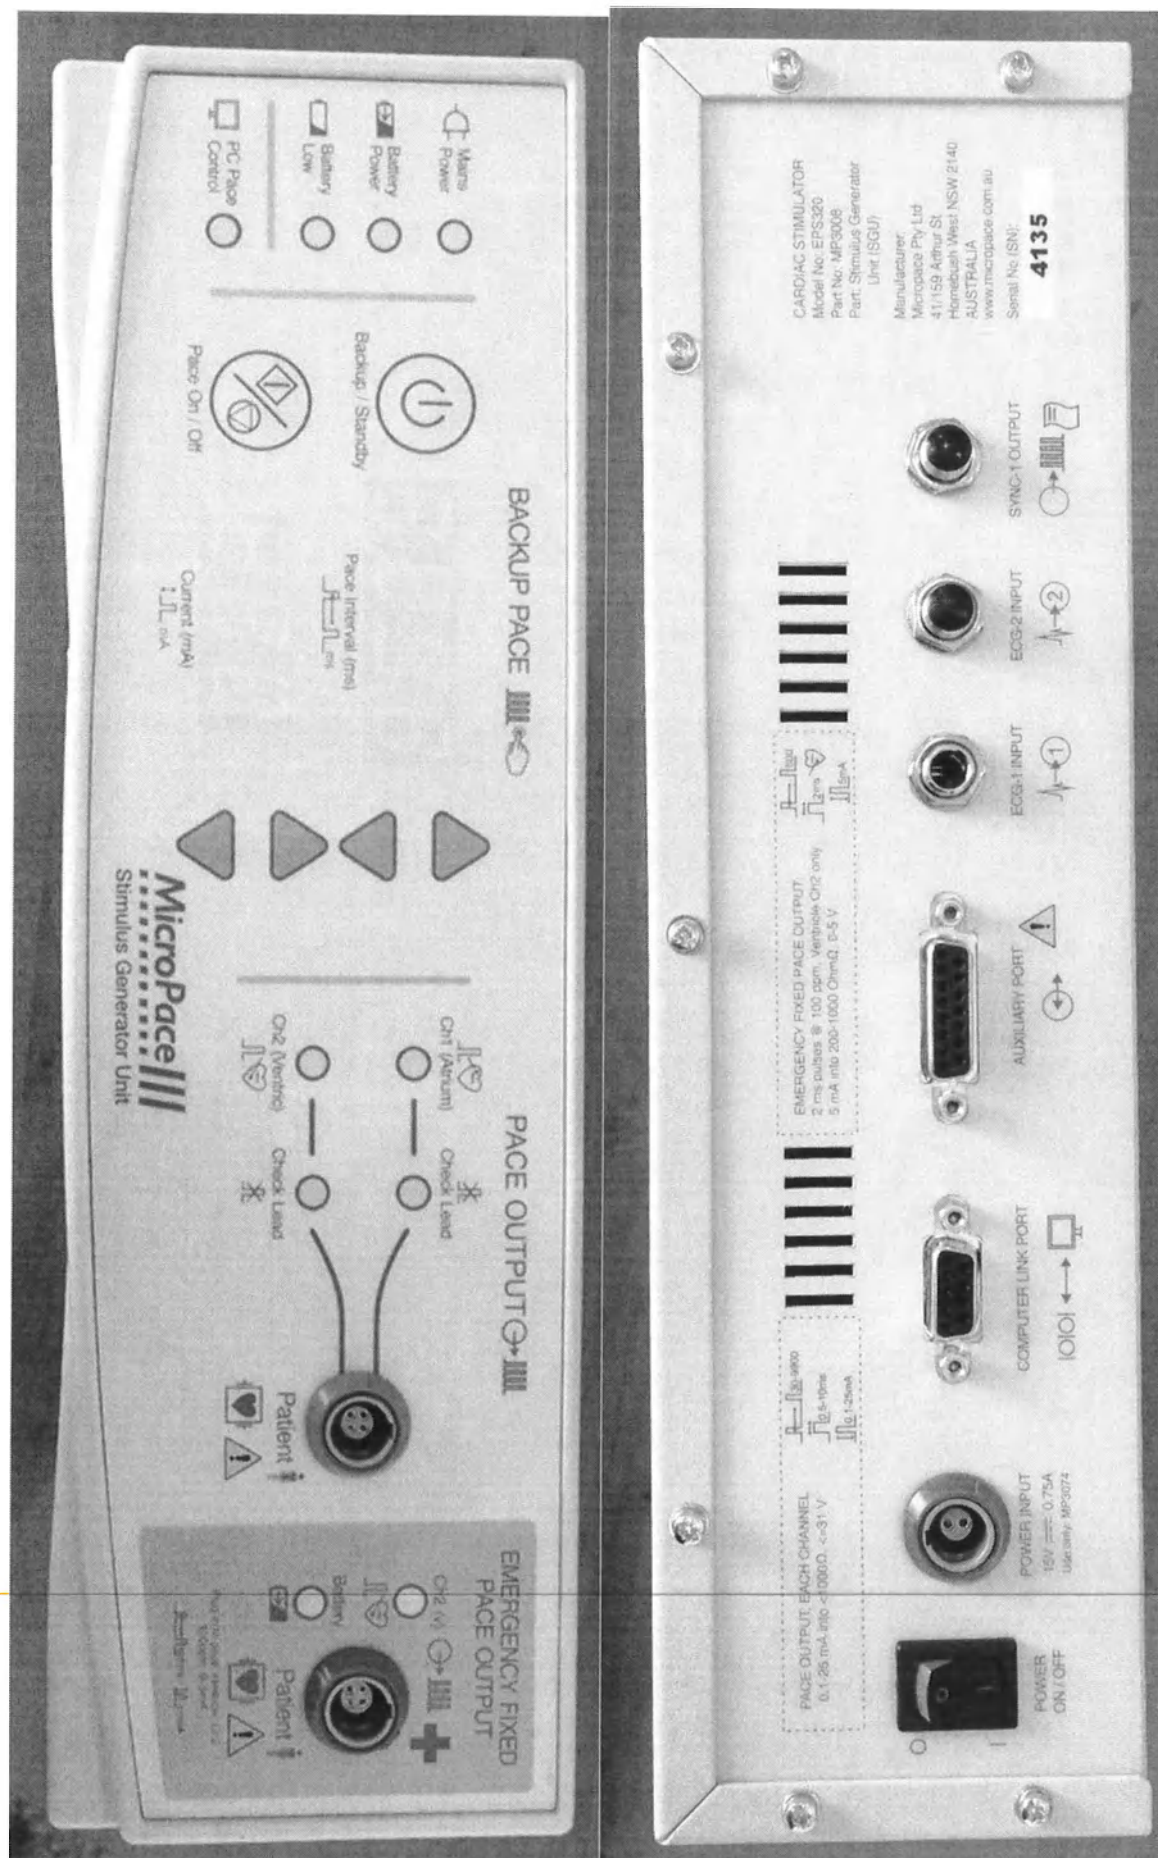

Генератор стимулов импульсный. Лицевая и обратная сторона.

MicroPace///

**BONA COMPUTECH LIGHT
SYSTEM PC**

€ Micropace EPS320™

REF Catalogue No.
MP3093

LOT 17-260



Micropace Pty Ltd.
41/159 Anhur Street
Homebush West
NSW 2140 Australia
Ph: +61 2 9718 1746



MC0872

CE
0086



Rx ONLY



L3093-V3.9-1116


**Factory Preloaded
Software V4.0
EPS320BT-2CHANNEL**

L_Factory_Preloaded 4.0-EPS320BT-2CHANNEL-V1 0-0615

Компьютер Bona Lite PC. Маркировка изделия



Компьютер Bona Lite PC. Общий вид изделия.

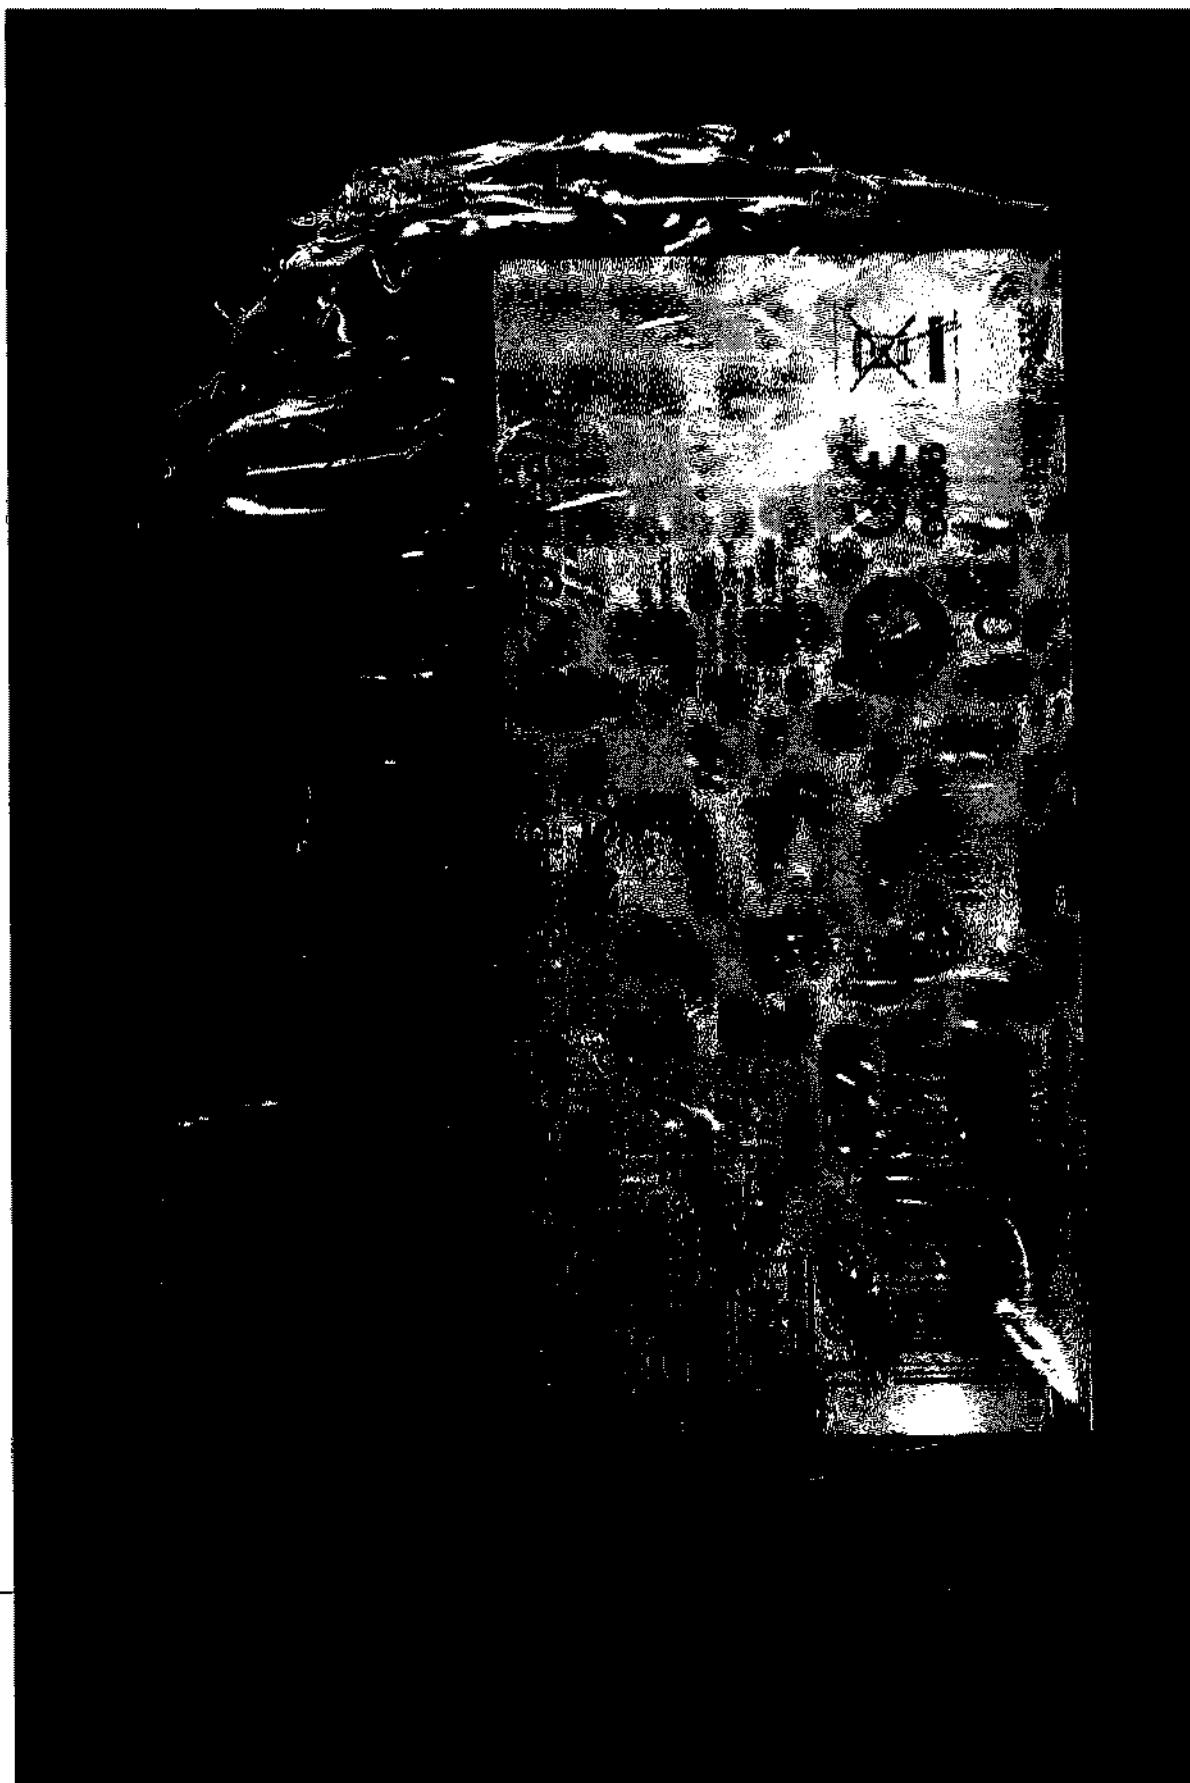

Источник питания компьютера Bona Lite PC. Маркировка изделия



Источник питания компьютера Bona Lite PC. Общий вид изделия.

Изоляционный трансформатор. Маркировка изделия сзади.

 **POWERTRONIX**


Isolation Station TM 

**ISOLATION TRANSFORMER
3RD ED - 300VA**



€ Micropace EPS320 TM

REF Catalogue No. **MP3107**


LOT **17-259**

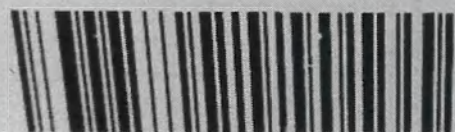

MC0669



Connect to Micropace Product only
Connecter à Micropace produit seulement
Verbinden Sie Produkt nur Micropace
Connettersi a Micropace prodotto solo
Conectar con Micropace producto sólo
Ligue apenas ao produto Micropace


Legal
Manufacturer
Micropace Pty Ltd
41/159 Arthur Street
Homebush West
NSW 2140 Australia
Ph: +61 2 9718 1746

CE
0086



R_x ONLY



L3107-V2 3-1116

Power Isolation Unit

300 VA



WARRANTY VOID IF THIS SEAL IS BROKEN.

WARRANTY VOID IF THIS SEAL IS BROKEN.



PLEASE REFER TO PRODUCT MANUAL FOR IMPORTANT OPERATING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS.

THIS APPARATUS IS A CLASS I EQUIPMENT.

WARRANTY VOID IF THIS SEAL IS BROKEN.

DANGER:

RISK OF EXPLOSION OF USED IN THE PRESENCE OF FLAMMABLE ANESTHETICS, OR OTHER FLAMMABLE GASES OR LIQUIDS.

NOTE:

USA AND CANADA; GROUNDING RELIABILITY CAN ONLY BE ACHIEVED WHEN THIS EQUIPMENT IS CONNECTED TO A RECEPTACLE MARKED "HOSPITAL ONLY", OR "HOSPITAL GRADE".

CAUTION:

THIS PRODUCT REQUIRES CONVECTION COOLING. ADEQUATE VENTILATION IS REQUIRED. CLEARANCE OF 2" MINIMUM ON ANY SIDE.

CAUTION:



TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK, DO NOT OPEN ENCLOSURE. NO SERVICEABLE PARTS INSIDE.

WARRANTY VOID IF THIS SEAL IS BROKEN.

POWERTRONIX

Isolation Station™

PART NO: X1ATWFHNOC1
 INPUT VOLTAGE: 115 (120) / 230 (240) VAC - 50/60Hz
 INPUT CURRENT: 2.6 A / 1.3 A
 LEAKAGE CURRENT: < 100 µA
 OUTPUT VOLTAGE: 115 (120) / 230 (240) VAC
 OUTPUT CURRENT: 2.5 A / 1.25 A



POWERTRONIX Corporation - Foster City, CA, USA - (650) 345-6800
www.powertronix.com

Изоляционный трансформатор. Маркировка изделия сверху.

MicroPace///

COMPUTER KEYBOARD

€ Micropace EPS320™


Catalogue No.

REF MP3016

LOT 17-281



MC0950




Micropace Pty Ltd.
41/159 Arthur Street
Homebush West
NSW 2140 Australia
Ph: +61 2 9718 1746

CE
0086



Rx ONLY

L3016-V4.4-1116

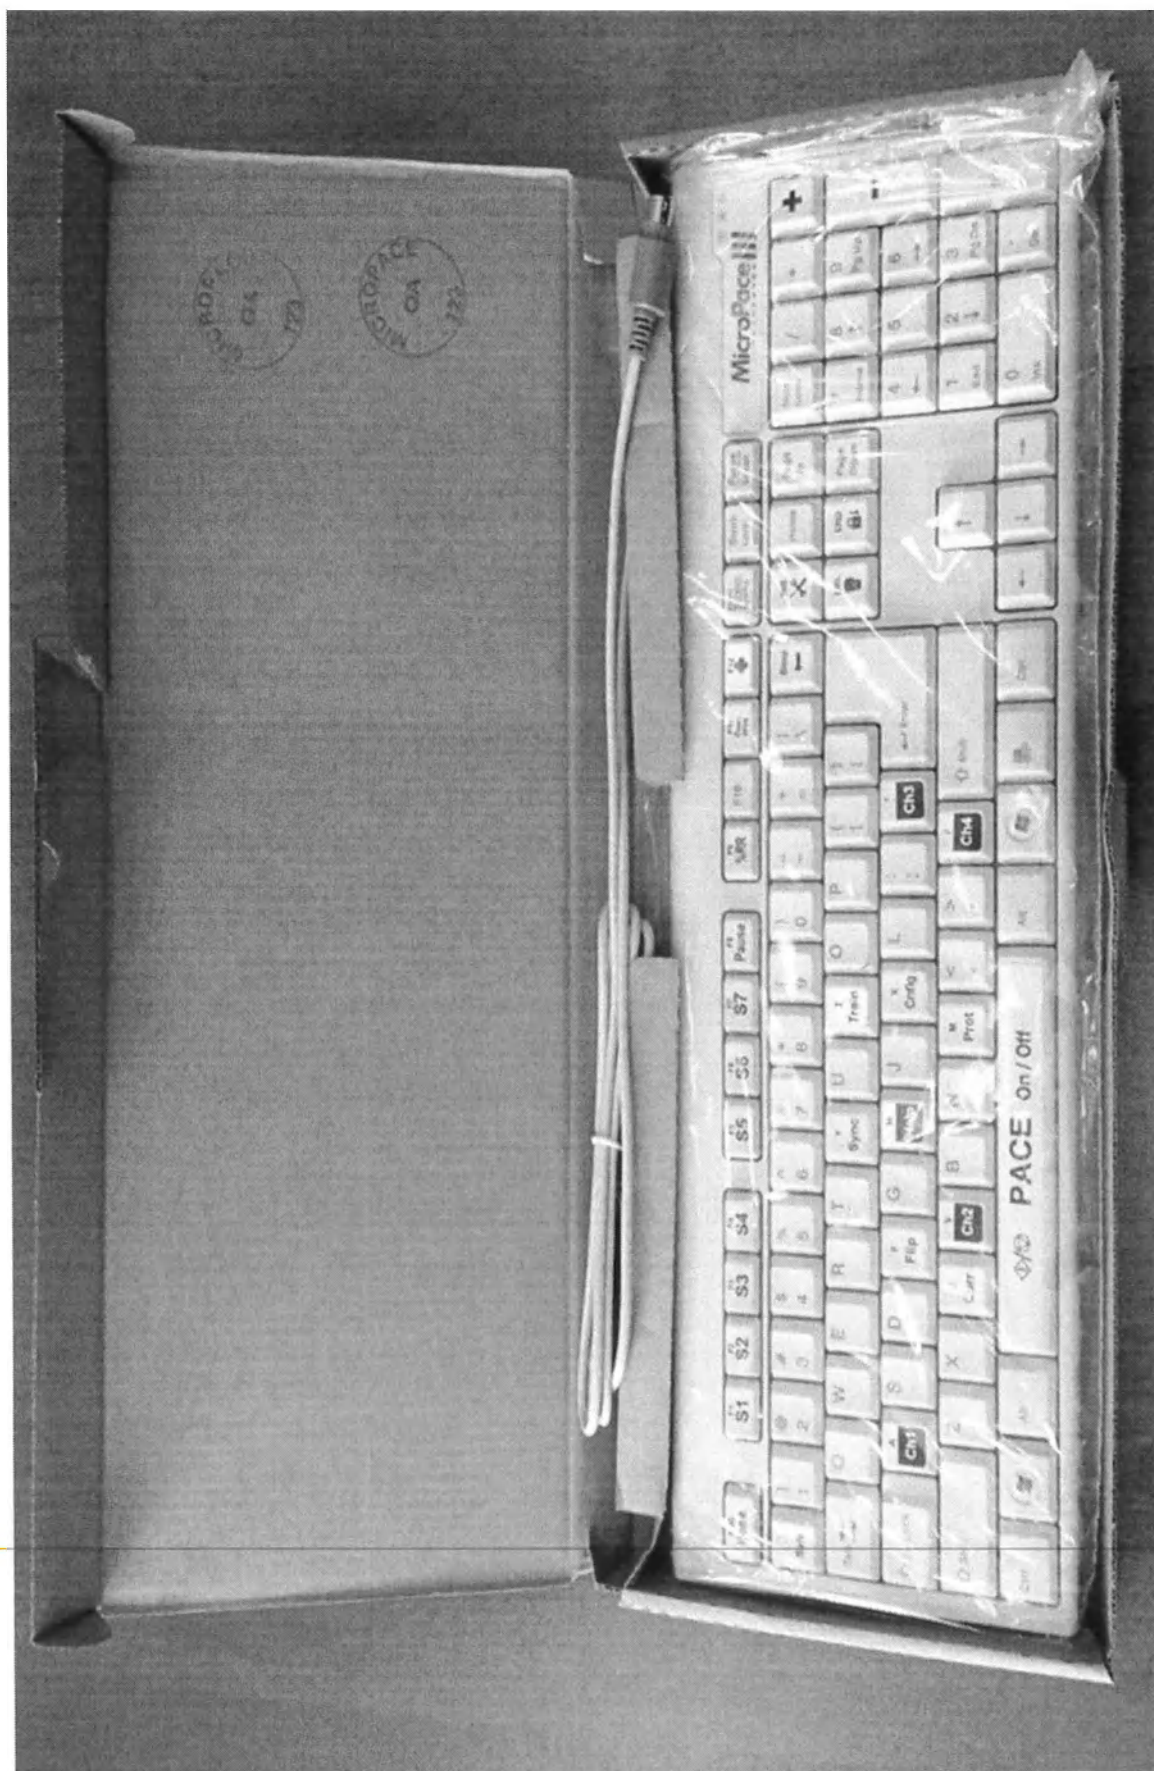

Клавиатура. Общий вид изделия.




Монитор с сенсорным экраном. Маркировка изделия.



Монитор с сенсорным экраном. Общий вид изделия.




Кабель питания. Маркировка изделия.

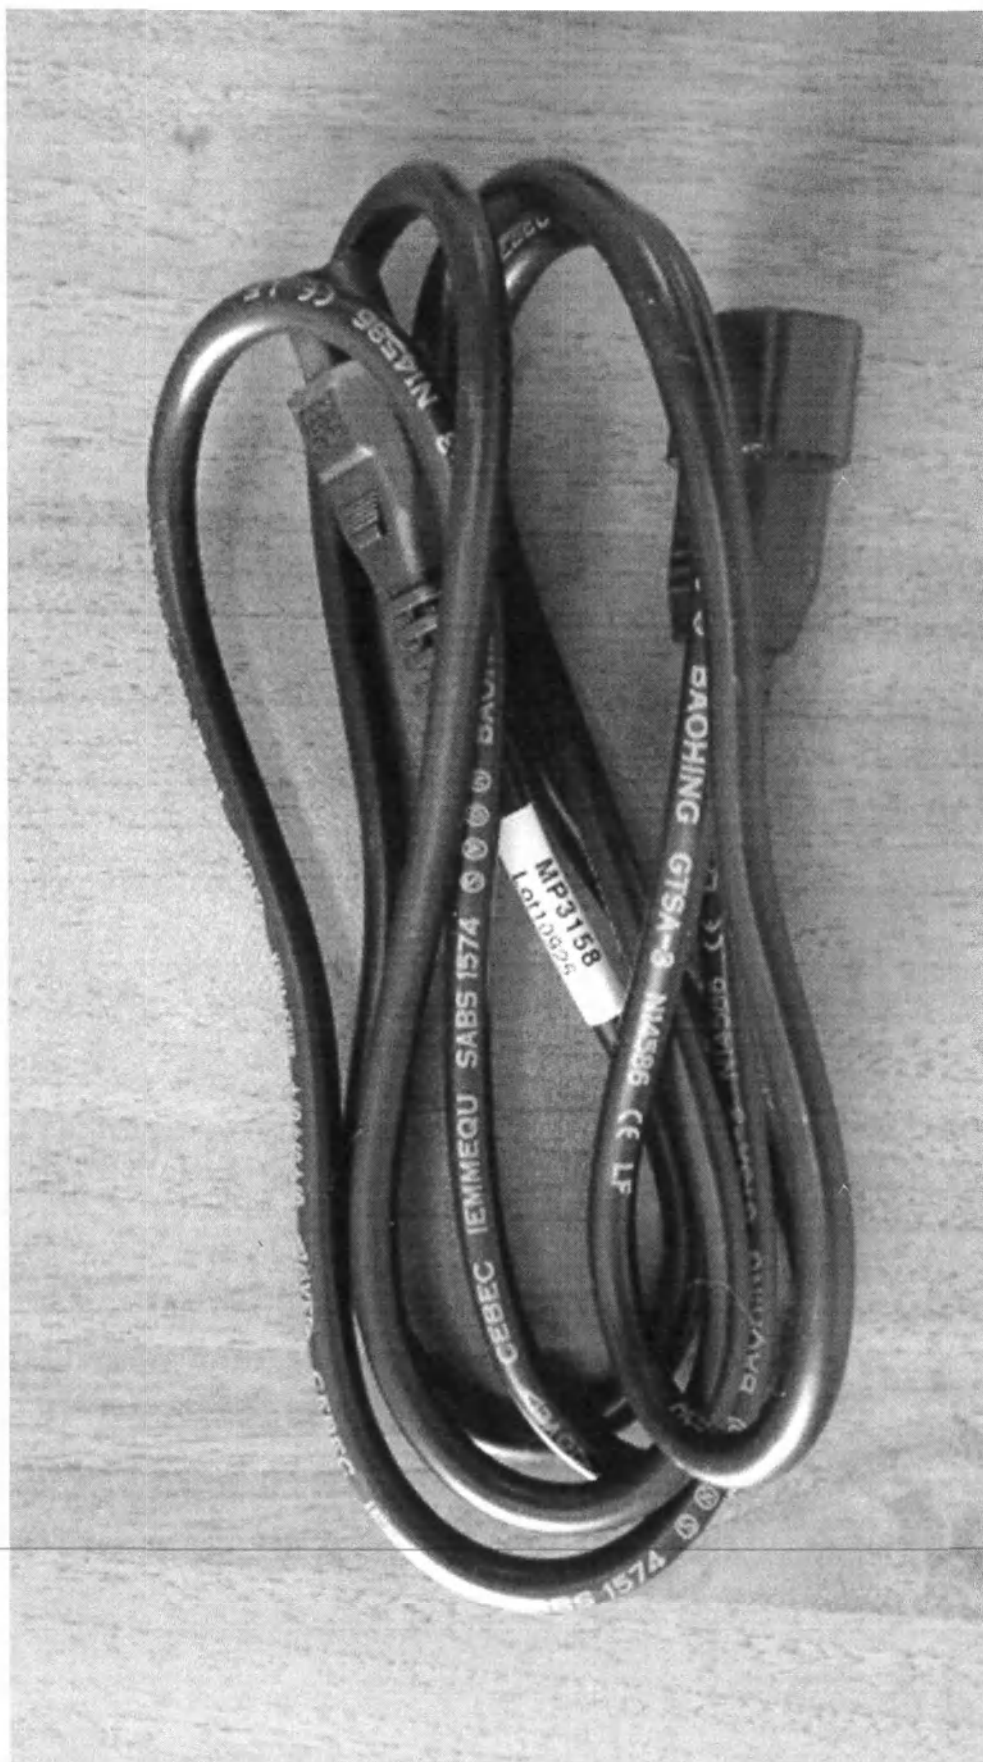

Кабель питания Общий вид изделия



Комплект для установки. Маркировка изделия

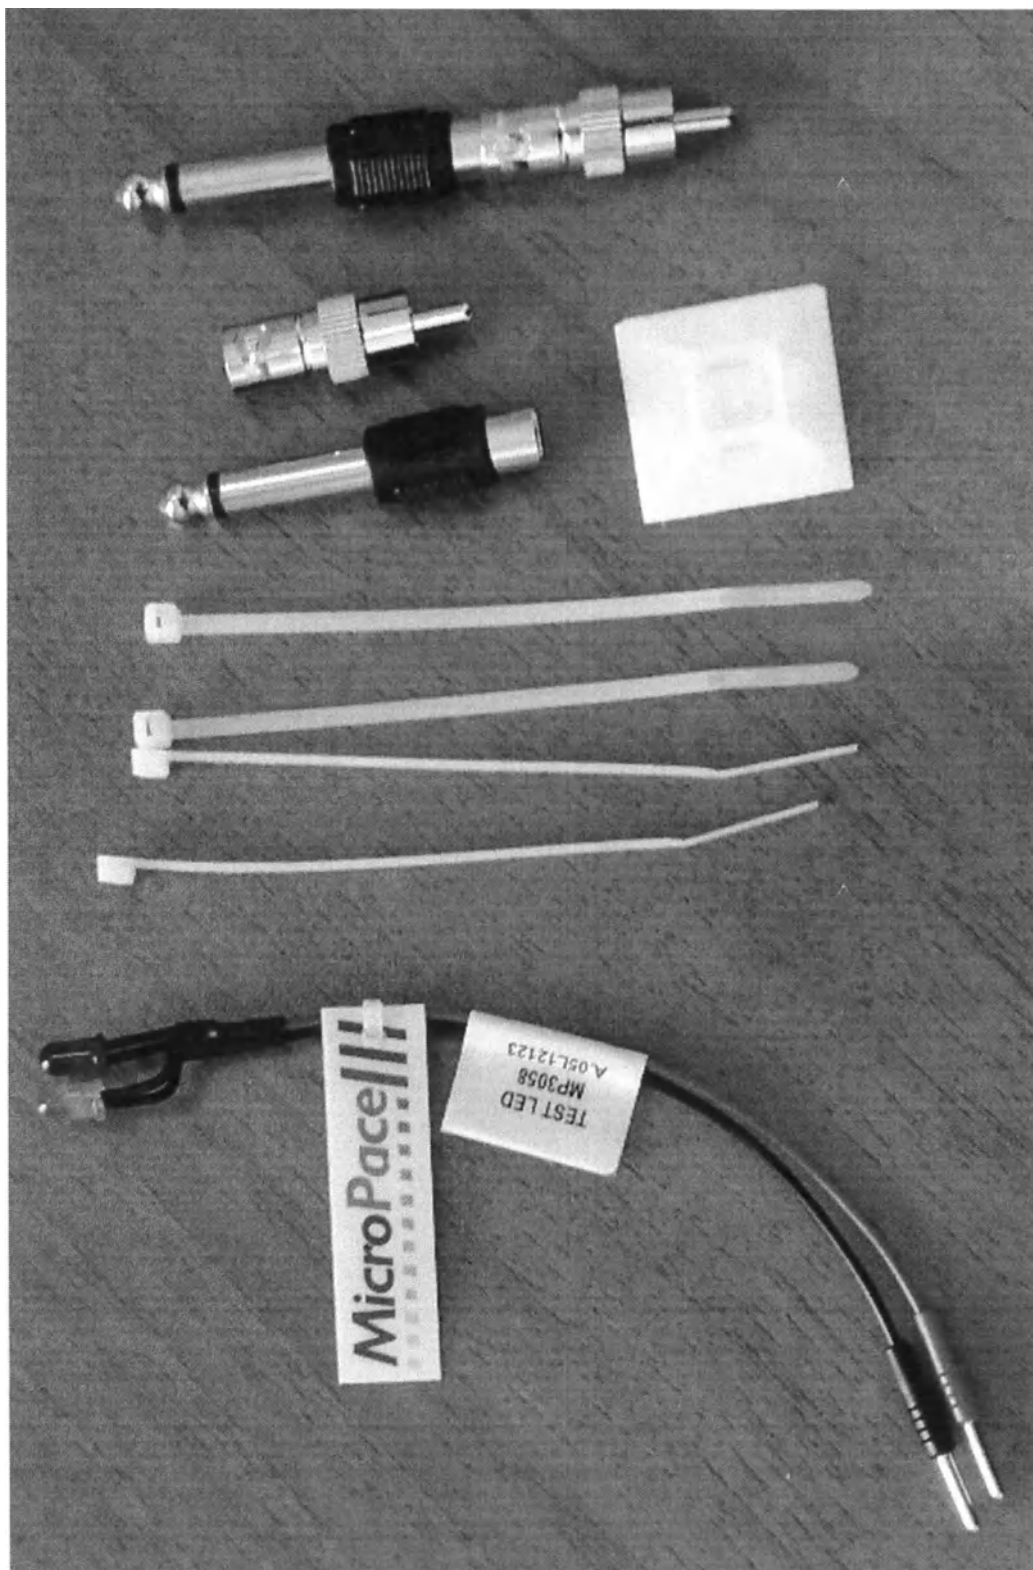

Комплект для установки. Общий вид изделия.

- кабельные стяжки - 4 шт.;
- одиночный телефонный штекер 6,5 мм на разъем RCA - 2шт.;
- переходник с разъема BNC на штекер RCA - 2шт.;
- тестовые электроды LED - 1шт.;
- клеящийся анкер кабельной стяжки - 1шт.

Принадлежности: Соединительный модуль четырехканальный (Мультиплексор стимулирующих импульсов четырехканальный). Маркировка изделия.

REF Catalogue No.
MP3086

SN 2513

LOT 11471

Stimulus Multiplexer Box, Multiplexeur de stimulation
de la case, Stimulus Multiplexer Box, Multiplexer di stimolo,
Cuadro estímulo multiplexor, Teşvik Çoklayıcı Kutu, Ερέθισμα
Πολυπλέκτη ασφαλείας, Stimulační Multiplexer Box, Warsztat
Multiplexer Box, Стимул мультиплексор окно, Inger
multiplexer, Stimul Multiplexer Box, Multiplexador estímulo
Caixa



MP3086

Micropace EPS320™

MicroPace III



Legal
Manufacturer
Micropace Pty Ltd.
41/159 Arthur Street
Homebush West
NSW 2140 Australia
Ph: +61 2 9718 1746


CE
0086



Rx ONLY



CL3086-V3.0-1116

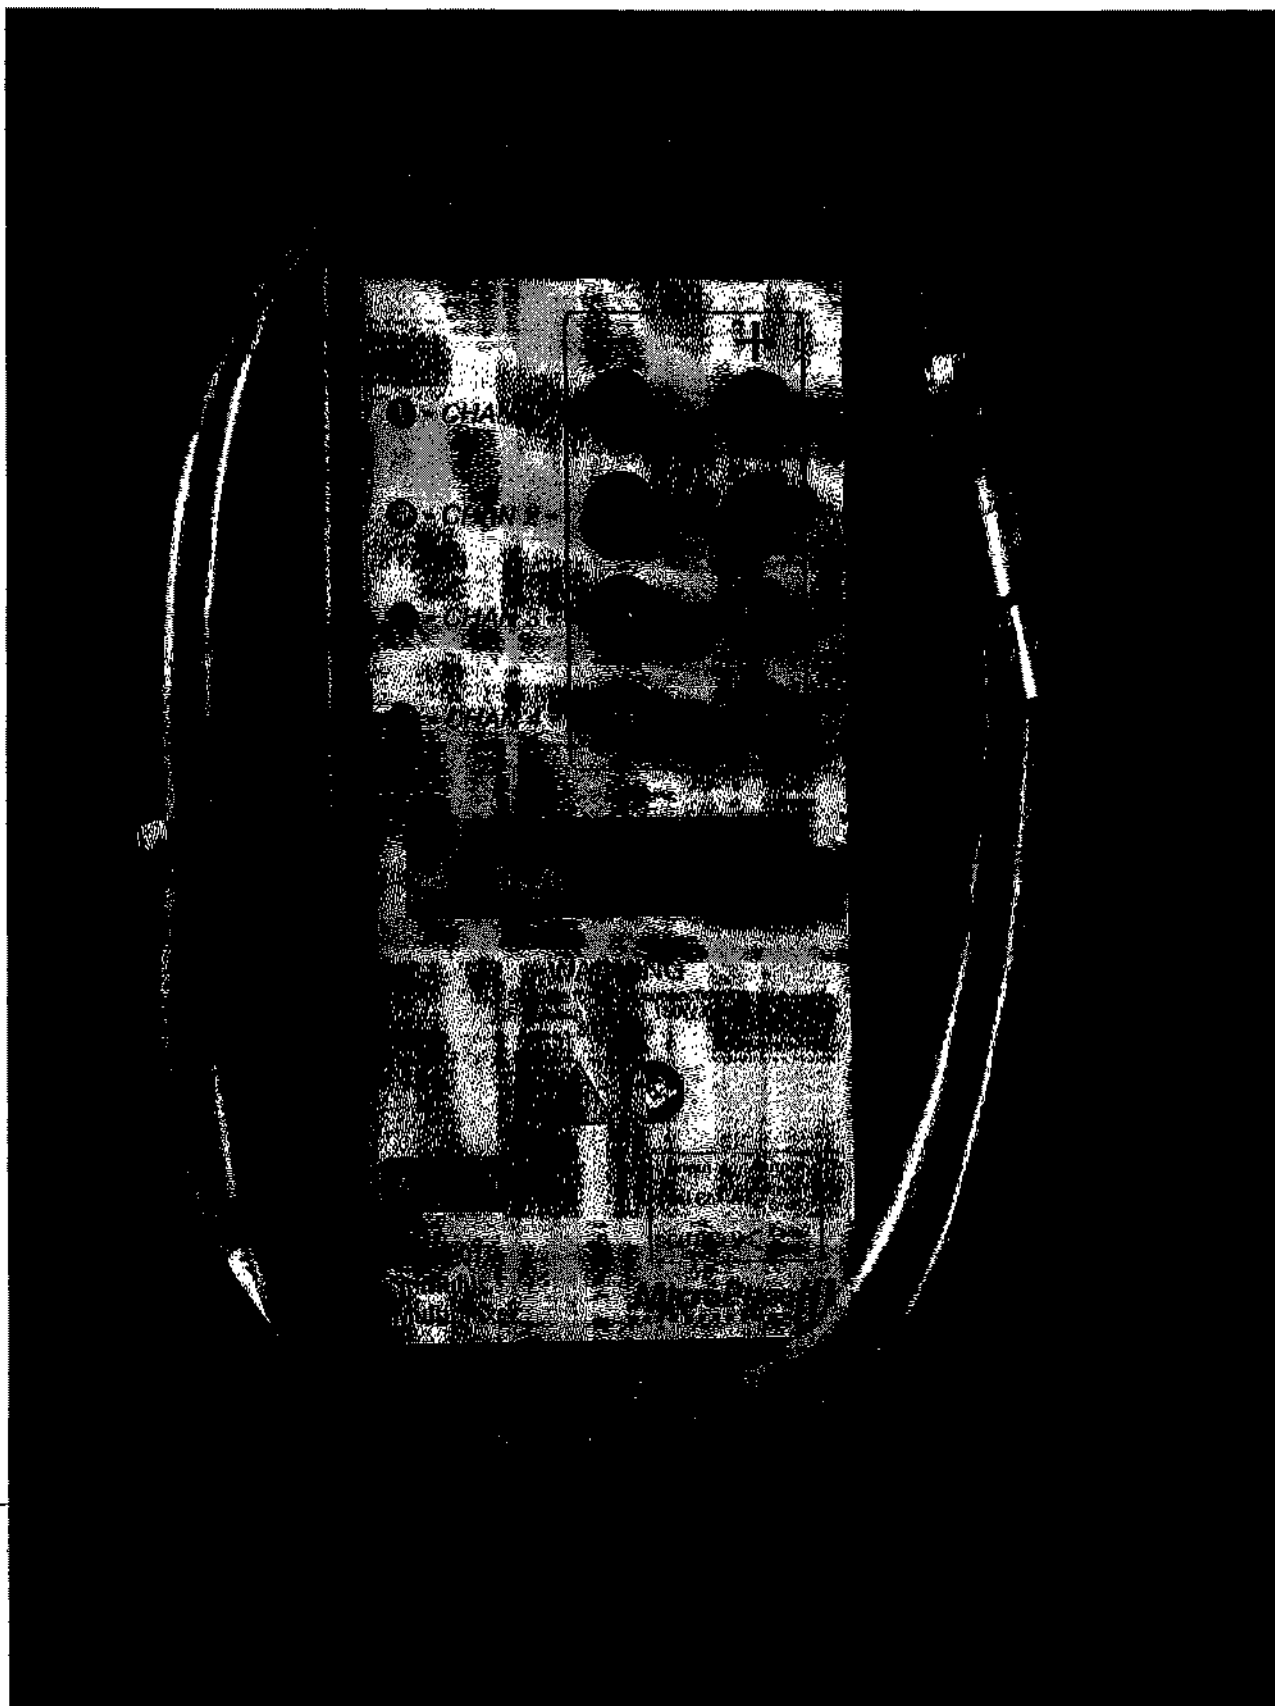

Принадлежности: Соединительный модуль четырехканальный (Мультиплексор стимулирующих импульсов четырехканальный). Общий вид изделия.



Принадлежности: Кабель управления SM-блока. Маркировка изделия.

Catalogue No.
REF MP3070-17

LOT 12618

MicroPaceIII


€ Micropace EPS320™

Low Capacitance Stimulus Extension Cable 17M. Câble
D'extension de stimulation de faible capacité 17M.
Niedrige Kapazität Stimulus Verlängerungskabel 17M.
Stimolo a bassa capacità Cavo prolunga 17M, Estimulo-
17M Cable de extensión, Düşük Kapasitans Teşvik
Uzatma Kablosu 17M, Χαμηλή χωρητικότητα επέκταση
καλώδιο προέκτασης 17M, Nizkou kapacitanci stimulačni
prodlužovací kabel 17M, Iska Reaktancja Stimulus Kabel
przedłużający 17M, Низкая емкость стимул кабель-
удлинитель 17M, Kiskapacitású inger hosszabbító kábel
17M, Cablu prelungitor de joasă capacitate stimul 17M,
Baixa capacitância estímulo 17M Cabo de Extensão



Legal
Manufacturer

Micropace Pty Ltd.
41/159 Arthur Street
Homebush West
NSW 2140 Australia
Ph: +61 2 9718 1746

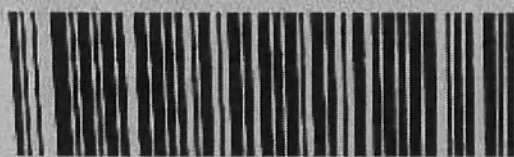

MP307017


CE
0086

Rx ONLY



CL3070-17-V1.3-1116


Принадлежности: Удлинительный кабель для стимулирующих импульсов для соединительного модуля, длиной 17 м. Маркировка изделия.

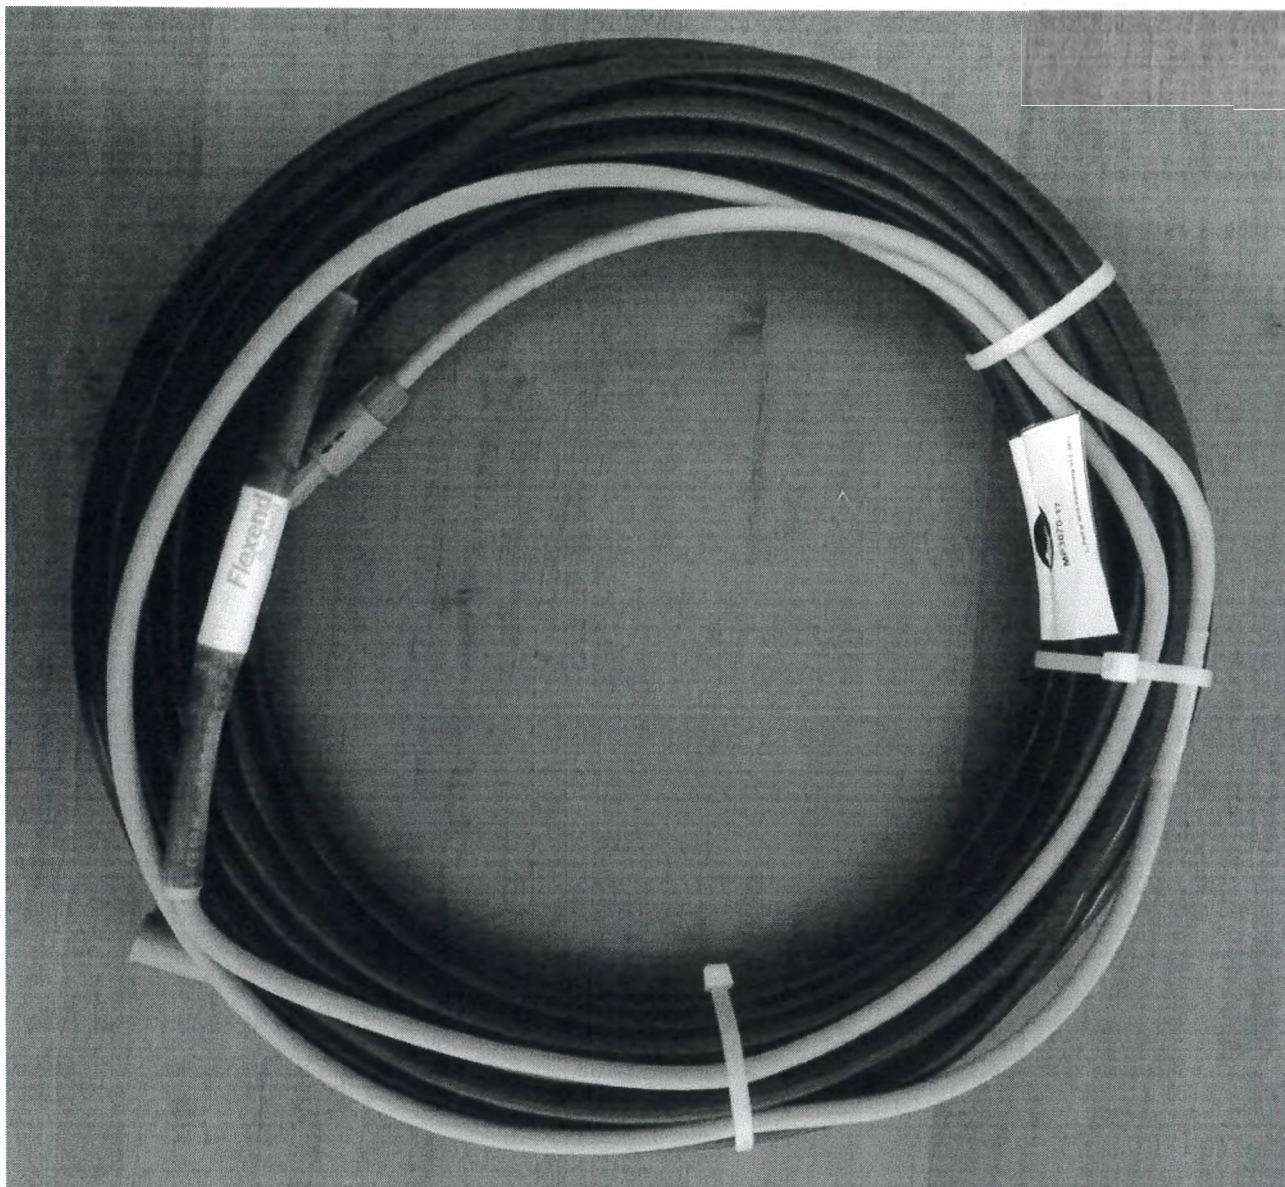

Принадлежности: Удлинительный кабель для стимулирующих импульсов для соединительного модуля, длиной 17 м. Общий вид изделия.




Принадлежности: Удлинительный кабель мультиплексора стимулирующих импульсов, 15 м.
Маркировка изделия.

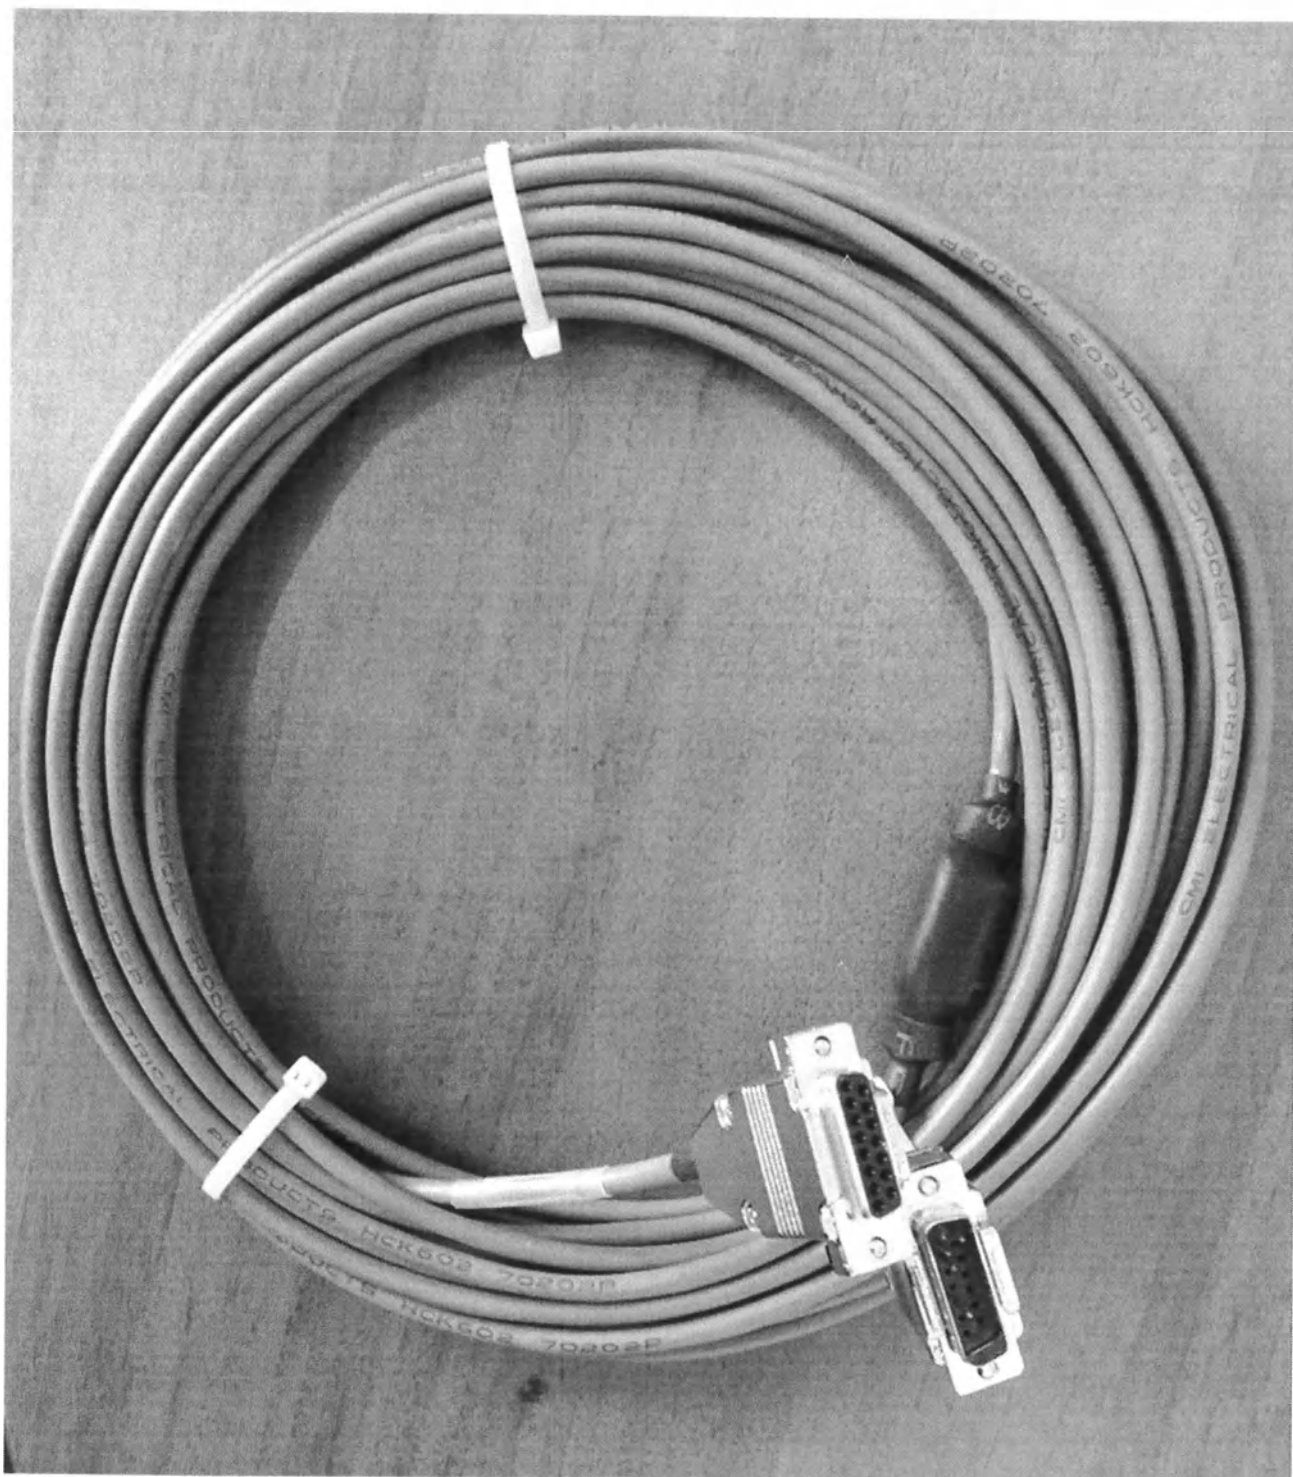

Принадлежности: Удлинительный кабель мультиплексора стимулирующих импульсов, 15 м.
Общий вид изделия.

Принадлежности: Тестовые электроды LED. Маркировка изделия

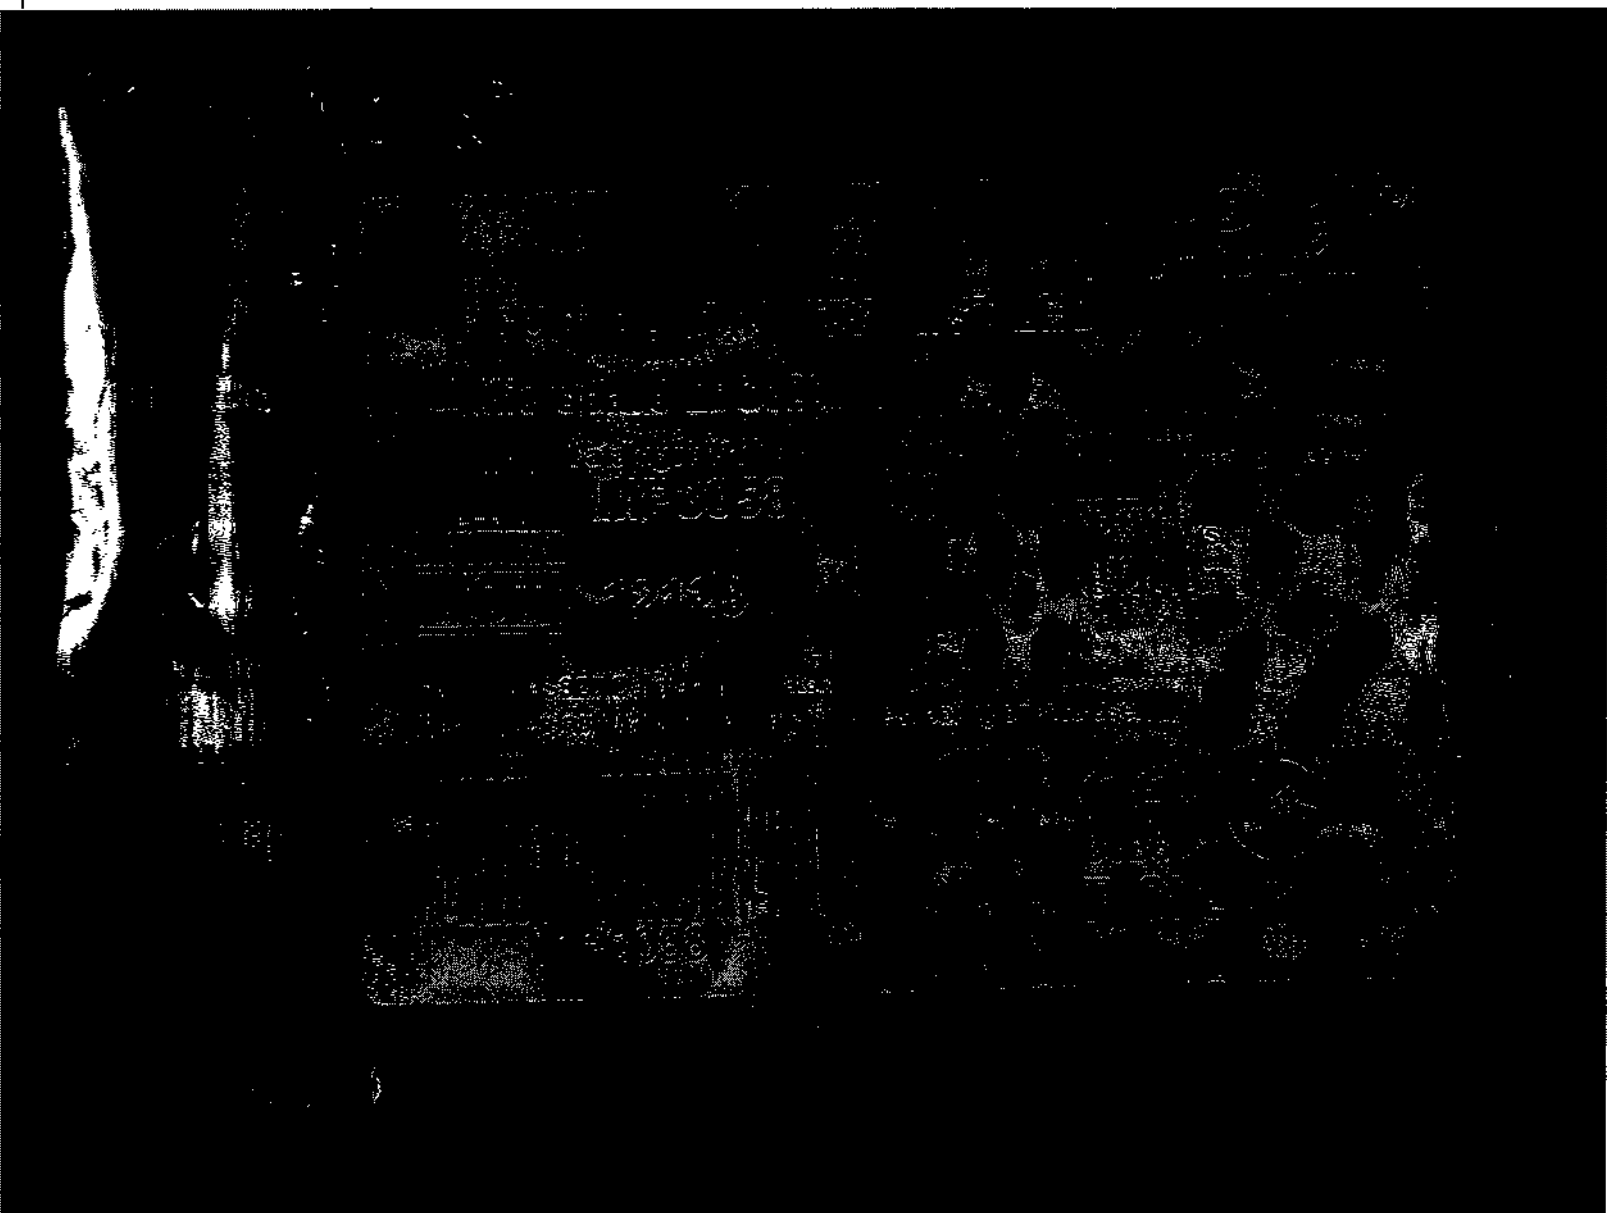



Принадлежности: Тестовые электроды LED. Общий вид изделия.

MicroPace///

COMPACT NUMERIC KEYPAD

Catalogue No.

REF MP3393

Product No.

UPN 200MP3393

LOT 16-270



GTIN
GS1



(01) 09349714003930



(11) 161024 (10) 16-270



MicroPace Pty Ltd
7/185-188 Canterbury Rd.
Canterbury, NSW 2193
Australia
Ph: +61 2 9718 1746
Made in Australia

CE
0086
R ONLY

EC REP EU Authorized Representative

Advena Ltd, Pure Offices,
Plato Close, Warwick CV34 6WE UK

Distributed by:
Boston Scientific Corporation
300 Boston Scientific Way
Marlborough, MA 01752
USA
USA Customer Service 888-272-1001



R_MP3393_BSC_V1.2.doc

Принадлежности: Компактный блок цифровой клавиатуры. Маркировка



Принадлежности: Компактный блок цифровой клавиатуры. Маркировка



Принадлежности: Компактный блок цифровой клавиатуры. Общий вид изделия.

MicroPace


BNC TO PHONE PLUG SIGNAL CABLE

Micropace EPS320™

Catalogue No.

REF MP3109

LOT 12128



Micropace Pty Ltd.
41/159 Arthur Street
Homebush West
NSW 2140 Australia
Ph: +61 2 9718 1746

Do not use if lead appears damaged. Nicht benutzen wenn das Kabel beschädigt zu sein scheint. Ne pas utiliser si le cable paraît endommagé. Se il conduttore appare danneggiato, non usarlo. No usar si el cable parece dañado.



CE

0086

Rx ONLY

L3109-V1.7-1116



MP3109

Принадлежности: Кабель сигнальный с переходником от штырькового разъёма к телефонному штекеру 3м. Маркировка изделия.



Принадлежности: Кабель сигнальный с переходником от штырькового разъёма к телефонному штекеру 3м. Общий вид изделия

Принадлежности: Батарея аккумуляторная на 12В. Маркировка изделия и общий вид



Принадлежности: Источник питания для БГС. Маркировка изделия.





Принадлежности: Источник питания для БГС. Общий вид изделия.

Принадлежности: Соединительный кабель для ЭКГ-сигнала с разъемом 6.5 Phone - 2.5 Phone.
Маркировка изделия.

SIGNAL CABLE WITH PHONE PLUGS

€ Micropace EPS320™

Catalogue No.

REF MP3034


LOT 11987

Do not use if lead appears damaged. Nicht benutzen wenn das Kabel beschädigt zu sein scheint. Ne pas utiliser si le cable paraît endommagé. Se il conduttore appare danneggiato, non usarlo. No usar si el cable parece dañado.



MP3034

MicroPace///



Micropace Pty Ltd.
41/159 Arthur Street
Homebush West
NSW 2140 Australia
Ph: +61 2 9718 1746

CE
0086



Rx ONLY

L3034-V3.9-1116



**Принадлежности: Соединительный кабель для ЭКГ-сигнала с разъемом 6.5 Phone - 2.5 Phone.
Общий вид изделия.**

MicroPace|||

**ISOLATED MAINS POWER LEAD
IEC 3 TO 2 Pin - EU STYLE**

€ Micropace EPS320™

REF Catalogue No. **MP3066EU**

LOT **11204**



Micropace Pty Ltd.
41/159 Arthur Street
Homebush West
NSW 2140 Australia
Ph: +61 2 9718 1746

Do not use if lead appears damaged.

Nich benutzen wenn das Kabel beschädigt zu sein scheint.

Ne pas utiliser si le cable paraît endommagé.

Se il conduttore appare danneggiato, non usarlo.

No usar si el cable parece dañado.



MP3066EU

CE
0086



L3066EU-V4 1-1116

Принадлежности: Изолированный сетевой кабель, IEC, 3 × 2 контакта, для ЕС. Маркировка изделия.



Принадлежности: Изолированный сетевой кабель, IEC, 3 × 2 контакта, для ЕС. Общий вид изделия.

Принадлежности: Изолированный сетевой кабель, IEC, 3 x 3 контакта. Маркировка изделия.

MicroPace///

Isolated Mains Power Lead IEC3 to 3 Pin

€ Micropace EPS320™


Catalogue No.
REF MP3030

LOT 10924

Connect only to isolated mains power supply via item
MP3107/MP3001US.
Do not use if lead appears damaged.



MC0346




Micropace Pty Ltd.
41/159 Arthur Street
Homebush West
NSW 2140 Australia
Ph: +61 2 9718 1746

CE
0086



Rx ONLY

L3030-V2.9-1116

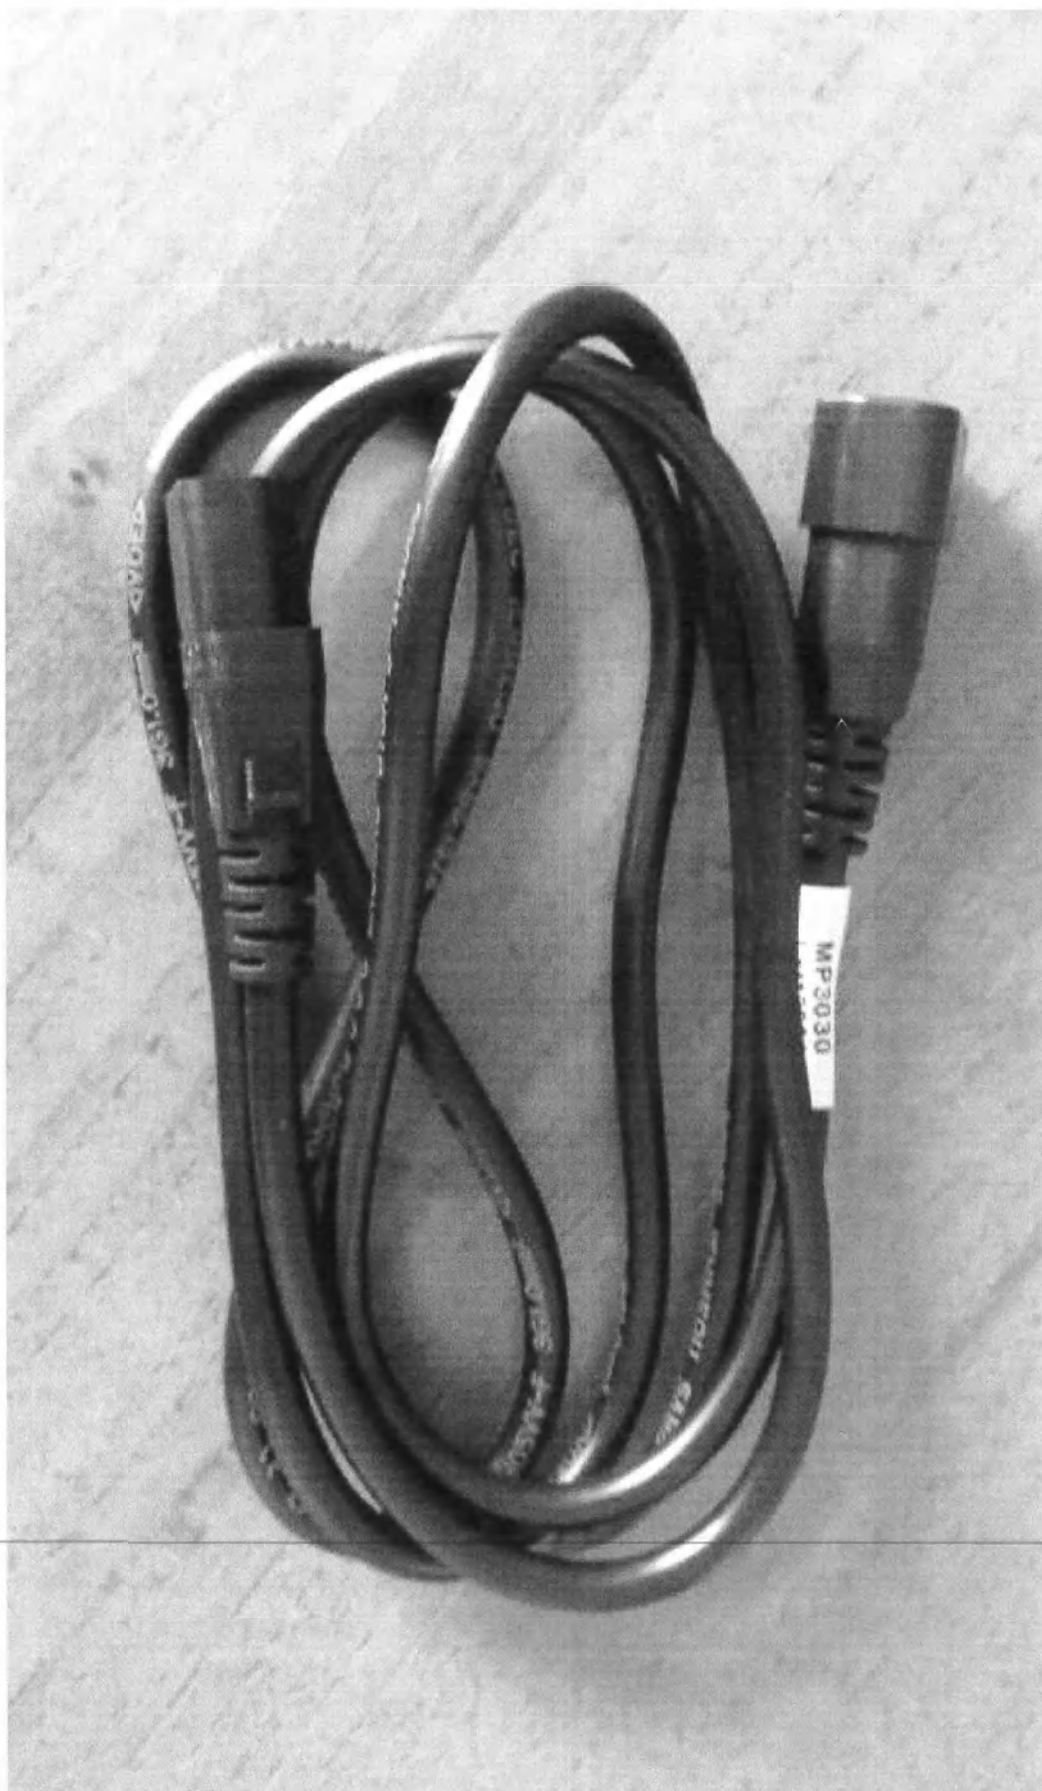

Принадлежности: Изолированный сетевой кабель, ИЕС, 3 × 3 контакта. Общий вид изделия.

Принадлежности: Кабель последовательного интерфейса RS232, 2м. Маркировка изделия.


MicroPace///

SERIAL BOOST RS232 CABLE - 2M

€ Micropace EPS320™

Catalogue No.
REF MP3033A

LOT 12175



Micropace Pty Ltd.
41/159 Arthur Street
Homebush West
NSW 2140 Australia
Ph: +61 2 9718 1746

Do not use if lead appears damaged.
Nicht benutzen wenn das Kabel beschädigt zu sein scheint.
Ne pas utiliser si le cable paraît endommagé.
Se il conduttore appare danneggiato, non usarlo.
No usar si el cable parece dañado.



MP3033A

CE
0086



Rx ONLY



L3033A-V1.8-1116



Принадлежности: Кабель последовательного интерфейса RS232, 2м. Общий вид изделия.


MicroPace
ISOLATION TRANSFORMER POWER
LEAD - EU SCHUKO STYLE

€ Micropace EPS320™

Catalogue No.

REF MP3059EU

LOT 11816



Micropace Pty Ltd.
41/159 Arthur Street
Homebush West
NSW 2140 Australia
Ph: +61 2 9718 1746

Connect to mains power supply and Isolation Transformer Item MP3107.
Do not use if lead appears damaged.

Mit Netzstrom und dem Isoliertransformator verbinden, Artikel MP3107.

Nicht benutzen, wenn das Kabel beschädigt zu sein scheint.

Brancher sur l'alimentation secteur et sur le transformateur d'isolement -Article MP3107.

Ne pas utiliser si le cable paraît endommagé.

Allacciarsi alla rete di distribuzione e al Trasformatore d'Isolamento, articolo MP3107.

Se il conduttore appare danneggiato, non usarlo.

Conecte al suministro de la red de alimentación y al Transformador de Aislación

Artículo MP3107. No usar si el cable parece dañado.



MP3059EU




L3059EU-V2.0-1116



Принадлежности: Кабель питания изолирующего трансформатора. Общий вид изделия.

Принадлежности: Блок соединения с пациентом 2-канальный с фильтром высоких частот.
Маркировка изделия.




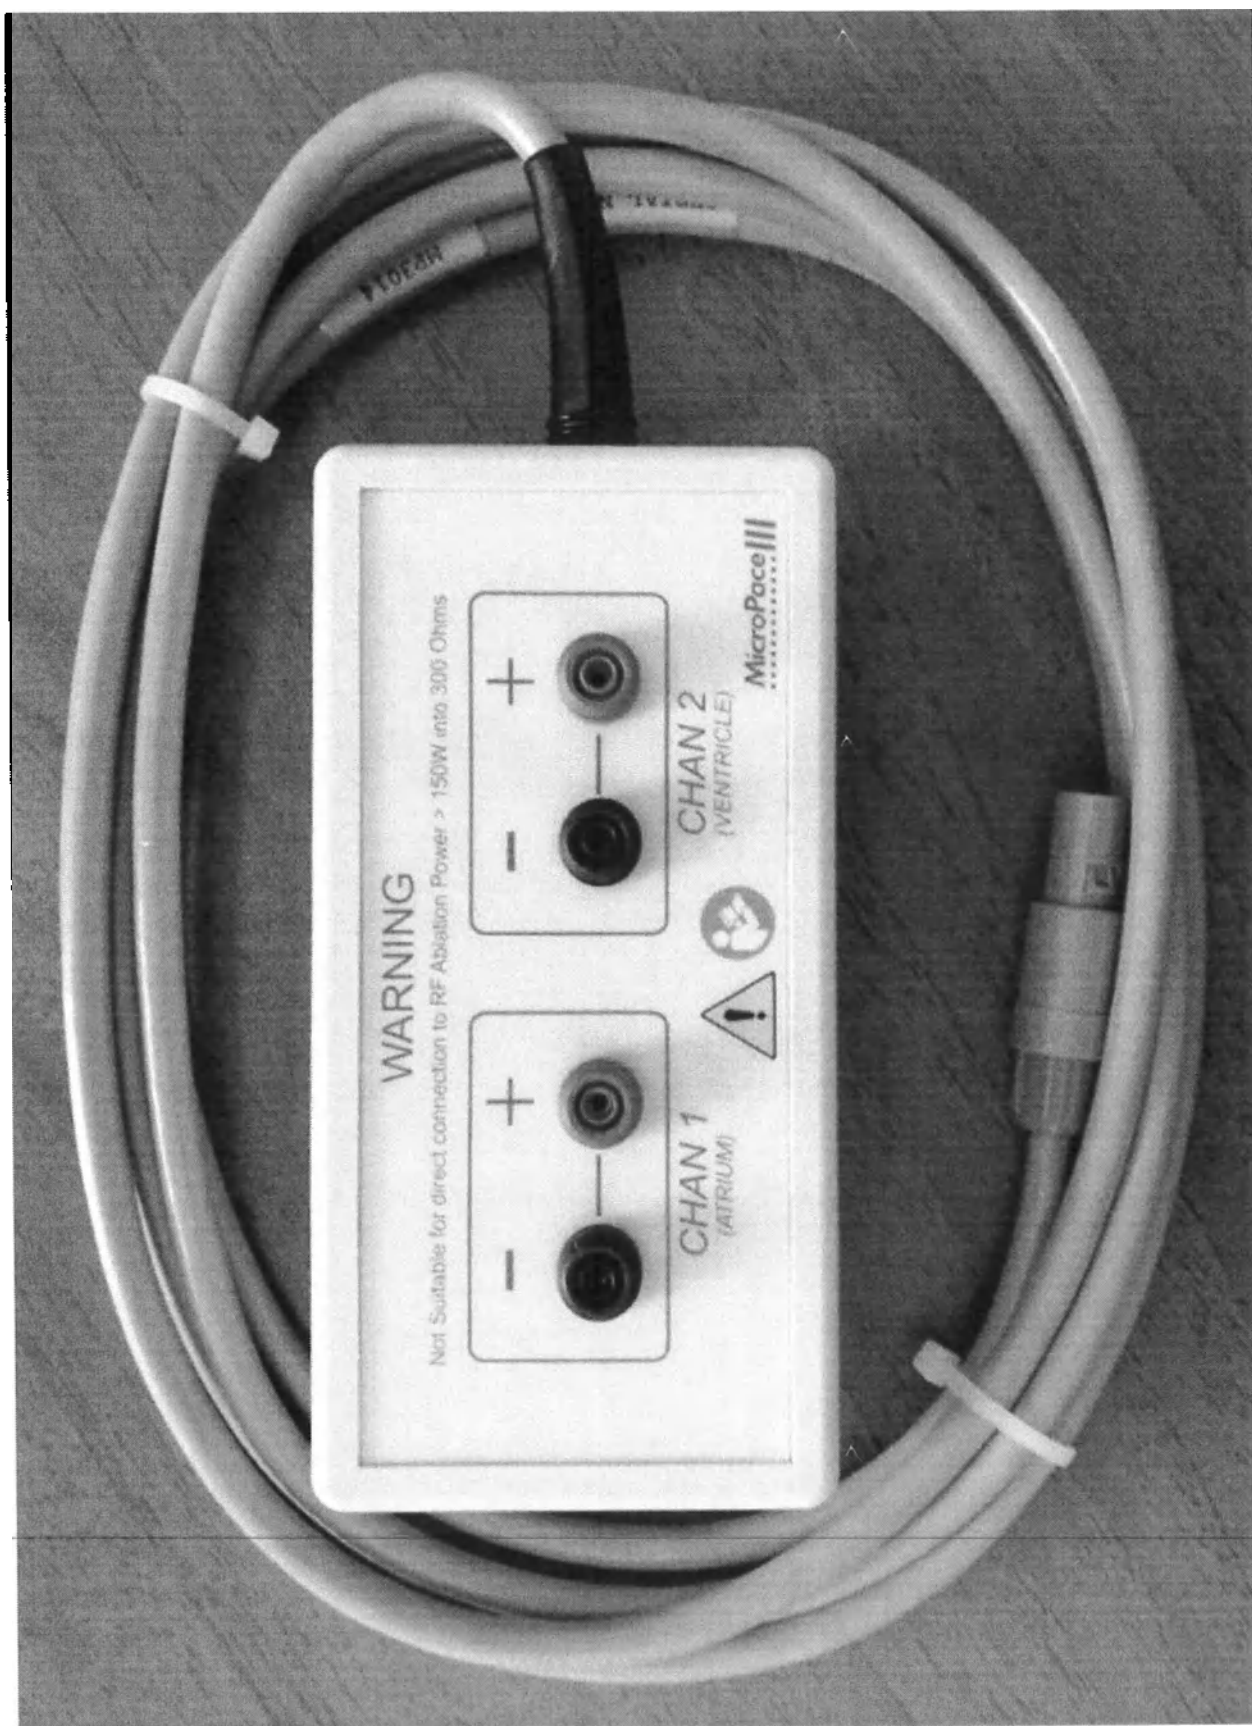

Принадлежности: Блок соединения с пациентом 2-канальный с фильтром высоких частот.
Общий вид изделия.

Принадлежности: Фиксатор кабеля питания изоляционного трансформатора. Маркировка изделия.



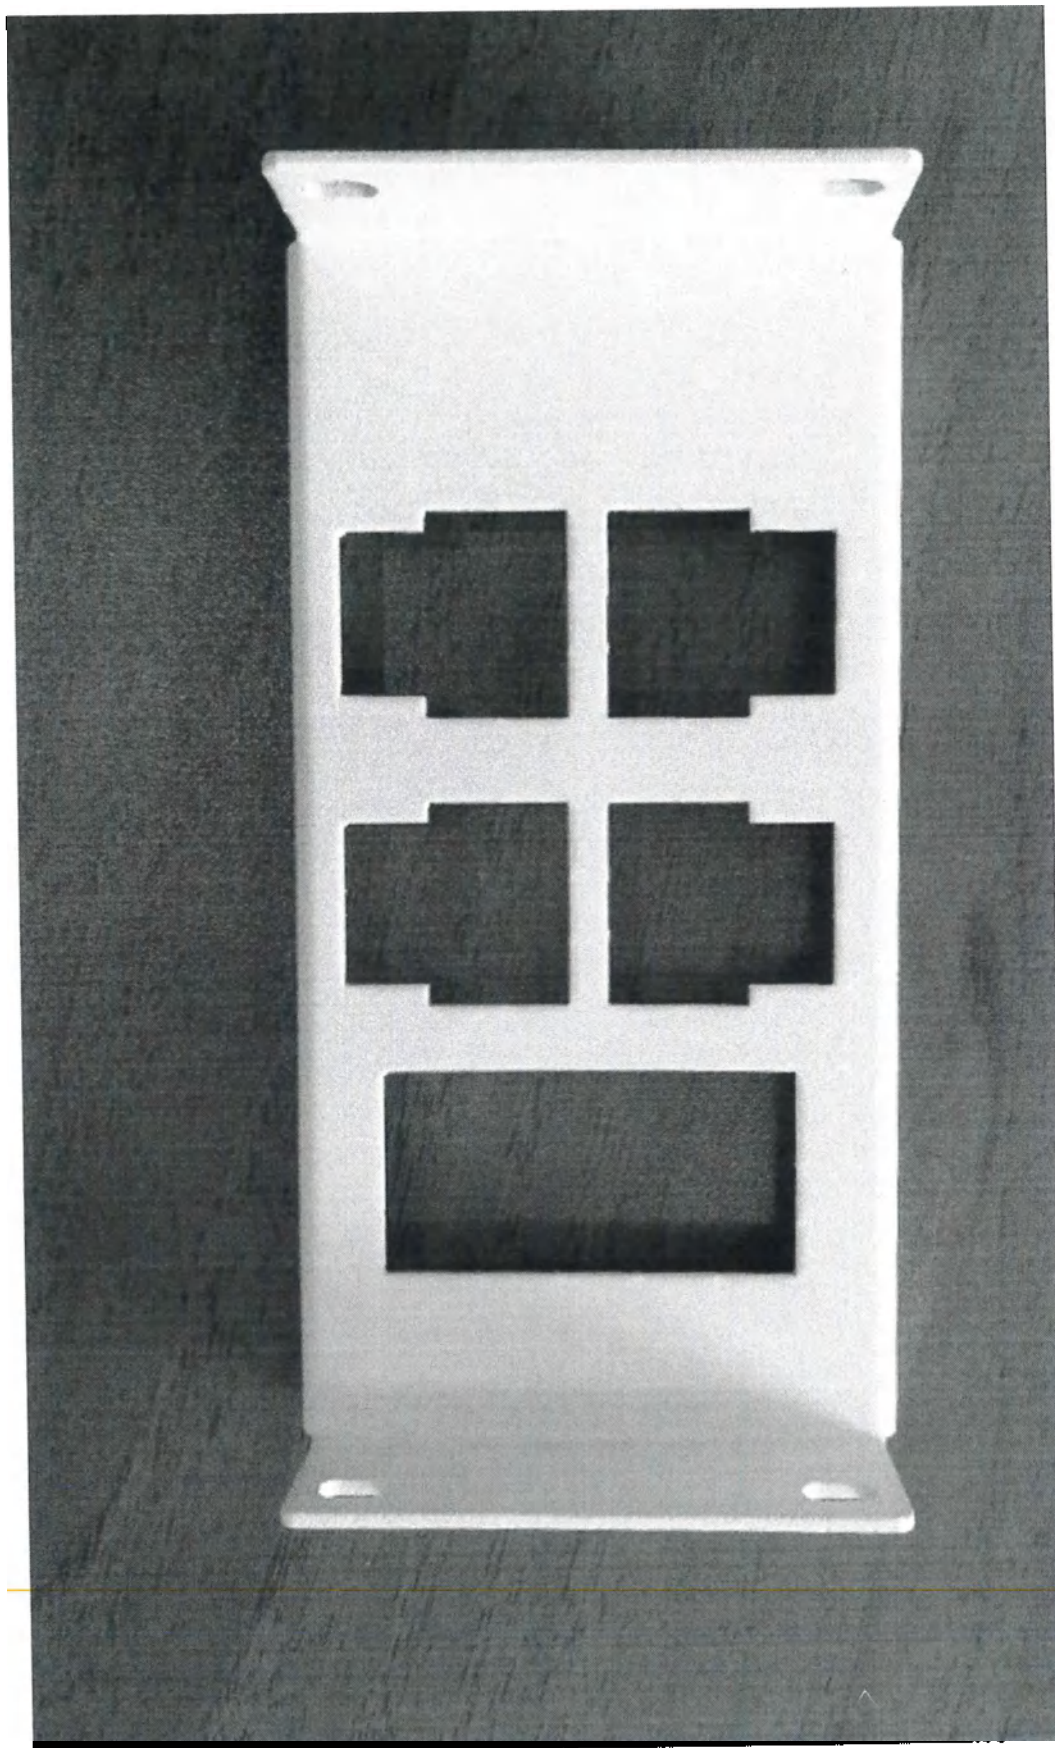

Принадлежности: Фиксатор кабеля питания изоляционного трансформатора. Общий вид изделия.

Стимулятор Micropace для диагностической электрокардиостимуляции с принадлежностями, вариант исполнения:

Стимулятор Micropace StimCor для диагностической электрокардиостимуляции, в составе:

1. Блок генератора стимулов с принадлежностями в составе:

- генератор стимулов импульсный;
- изоляционный трансформатор;
- клавиатура;
- принадлежности;
- эксплуатационная документация.

2. Компьютерный шкаф StimCor.

3. Монитор с сенсорным экраном в составе:

- монитор с сенсорным экраном;
- видеокабель, 2м
- последовательный кабель, 2м
- акустический кабель, 2м
- кабель питания;
- стилус с держателем для сенсорного экрана
- эксплуатационная документация.

4. Набор для замены компьютерного модуля для EPS320/StimLab, StimCor (при необходимости), в составе:

- компьютер Bona Lite PC;
- источник питания компьютера Bona Lite PC;
- кабель последовательного интерфейса RS232, 2м;
- клавиатура.

5. Комплект для установки (при необходимости), в составе:

- кабельные стяжки - 4 шт.;
- одиночный телефонный штекер 6,5 мм на разъем RCA - 2шт.;
- переходник с разъема BNC на штекер RCA - 2шт.;
- тестовые электроды LED - 1шт.;
- клеящийся анкер кабельной стяжки - 1шт.

Принадлежности:

1. Соединительный модуль четырехканальный (Мультиплексор стимулирующих импульсов четырехканальный).

2. Кабель управления SM-блока.

3. Комплект оборудования StimLink для обмена данными с регистратором электрофизиологических параметров, в составе:

- соединительный кабель StimLink с разъемами DB25 – DB9;
- соединительный кабель StimLink для подключения ЭФИ системы.

4. Удлинительный кабель для стимулирующих импульсов для соединительного модуля, длиной 8м, 13м и 17 м.

5. Удлинительный кабель мультиплексора стимулирующих импульсов, длиной 15 м, 27 м.

6. Удлинительный кабель последовательного порта RS232 (с радиочастотным фильтром), длиной 12м, 25м.

7. Комплект кабелей для подключения сенсорного монитора к стимулятору StimCor.

8. Тестовые электроды LED.
9. Компактный блок цифровой клавиатуры.
10. Кабель сигнальный с переходником от штырькового разъёма к телефонному штекеру 3м.
11. Батарея аккумуляторная на 12В.
12. Батарея литиевая на 9В.
13. Источник питания для БГС.
14. Соединительный кабель StimLink с разъёмами DB25 – DB9.
15. Соединительный кабель StimLink для подключения ЭФИ системы.
16. Соединительный кабель для ЭКГ-сигнала с разъёмом 6.5 Phone - 2.5 Phone.
17. Изолированный сетевой кабель, IEC, 3 × 2 контакта, для ЕС.
18. Изолированный сетевой кабель, IEC, 3 × 3 контакта.
19. Кабель последовательного интерфейса RS232, 2м.
20. Кабель питания изолирующего трансформатора.
21. Распределитель питания изолированный (Isolated IEC Power Distribution Board).
22. Блок соединения с пациентом 2-канальный с фильтром высоких частот.
23. Фиксатор кабеля питания изоляционного трансформатора MP3181.
24. Кабель передачи данных RS232 «папа-мама», длина 7.5м (25ft), 15м (50ft), 30м (100ft).



Генератор стимулов импульсный. Общий вид изделия

MicroPace///

Catalogue No.

REF MP3008

SN 4135

LOT 059

€ Micropace EPS320™

PCB Ver. 3.16d Firm Ver. 4.76

Stimulus Generator Unit

Groupe électrogène de stimulation,

Stimulus Generator Einheit,

Gruppo generatore di stimoli,

Grupo electrógeno Estimulo,

Teşvik Jeneratör Ünitesi,

Ερέθισμα γεννήτρια ασφαλείας,

Stimulační generátor pole,

Warsztat Generator Box,

Стимул блока генератора,

Inger-generátor egység,

Stimul Unitatea de generator,

Unidade estimulo gerador.



Micropace Pty Ltd.
41/159 Arthur Street
Homebush West
NSW 2140 Australia
Ph: +61 2 9718 1746

CE
0086



Rx ONLY



MP3008

2017-12

CL3008-V5 2-1116

MicroPace///

CONFIGURABLE SYSTEM UDI

EPS320/StimCor Cardiac Stimulator




(01)09349714004623



(11)180209(10)17-496(21)4135

CL3462_EPS320 System UDI-V1.0-0615

Генератор стимулов импульсный. Маркировка изделия.

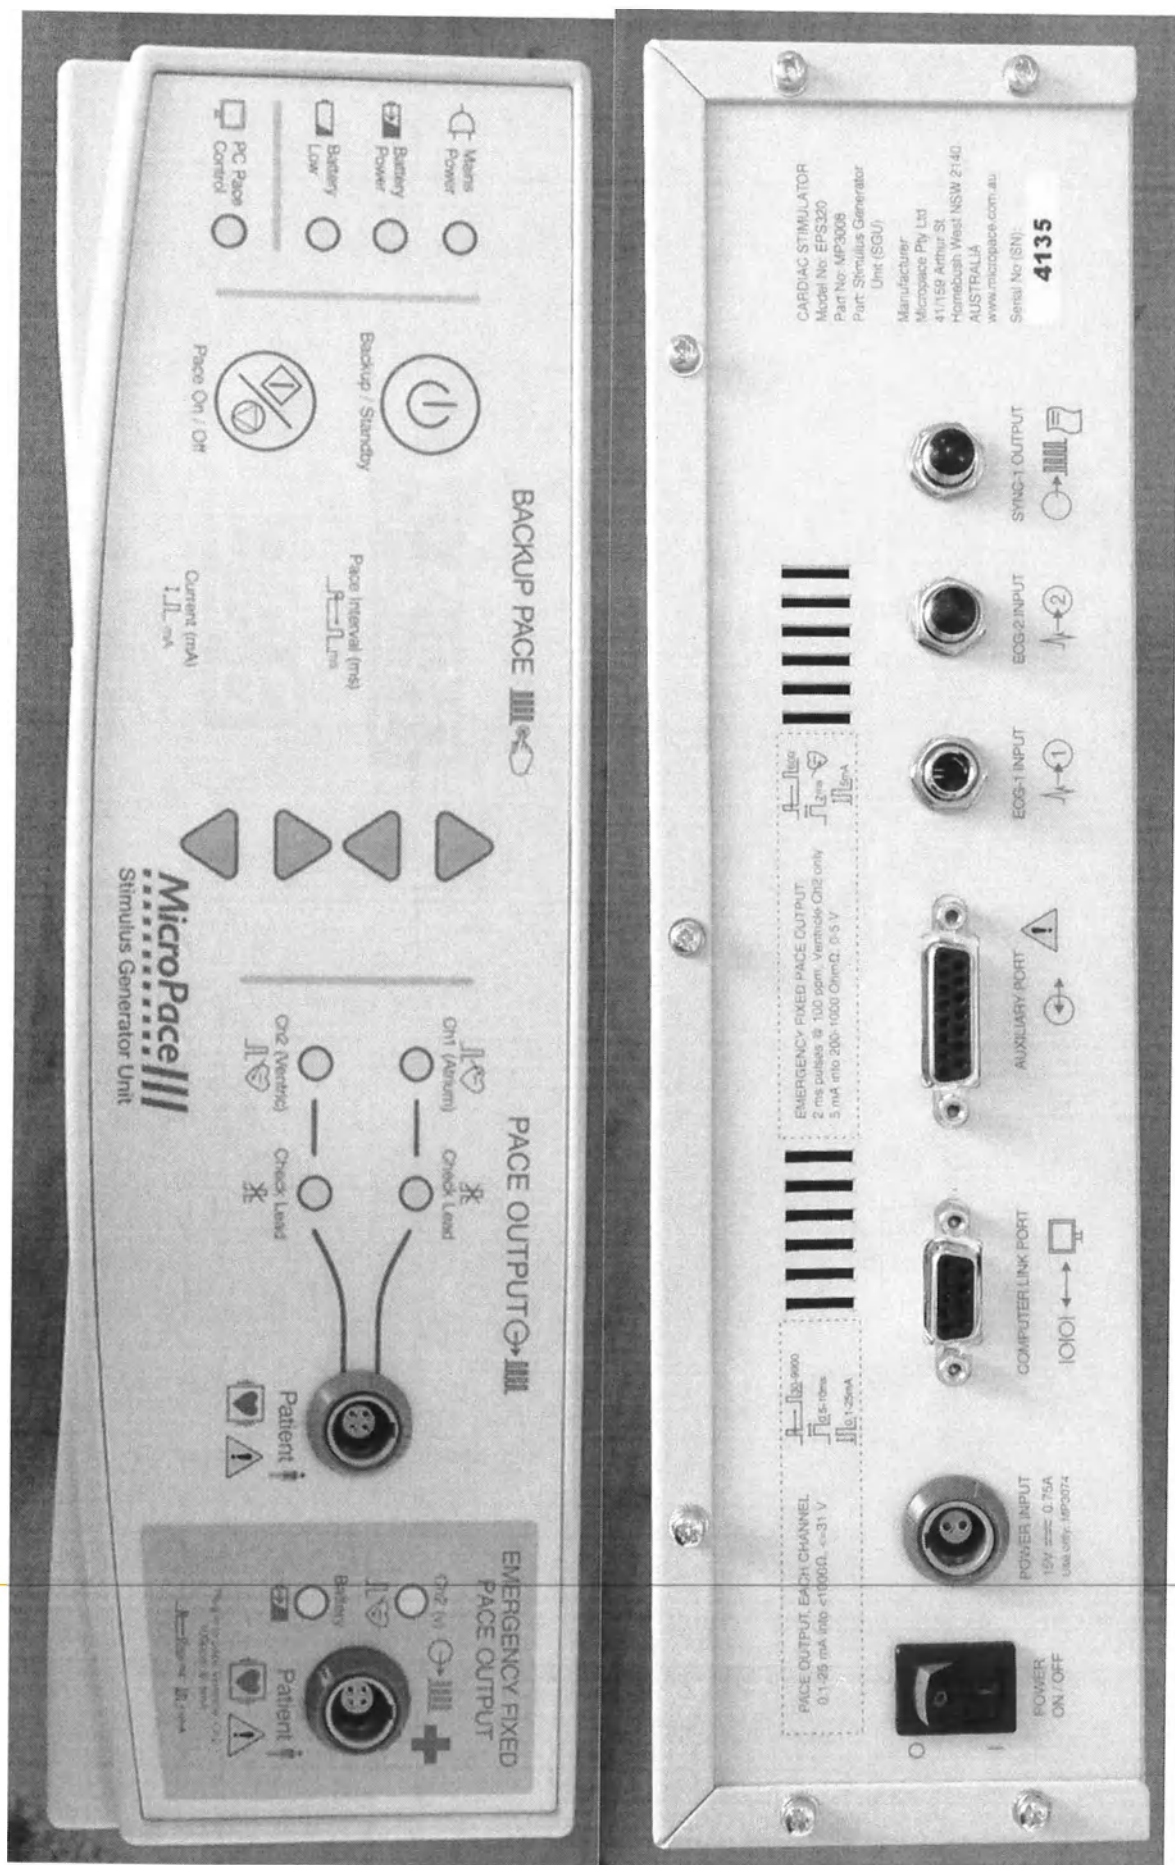

Генератор стимулов импульсный. Лицевая и обратная сторона.

POWERTRONIX

Isolation Station™

ISOLATION TRANSFORMER

3RD ED - 300VA

€ Micropace EPS320™

Catalogue No.

REF MP3107


LOT 17-259



MC0524
5A


MC0553
3.15A

Micropace



Micropace Pty Ltd
41/159 Arthur Street
Hornbush West
NSW 2140 Australia
Ph: +61 2 9718 1746

Connect to Micropace Product only
Connecter à Micropace produit seulement
Verbinden Sie Produkt nur Micropace
Connettersi a Micropace prodotto solo
Conectar con Micropace producto solo
Ligue apenas ao produto Micropace

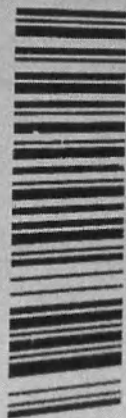

MC0669



CE 0086


R ONLY

L3107-V2.3-1116

Power Isolation Unit

300 VA

Изоляционный трансформатор. Маркировка изделия сзади.

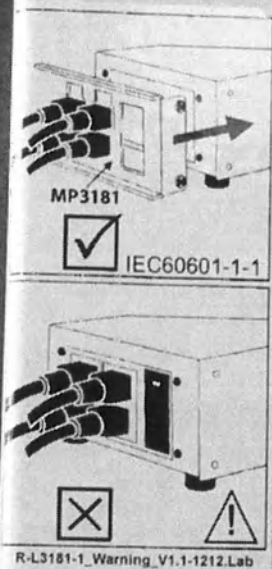

WARRANTY VOID IF THIS SEAL IS BROKEN.



PLEASE REFER TO PRODUCT
MANUAL FOR IMPORTANT OPERATING
AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS.

THIS APPARATUS IS A CLASS I
EQUIPMENT.

DANGER:

RISK OF EXPLOSION OF
USED IN
THE PRESENCE OF
FLAMMABLE ANESTHETICS,
OR OTHER FLAMMABLE
GASES OR LIQUIDS.

NOTE:

USA AND CANADA;
GROUNDING RELIABILITY
CAN ONLY BE ACHIEVED
WHEN THIS
EQUIPMENT IS CONNECTED
TO A RECEPTACLE MARKED
"HOSPITAL ONLY", OR
"HOSPITAL GRADE".

CAUTION:

THIS PRODUCT REQUIRES
CONVECTION COOLING.
ADEQUATE VENTILATION
IS REQUIRED. CLEARANCE
OF 2" MINIMUM ON ANY
SIDE.

CAUTION:

TO REDUCE THE RISK OF
ELECTRICAL SHOCK, DO
NOT OPEN ENCLOSURE.
NO SERVICEABLE PARTS
INSIDE.

WARRANTY VOID IF THIS SEAL IS BROKEN.

POWERTRONIX

Isolation Station™

PART NO: X1ATWFHNO1
INPUT VOLTAGE: 115 (120) / 230 (240) VAC - 50/60Hz
INPUT CURRENT: 2.6 A / 1.3 A
LEAKAGE CURRENT: < 100 μ A
OUTPUT VOLTAGE: 115 (120) / 230 (240) VAC
OUTPUT CURRENT: 2.5 A / 1.25 A



MEDICAL I.T.E. ANSIAAMI ES60601-1
ISOLATION 10HW CANCSA-C22.2 NO. 00601-1
STATION 10HV EN60601-1 : 2005
IEC60601-1 : 2005



POWERTRONIX Corporation - Foster City, CA, USA - (650) 345-6800
www.powertronix.com

Изоляционный трансформатор. Маркировка изделия сверху.

MicroPace///

COMPUTER KEYBOARD

€ Micropace EPS320™

Catalogue No.

REF MP3016

LOT 17-281



MC0950

 Legal
Manufacturer


Micropace Pty Ltd.
41/159 Arthur Street
Homebush West
NSW 2140 Australia
Ph: +61 2 9718 1746

CE
0086



R_x ONLY

L3016-V4.4-1116

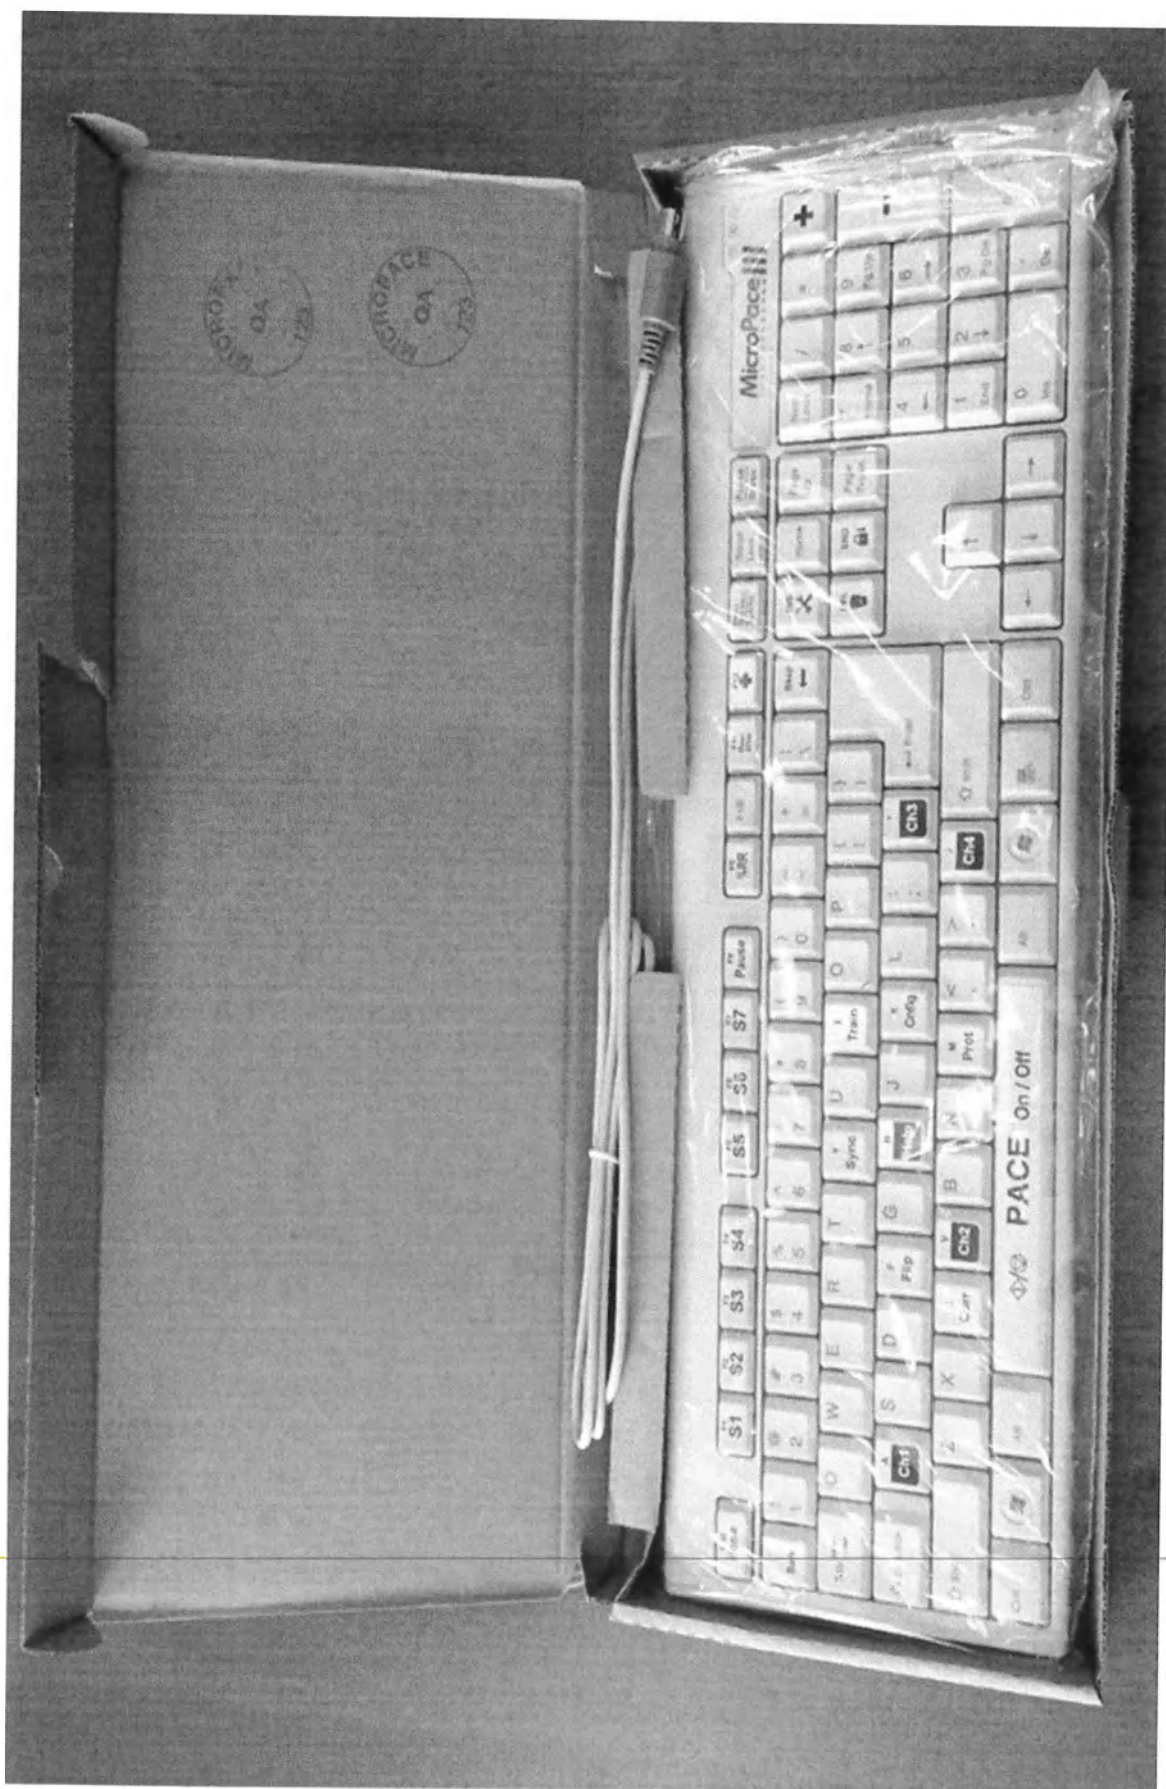

Клавиатура. Общий вид изделия.

MicroPace///

COMPUTER CABINET

€ Micropace StimCor™

Catalogue No.

REF

MP3346

SN

SC281

LOT

17-414


Legal
Manufacturer

Micropace Pty Ltd.
41/159 Arthur Street
Homebush West
NSW 2140 Australia
Ph: +61 2 9718 1746

CE
0086



Rx ONLY

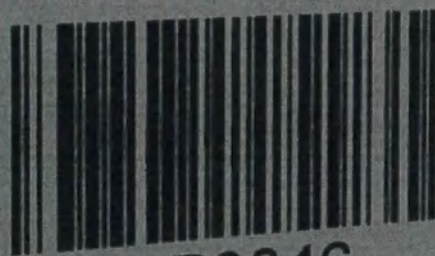


MP3346



L3346-V1.3-1116

Компьютерный шкаф StimCor. Маркировка изделия.

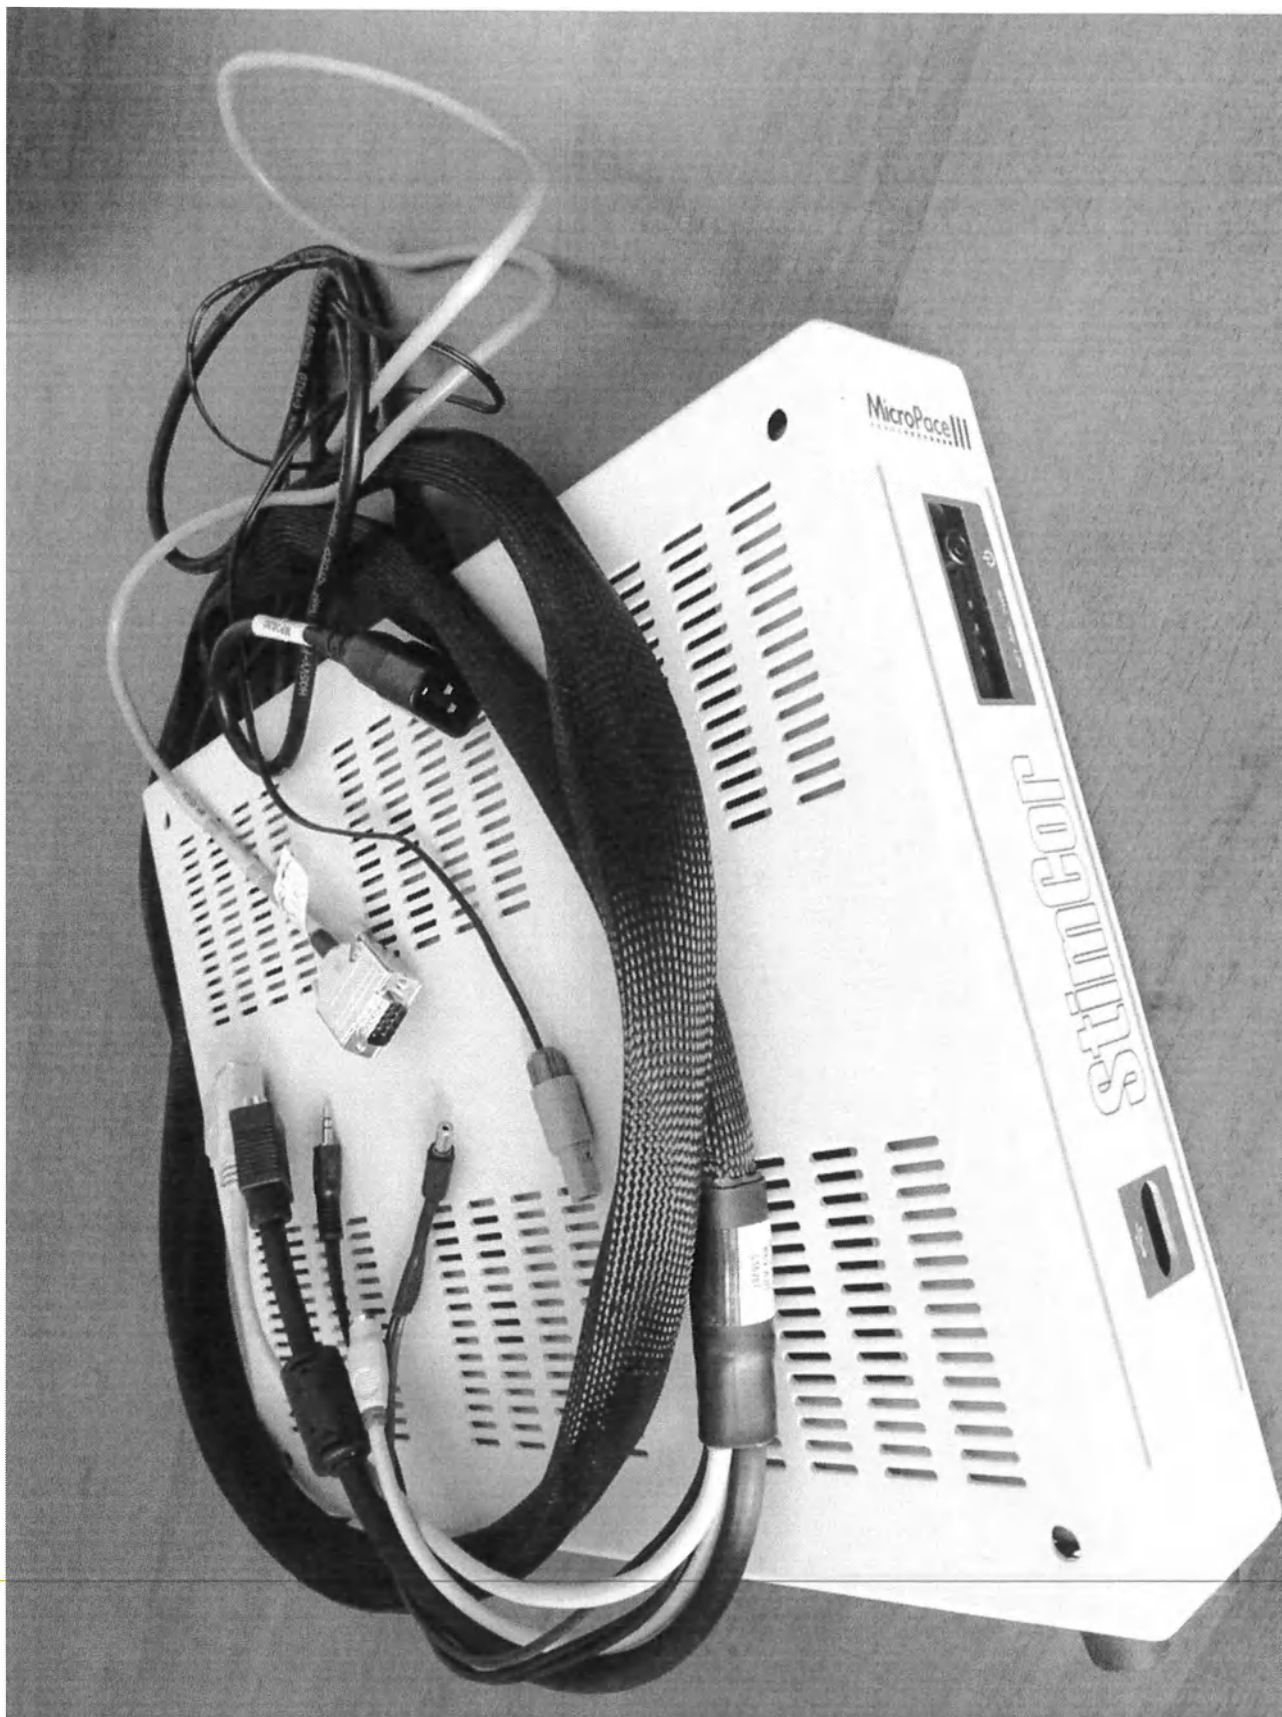

Компьютерный шкаф StimCor. Общий вид изделия.



ELO LCD TOUCH SCREEN *MicroPace*

MicroPace EPS320™



Catalogue No.

REF MP3114

LOT 17-465



MicroPace Pty Ltd.
41/159 Arthur Street
Homedust West
NSW 2140 Australia
Ph: +61 2 9718 1745

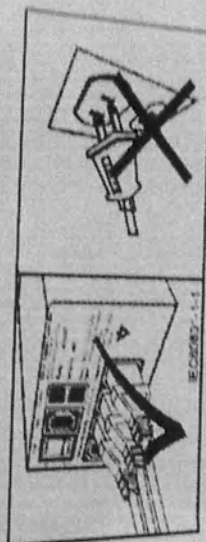

0086
R ONLY



MC0957


L3114-V2-0-0717


Монитор с сенсорным экраном. Маркировка изделия.



Монитор с сенсорным экраном. Общий вид изделия.

Видеокабель, 2м. Маркировка изделия.

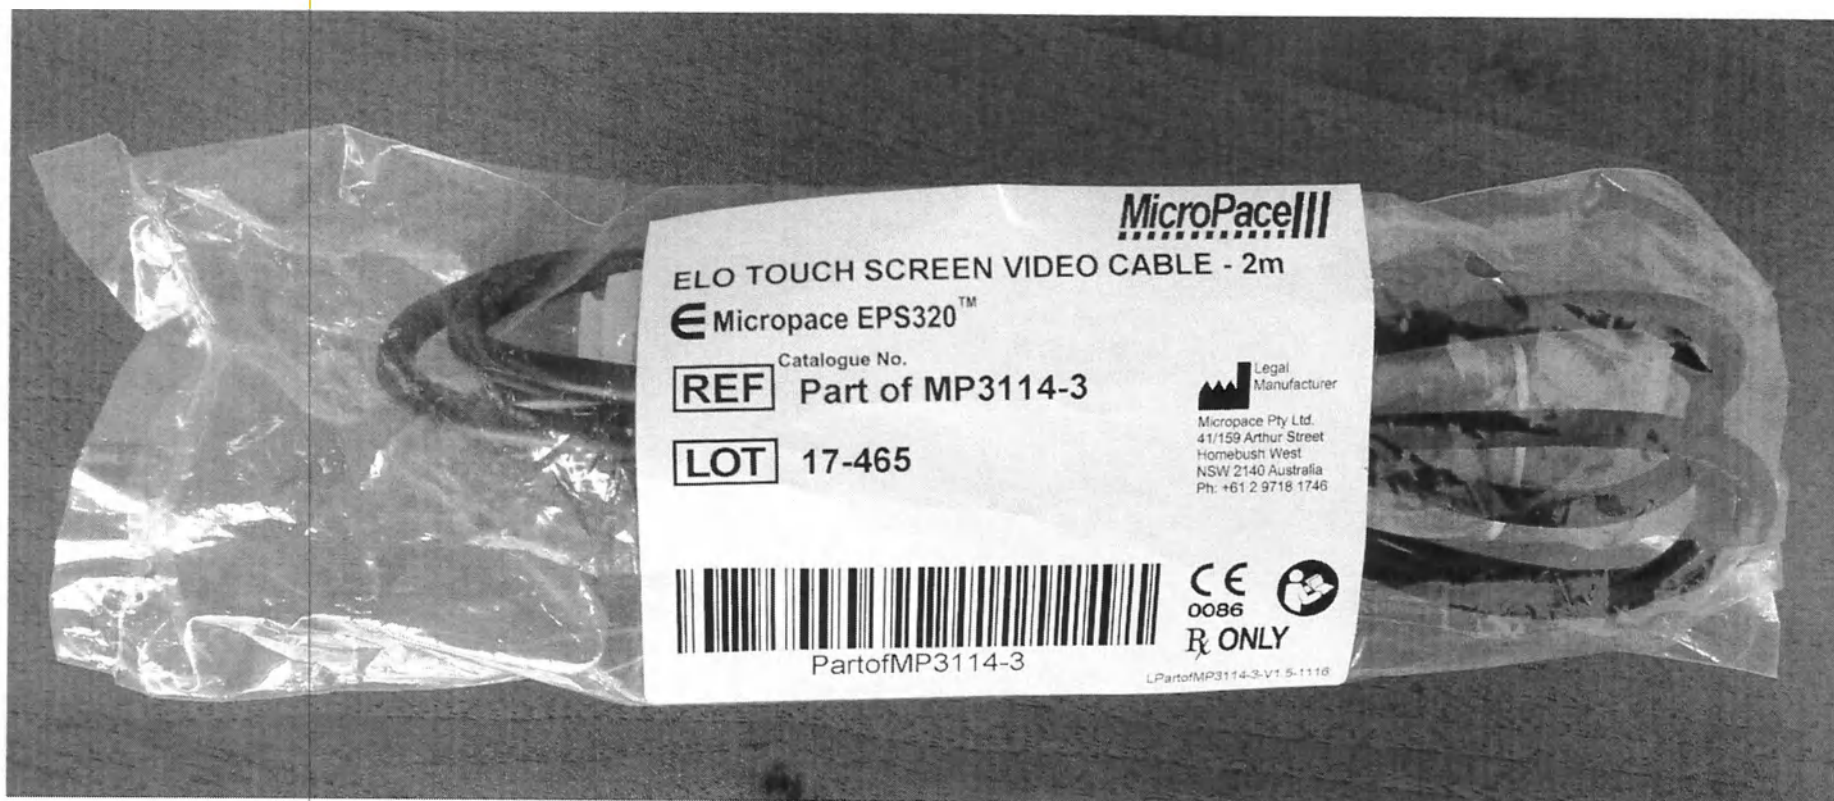


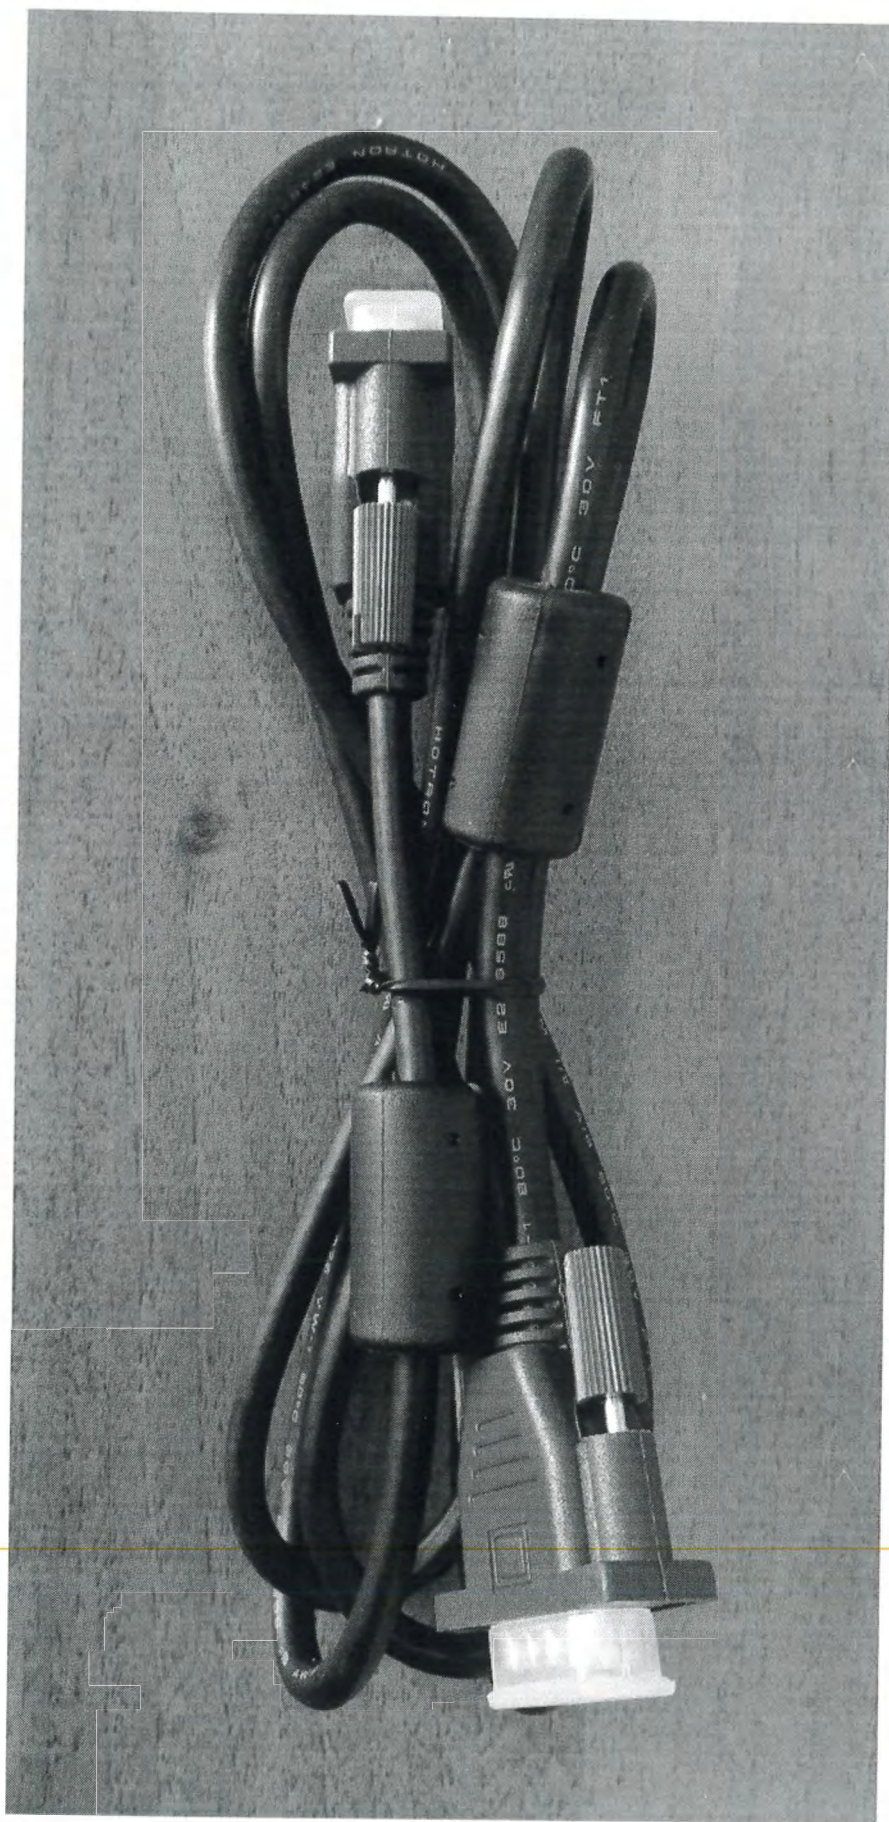

Видеокабель, 2м. Общий вид изделия.




Последовательный кабель, 2м. Маркировка изделия.

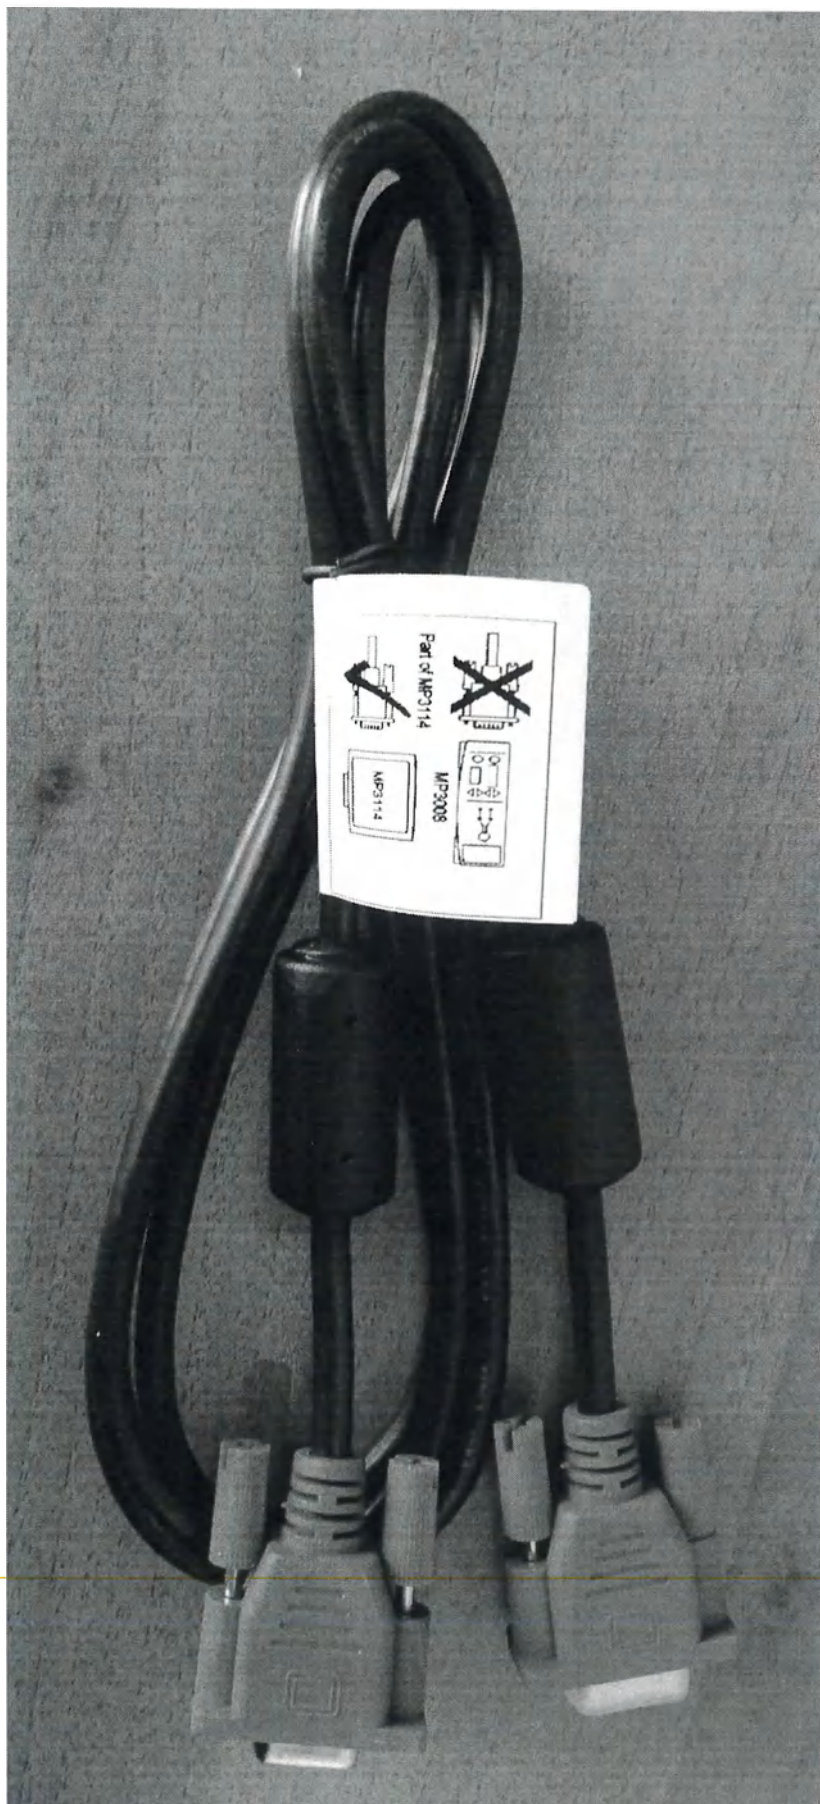

Последовательный кабель, 2м. Общий вид изделия.

Акустический кабель, 2м. Маркировка изделия.




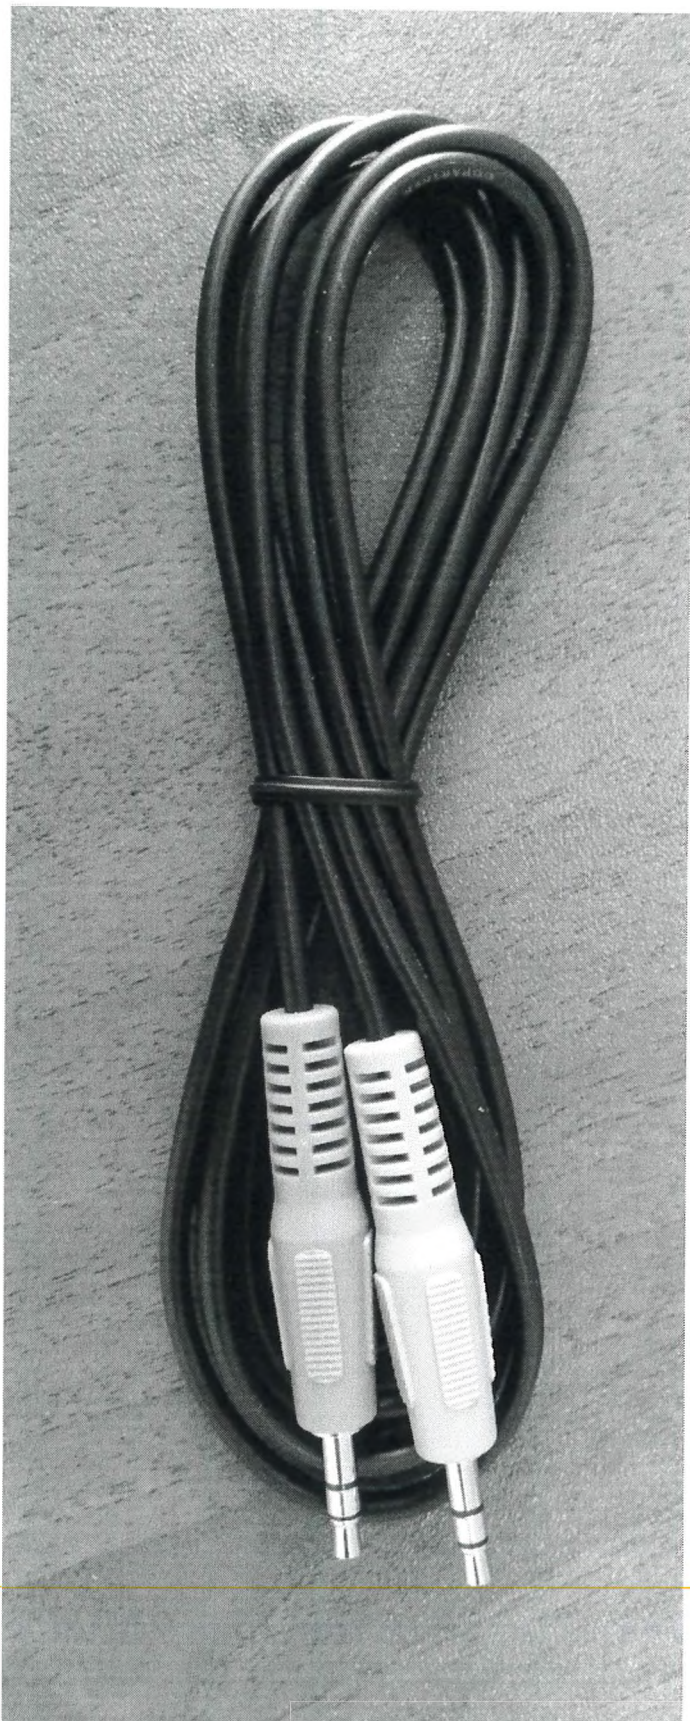

Акустический кабель, 2м. Общий вид изделия.




Кабель питания. Маркировка изделия.

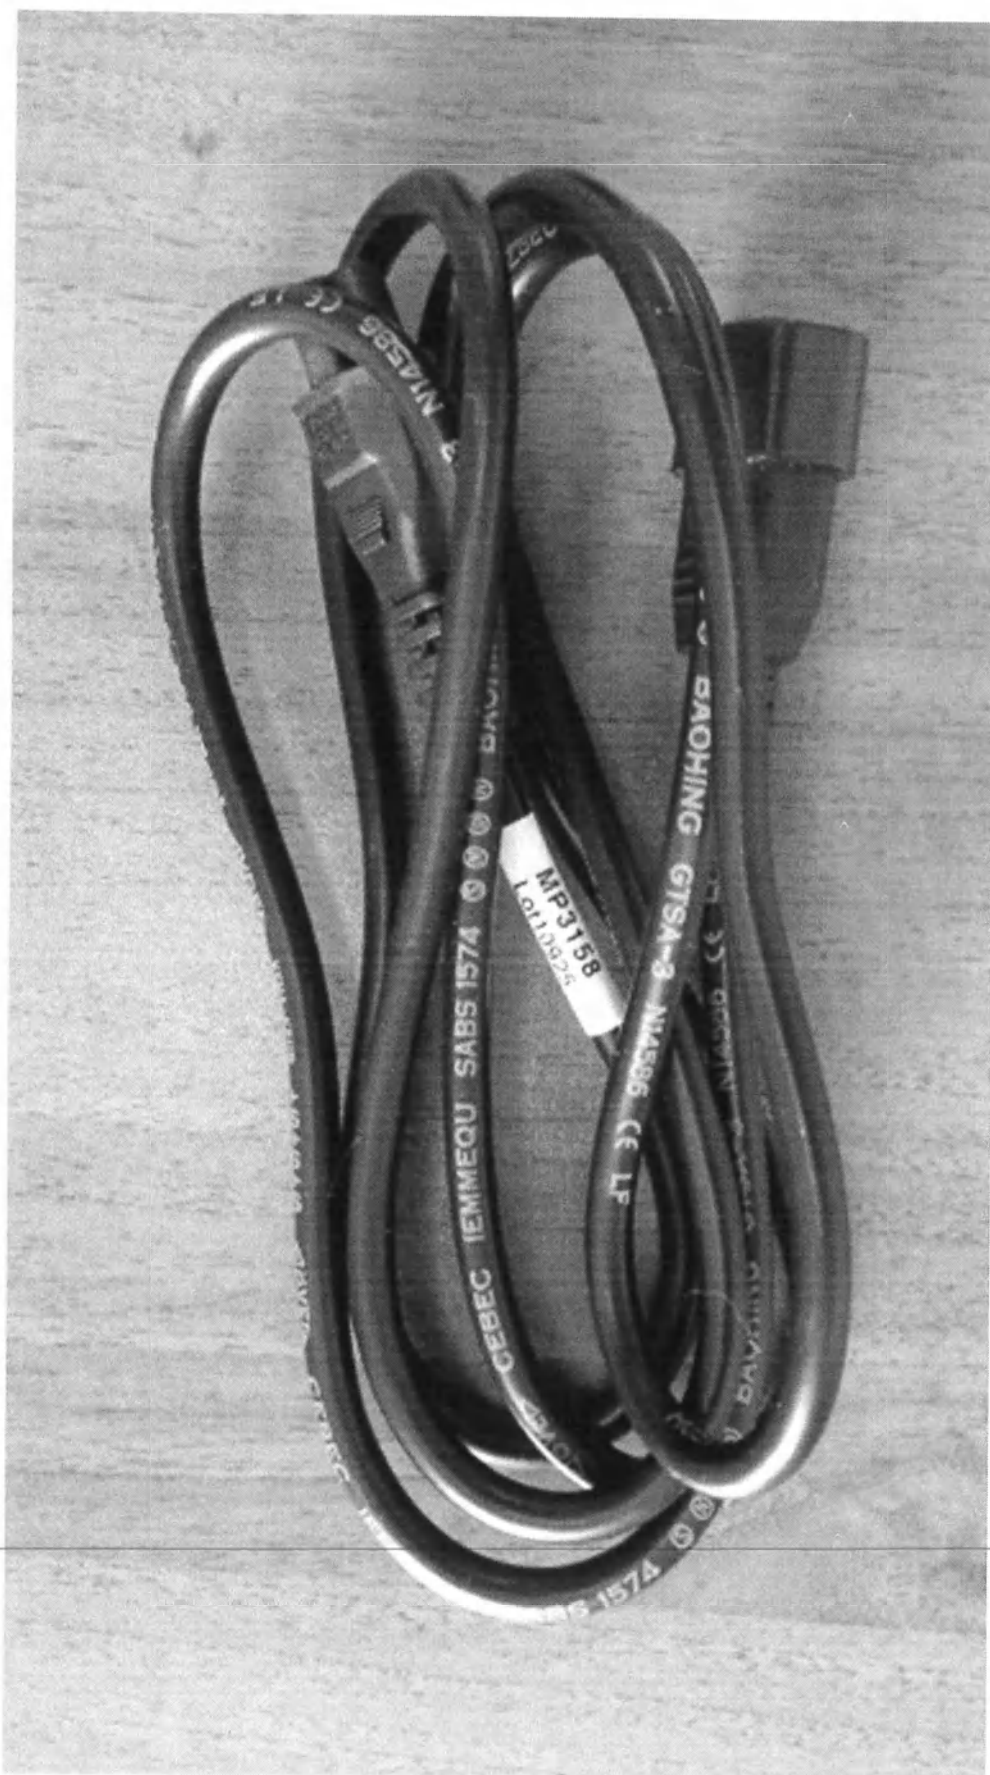

Кабель питания Общий вид изделия

Стигус с держателем для сенсорного экрана. Маркировка изделия.



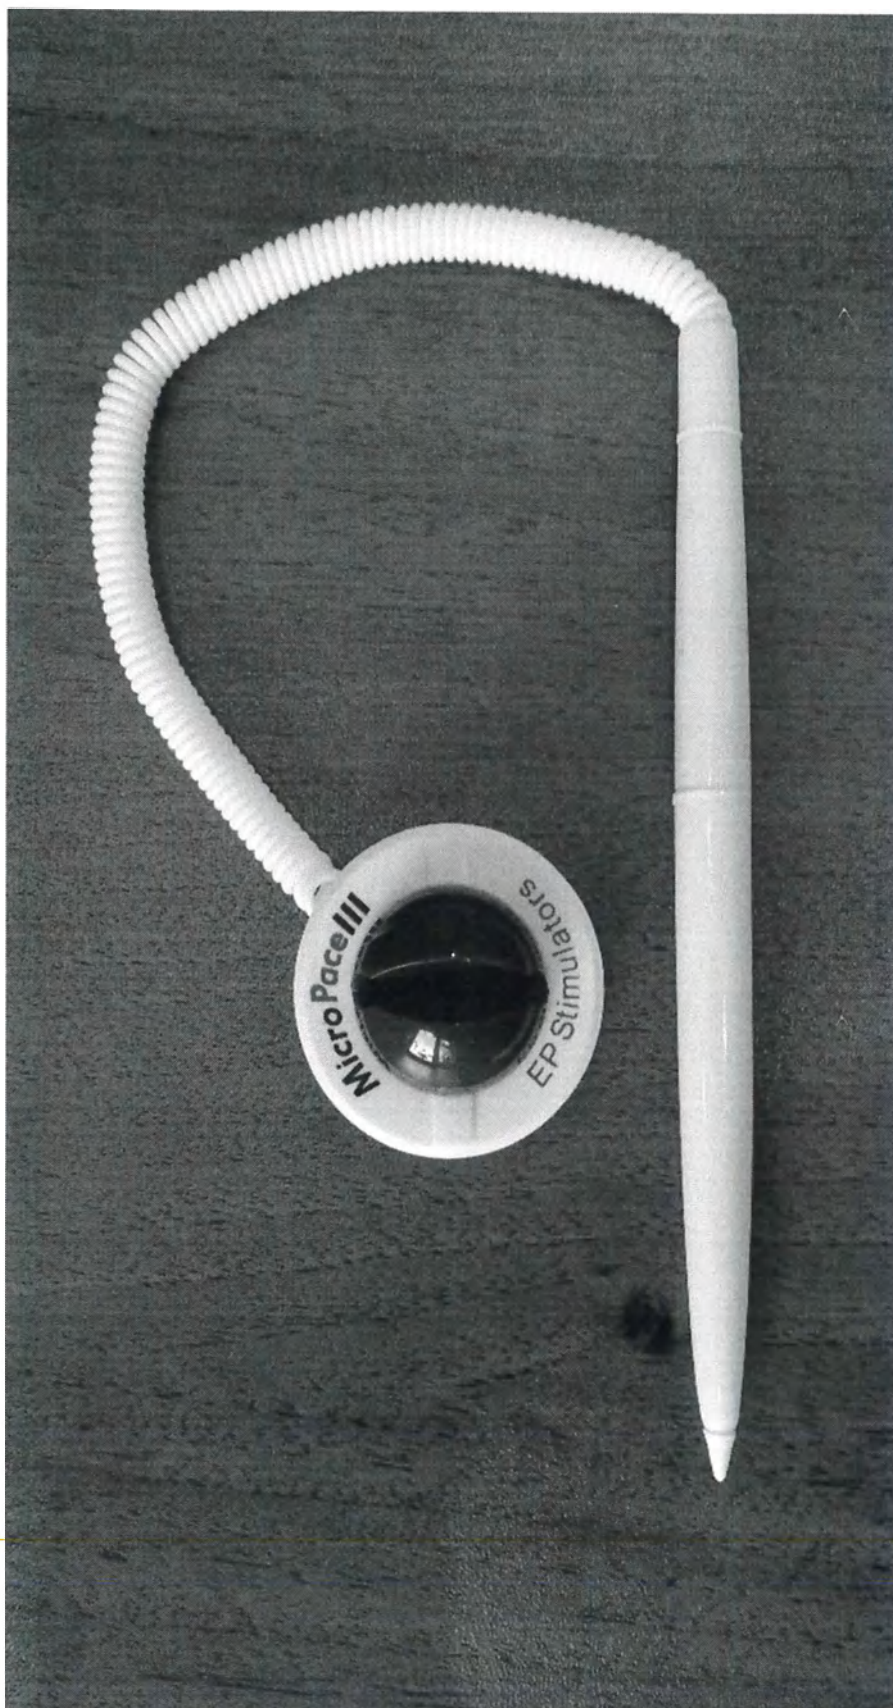

Стилус с держателем для сенсорного экрана. Общий вид изделия.

MicroPace///

**BONA COMPUTECH LIGHT
SYSTEM PC**

€ Micropace EPS320™

REF Catalogue No.
MP3093

LOT 17-260

 Legal
Manufacturer

Micropace Pty Ltd.
41/159 Arihur Street
Homebush West
NSW 2140 Australia
Ph: +61 2 9718 1746



MC0872

CE
0086



Rx ONLY




L3093-V3.9-1116

**Factory Preloaded
Software V4.0
EPS320BT-2CHANNEL**

L_Factory_Preload 4.0-EPS320BT-2CHANNEL-V1 0-0615

Компьютер Bona Lite PC. Маркировка изделия

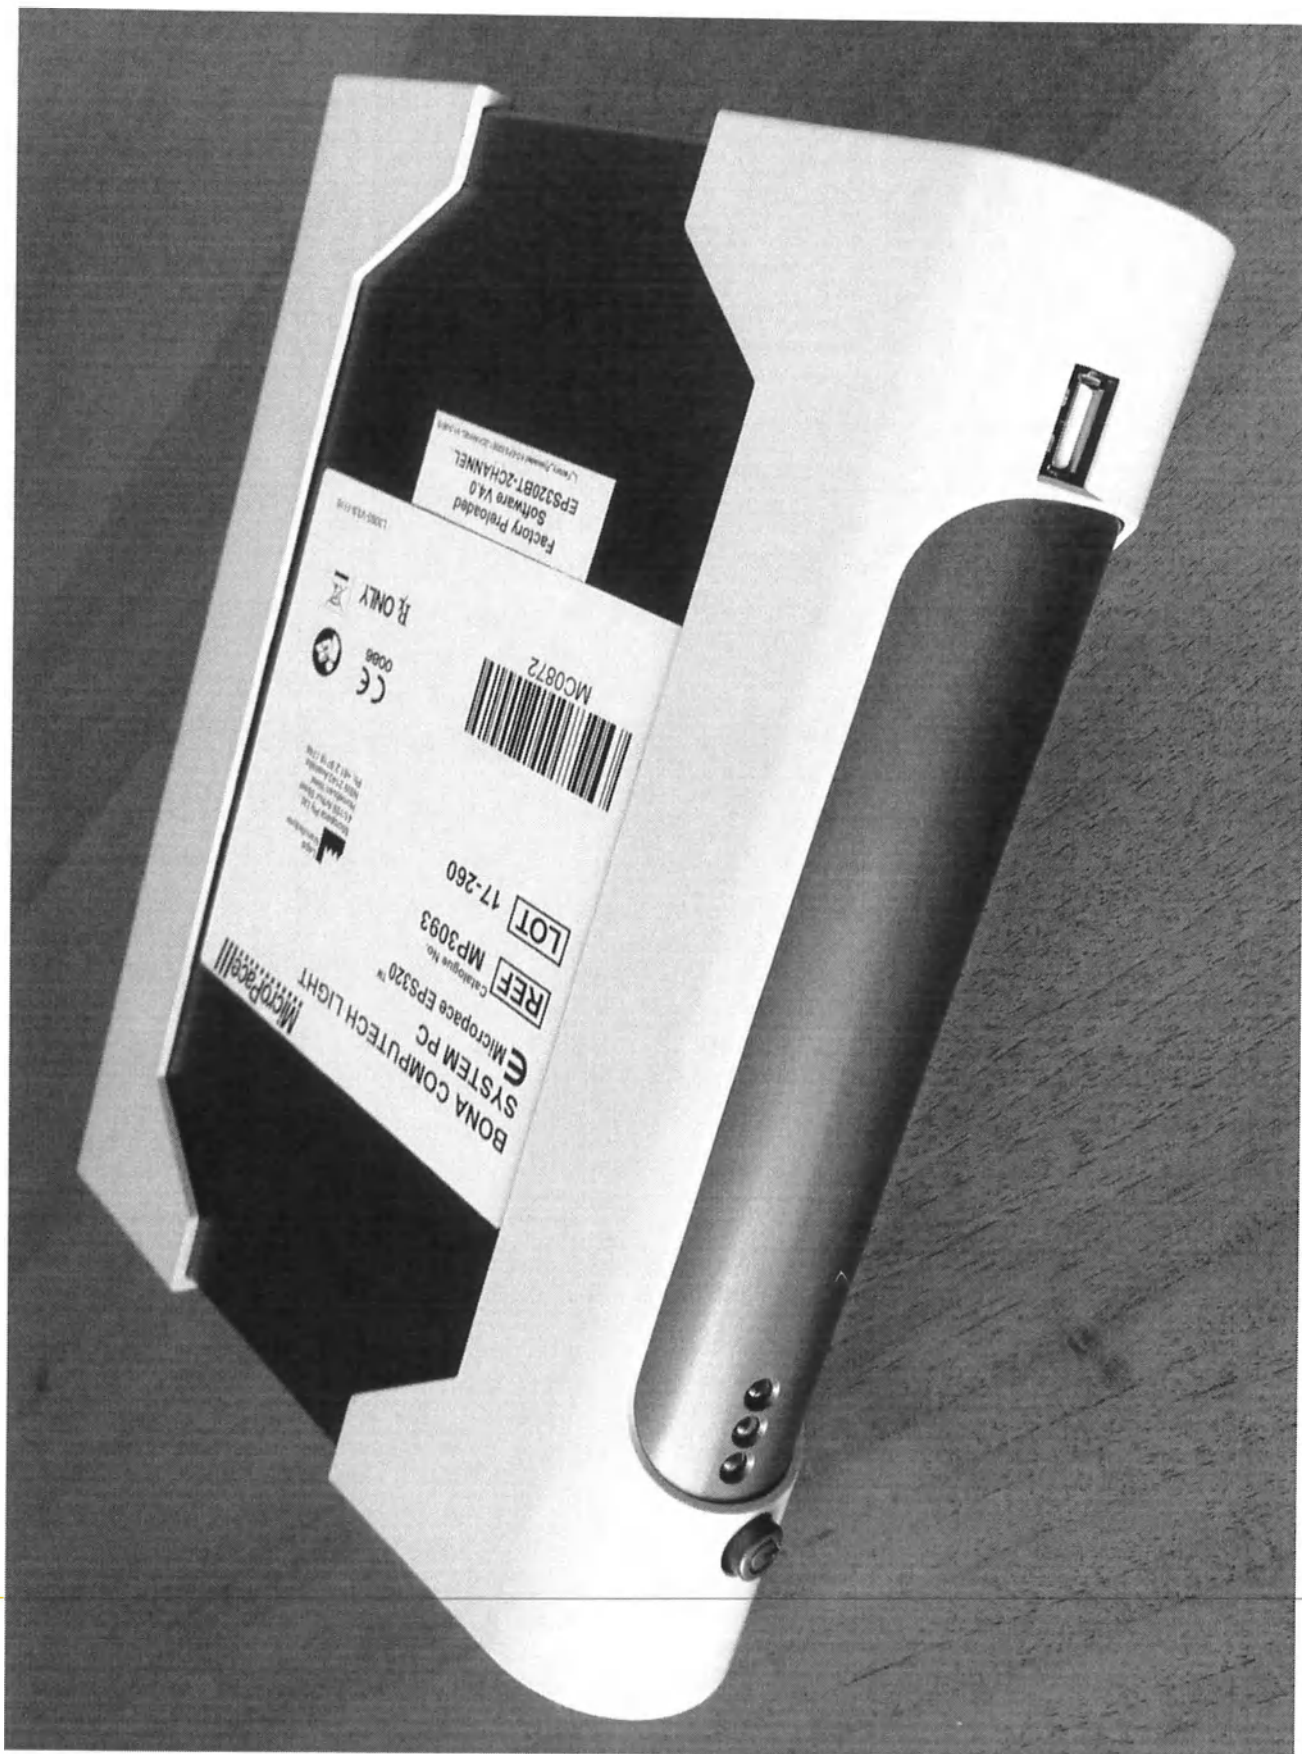

Компьютер Bona Lite PC. Общий вид изделия.

Источник питания компьютера Bona Lite PC. Маркировка изделия





Источник питания компьютера Vona Lite PC. Общий вид изделия.

MicroPace

INSTALLATION KIT

€ Micropace EPS320™

Catalogue No.
REF **MP3063**

LOT **17-226**



Legal
Manufacturer

Micropace Pty Ltd.
41/159 Arthur Street
Homebush West
NSW 2140 Australia
Ph: +61 2 9718 1746

MP3039 Cable Ties	4
MP3056 Phono to RCA	2
MP3057 BNC to RCA Plug	2
MP3058 Yellow/Red Test LED	1
MP3061 Cable tie adhesive	1



MP3063


CE
0086



Rx ONLY

L3063-V1.6-1116

Комплект для установки. Маркировка изделия

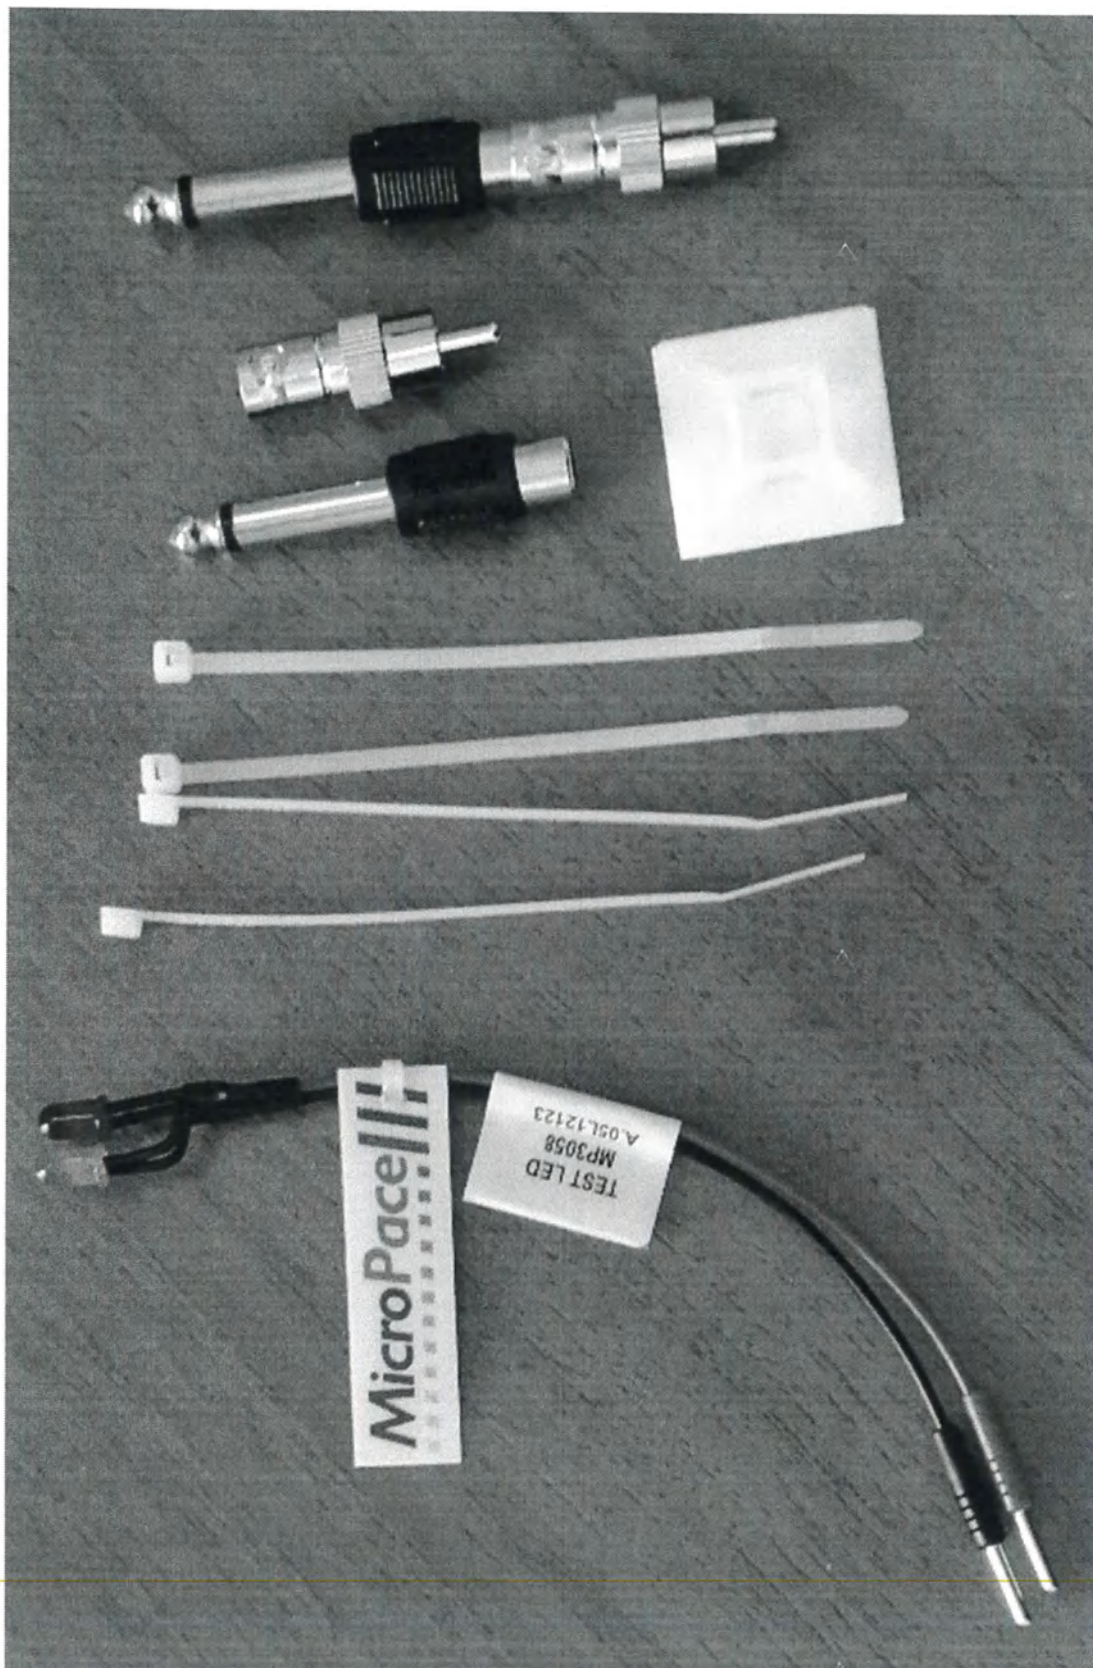

Комплект для установки. Общий вид изделия.

- кабельные стяжки - 4 шт.;
- одиночный телефонный штекер 6,5 мм на разъем RCA - 2шт.;
- переходник с разъема BNC на штекер RCA - 2шт.;
- тестовые электроды LED - 1шт.;
- клеящийся анкер кабельной стяжки - 1шт.

Catalogue No.


REF MP3086

Micropace EPS320™

SN 2513

LOT 11471

Stimulus Multiplexer Box, Multiplexeur de stimulation
de la case, Stimulus Multiplexer Box, Multiplexer di stimolo,
Cuadro estímulo multiplexor, Teşvik Çokluçu Kutu, Επέλαμα
Multiplexor Box, Stymul multiplexor, Stymulacni Multiplexer Box, Warsztat
multiplexer, Stimul Multiplexer Box, Multiplexador estmulo
Caixa

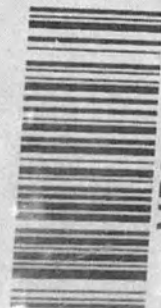

MP3086

Micropace



Legal
Manufacturer
Micropace Pty Ltd.
41/159 Arthur Street
Homebush West
NSW 2140 Australia
Ph: +61 2 9718 1746




0086

RoHS ONLY

CL3086-V3.0-1116

Принадлежности: Соединительный модуль четырехканальный (Мультиплексор стимулирующих импульсов четырехканальный). Маркировка изделия.

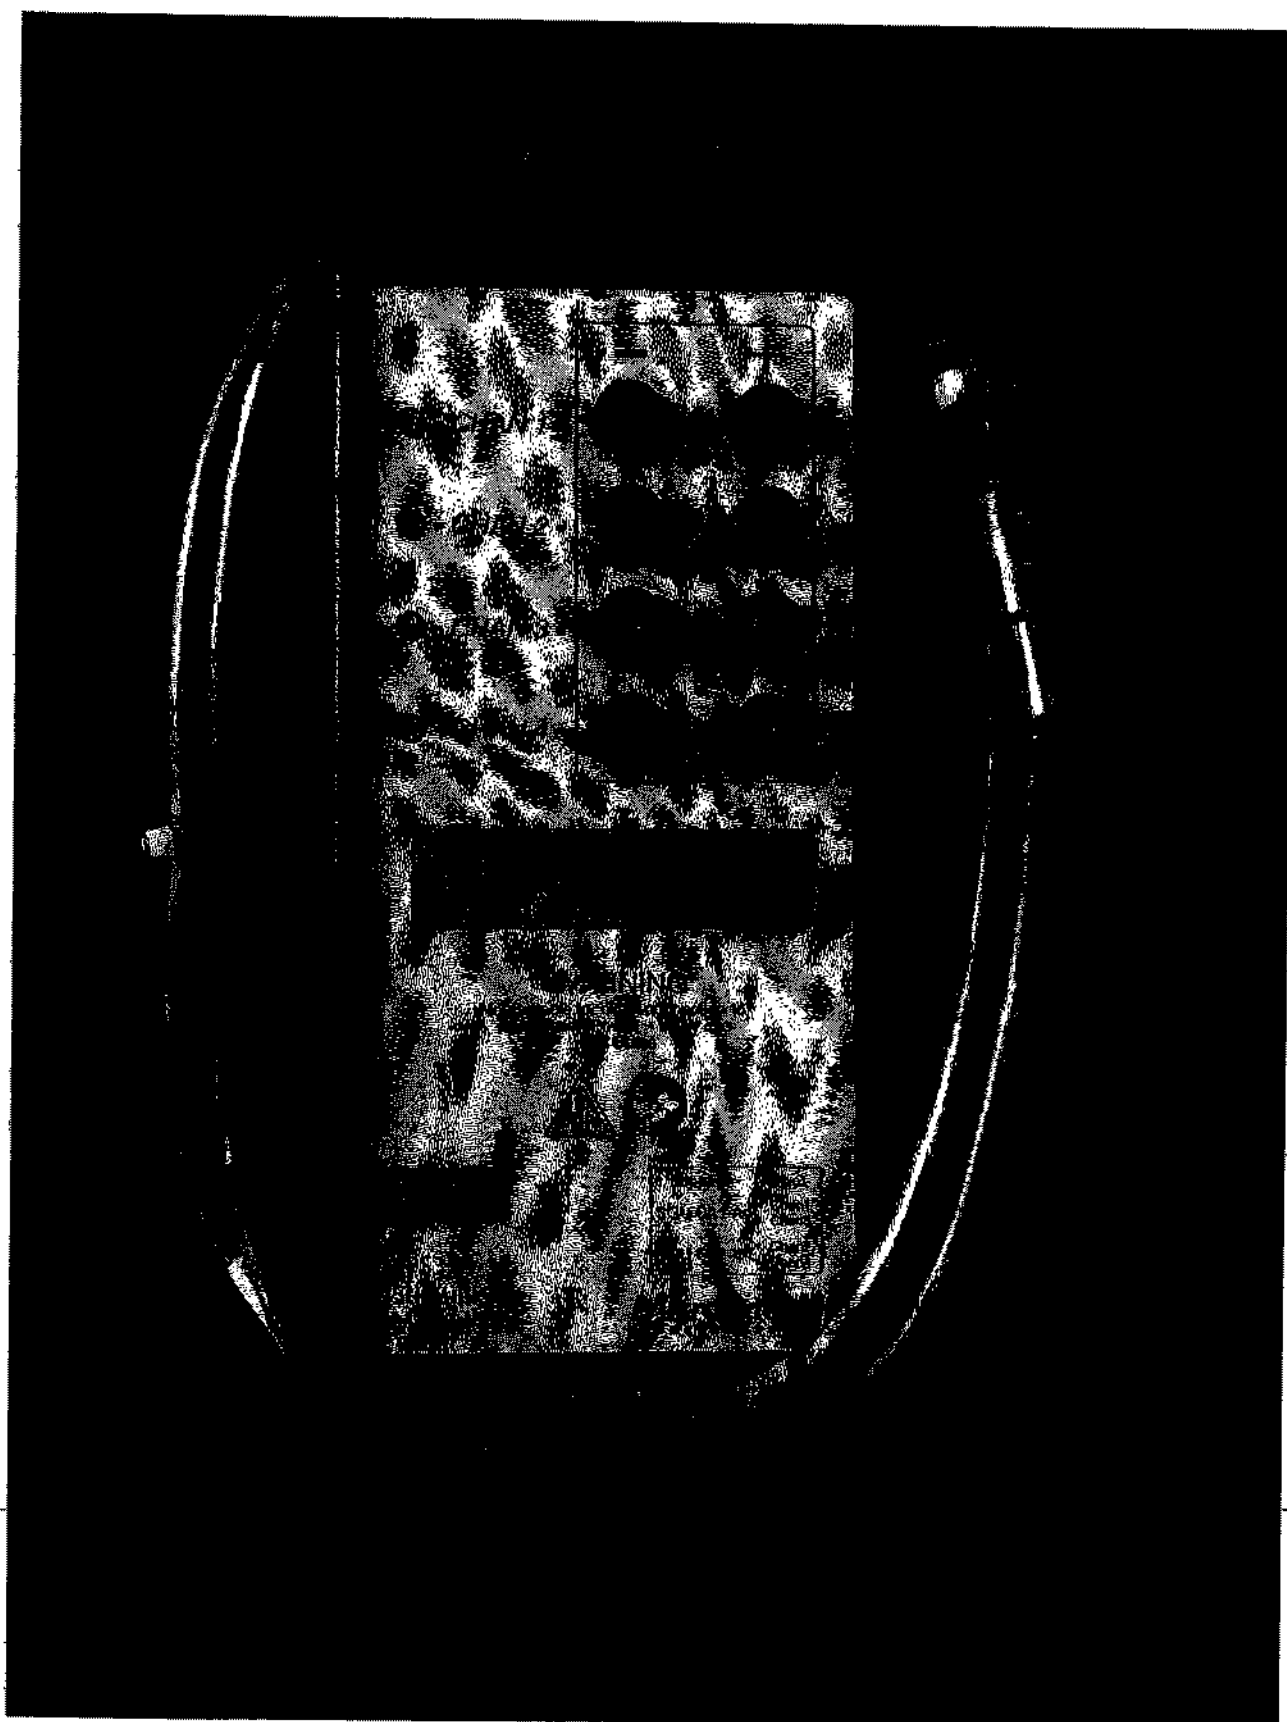

Принадлежности: Соединительный модуль четырехканальный (Мультиплексор стимулирующих импульсов четырехканальный). Общий вид изделия.



Принадлежности: Кабель управления SM-блока. Маркировка изделия.

Catalogue No.
REF MP3070-17

LOT 12618

MicroPaceIII

€ Micropace EPS320™

Low Capacitance Stimulus Extension Cable 17M, Câble
D'extension de stimulation de faible capacité 17M,
Niedrige Kapazitätanz Stimulus Verlängerungskabel 17M,
Stimolo a bassa capacità Cavo prolunga 17M, Estimulo-
17M Cable de extensión, Düşük Kapasitans Teşvik
Uzatma Kablosu 17M, Χαμηλή χωρητικότητα επέκταση
καλώδιο προέκτασης 17M, Nizkou kapacitanci stimulační
prodlužovací kabel 17M, Iska Reaktancja Stimulus Kabel
przedłużający 17M, Низкая емкость стимул кабель-
удлинитель 17M, Kiskapacitású inger hosszabbitó kábel
17M, Cablu prelungitor de joasă capacitatea stimul 17M,
Baixa capacitância estímulo 17M Cabo de Extensão



Legal
Manufacturer

Micropace Pty Ltd.
41/159 Arthur Street
Homebush West
NSW 2140 Australia
Ph: +61 2 9718 1746



MP307017


CE
0086

Rx ONLY



CL3070-17-V1.3-1116


Принадлежности: Удлинительный кабель для стимулирующих импульсов для соединительного модуля, длиной 17 м. Маркировка изделия.

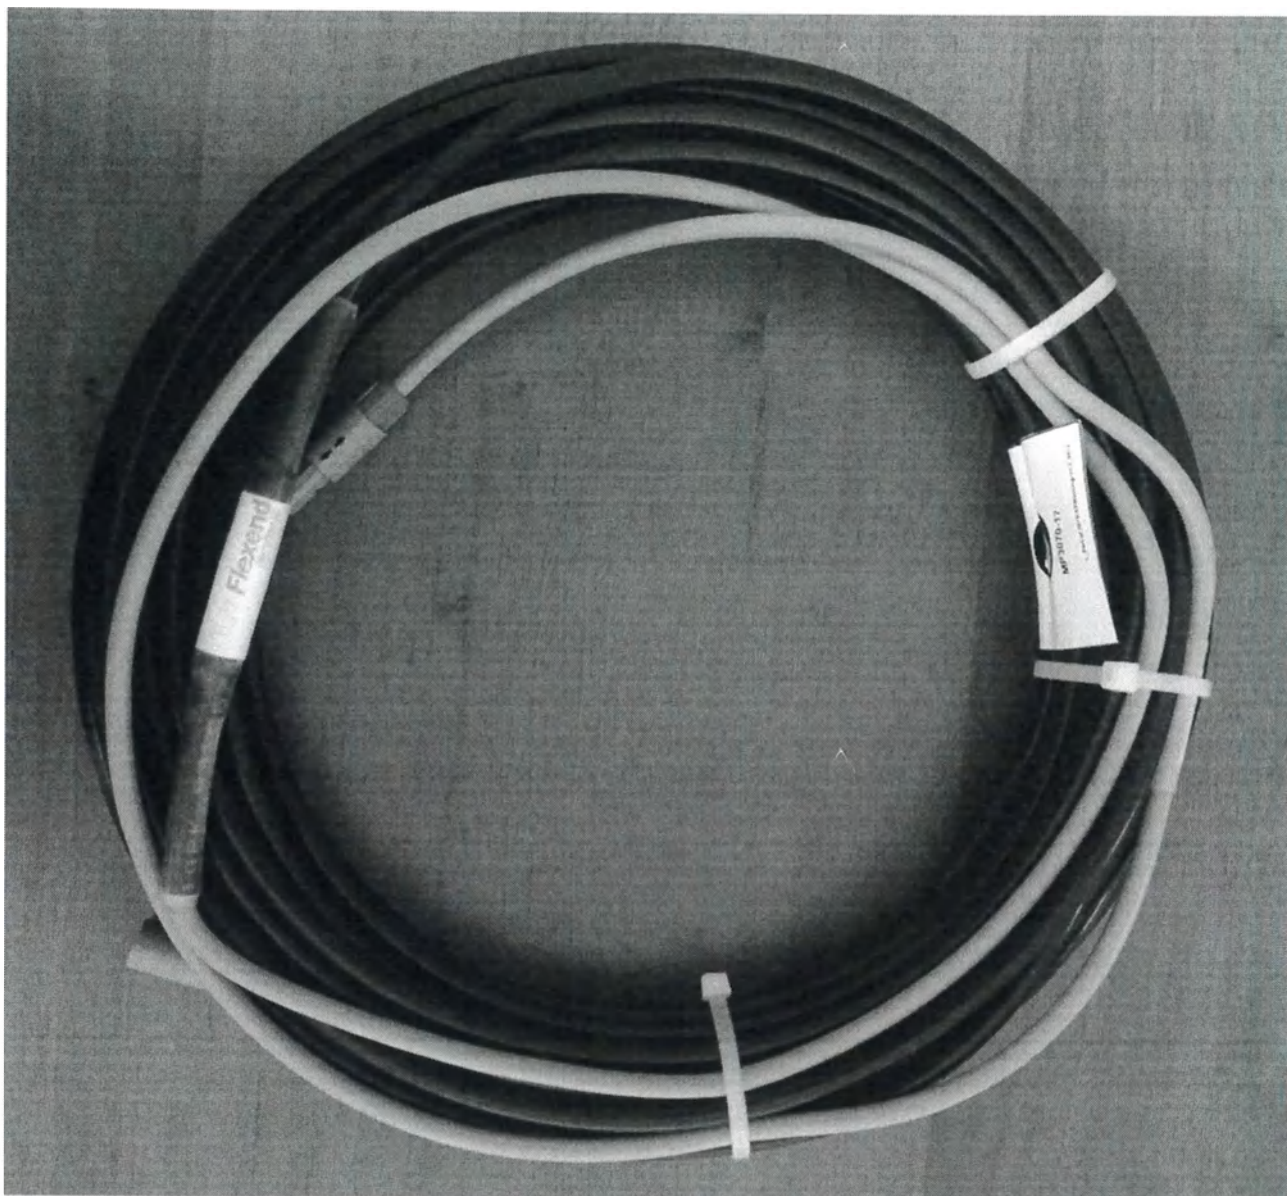

Принадлежности: Удлинительный кабель для стимулирующих импульсов для соединительного модуля, длиной 17 м. Общий вид изделия.



Принадлежности: Удлинительный кабель мультиплексора стимулирующих импульсов, 15 м.
Маркировка изделия.

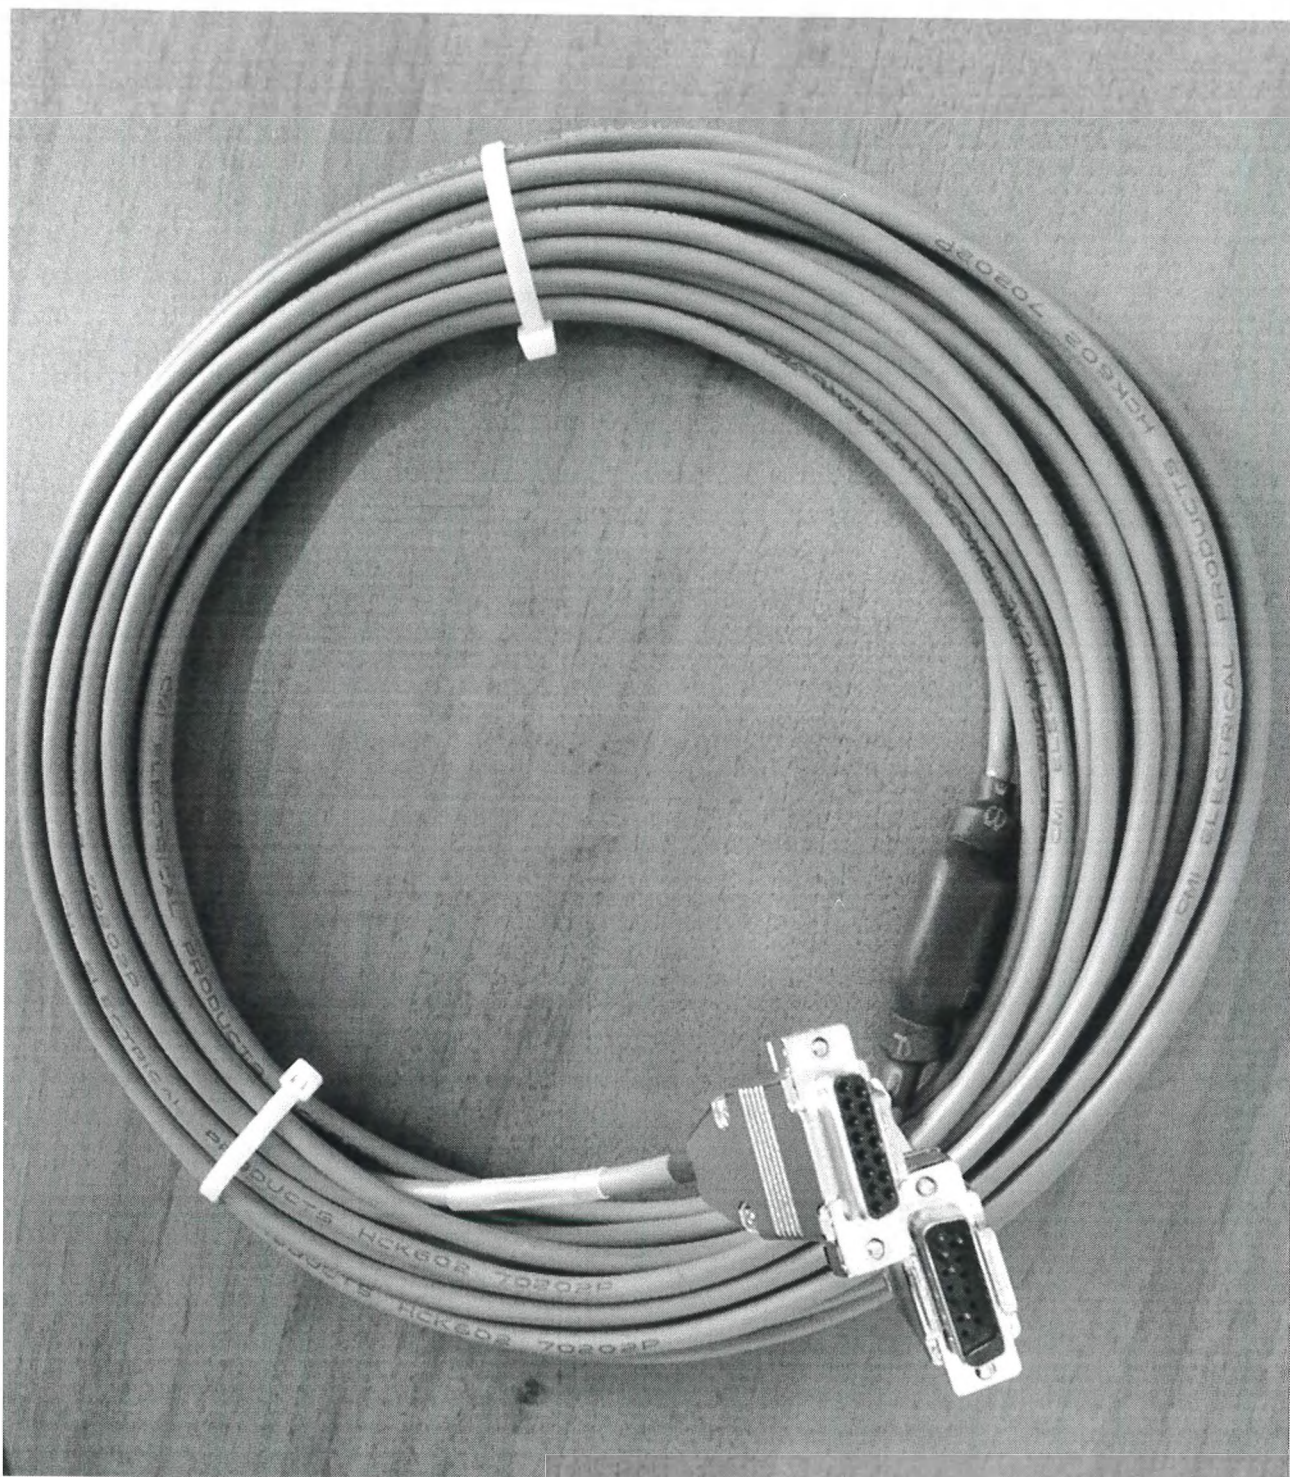

Принадлежности: Удлинительный кабель мультиплексора стимулирующих импульсов, 15 м.
Общий вид изделия.

Принадлежности: Тестовые электроды LED. Маркировка изделия

MicroPace
CIRCUIT CONTINUITY TEST LED

€ Micropace EPS320™

Catalogue No.
REF MP3058

LOT 12123

 Legal
Manufacturer

Micropace Pty Ltd.
41/159 Arthur Street
Homebush West
NSW 2140 Australia
Ph: +61 2 9718 1746

Part of EPS320 Cardiac Stimulator.
Read User Instructions Manual : Troubleshooting prior to use.




MP3058

CE
0086



Rx ONLY

L3058-V1.6-1116

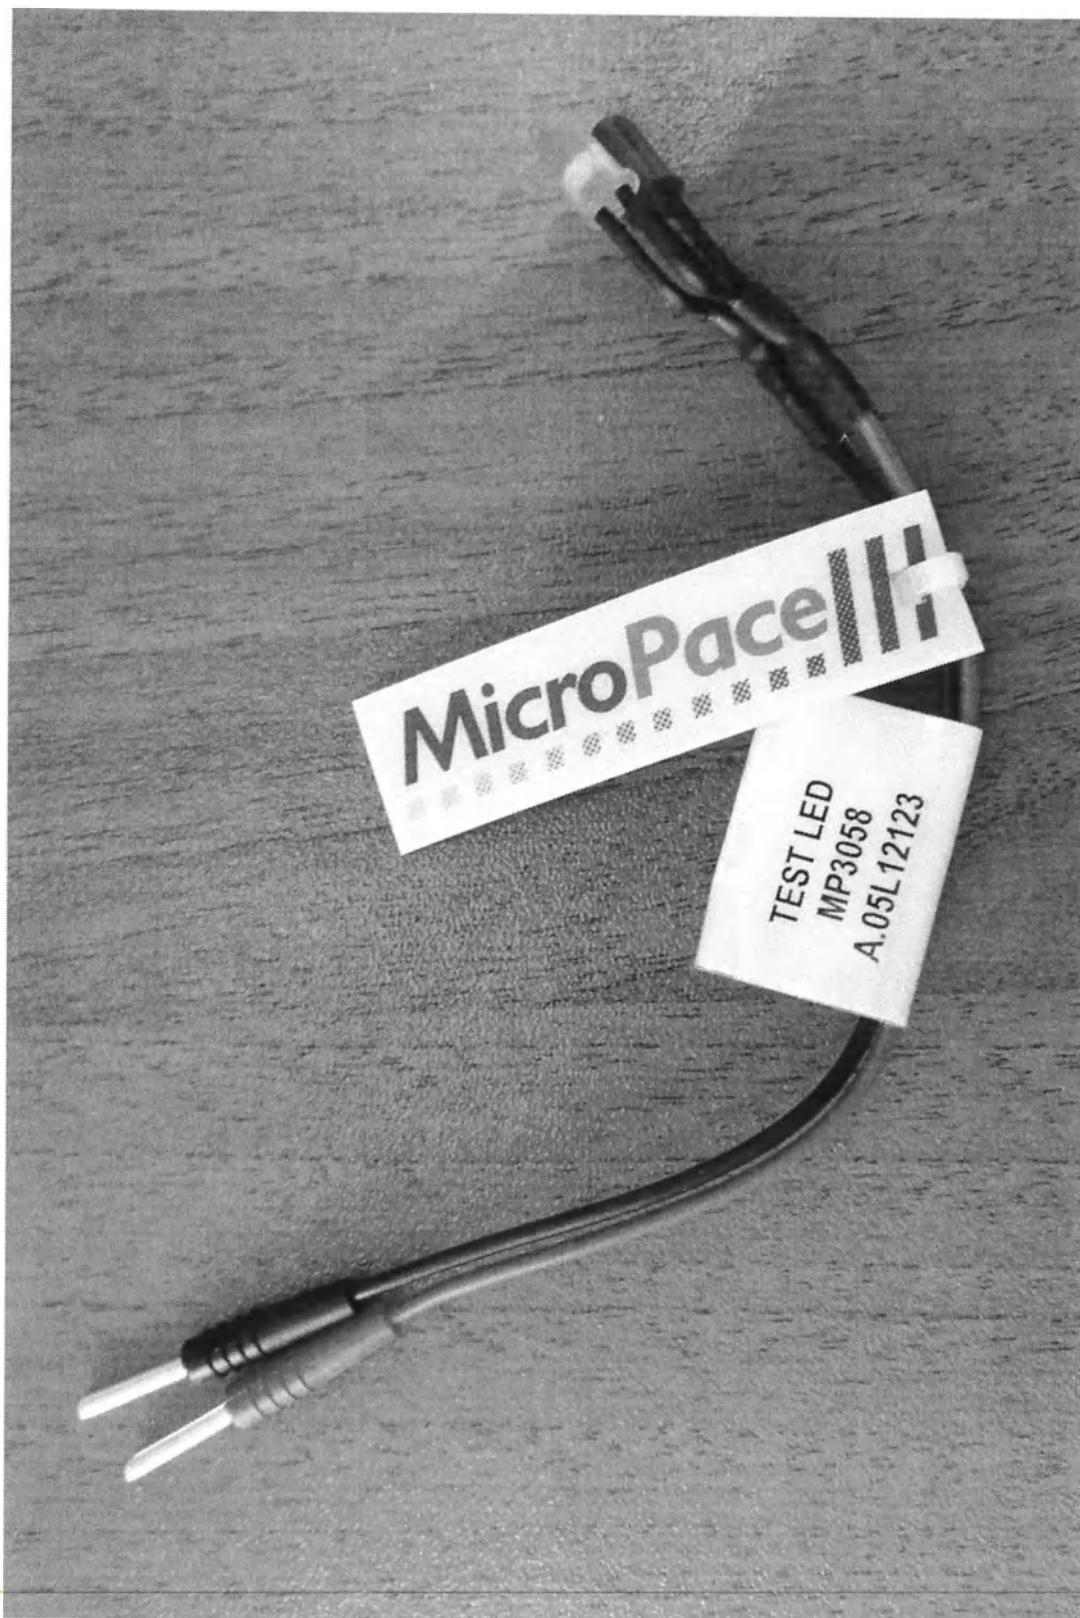

Принадлежности: Тестовые электроды LED. Общий вид изделия.

MicroPace

COMPACT NUMERIC KEYPAD

Catalogue No.

REF MP3393

Product No.

UPN 200MP3393


LOT 16-270



GTIN
GS1



(01) 09349714003930

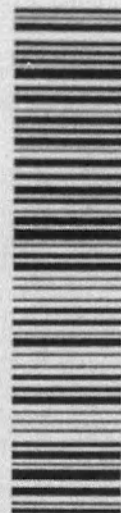

(11) 161024 (10) 16-270



MicroPace Pty Ltd
7/186-188 Canterbury Rd.
Canterbury, NSW 2193
Australia
Ph: +61 2 9718 1746
Made in Australia

CE 0086
R ONLY

EC REP

EU Authorized
Representative

Advena Ltd, Pure Offices,
Plato Close, Warwick CV34 6WE UK

Distributed by:
Boston Scientific Corporation
300 Boston Scientific Way
Marlborough, MA 01752
USA
USA Customer Service 888-272-1001



R_MP3393_BSC_V1.2.doc

Принадлежности: Компактный блок цифровой клавиатуры. Маркировка



Принадлежности: Компактный блок цифровой клавиатуры. Маркировка



Принадлежности: Компактный блок цифровой клавиатуры. Общий вид изделия.

MicroPace


BNC TO PHONE PLUG SIGNAL CABLE

Micropace EPS320™

Catalogue No.

REF MP3109

LOT 12128



Legal
Manufacturer
Micropace Pty Ltd.
41/159 Arthur Street
Homebush West
NSW 2140 Australia
Ph: +61 2 9718 1746

Do not use if lead appears damaged. Nicht benutzen wenn das Kabel beschädigt zu sein scheint. Ne pas utiliser si le cable paraît endommagé. Se il conduttore appare danneggiato, non usarlo. No usar si el cable parece dañado.



MP3109



CE
0086

R ONLY


L3109-V1 7-1116

Принадлежности: Кабель сигнальный с переходником от штырькового разъёма к телефонному штекеру 3м. Маркировка изделия.



Принадлежности: Кабель сигнальный с переходником от штырькового разъема к телефонному штекеру 3м. Общий вид изделия

Принадлежности: Батарея аккумуляторная на 12В. Маркировка изделия и общий вид

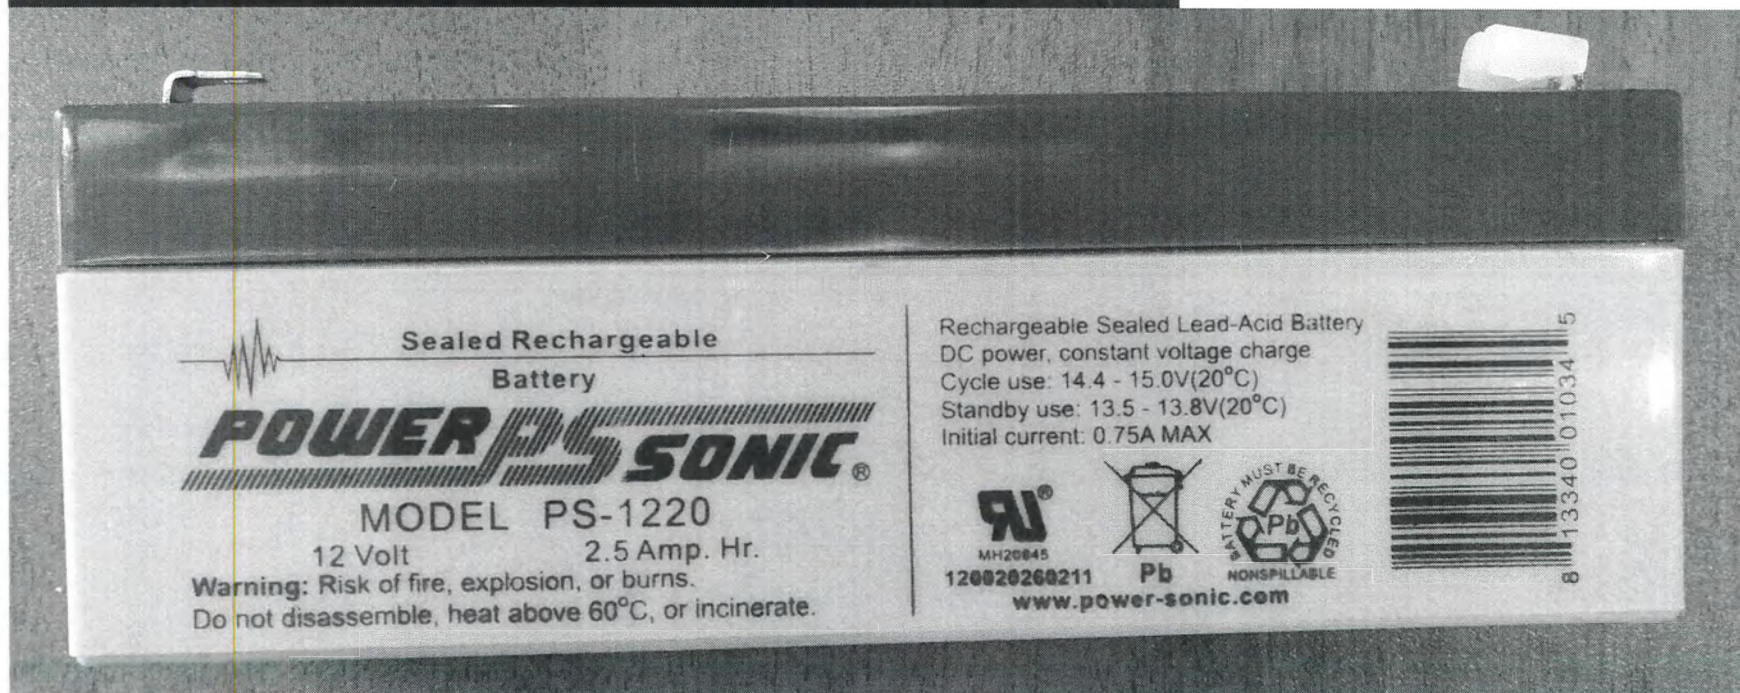

Принадлежности: Источник питания для БГС. Маркировка изделия.





Принадлежности: Источник питания для БГС. Общий вид изделия.

Принадлежности: Соединительный кабель для ЭКГ-сигнала с разъемом 6.5 Phone - 2.5 Phone.
Маркировка изделия.

MicroPace///

SIGNAL CABLE WITH PHONE PLUGS

€ Micropace EPS320™

Catalogue No.
REF MP3034

LOT 11987



Micropace Pty Ltd.
41/159 Arthur Street
Homebush West
NSW 2140 Australia
Ph: +61 2 9718 1746

Do not use if lead appears damaged. Nicht benutzen wenn das Kabel beschädigt zu sein scheint. Ne pas utiliser si le cable paraît endommagé. Se il conduttore appare danneggiato, non usarlo. No usar si el cable parece dañado.



MP3034

CE
0086



Rx ONLY

L3034-V3.9-1116



**Принадлежности: Соединительный кабель для ЭКГ-сигнала с разъемом 6.5 Phone - 2.5 Phone.
Общий вид изделия.**

MicroPace|||

**ISOLATED MAINS POWER LEAD
IEC 3 TO 2 Pin - EU STYLE**

€ Micropace EPS320™

REF Catalogue No. **MP3066EU**

LOT **11204**



Micropace Pty Ltd.
41/159 Arthur Street
Homebush West
NSW 2140 Australia
Ph: +61 2 9718 1746

Do not use if lead appears damaged.

Nich benutzen wenn das Kabel beschädigt zu sein scheint.

Ne pas utiliser si le cable paraît endommagé.

Se il conduttore appare danneggiato, non usarlo.

No usar si el cable parece dañado.



MP3066EU

CE
0086



L3066EU-V4 1-1116

Принадлежности: Изолированный сетевой кабель, IEC, 3 × 2 контакта, для ЕС. Маркировка изделия.



Принадлежности: Изолированный сетевой кабель, IEC, 3 × 2 контакта, для ЕС. Общий вид изделия.

Принадлежности: Изолированный сетевой кабель, IEC, 3 x 3 контакта. Маркировка изделия.

MicroPace///

Isolated Mains Power Lead IEC3 to 3 Pin

€ Micropace EPS320™

Catalogue No.

REF

MP3030

LOT


10924

Connect only to isolated mains power supply via item
MP3107/MP3001US.

Do not use if lead appears damaged.



MC0346




Micropace Pty Ltd.
41/159 Arthur Street
Homebush West
NSW 2140 Australia
Ph: +61 2 9718 1746

CE
0086



R_x ONLY

L3030-V2.9-1116

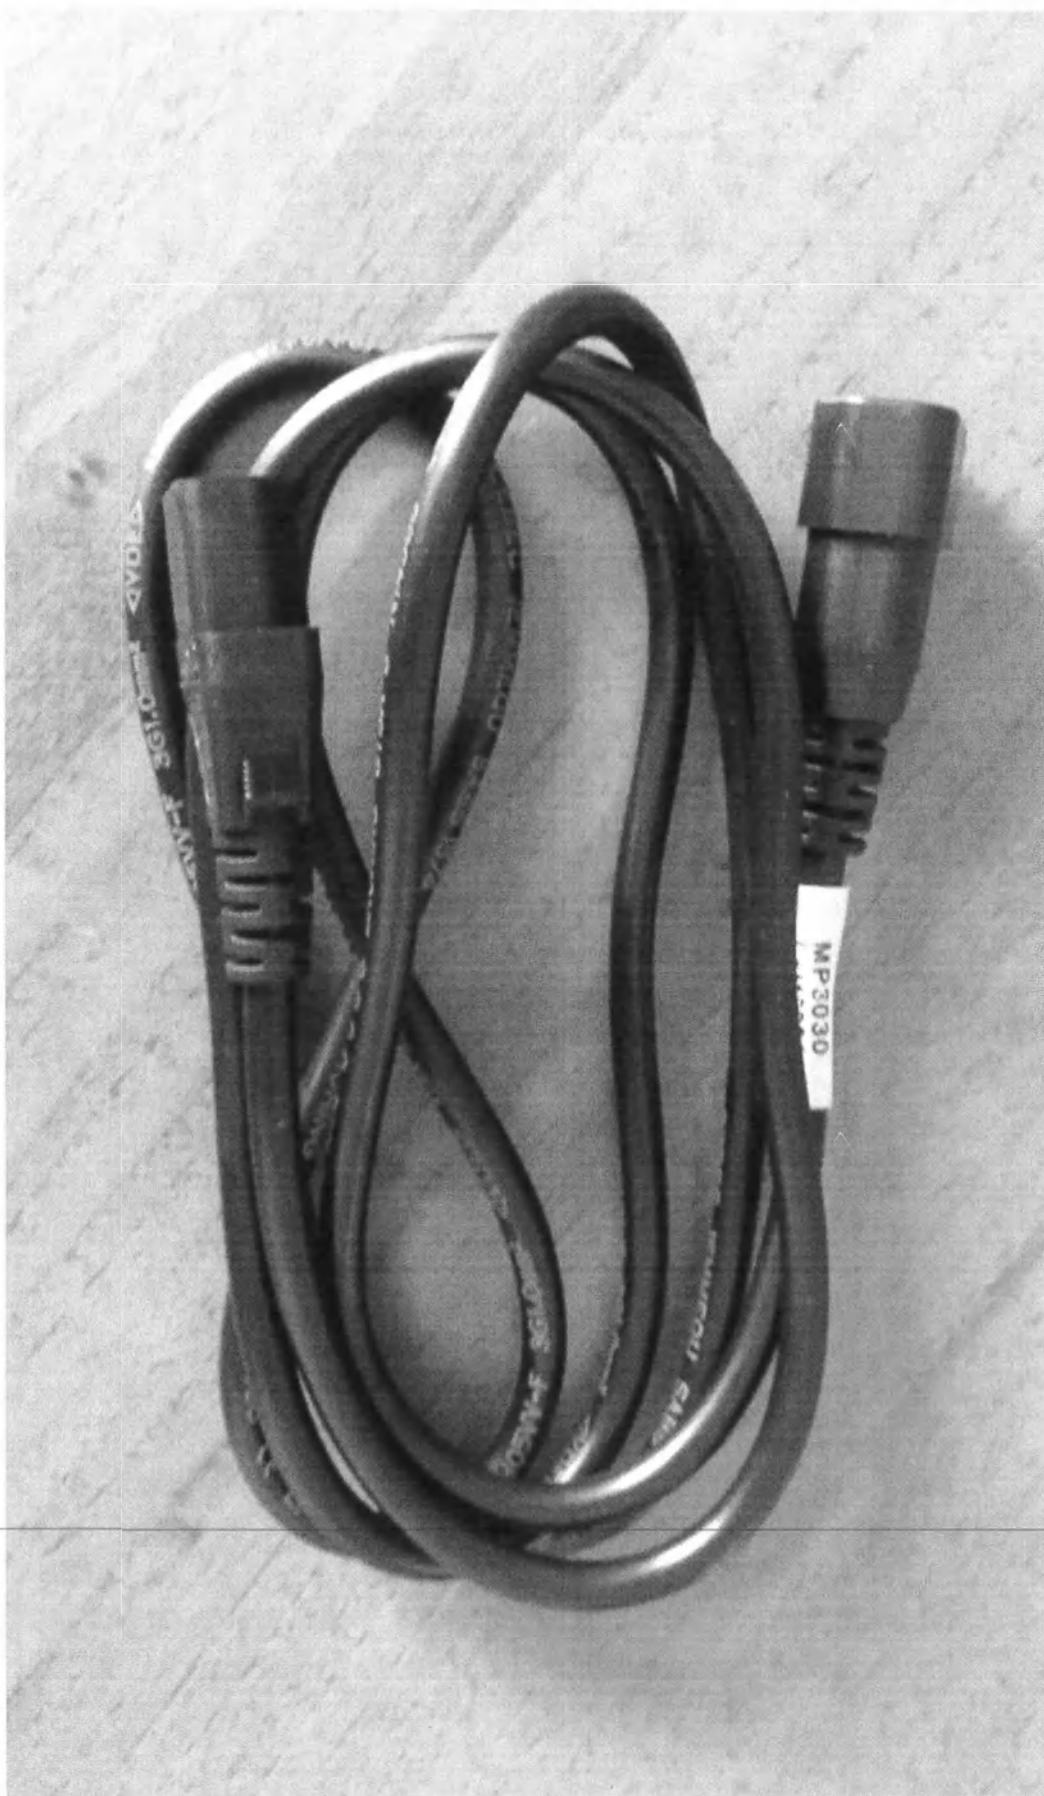

Принадлежности: Изолированный сетевой кабель, ИЕС, 3 × 3 контакта. Общий вид изделия.

Принадлежности: Кабель последовательного интерфейса RS232, 2м. Маркировка изделия.

MicroPace///

SERIAL BOOST RS232 CABLE - 2M

€ Micropace EPS320™

Catalogue No.
REF MP3033A

LOT 12175

 Legal
Manufacturer

Micropace Pty Ltd.
41/159 Arthur Street
Homebush West
NSW 2140 Australia
Ph: +61 2 9718 1746

Do not use if lead appears damaged.
Nicht benutzen wenn das Kabel beschädigt zu sein scheint.
Ne pas utiliser si le cable paraît endommagé.
Se il conduttore appare danneggiato, non usarlo.
No usar si el cable parece dañado.



MP3033A


CE
0086



Rx ONLY



L3033A-V1.8-1116

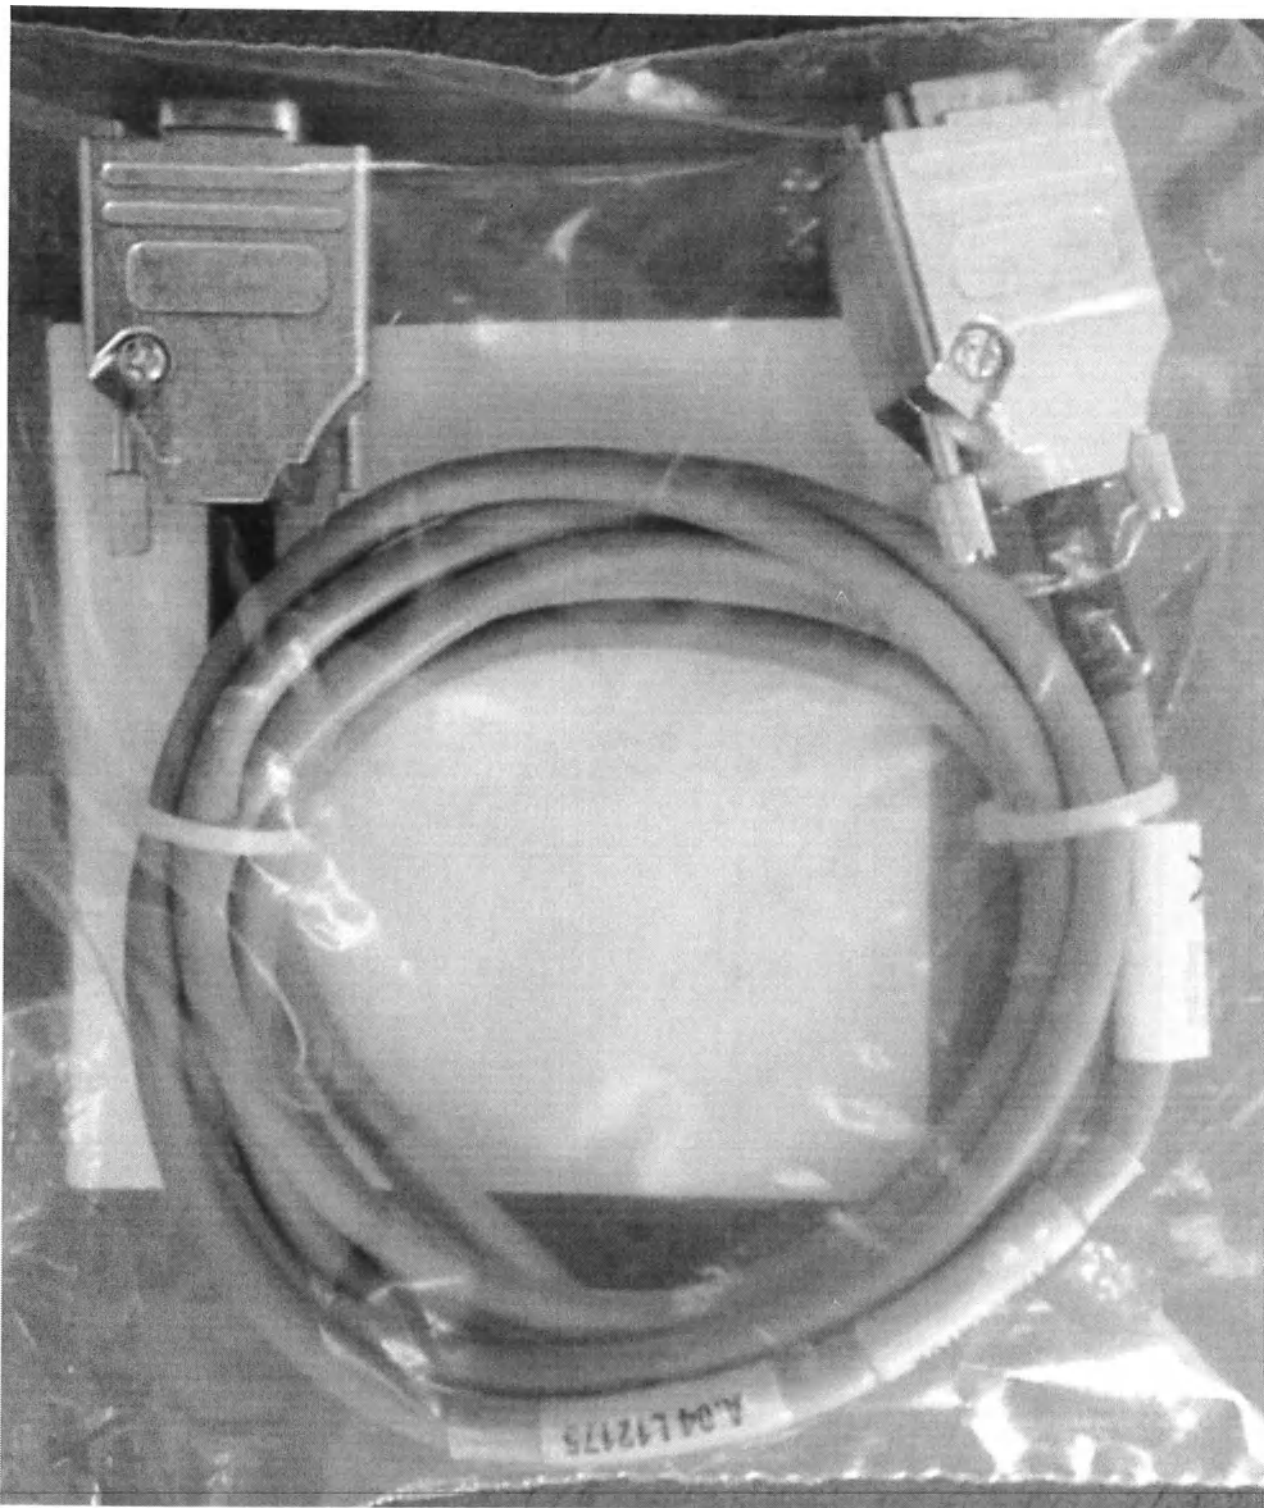

Принадлежности: Кабель последовательного интерфейса RS232, 2м. Общий вид изделия.

Принадлежности: Кабель питания изолирующего трансформатора. Маркировка изделия.

MicroPace
**ISOLATION TRANSFORMER POWER
LEAD - EU SCHUKO STYLE**

€ Micropace EPS320™

Catalogue No.

REF MP3059EU

LOT 11816

 Legal
Manufacturer
Micropace Pty Ltd.
41/159 Arthur Street
Homebush West
NSW 2140 Australia
Ph: +61 2 9718 1746

Connect to mains power supply and Isolation Transformer Item MP3107.
Do not use if lead appears damaged.

Mit Netzstrom und dem Isoliertransformator verbinden, Artikel MP3107.

Nicht benutzen, wenn das Kabel beschädigt zu sein scheint.

Brancher sur l'alimentation secteur et sur le transformateur d'isolement -Article MP3107.

Ne pas utiliser si le cable paraît endommagé.

Allacciarsi alla rete di distribuzione e al Trasformatore d'Isolamento, articolo MP3107.

Se il conduttore appare danneggiato, non usarlo.

Conecte al suministro de la red de alimentación y al Transformador de Aislación

Artículo MP3107. No usar si el cable parece dañado.



MP3059EU

CE
0086




L3059EU-V2.0-1116



Принадлежности: Кабель питания изолирующего трансформатора. Общий вид изделия.

Принадлежности: Блок соединения с пациентом 2-канальный с фильтром высоких частот.
Маркировка изделия.




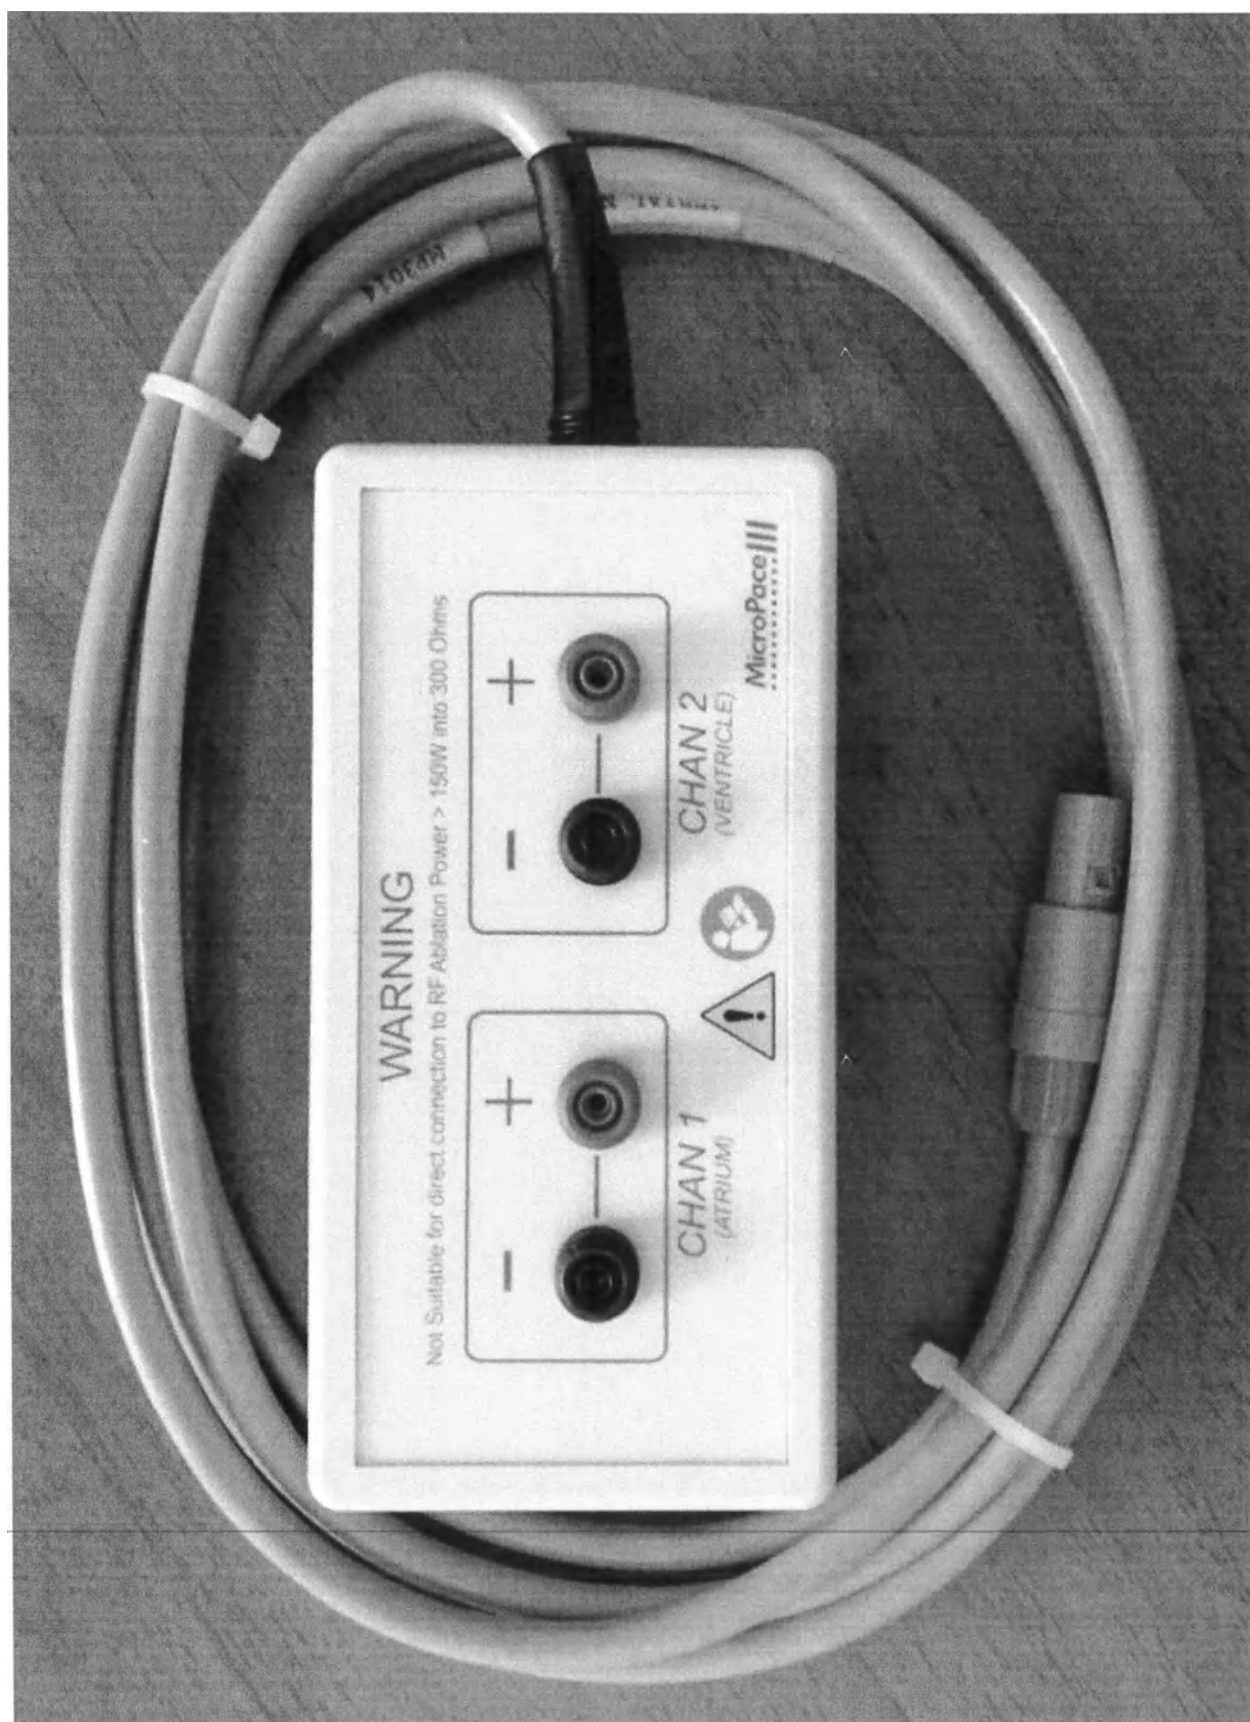

Принадлежности: Блок соединения с пациентом 2-канальный с фильтром высоких частот.
Общий вид изделия.



Принадлежности: Фиксатор кабеля питания изоляционного трансформатора. Маркировка изделия.

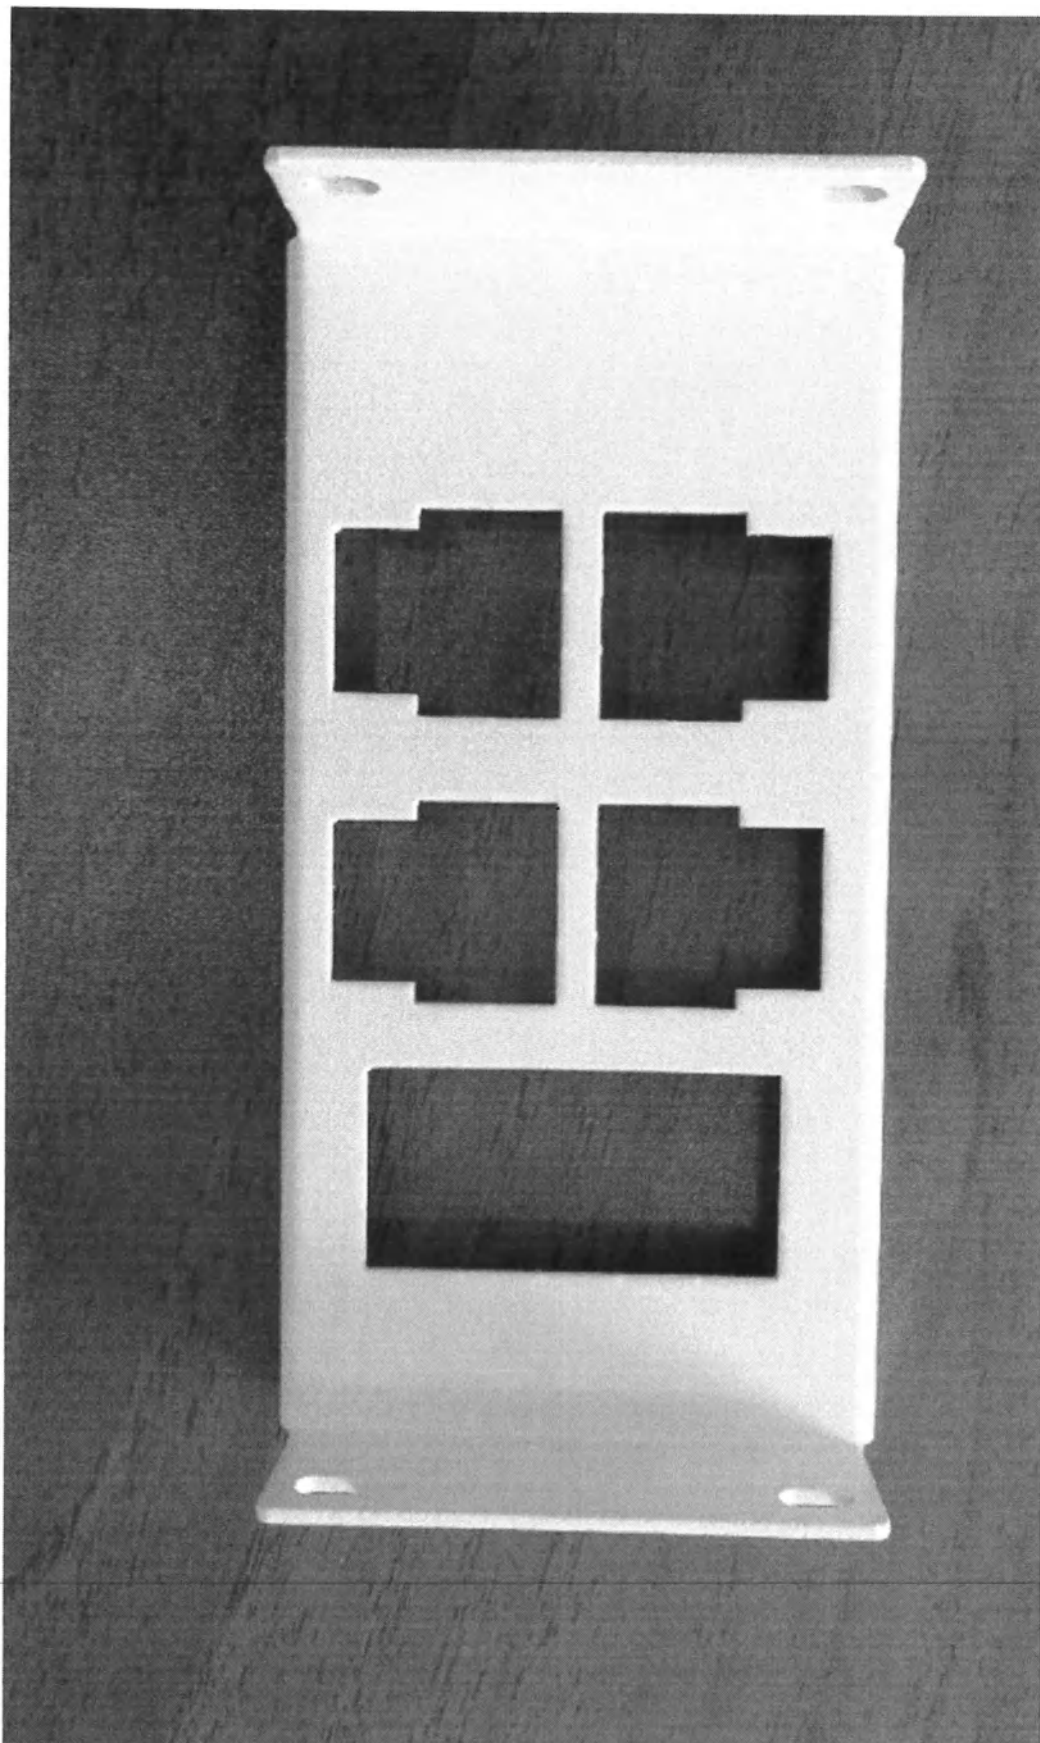

Принадлежности: Фиксатор кабеля питания изоляционного трансформатора. Общий вид изделия.

Стимулятор Micropace для диагностической электрокардиостимуляции с принадлежностями, вариант исполнения:

Стимулятор Micropace StimLab для диагностической электрокардиостимуляции с прикроватной системой контроля работы, в составе:

1. Блок генератора стимулов с принадлежностями в составе:

- генератор стимулов импульсный;
- кабель удлинительный для стимулирующих импульсов для генератора импульсного, длина 13 м.
- изоляционный трансформатор;
- клавиатура;
- удлинительный кабель мультиплексора стимулирующих импульсов, 15 м;
- принадлежности;
- эксплуатационная документация.

2. Компьютерный шкаф StimLab.

3. Монитор с сенсорным экраном локальный.

4. Монитор с сенсорным экраном удаленный.

5. Набор для замены компьютерного модуля для EPS320/StimLab, StimCor (при необходимости), в составе:

- компьютер Bona Lite PC;
- источник питания компьютера Bona Lite PC;
- кабель последовательного интерфейса RS232, 2м;
- клавиатура.

6. Комплект для установки (при необходимости), в составе:

- кабельные стяжки - 4 шт.;
- одиночный телефонный штекер 6,5 мм на разъем RCA - 2шт.;
- переходник с разъема BNC на штекер RCA - 2шт.;
- тестовые электроды LED - 1шт.;
- клеящийся анкер кабельной стяжки - 1шт.

Принадлежности:

1. Кабель управления SM-блока.

2. Комплект оборудования StimLink для обмена данными с регистратором электрофизиологических параметров, в составе:

- соединительный кабель StimLink с разъемами DB25 – DB9;
- соединительный кабель StimLink для подключения ЭФИ системы.

3. Удлинительный кабель для стимулирующих импульсов для соединительного модуля, длиной 8м, 13м и 17 м.

4. Удлинительный кабель мультиплексора стимулирующих импульсов, длиной 27 м.

5. Удлинительный кабель последовательного порта RS232 (с радиочастотным фильтром), длиной 12м, 25м.

6. Комплект кабелей для подключения сенсорного монитора к стимулятору StimLab.


7. Тестовые электроды LED.

8. Компактный блок цифровой клавиатуры.

9. Кабель сигнальный с переходником от штырькового разъема к телефонному штекеру 3м.

10. Батарея аккумуляторная на 12В.

11. Батарея литиевая на 9В.
12. Источник питания для БГС.
13. Соединительный кабель StimLink с разъемами DB25 – DB9.
14. Соединительный кабель StimLink для подключения ЭФИ системы.
15. Соединительный кабель для ЭКГ-сигнала с разъемом 6.5 Phone - 2.5 Phone.
16. Изолированный сетевой кабель, IEC, 3 × 2 контакта, для ЕС.
17. Изолированный сетевой кабель, IEC, 3 × 3 контакта.
18. Кабель последовательного интерфейса RS232, 2м.
19. Кабель питания изолирующего трансформатора.
20. Удлинительный кабель Stimlab.
21. Изоляционный трансформатор.
22. Распределитель питания изолированный (Isolated IEC Power Distribution Board).
23. Стойка компьютерная.
24. Блок соединения с пациентом 2-канальный с фильтром высоких частот.
25. Фиксатор кабеля питания изоляционного трансформатора MP3181.
26. Кабель передачи данных RS232 «папа-мама», длина 7.5м (25ft), 15м (50ft), 30м (100ft).

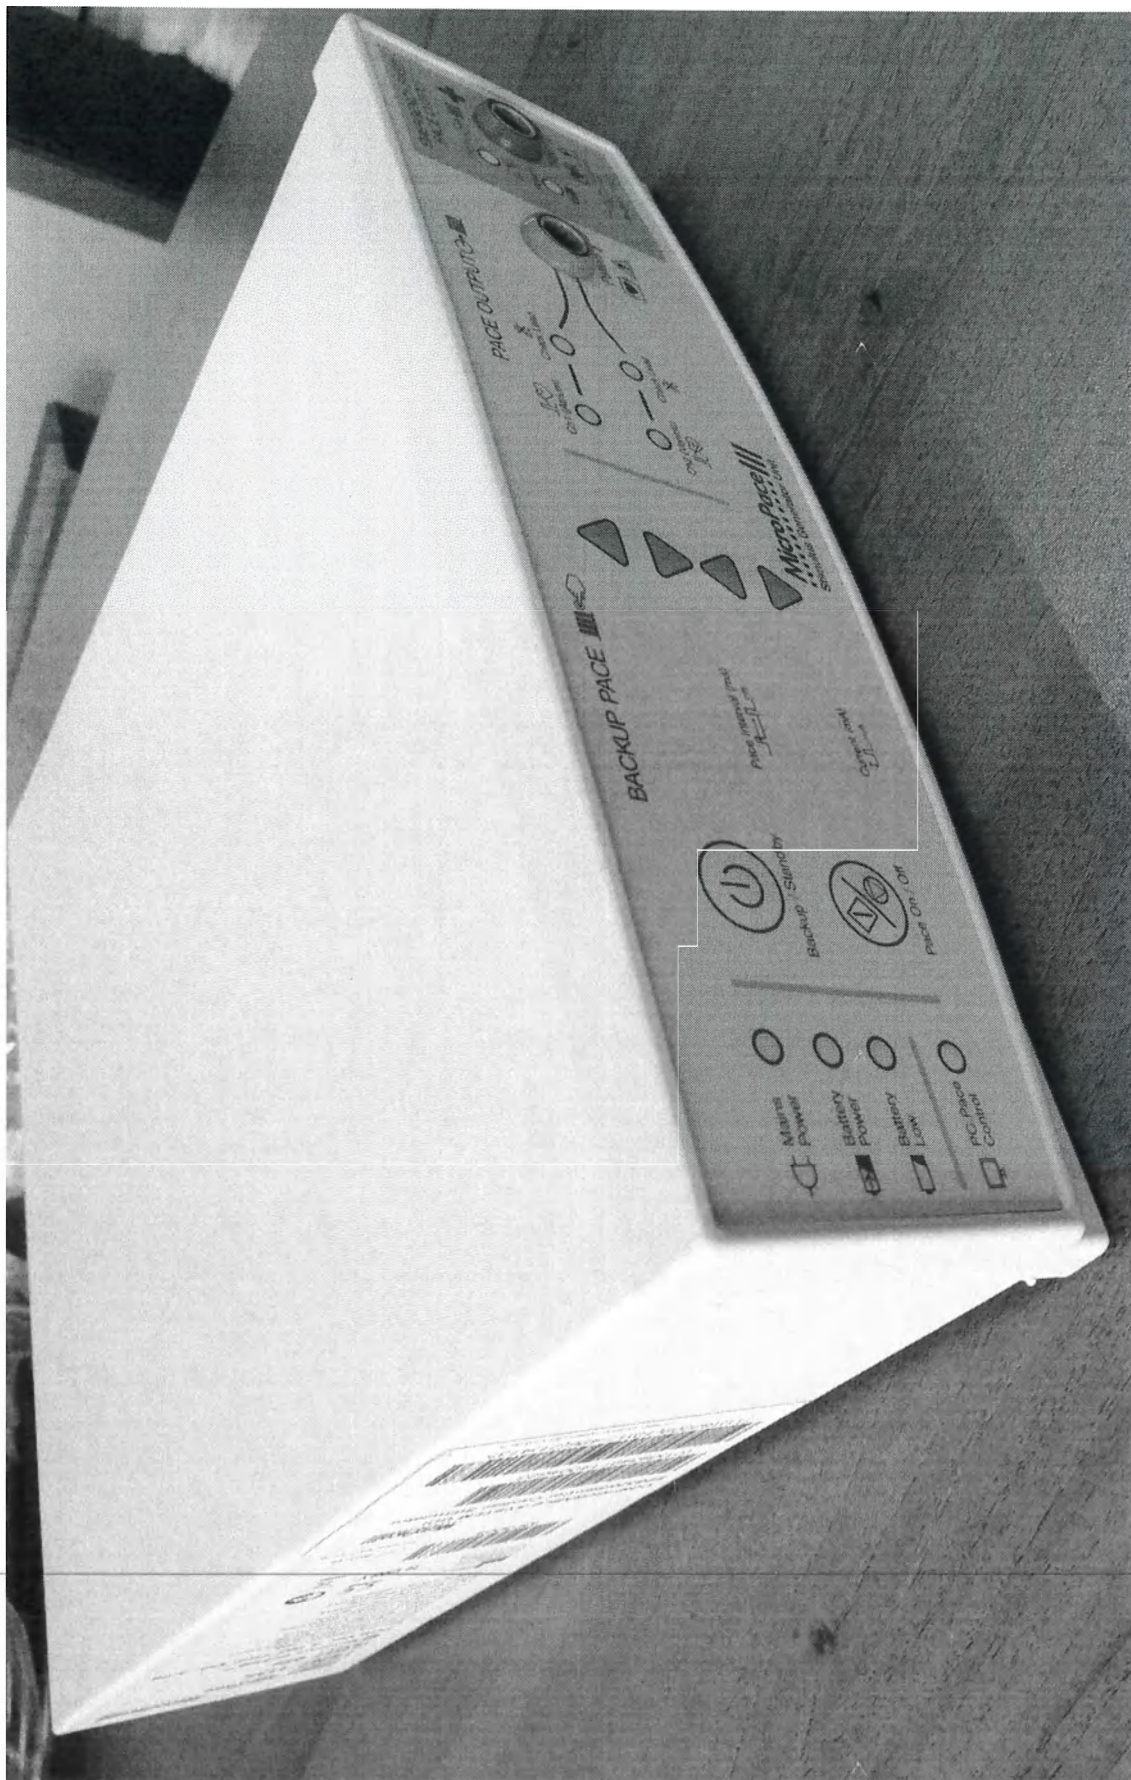

Генератор стимулов импульсный. Общий вид изделия

MicroPace///

REF Catalogue No. **MP3008**

SN **4135**

LOT **059**

€ **Micropace EPS320™**

PCB Ver. 3.16d Firm Ver. 4.76

Stimulus Generator Unit

Groupe électrogène de stimulation,

Stimulus Generator Einheit,

Gruppo generatore di stimoli,

Grupo electrógeno Estimulo,

Teşvik Jeneratör Ünitesi,

Ερέθισμα γεννήτρια ασφαλείας,

Stimulačni generátor pole,

Warsztat Generator Box,

Стимул блока генератора,

Inger-generátor egység,

Stimul Unitatea de generator,

Unidade estímulo gerador.



Legal
Manufacturer
Micropace Pty Ltd.
41/159 Arthur Street
Homebush West
NSW 2140 Australia
Ph: +61 2 9716 1746

CE
0086



Rx ONLY



MP3008

2017-12

CL3008-V5 2-1116

MicroPace///

CONFIGURABLE SYSTEM UDI

EPS320/StimCor Cardiac Stimulator




(01)09349714004623



(11)180209(10)17-496(21)4135

CL3462_EPS320 System UDI-V1.0-0615

Генератор стимулов импульсный. Маркировка изделия.

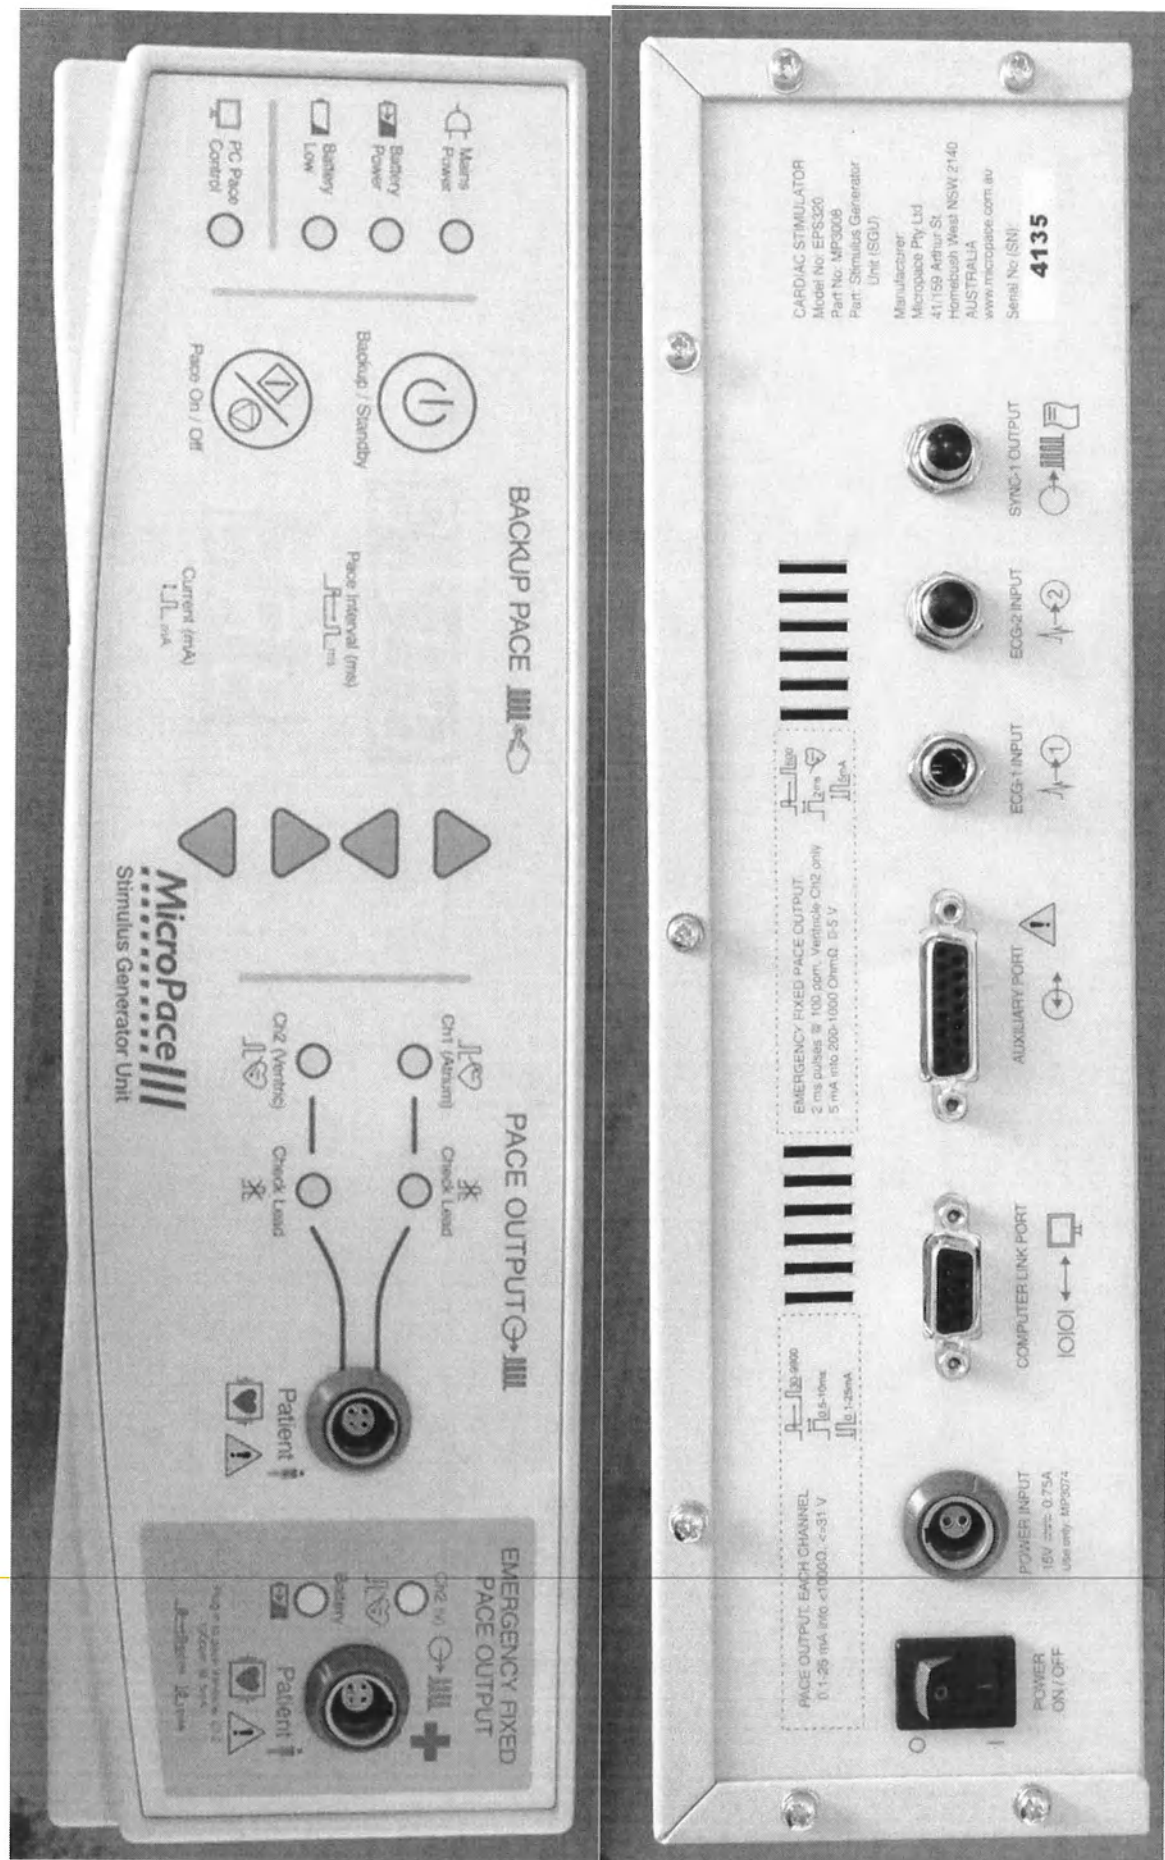

Генератор стимулов импульсный. Лицевая и оборотная сторона.

POWERTRONIX

Isolation Station™

ISOLATION TRANSFORMER


3RD ED - 300VA

Micropace EPS320™


Catalogue No.

REF MP3107


LOT 17-259




MicroPace




Legal
Manufacturer
Micropace Pty Ltd
41/159 Arthur Street
Hornebush West
NSW 2140 Australia
Ph +61 2 9718 1746



Connect to Micropace Product only
Connecter à Micropace produit seulement
Verbinden Sie Produkt nur Micropace
Connettersi a Micropace prodotto solo
Conectar con Micropace producto sólo
Ligue apenas ao produto Micropace

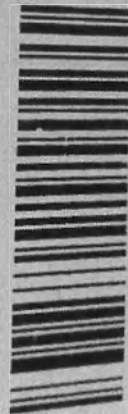

MC0869




RoHS ONLY

L3107-V2 3-1116

Power Isolation Unit

300 VA

Изоляционный трансформатор. Маркировка изделия сзади.

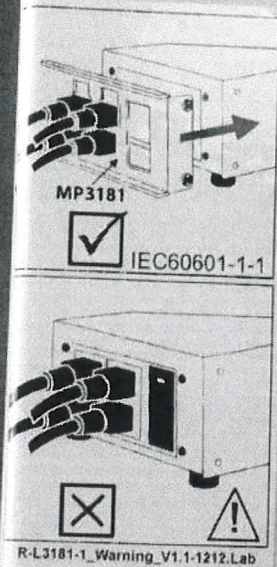

WARRANTY VOID IF THIS SEAL IS BROKEN.



PLEASE REFER TO PRODUCT
MANUAL FOR IMPORTANT OPERATING
AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS.

THIS APPARATUS IS A CLASS I
EQUIPMENT.

DANGER:

RISK OF EXPLOSION OF
USED IN
THE PRESENCE OF
FLAMMABLE ANESTHETICS,
OR OTHER FLAMMABLE
GASES OR LIQUIDS.

NOTE:

USA AND CANADA;
GROUNDING RELIABILITY
CAN ONLY BE ACHIEVED
WHEN THIS
EQUIPMENT IS CONNECTED
TO A RECEPTACLE MARKED
"HOSPITAL ONLY", OR
"HOSPITAL GRADE".

CAUTION:

THIS PRODUCT REQUIRES
CONVECTION COOLING.
ADEQUATE VENTILATION
IS REQUIRED. CLEARANCE
OF 2" MINIMUM ON ANY
SIDE.

CAUTION:

TO REDUCE THE RISK OF
ELECTRICAL SHOCK, DO
NOT OPEN ENCLOSURE.
NO SERVICEABLE PARTS
INSIDE.

WARRANTY VOID IF THIS SEAL IS BROKEN.

WARRANTY VOID IF THIS SEAL IS BROKEN.

POWERTRONIX

Isolation Station™

PART NO: X1ATWFHNO1
INPUT VOLTAGE: 115 (120) / 230 (240) VAC - 50/60Hz
INPUT CURRENT: 2.6 A / 1.3 A
LEAKAGE CURRENT: < 100 μ A
OUTPUT VOLTAGE: 115 (120) / 230 (240) VAC
OUTPUT CURRENT: 2.5 A / 1.25 A



MEDICAL I.T.E. ANSAAAMI ES60601-1
ISOLATION 10HW CAN/CSA-C22.2 NO 60601-1
STATION 10HV EN60601-1 : 2006
IEC60601-1 : 2005



POWERTRONIX Corporation - Foster City, CA, USA - (650) 345-6800
www.powertronix.com

Изоляционный трансформатор. Маркировка изделия сверху.



Изоляционный трансформатор. Общий вид изделия.

MicroPace///

COMPUTER KEYBOARD

€ Micropace EPS320™


Catalogue No.

REF MP3016

LOT 17-281



MC0950




Micropace Pty Ltd.
41/159 Arthur Street
Homebush West
NSW 2140 Australia
Ph: +61 2 9718 1746

CE
0086



R_x ONLY


L3016-V4.4-1116

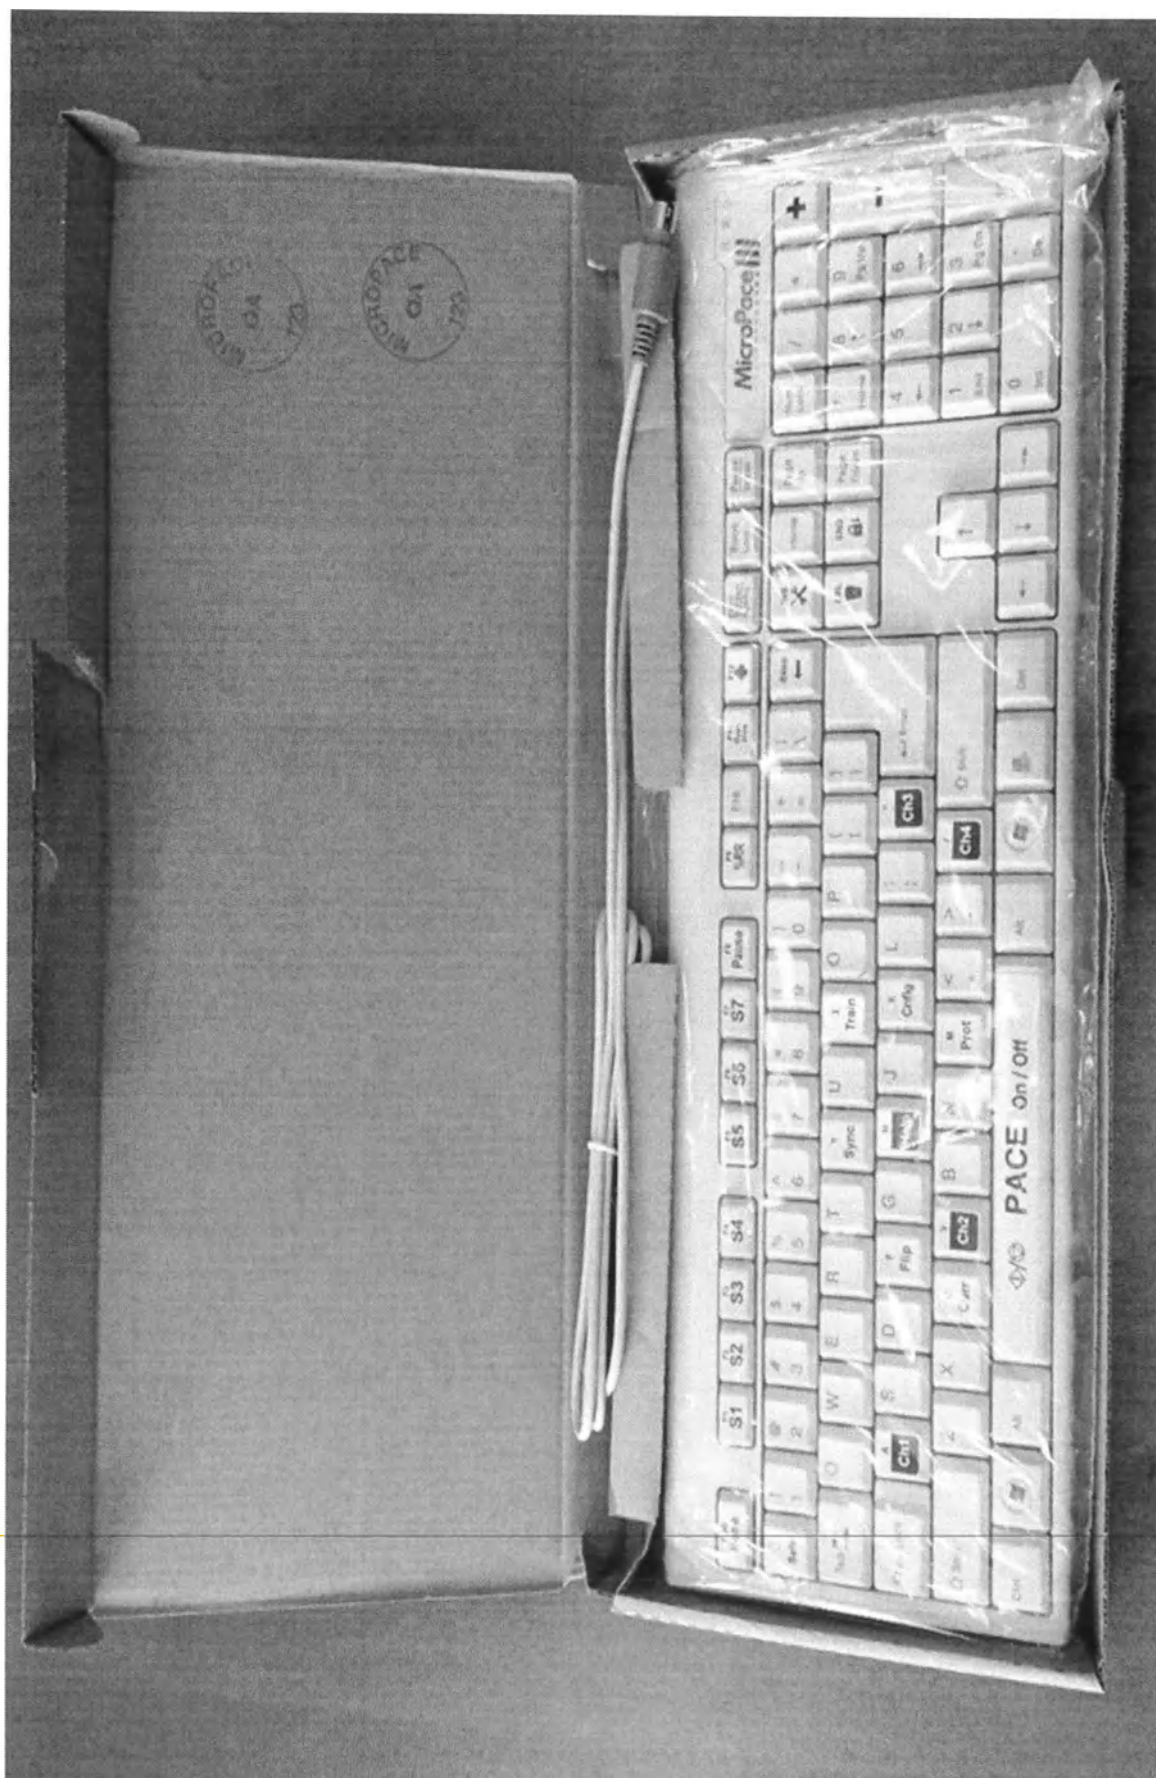

Клавиатура. Общий вид изделия.



Удлинительный кабель мультиплексора стимулирующих импульсов, 15 м. Маркировка изделия.

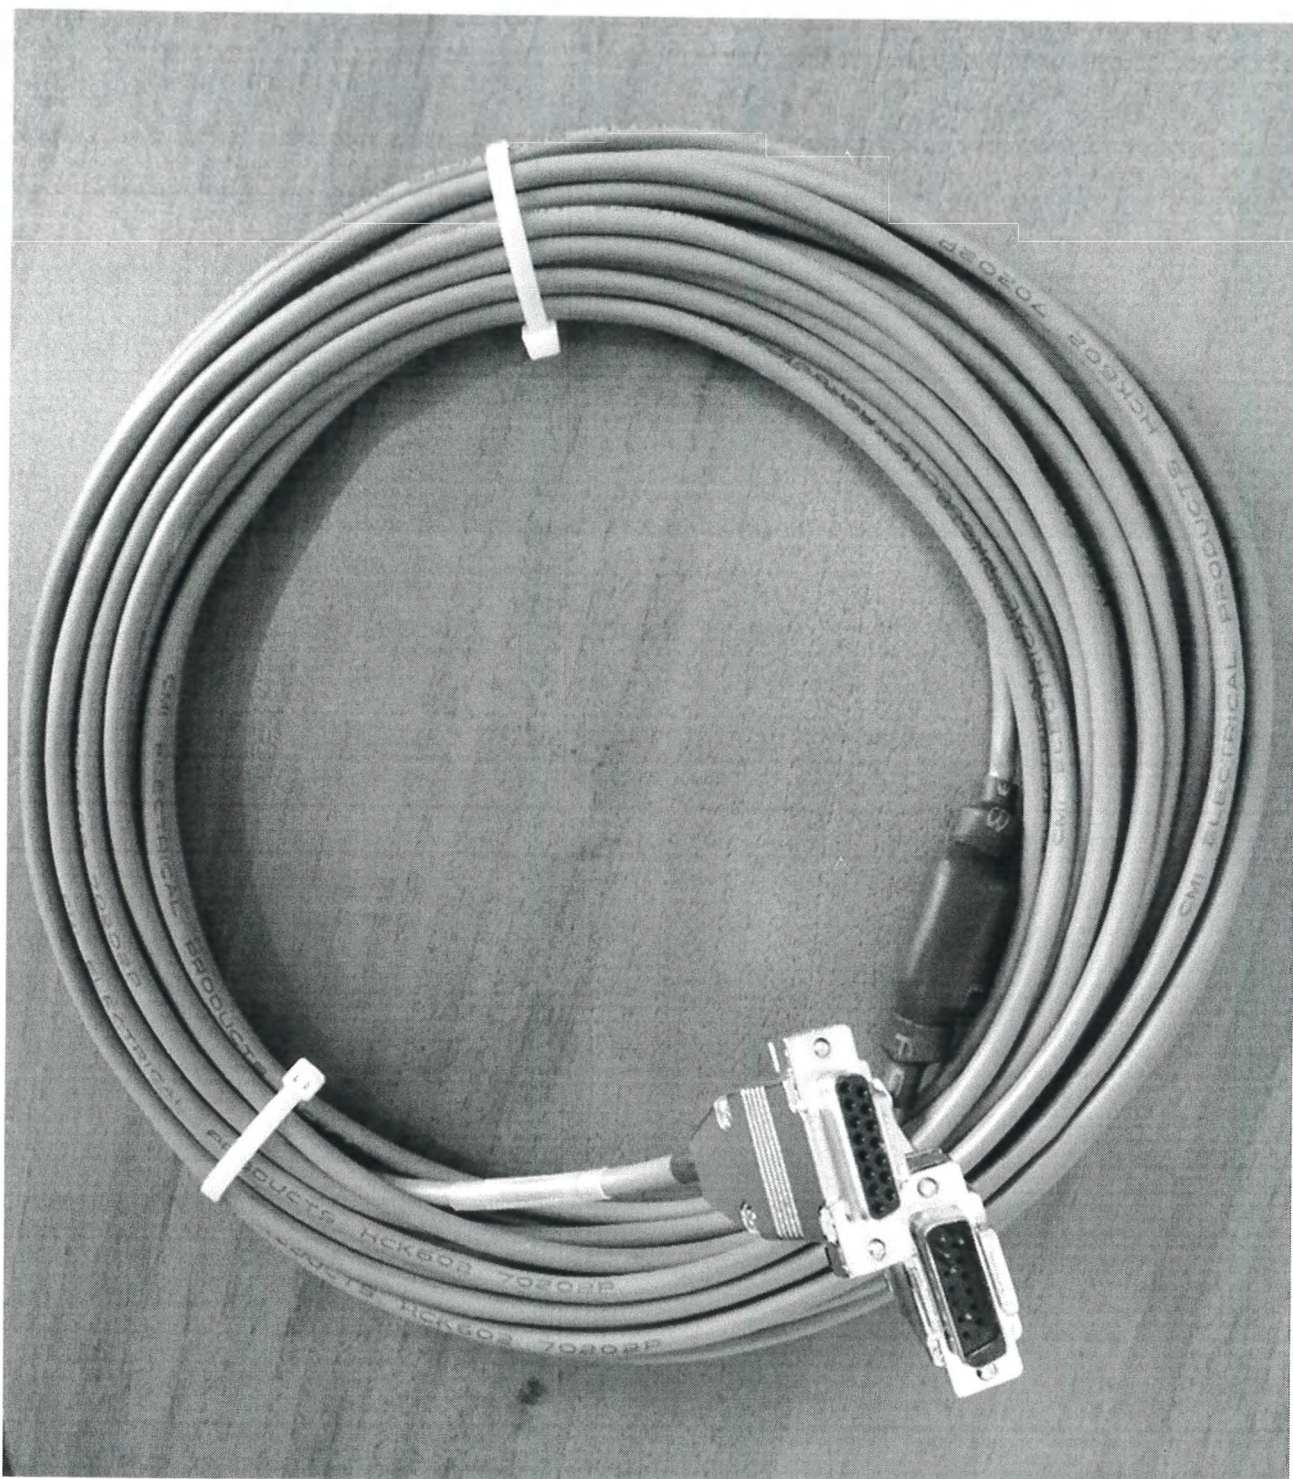

Удлинительный кабель мультиплексора стимулирующих импульсов, 15 м. Общий вид изделия.



Монитор с сенсорным экраном удаленный. Маркировка изделия.



Монитор с сенсорным экраном локальный. Общий вид изделия.



Монитор с сенсорным экраном удаленный. Маркировка изделия.



Монитор с сенсорным экраном удаленный. Общий вид изделия.

MicroPace///

**BONA COMPUTECH LIGHT
SYSTEM PC**

€ Micropace EPS320™

REF Catalogue No.
MP3093

LOT 17-260

 Legal
Manufacturer

Micropace Pty Ltd.
41/159 Arthur Street
Homebush West
NSW 2140 Australia
Ph: +61 2 9718 1746



MC0872

CE
0086



R_x ONLY



L3093-V3.9-1116

**Factory Preloaded
Software V4.0
EPS320BT-2CHANNEL**

L_Factory_Preload 4.0-EPS320BT-2CHANNEL-V1.0-0615

Компьютер Bona Lite PC. Маркировка изделия




Компьютер Bona Lite PC. Общий вид изделия.




Источник питания компьютера Bona Lite PC. Маркировка изделия



Источник питания компьютера Bona Lite PC. Общий вид изделия.

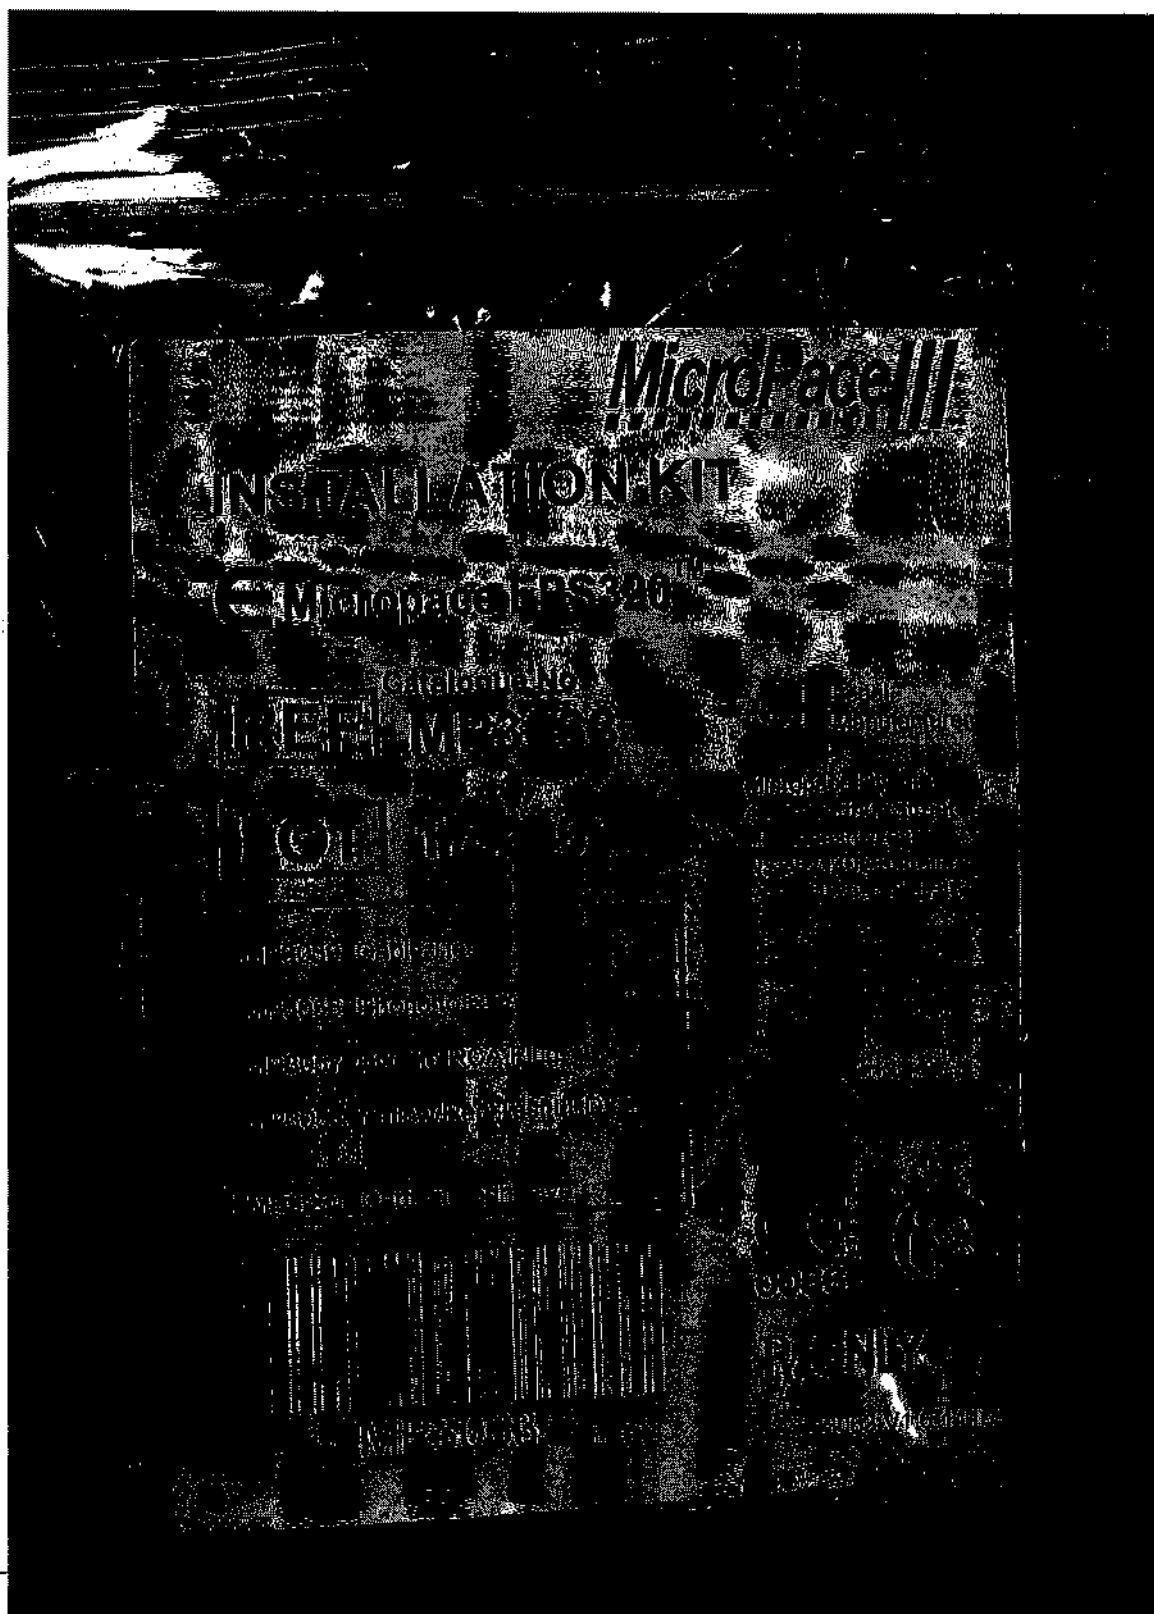

Комплект для установки. Маркировка изделия

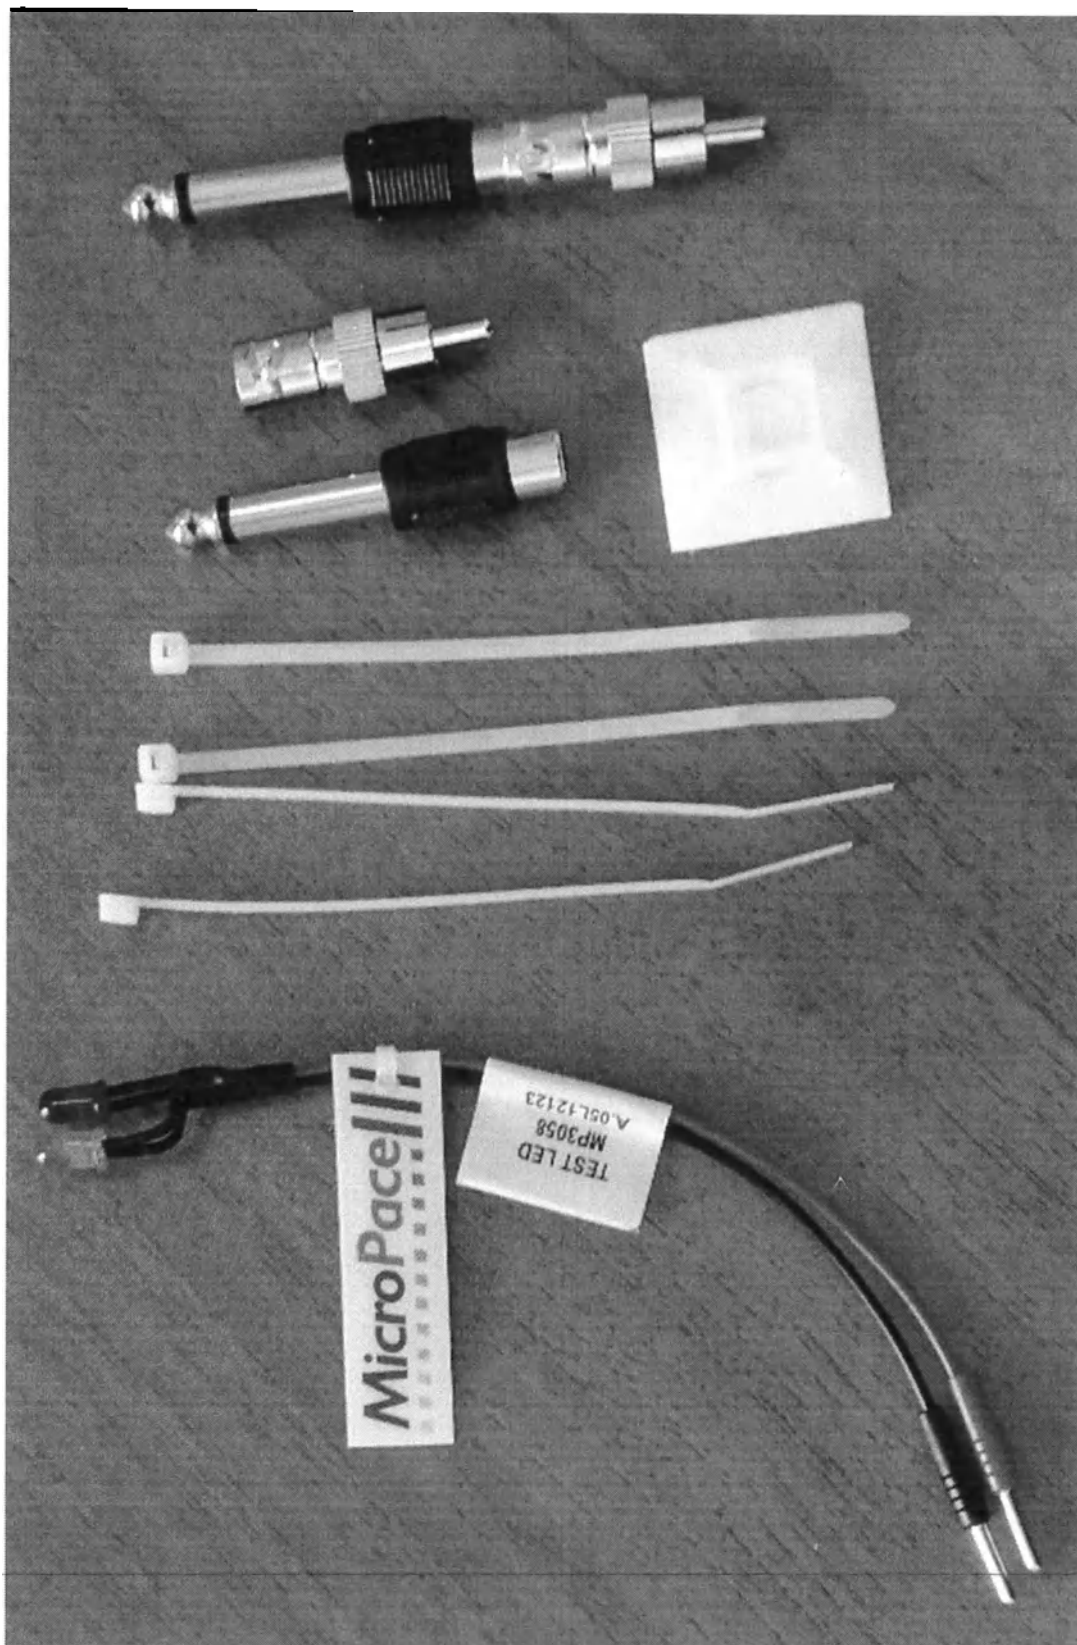

Комплект для установки. Общий вид изделия.

- кабельные стяжки - 4 шт.;
- одиночный телефонный штекер 6,5 мм на разъем RCA - 2шт.;
- переходник с разъема BNC на штекер RCA - 2шт.;
- тестовые электроды LED - 1шт.;
- клеящийся анкер кабельной стяжки - 1шт.



Принадлежности: Кабель управления SM-блока. Маркировка изделия.

Catalogue No.
REF MP3070-17

LOT 12618

MicroPaceIII


€ Micropace EPS320™



Legal
Manufacturer

Micropace Pty Ltd
41/159 Arthur Street
Homebush West
NSW 2140 Australia
Ph: +61 2 9718 1746

Low Capacitance Stimulus Extension Cable 17M, Câble
D'extension de stimulation de faible capacité 17M,
Niedrige Kapazität Stimulus Verlängerungskabel 17M,
Stimolo a bassa capacità Cavo prolunga 17M, Estimulo-
17M Cable de extensión, Düşük Kapasitans Tesvik
Uzatma Kablosu 17M, Χαμηλή χωρητικότητα επέκτα-
καλώδιο προέκτασης 17M, Nizkou kapacitanci stimulačni
prodlužovací kabel 17M, Iska Reaktancja Stimulus Kabel
przedłużający 17M, Низкая емкость стимул кабель-
удлинитель 17M, Kiskapacitású inger hosszabbító kábel
17M, Cablu prelungitor de joasă capacitate stimul 17M,
Baixa capacitância estímulo 17M Cabo de Extensão

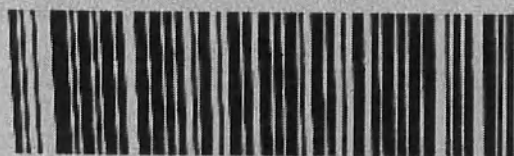

MP307017


CE
0086

R_x ONLY



CI.3070-17-V1.3-1116


Принадлежности: Удлинительный кабель для стимулирующих импульсов для соединительного модуля, длиной 17 м. Маркировка изделия.

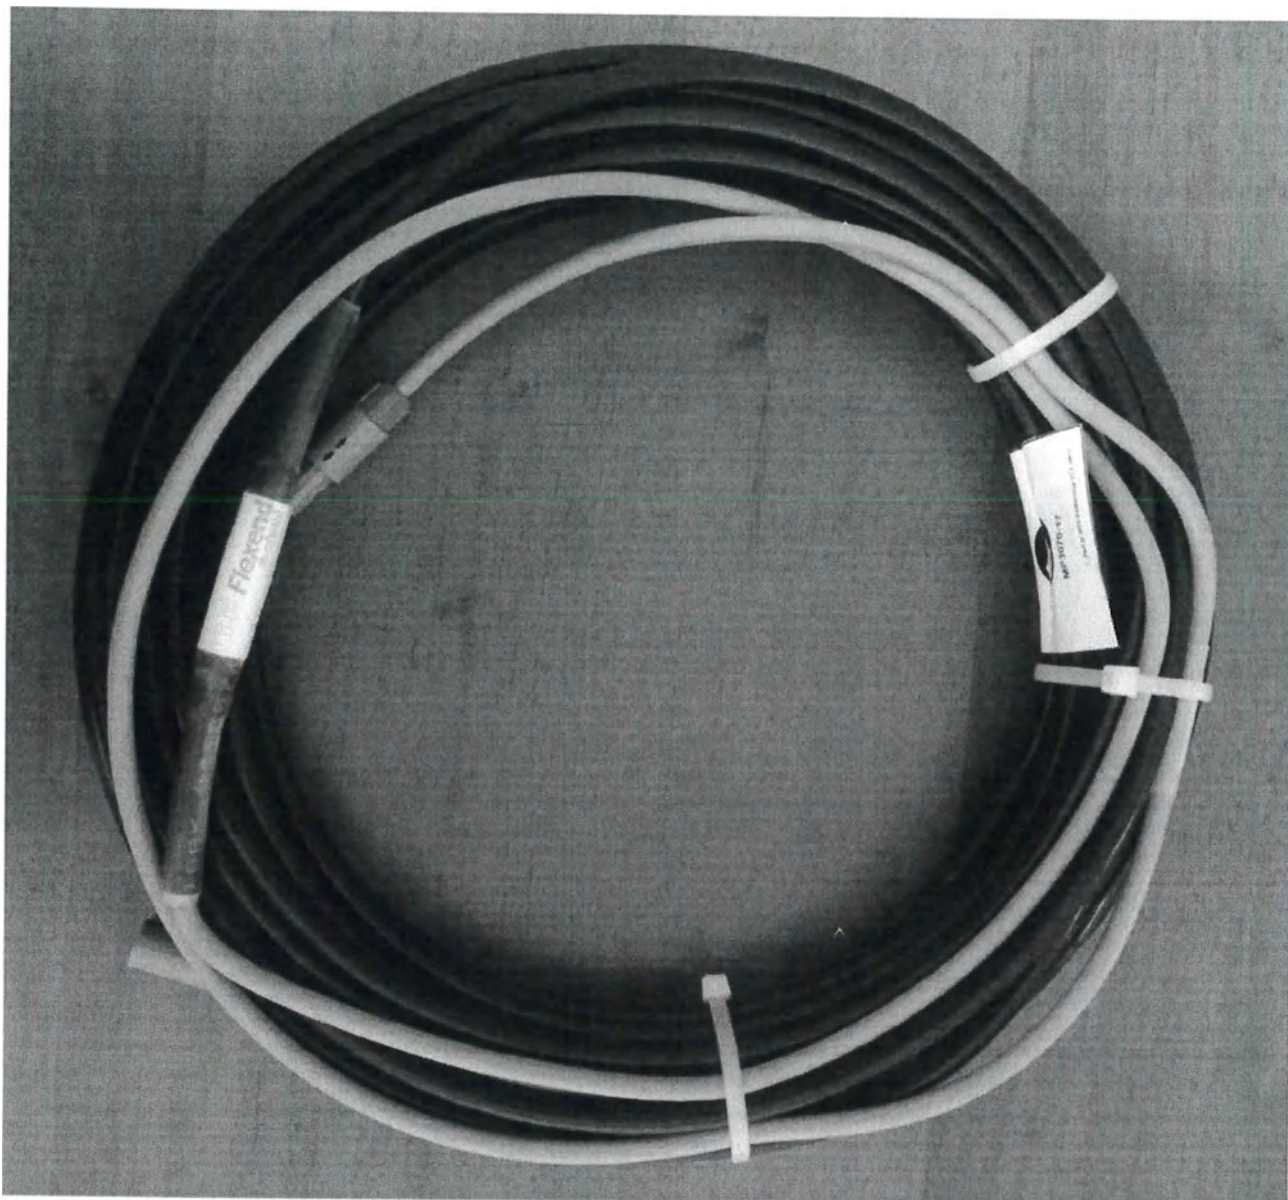

Принадлежности: Удлинительный кабель для стимулирующих импульсов для соединительного модуля, длиной 17 м. Общий вид изделия.



Принадлежности: Удлинительный кабель мультиплексора стимулирующих импульсов, 15 м.
Маркировка изделия.

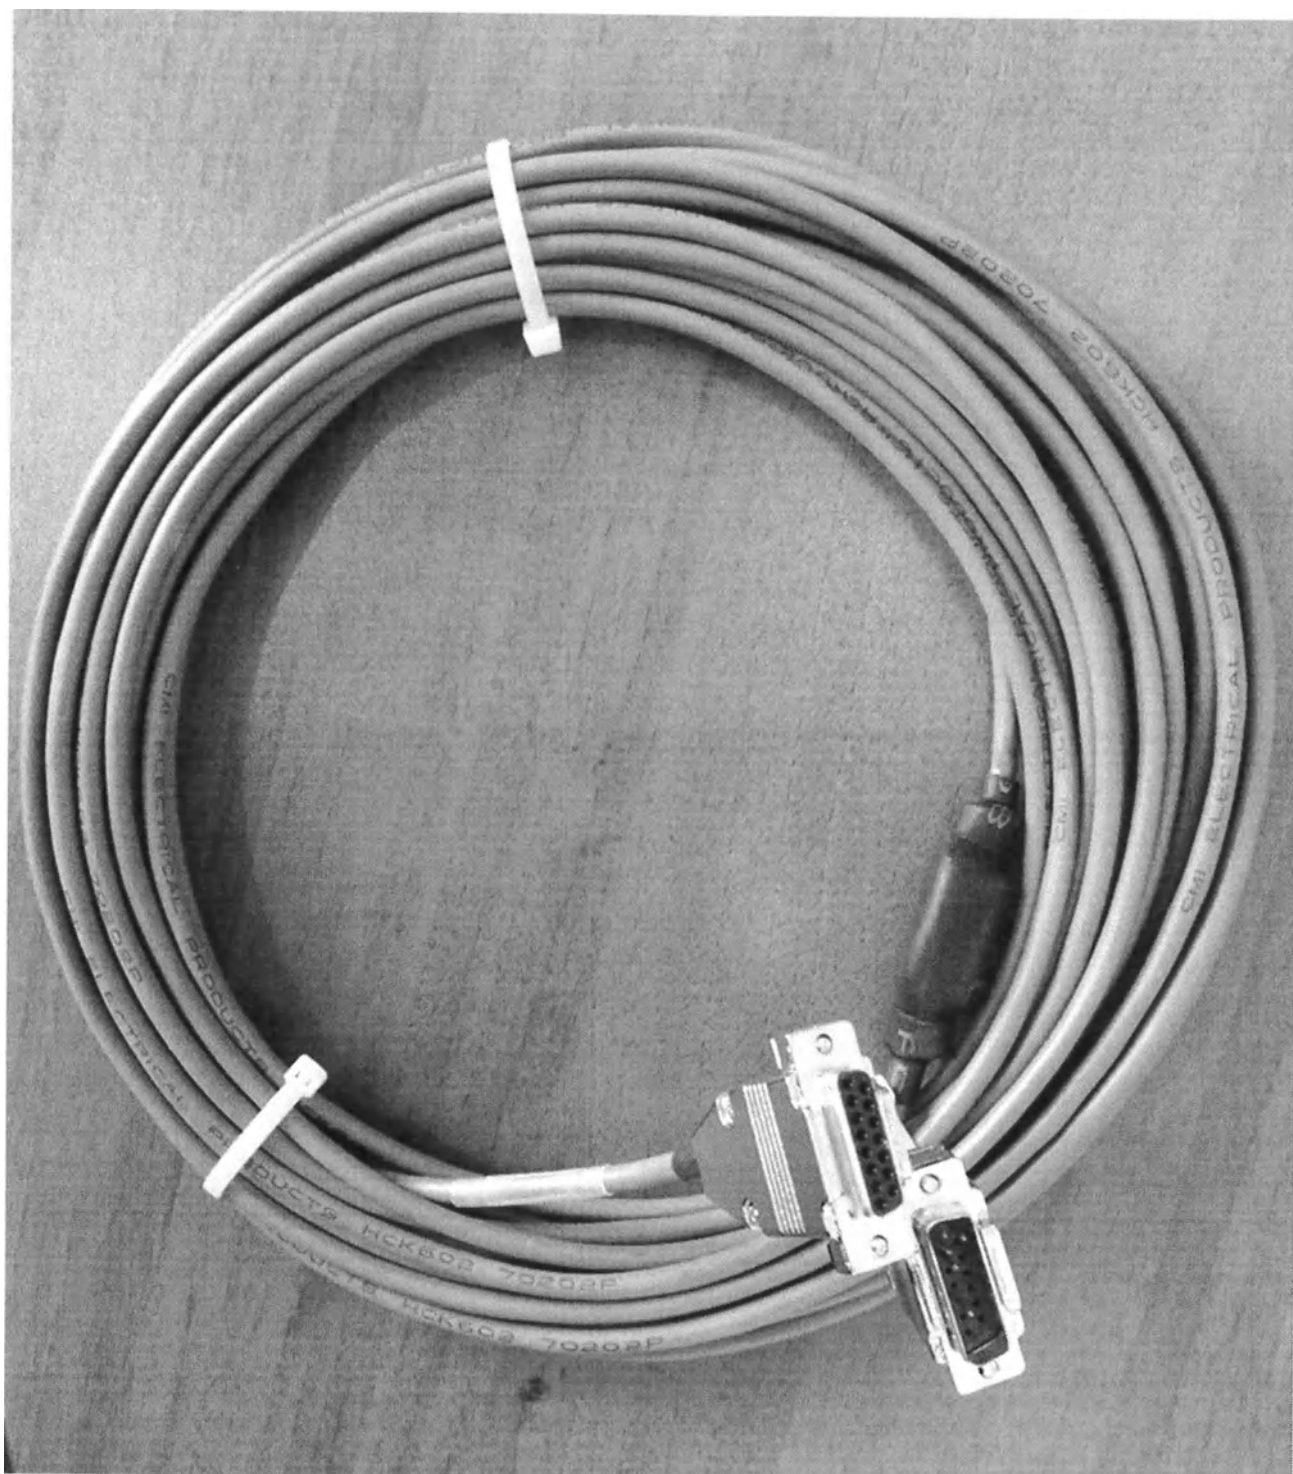

**Принадлежности: Удлинительный кабель мультиплексора стимулирующих импульсов, 15 м.
Общий вид изделия.**

Принадлежности: Тестовые электроды LED. Маркировка изделия





Принадлежности: Тестовые электроды LED. Общий вид изделия.

MicroPace///

COMPACT NUMERIC KEYPAD

[REF] MP3393

Catalogue No.

[UPN] 200MP3393

Product No.

[LOT] 16-270



GTIN
GS1



(01)09349714003930



(11)161024(10)16-270

Legal Manufacturer
MicroPace Pty Ltd
77186-168 Canterbury Rd.
Canterbury, NSW 2193
Australia
Ph: +61 2 9718 1746
Made in Australia

CE
0086
R ONLY

[EC REP] EU Authorized Representative

Advena Ltd, Pure Offices,
Plato Close, Warwick CV34 6WE UK

Distributed by:
Boston Scientific Corporation
300 Boston Scientific Way
Marlborough, MA 01752
USA
USA Customer Service 888-272-1001



R_MP3393_BSC_V1.2.doc

Принадлежности: Компактный блок цифровой клавиатуры. Маркировка



Принадлежности: Компактный блок цифровой клавиатуры. Маркировка



Принадлежности: Компактный блок цифровой клавиатуры. Общий вид изделия.

MicroPace


BNC TO PHONE PLUG SIGNAL CABLE

Micropace EPS320™

Catalogue No.

REF MP3109

LOT 12128



Micropace Pty Ltd.
41/159 Arthur Street
Homebush West
NSW 2140 Australia
Ph: +61 2 9718 1746

Do not use if lead appears damaged. Nicht benutzen wenn das Kabel beschädigt zu sein scheint. Ne pas utiliser si le cable paraît endommagé. Se il conduttore appare danneggiato, non usarlo. No usar si el cable parece dañado.



MP3109



CE
0086

Rx ONLY



L3109-V1.7-1116

Принадлежности: Кабель сигнальный с переходником от штырькового разъёма к телефонному штекеру 3м. Маркировка изделия.



Принадлежности: Кабель сигнальный с переходником от штырькового разъёма к телефонному штекеру 3м. Общий вид изделия

Принадлежности: Батарея аккумуляторная на 12В. Маркировка изделия и общий вид

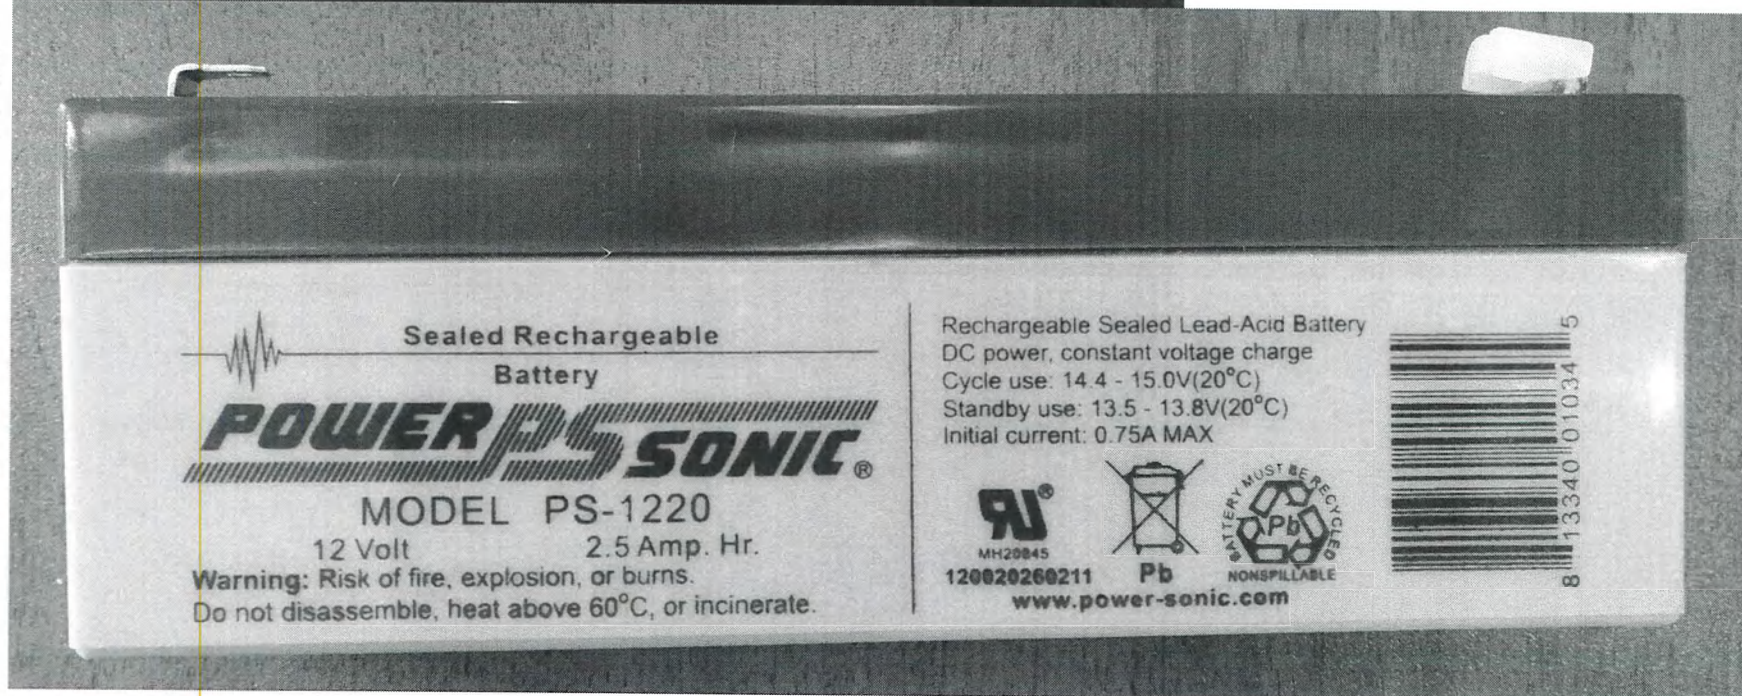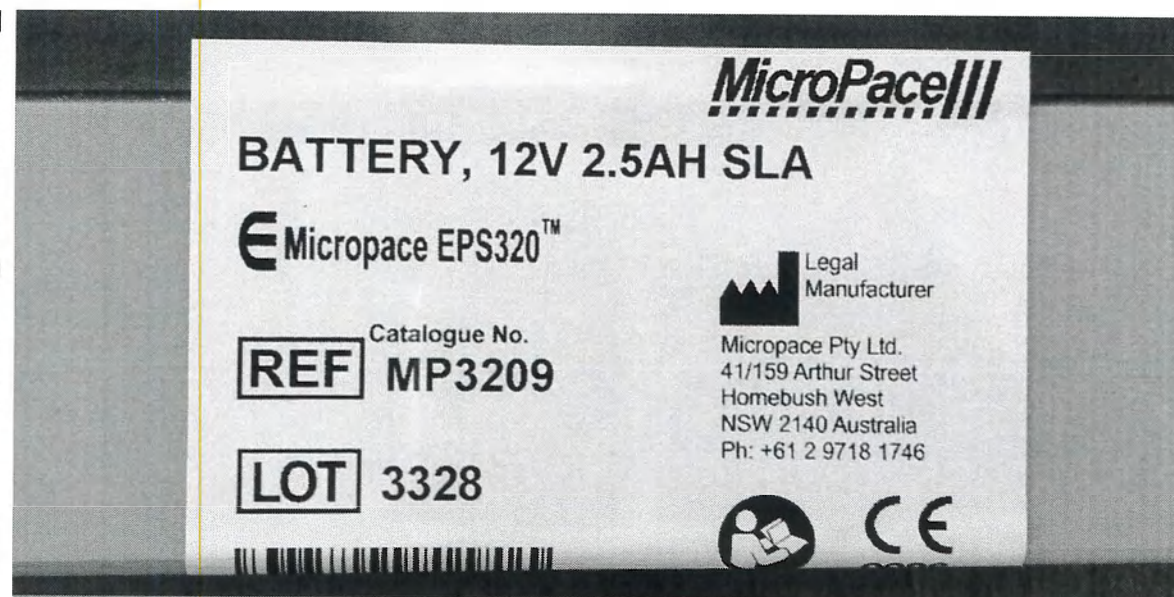

Принадлежности: Источник питания для БГС. Маркировка изделия.





Принадлежности: Источник питания для БГС. Общий вид изделия.

Принадлежности: Соединительный кабель для ЭКГ-сигнала с разъемом 6.5 Phone - 2.5 Phone.
Маркировка изделия.

MicroPace

SIGNAL CABLE WITH PHONE PLUGS

€ Micropace EPS320™

Catalogue No.

REF

MP3034

LOT

11987



Legal
Manufacturer

Micropace Pty Ltd.
41/159 Arthur Street
Homebush West
NSW 2140 Australia
Ph: +61 2 9718 1746

Do not use if lead appears damaged. Nich benutzen wenn das Kabel beschädigt zu sein scheint. Ne pas utiliser si le cable paraît endommagé. Se il conduttore appare danneggiato, non usarlo. No usar si el cable parece dañado.



MP3034

CE
0086



Rx ONLY

L3034-V3.9-1116



**Принадлежности: Соединительный кабель для ЭКГ-сигнала с разъемом 6.5 Phone - 2.5 Phone.
Общий вид изделия.**

MicroPace|||

**ISOLATED MAINS POWER LEAD
IEC 3 TO 2 Pin - EU STYLE**

€ Micropace EPS320™

Catalogue No.
REF MP3066EU

LOT 11204



Micropace Pty Ltd.
41/159 Arthur Street
Homebush West
NSW 2140 Australia
Ph: +61 2 9718 1746


Do not use if lead appears damaged.

Nich benutzen wenn das Kabel beschädigt zu sein scheint.

Ne pas utiliser si le cable paraît endommagé.

Se il conduttore appare danneggiato, non usarlo.

No usar si el cable parece dañado.

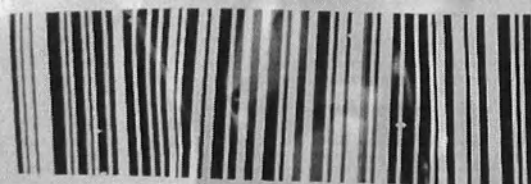

MP3066EU

CE
0086



L3066EU-V4.1-1116


Принадлежности: Изолированный сетевой кабель, IEC, 3 × 2 контакта, для ЕС. Маркировка изделия.



Принадлежности: Изолированный сетевой кабель, IEC, 3 × 2 контакта, для ЕС. Общий вид изделия.

Принадлежности: Изолированный сетевой кабель, IEC, 3 x 3 контакта. Маркировка изделия.



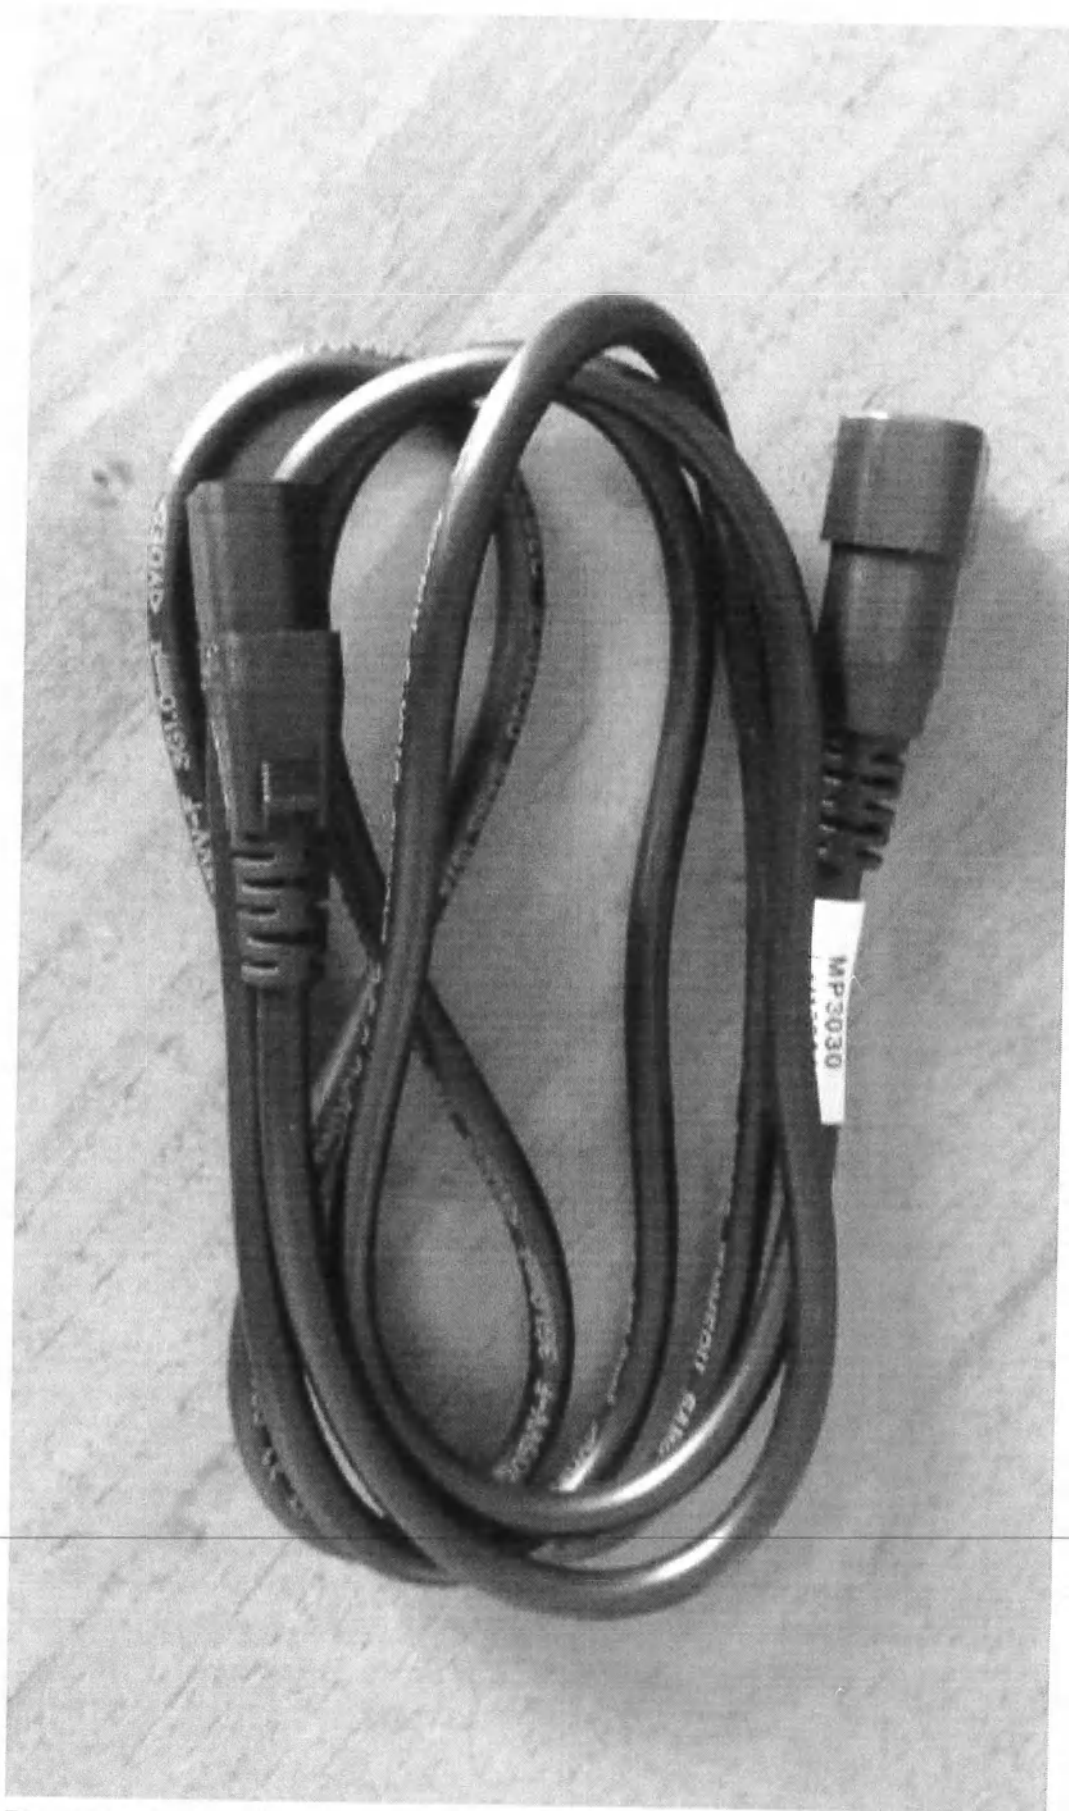

Принадлежности: Изолированный сетевой кабель, ИЕС, 3 × 3 контакта. Общий вид изделия.

Принадлежности: Кабель последовательного интерфейса RS232, 2м. Маркировка изделия.


MicroPace///

SERIAL BOOST RS232 CABLE - 2M

€ Micropace EPS320™

Catalogue No.
REF MP3033A

LOT 12175



Micropace Pty Ltd.
41/159 Arthur Street
Homebush West
NSW 2140 Australia
Ph: +61 2 9718 1746

Do not use if lead appears damaged.
Nicht benutzen wenn das Kabel beschädigt zu sein scheint.
Ne pas utiliser si le cable paraît endommagé.
Se il conduttore appare danneggiato, non usarlo.
No usar si el cable parece dañado.



MP3033A


CE
0086



R ONLY



L3033A-V1.8-1116

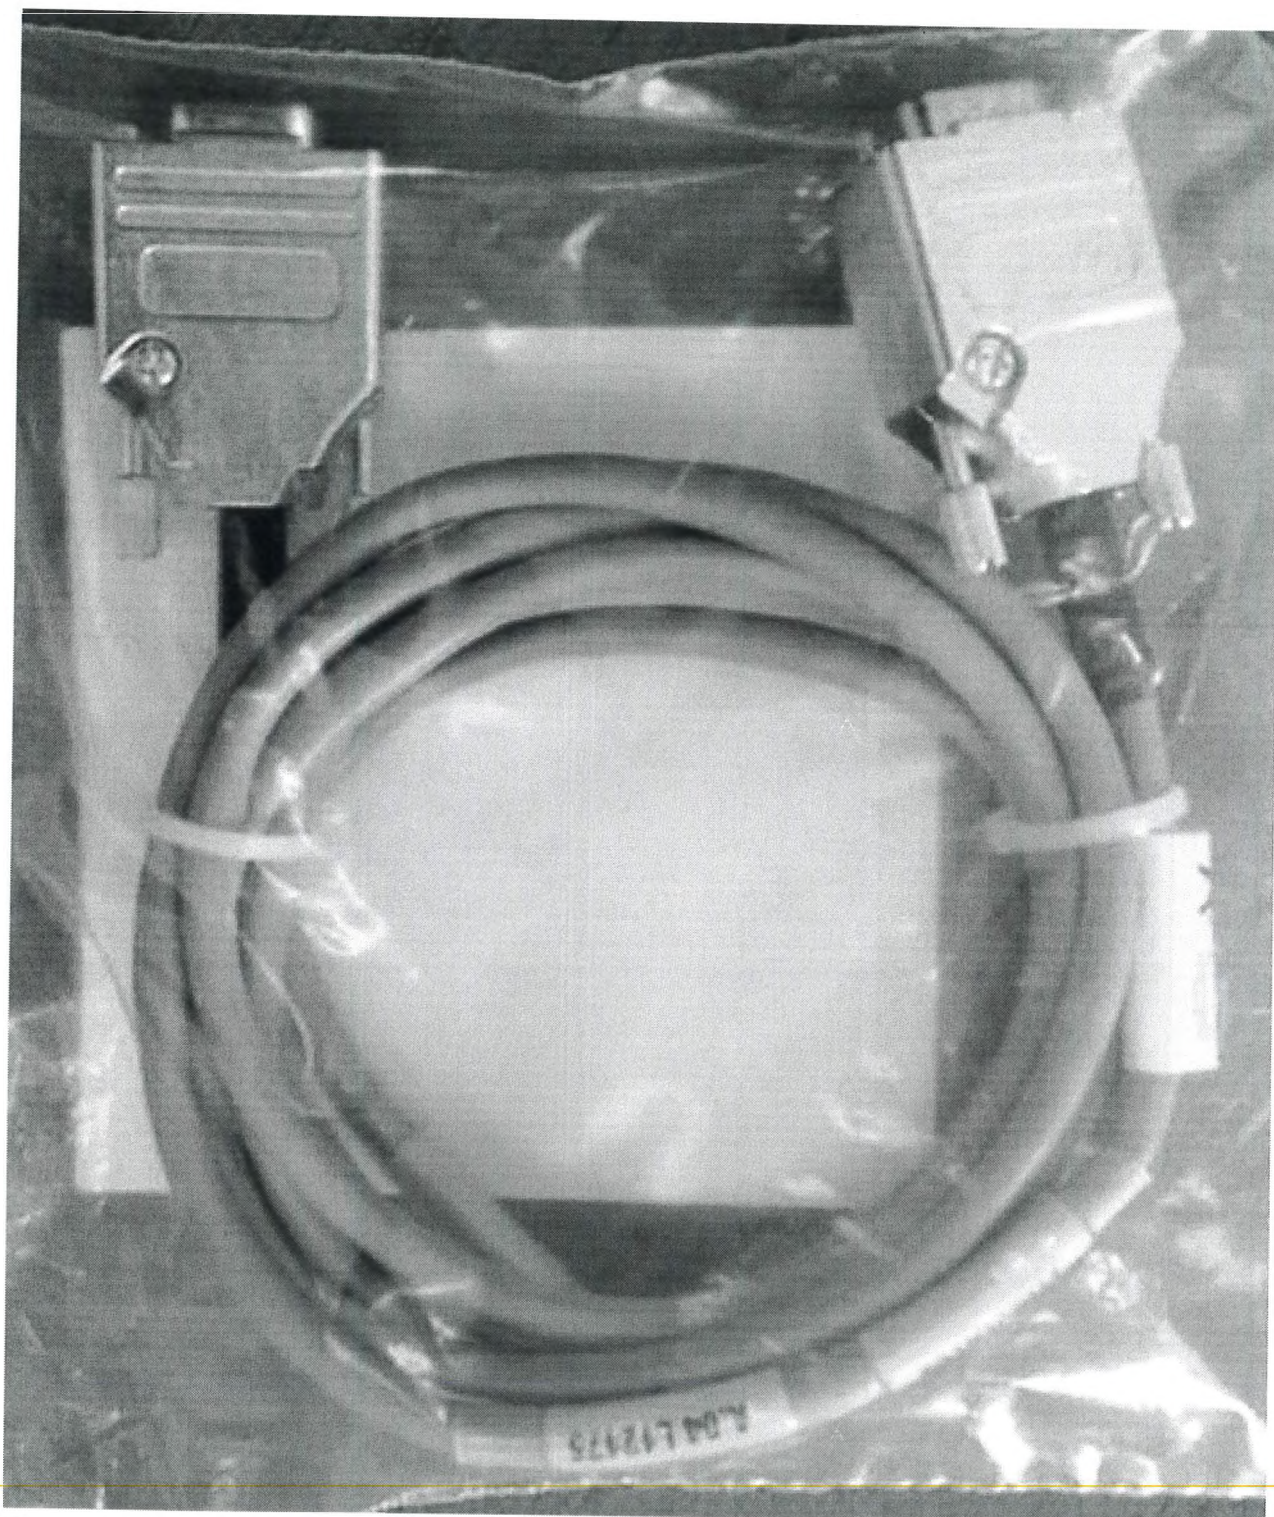

Принадлежности: Кабель последовательного интерфейса RS232, 2м. Общий вид изделия.

Принадлежности: Кабель питания изолирующего трансформатора. Маркировка изделия.

MicroPace///

**ISOLATION TRANSFORMER POWER
LEAD - EU SCHUKO STYLE**

€ Micropace EPS320™

Catalogue No.
REF MP3059EU

LOT 11816

 Legal
Manufacturer
Micropace Pty Ltd.
41/159 Arthur Street
Homebush West
NSW 2140 Australia
Ph: +61 2 9718 1746

Connect to mains power supply and Isolation Transformer Item MP3107.

Do not use if lead appears damaged.

Mit Netzstrom und dem Isoliertransformator verbinden, Artikel MP3107.

Nicht benutzen, wenn das Kabel beschädigt zu sein scheint.

Brancher sur l'alimentation secteur et sur le transformateur d'isolement -Article MP3107.

Ne pas utiliser si le cable paraît endommagé.

Allacciarsi alla rete di distribuzione e al Trasformatore d'isolamento, articolo MP3107.

Se il conduttore appare danneggiato, non usarlo.

Conecte al suministro de la red de alimentación y al Transformador de Aislación

Artículo MP3107. No usar si el cable parece dañado.



MP3059EU

CE
0086



L3059EU-V2.0-1116



Принадлежности: Кабель питания изолирующего трансформатора. Общий вид изделия.

ROLL STAND

Part of MP3183

MODEL StimLab™

Item: MC0500

Lot: 2481

Contents: 1

Rx only

Refer to StimLab Quick Installation Guide for installation information.
Se référer à StimLab Guide d'installation rapide pour l'installation d'information.
Wenden sie sich an StimLab Kurze Montageanleitung für die Installation d'information.
Für die Installation d'information.
Consulte a StimLab guía de instalación rápida para la instalación de información.



MC0500-2481

MicroPace

Distributor:

Micropace Pty Ltd,
7/186-188 Canterbury Rd
Canterbury NSW 2193
Australia

www.micropace.com.au

Installation information
pour l'installation d'information
Informationen
guida di installazione rapida per
para la instalación de información

R_L0500_Part of MP3183-V1.1-0908


Стойка компьютерная. Маркировка изделия.



Стойка компьютерная. Общий вид изделия.




Принадлежности: Блок соединения с пациентом 2-канальный с фильтром высоких частот.
Маркировка изделия.

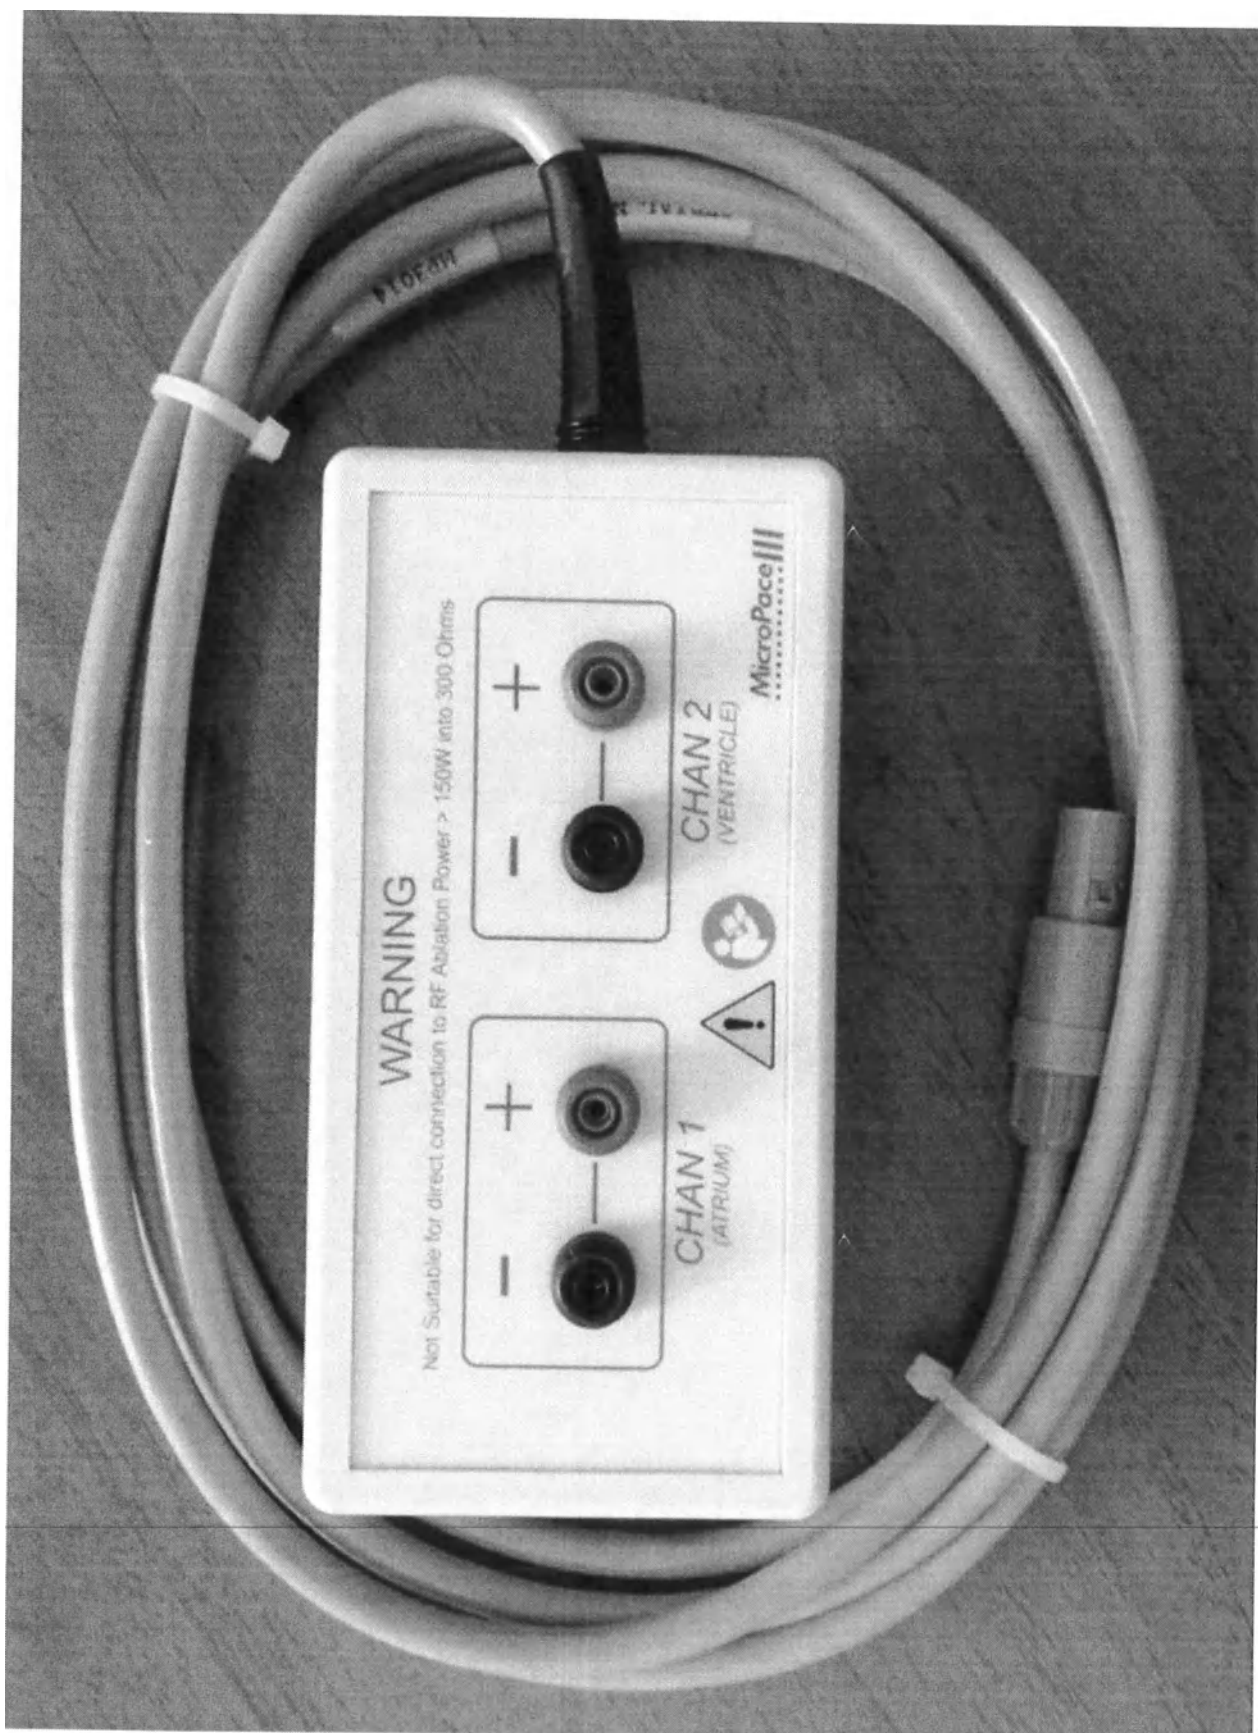

**Принадлежности: Блок соединения с пациентом 2-канальный с фильтром высоких частот.
Общий вид изделия.**

Принадлежности: Фиксатор кабеля питания изоляционного трансформатора. Маркировка изделия.



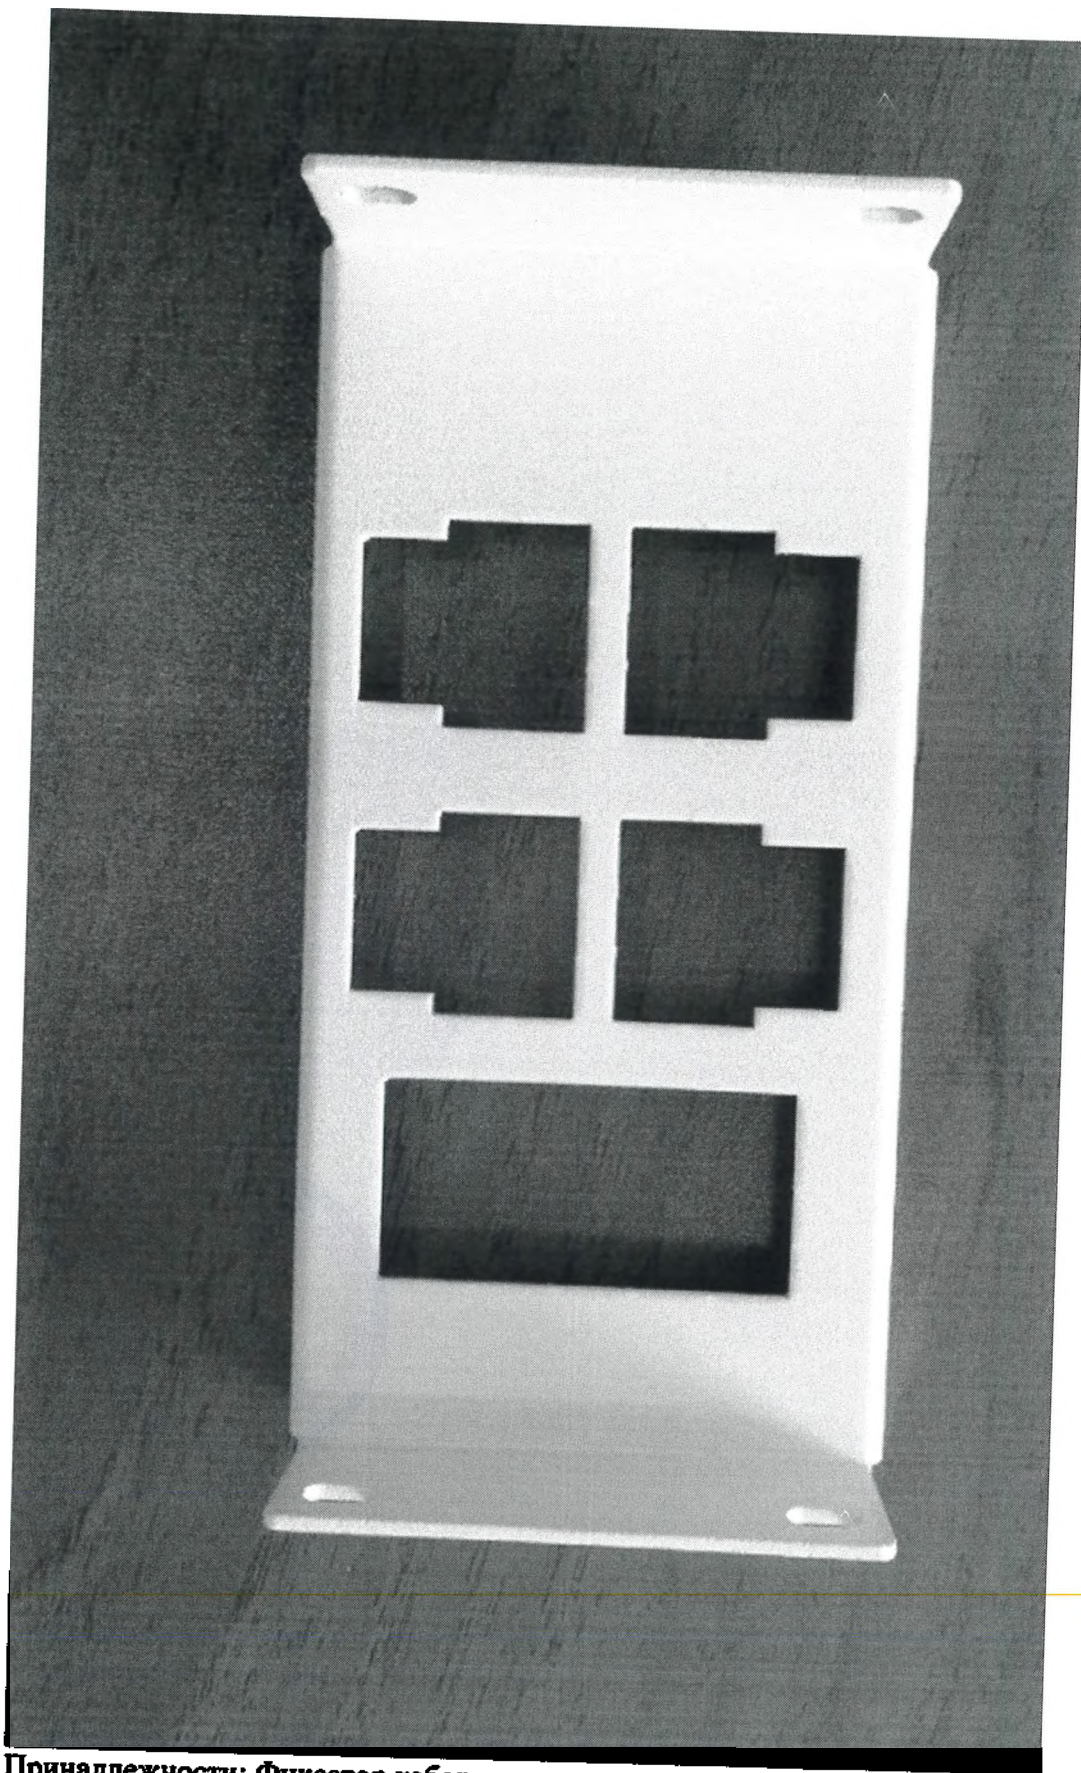

Принадлежности: Фиксатор кабеля питания изоляционного трансформатора. Общий вид изделия.

Всего прошнуровано, пронумеровано
И скреплено печатью 166 листов

