

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
“ВектоКрым-КТЛ-IgM”
 серия 1




Генеральный директор
 АО “Вектор-Бест”

“14” 03/

М.Д. Хусаинов

20 19 г.

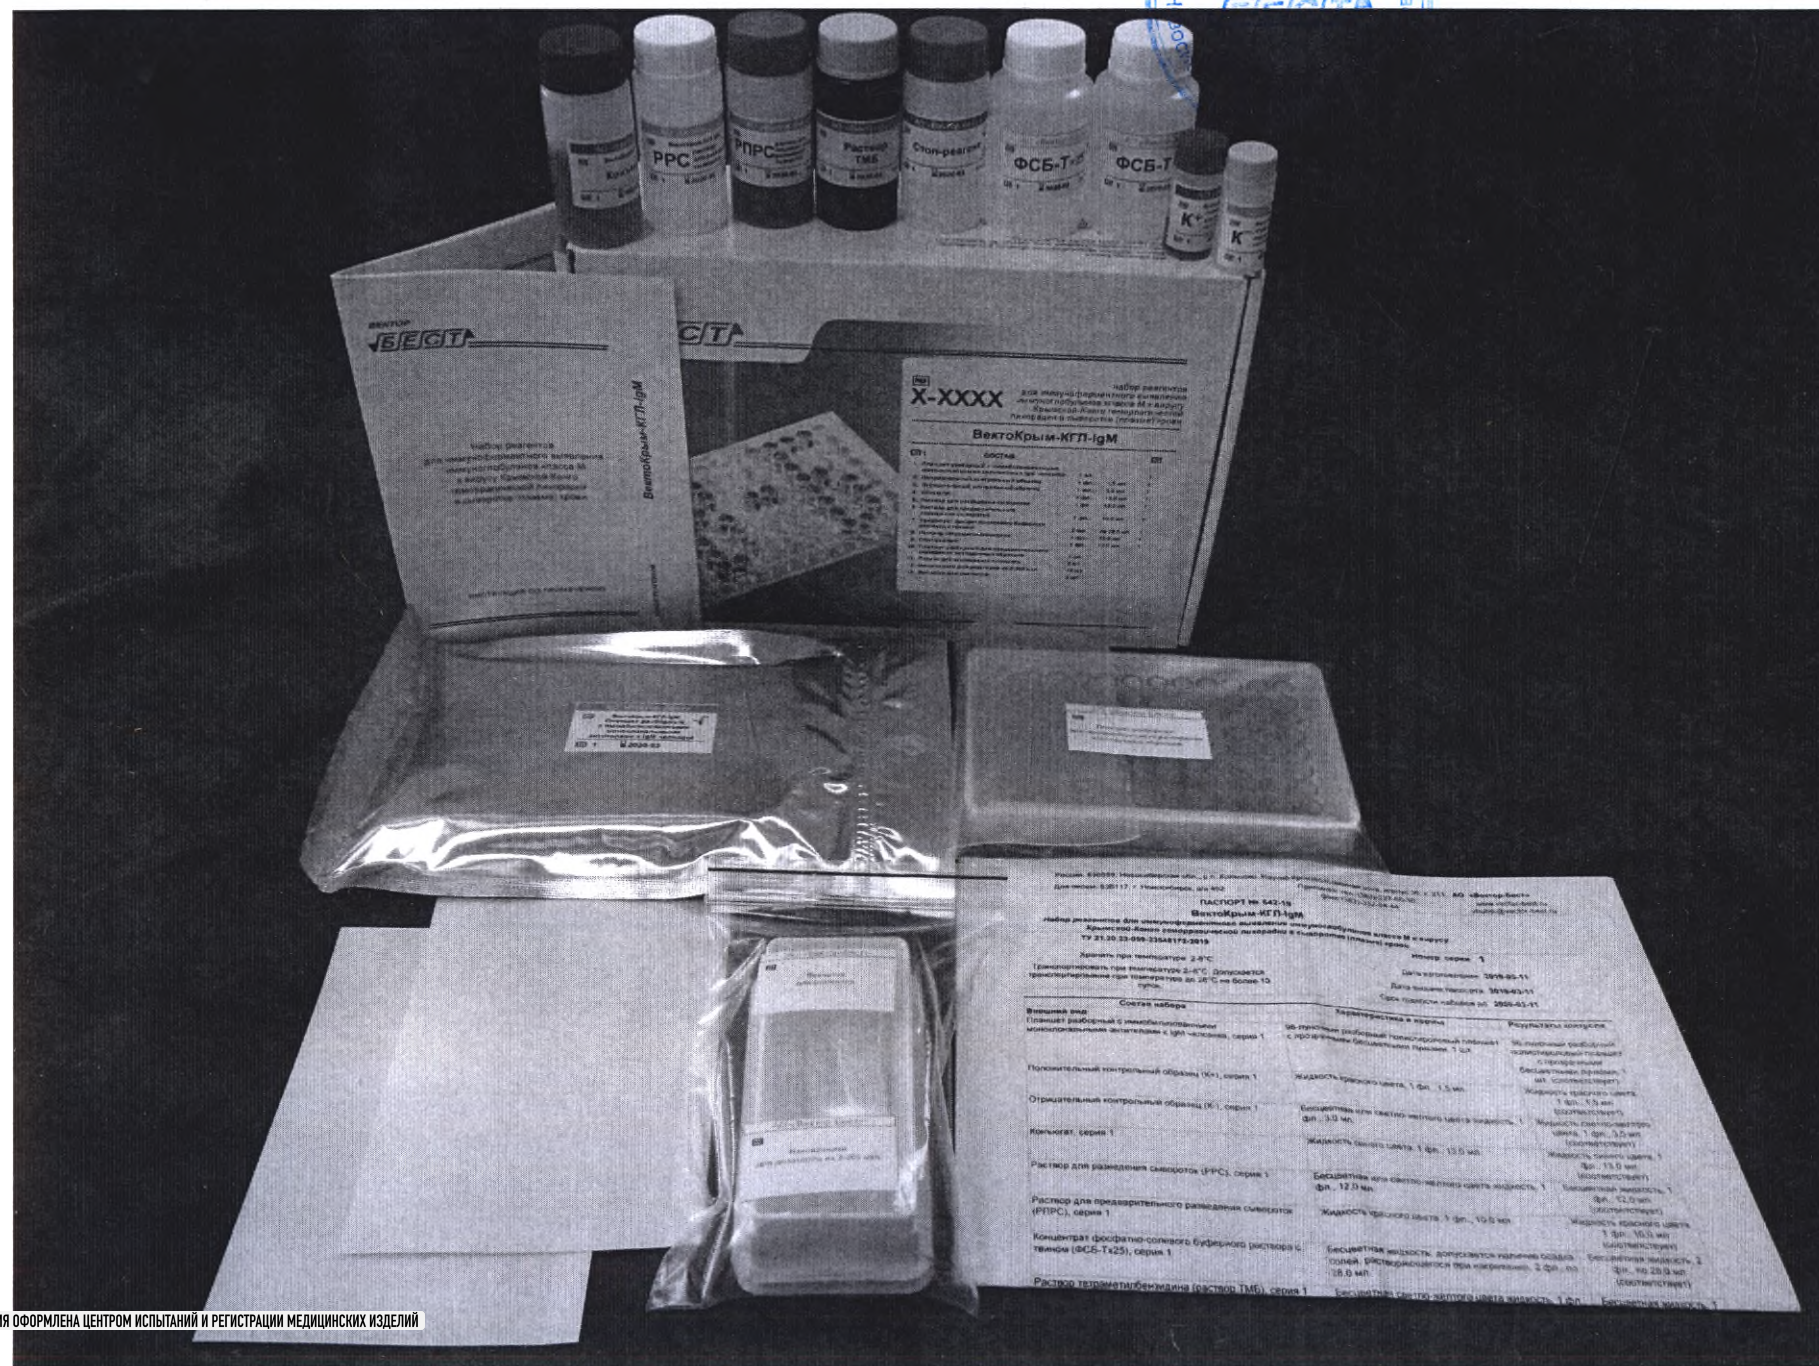

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ВектоКрым-КГЛ-IgM” № 1
серия 1




Генеральный директор

АО “Вектор-Бест”

[Signature]
“14” 03/

М.Д. Хусаинов


20 19 г.

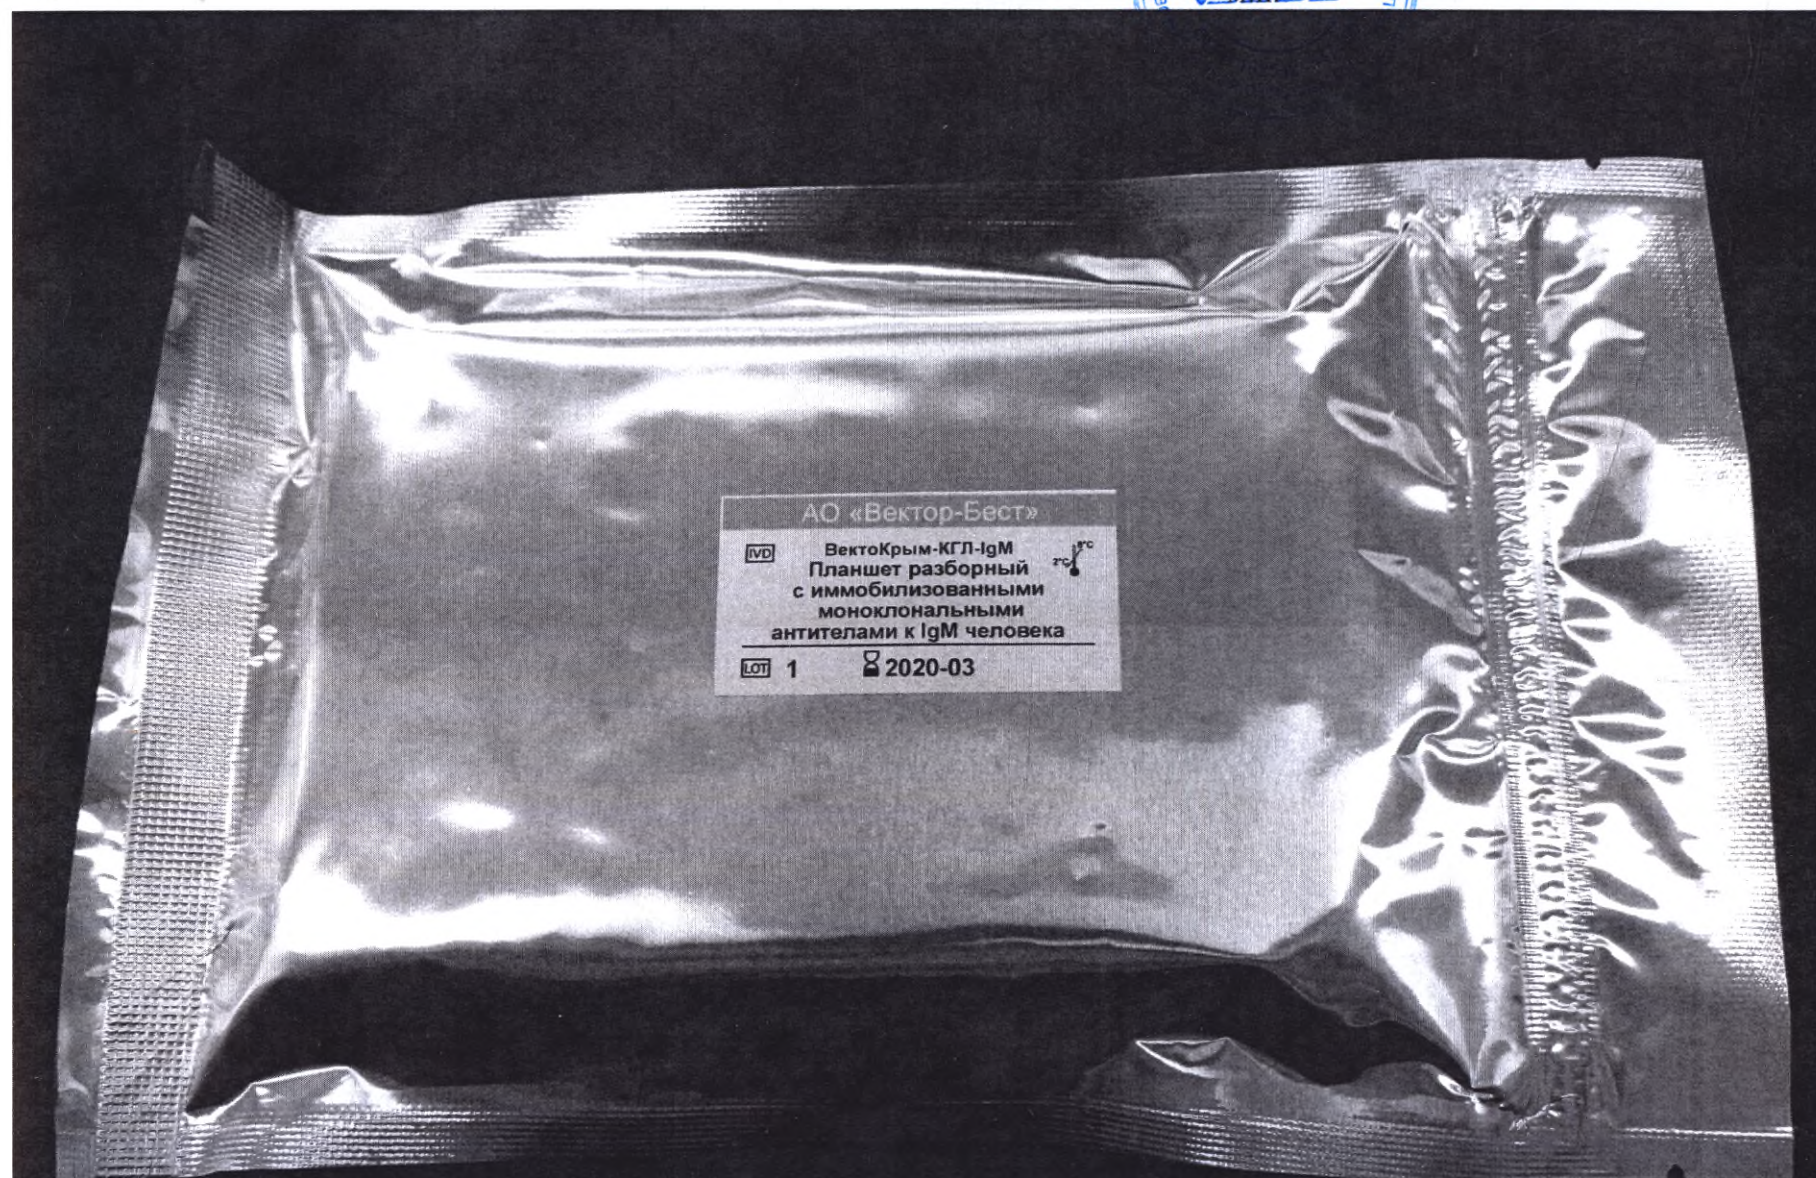



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ ВектоКрым-КГЛ-IgM” № 2
серия 1




Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”

 М.Д. Хусаинов
“ 14 ” 08 20 19 г.

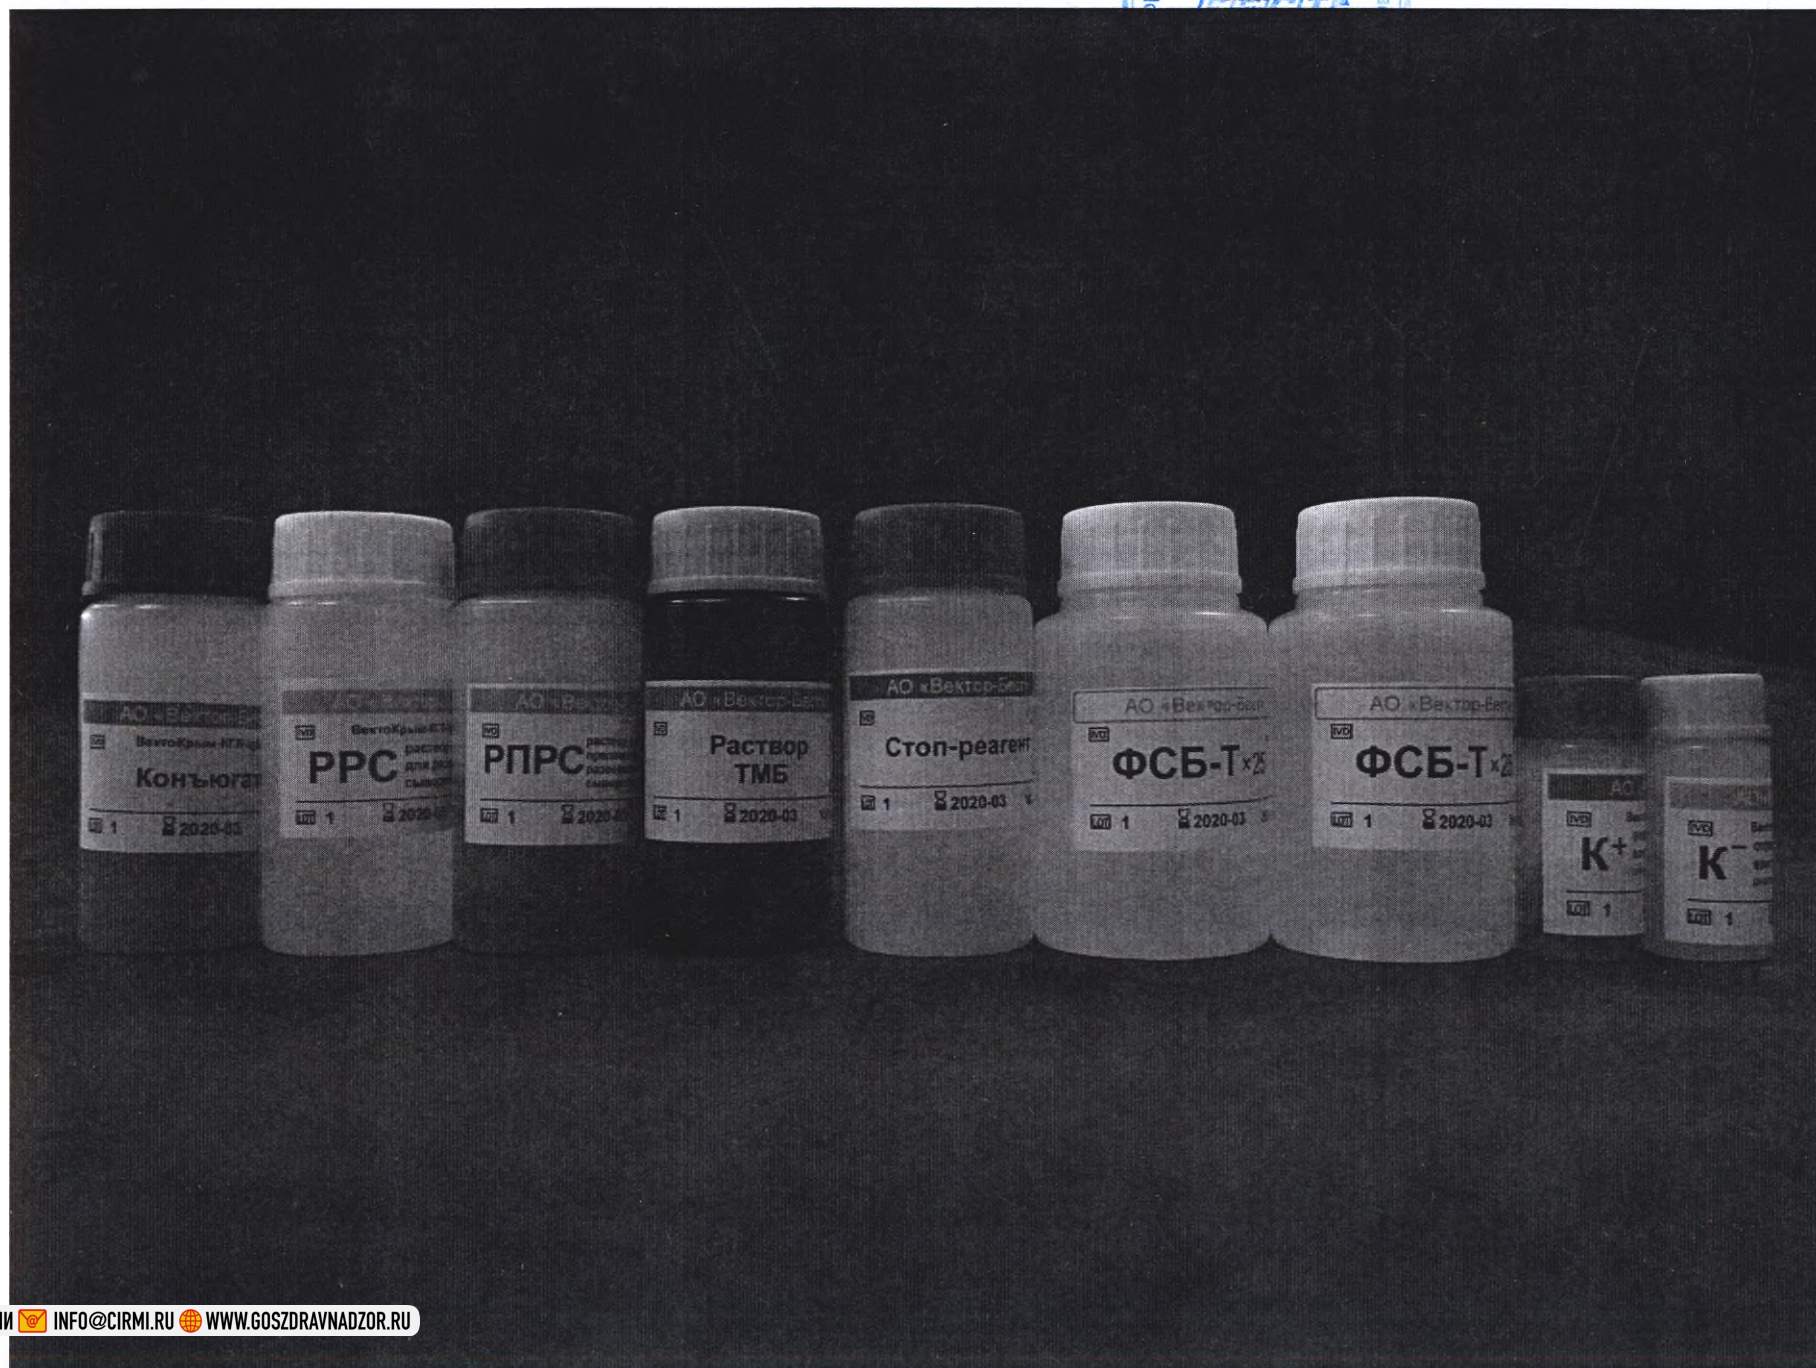


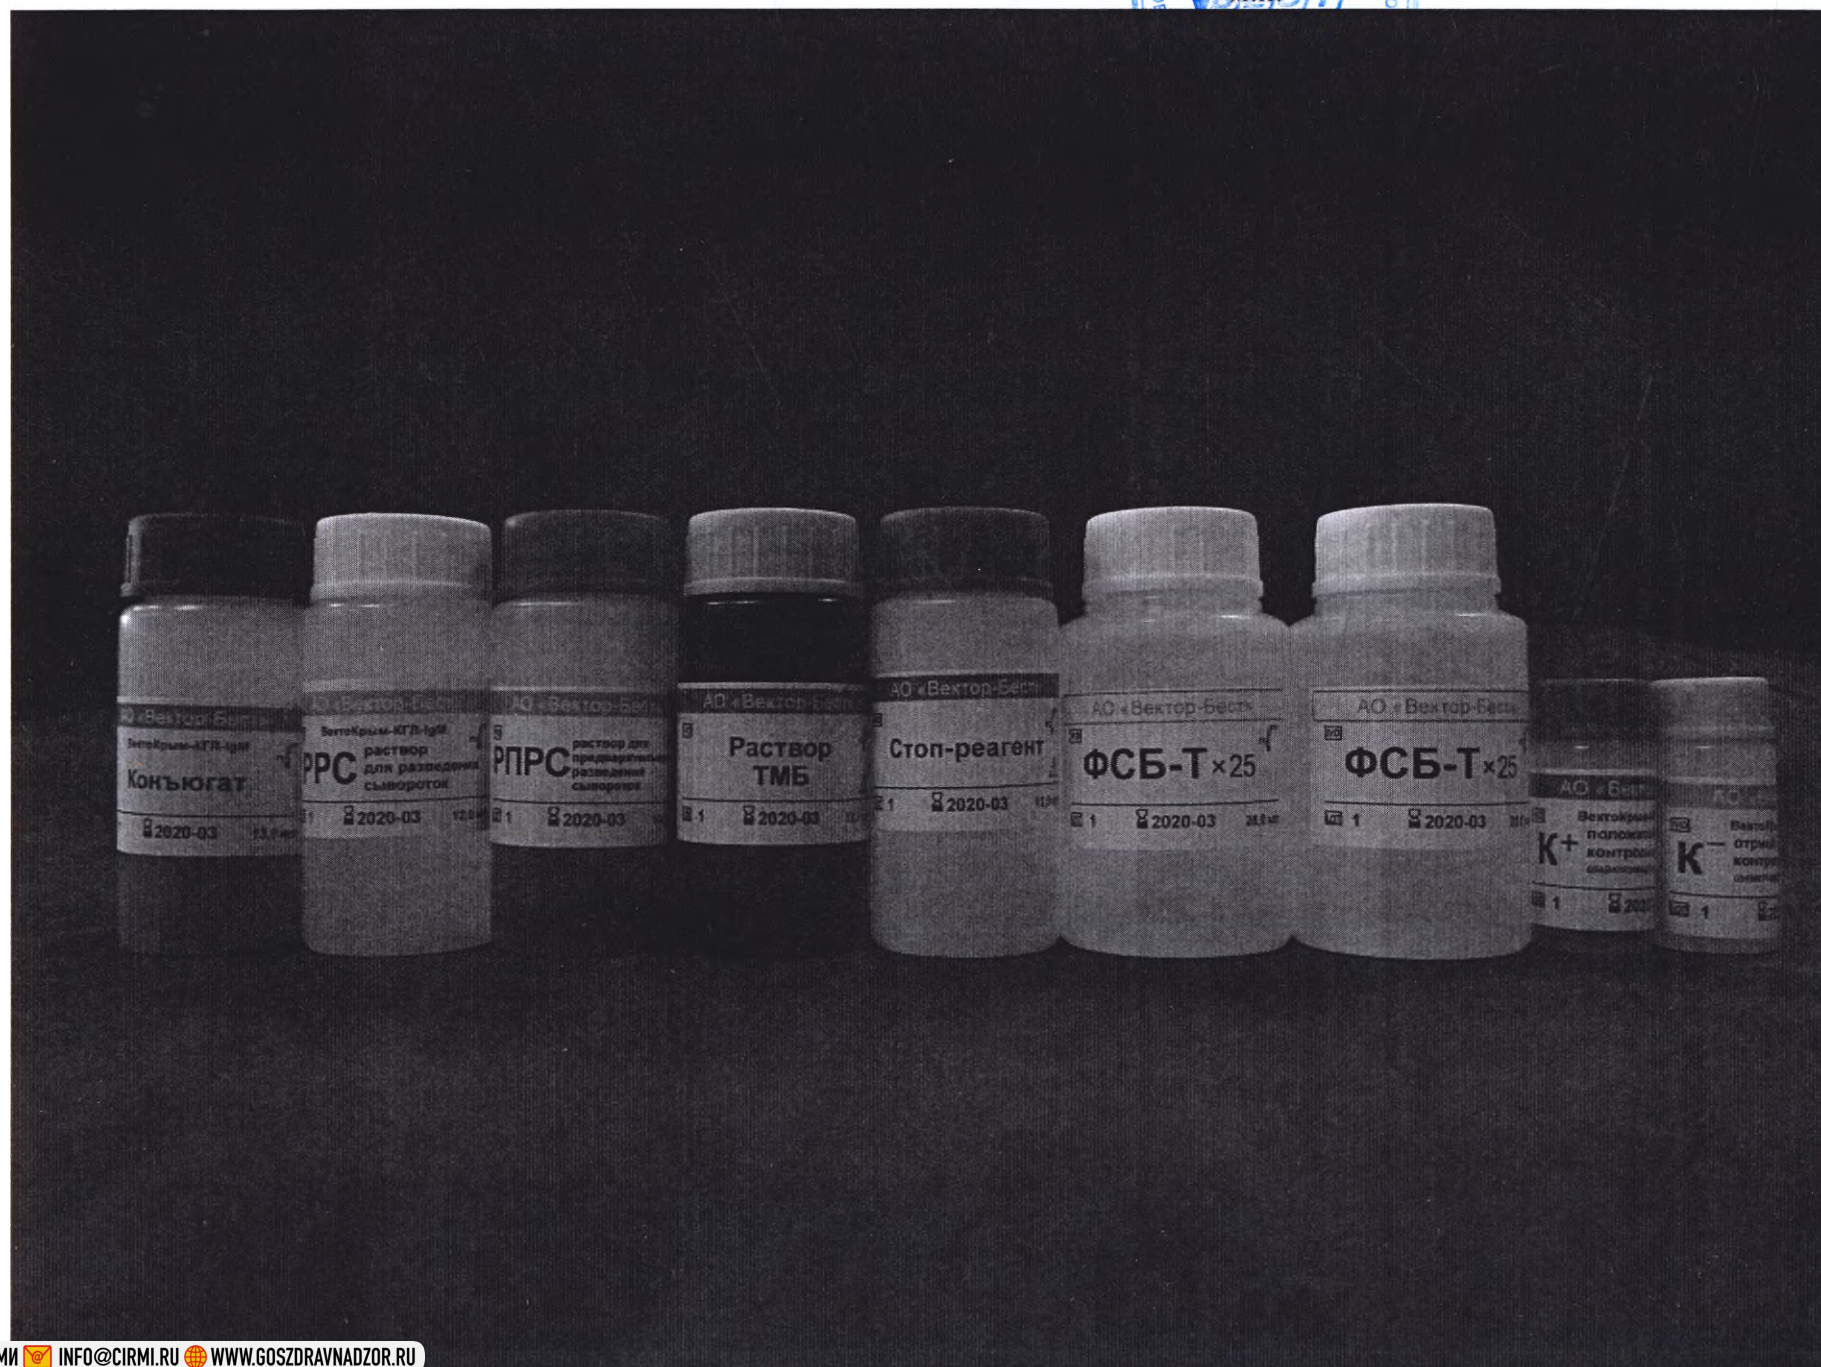



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ВектоКрым-КГЛ-IgM” № 4
серия 1




Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» *М.Д. Хусаинов*
“14” 03 2019 г.

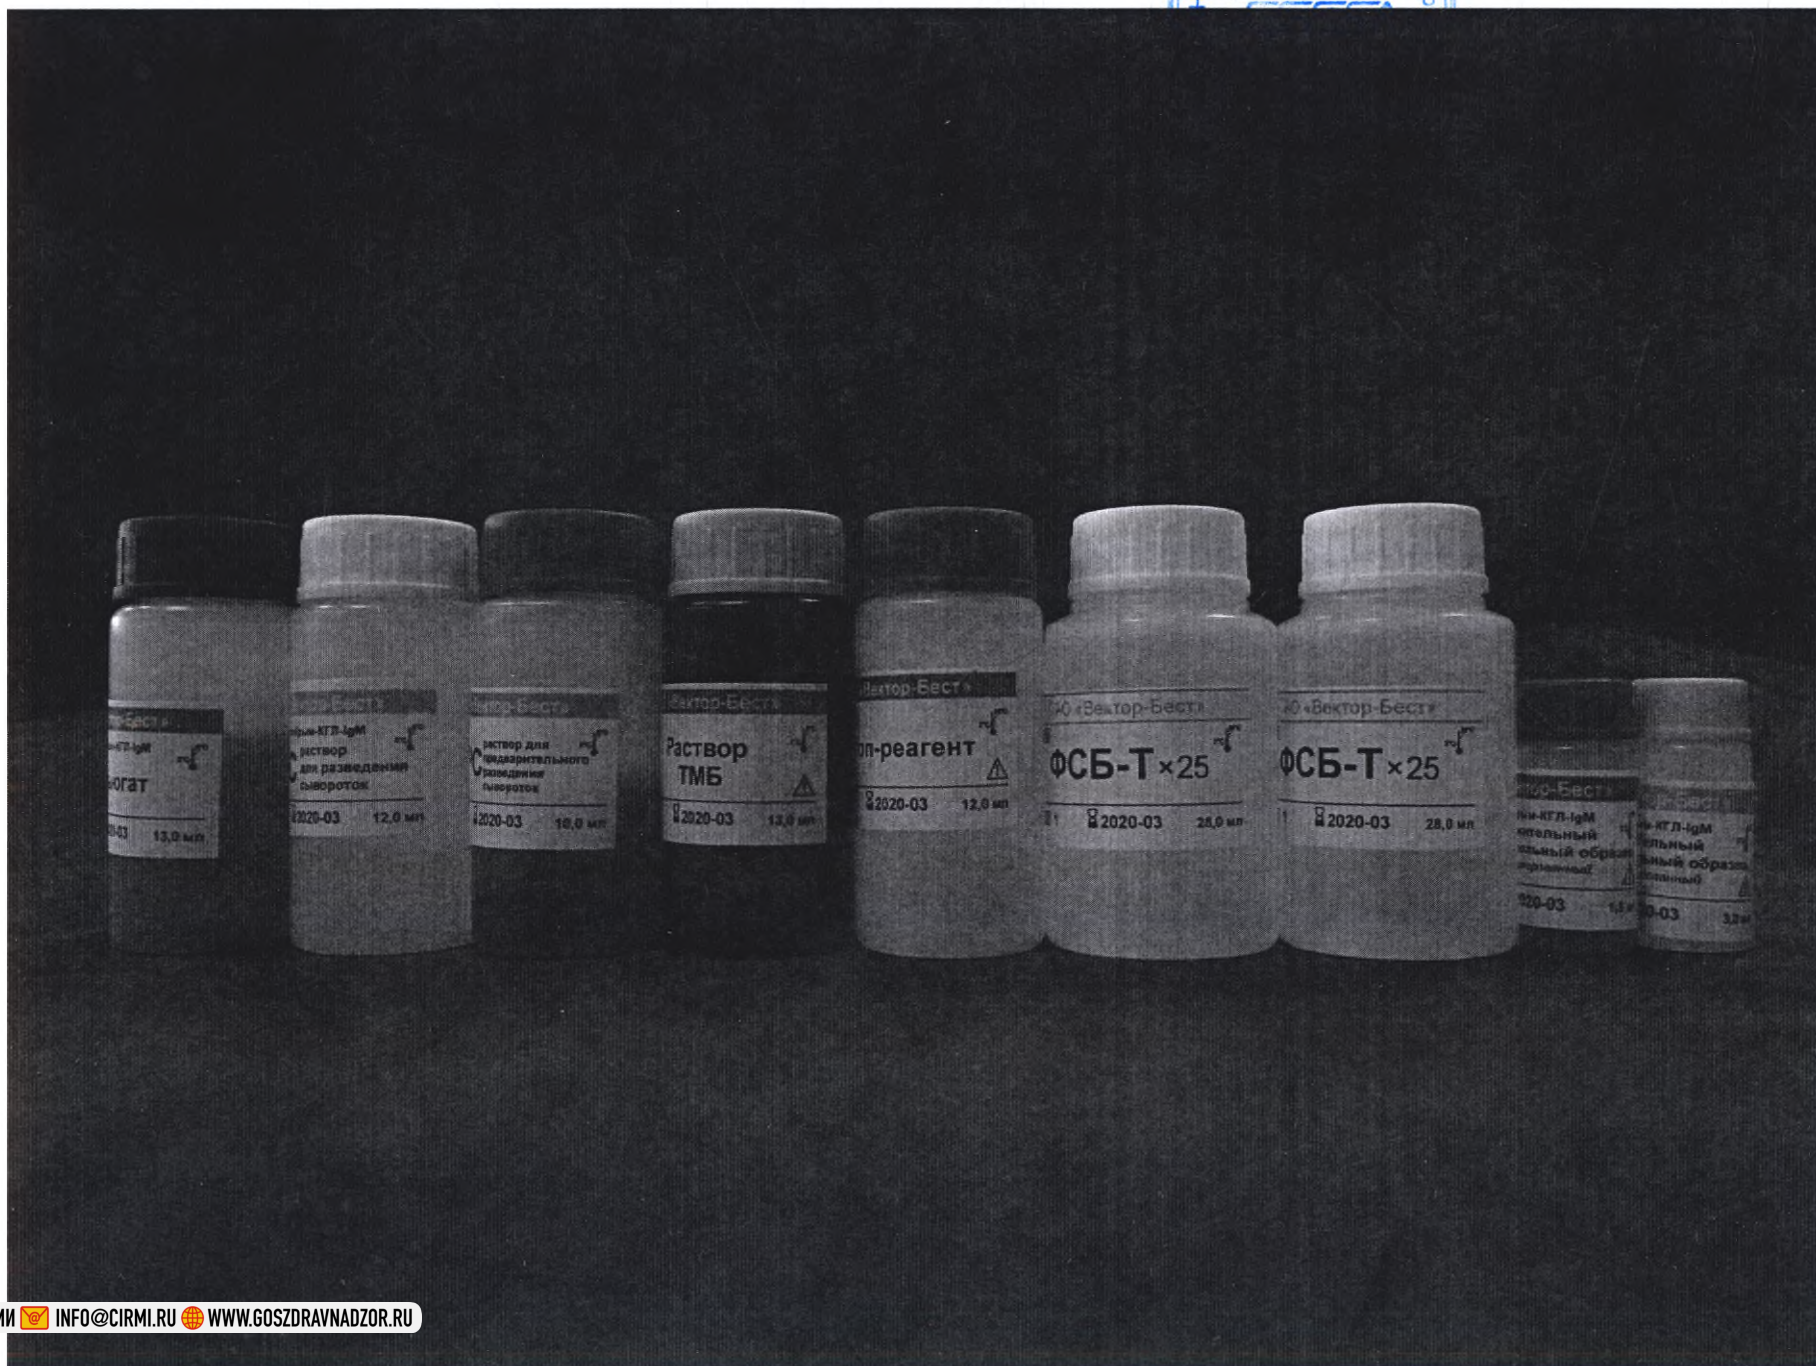

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ВектоКрым-КТЛ-IgM” №5
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”  М.Д. Хусаинов
“14” 03 20 19 г.

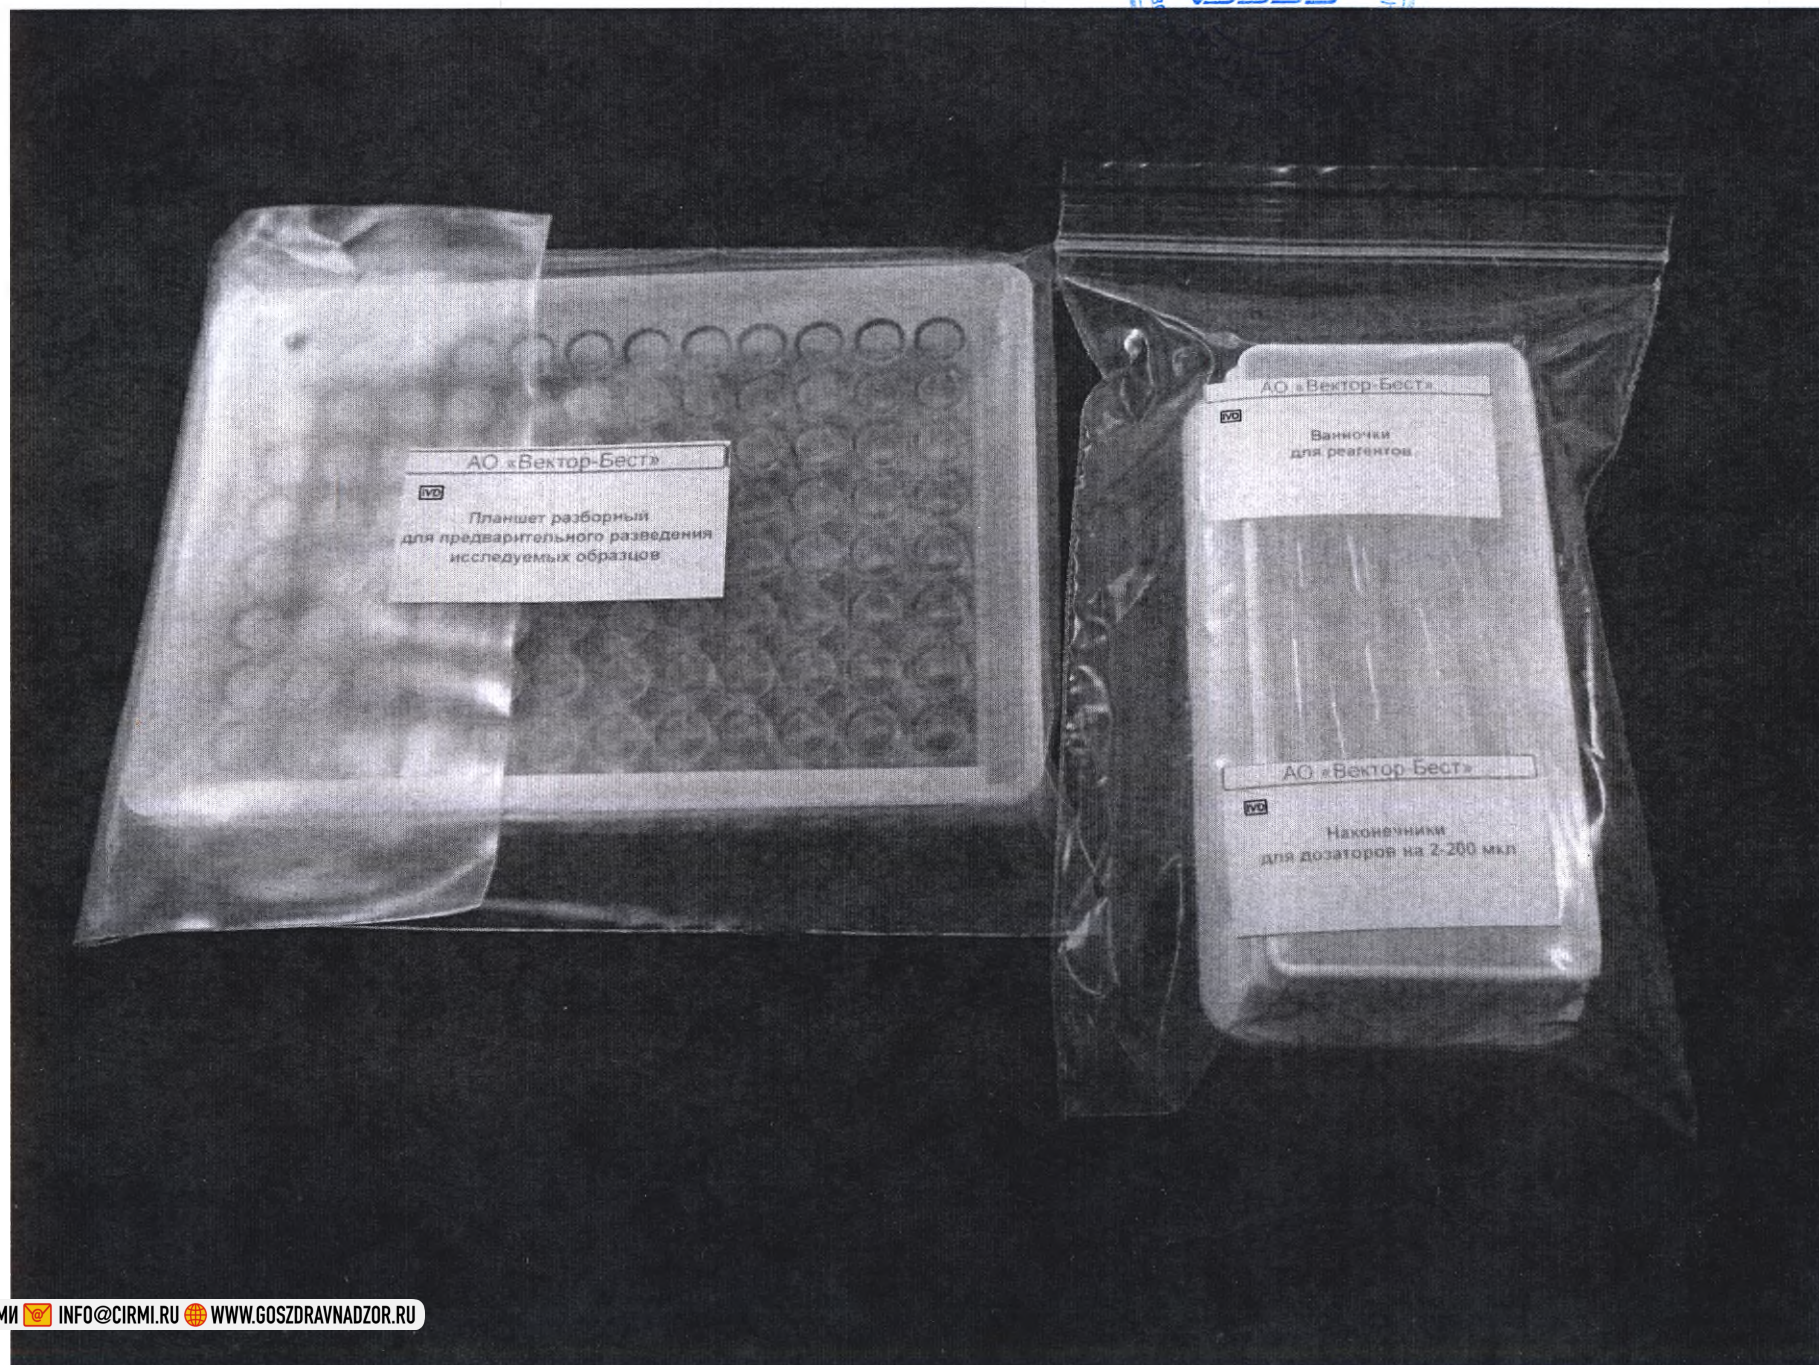


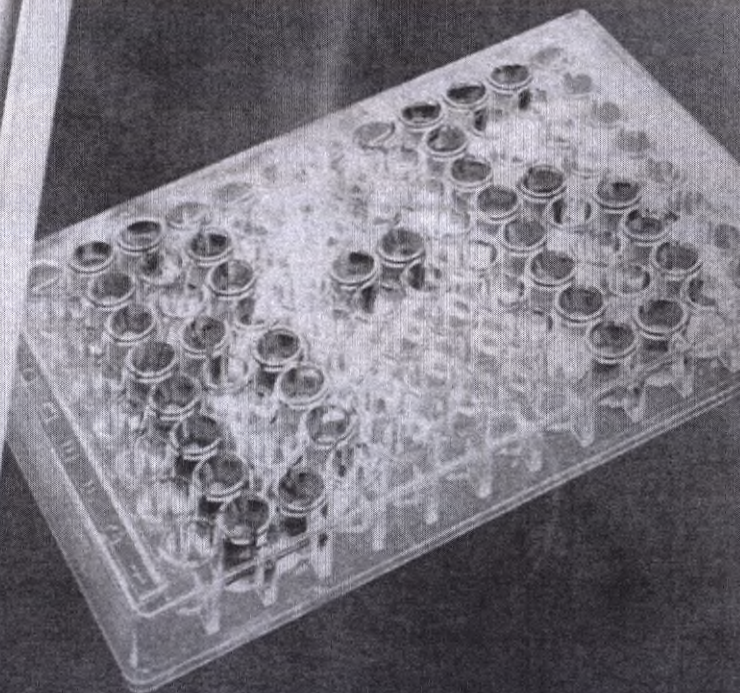


Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”

М.Д. Хусаинов

“14” 03 2019 г.

БЕКТОР
БЕСТ



REF
X-XXXX

набор реагентов
для иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов класса М к вирусу
Крымской-Конго геморрагической
лихорадки в сыворотке (плазме) крови

ВектоКрым-КГЛ-IgM

LOT 1

СОСТАВ:

LOT


1. Планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к IgM человека	1 шт.		1
2. Положительный контрольный образец	1 фл.,	1,5 мл	1
3. Отрицательный контрольный образец	1 фл.,	3,0 мл	1
4. Конъюгат	1 фл.,	13,0 мл	1
5. Раствор для разведения сывороток	1 фл.,	12,0 мл	1
6. Раствор для предварительного разведения сывороток	1 фл.,	10,0 мл	1
7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	2 фл.	по 28,0 мл	1
8. Раствор тетраметилбензидина	1 фл.,	13,0 мл	1
9. Стоп-реагент	1 фл.,	12,0 мл	1
10. Планшет разборный для предварительного разведения исследуемых образцов	1 шт.		
11. Пленки для заклеивания планшета	2 шт.		
12. Наконечники для дозаторов на 2-200 мкл	16 шт.		
13. Ванночки для реагентов	2 шт.		

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“ВектоКрым-КГЛ-IgM” № 2
серия 1



Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”


М.Д. Хусаинов
“14” 03 2019 г.

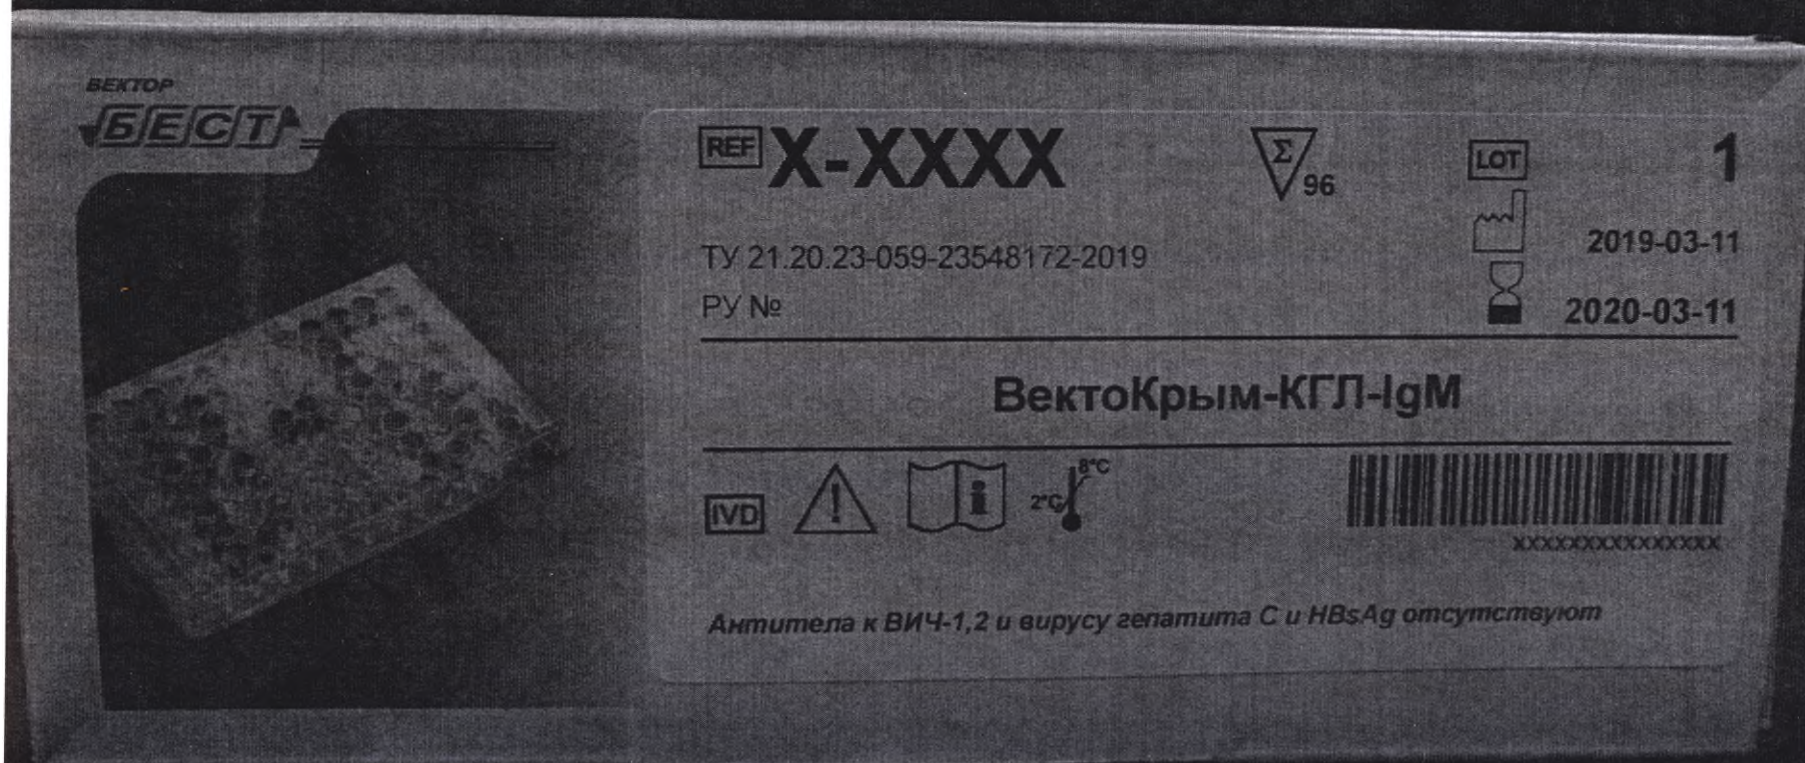

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"ВектоКрым-КГЛ-IgM" № 3
серия 1



Генеральный директор
АО "Вектор-Бест"

 М.Д. Хусаинов
"14" 03 20 19 г.



АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52

E-mail: vbmarket@vector-best.ru

www.vector-best.ru

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
“ВектоКрым-КТЛ-IgM”
 серия 2



Генеральный директор
 АО “Вектор-Бест”

“14” 03 2019 г.


М.Д. Хусаинов




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ВектоКрым-КГЛ-IgM” № 1
серия 2



Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”

 М.Д. Хусаинов
“14” 03 2019 г.

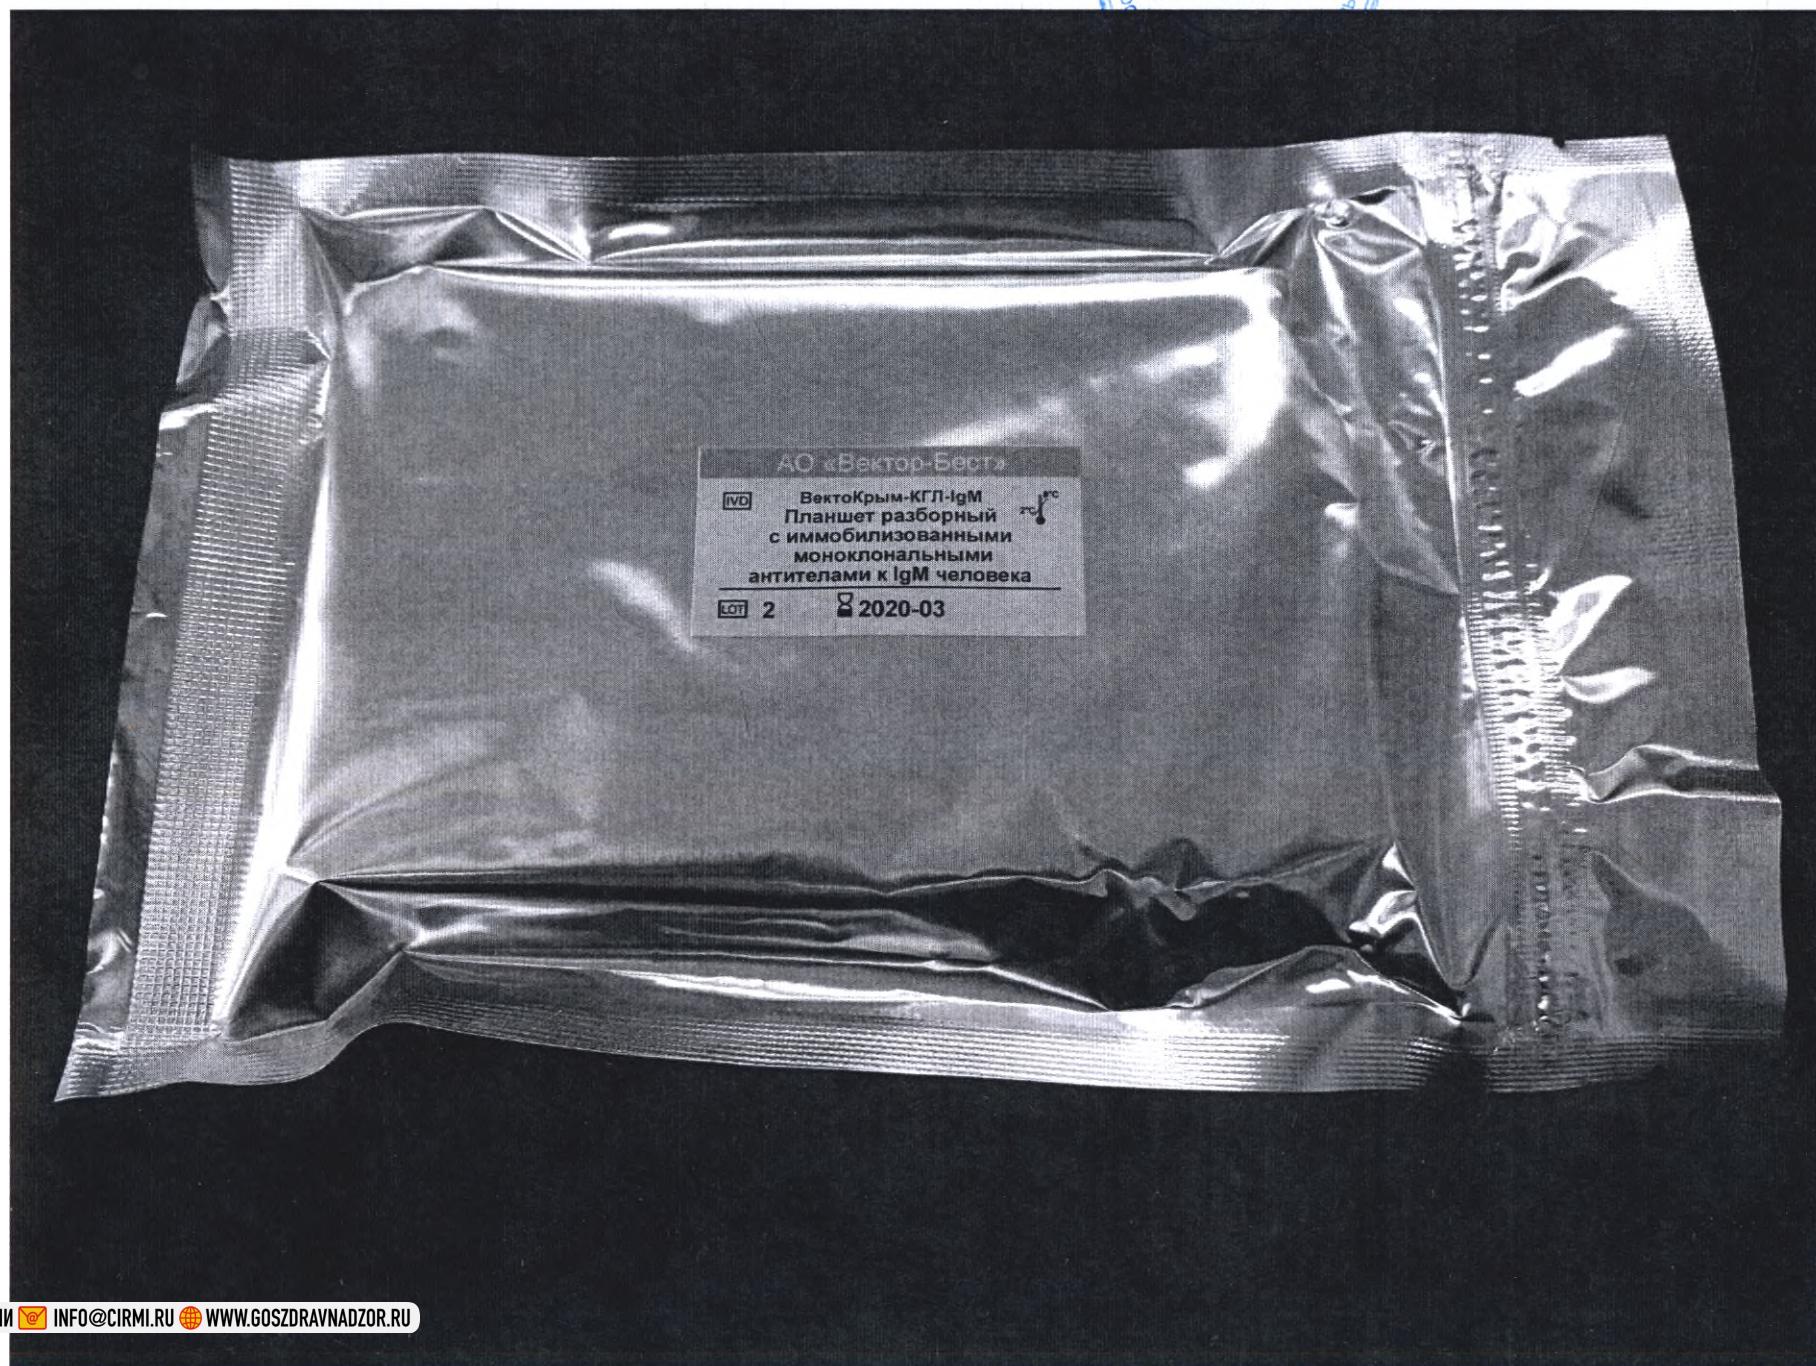



АО «Вектор-Бест»
IVD ВектоКрым-КГЛ-IgM
Планшет разборный
с иммобилизованными
моноклональными
антителами к IgM человека
LOT 2 2020-03

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ВектоКрым-КТЛ-IgM” № 2
серия 2



Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»


 М.Д. Хусаинов
“14” 03 20 19 г.

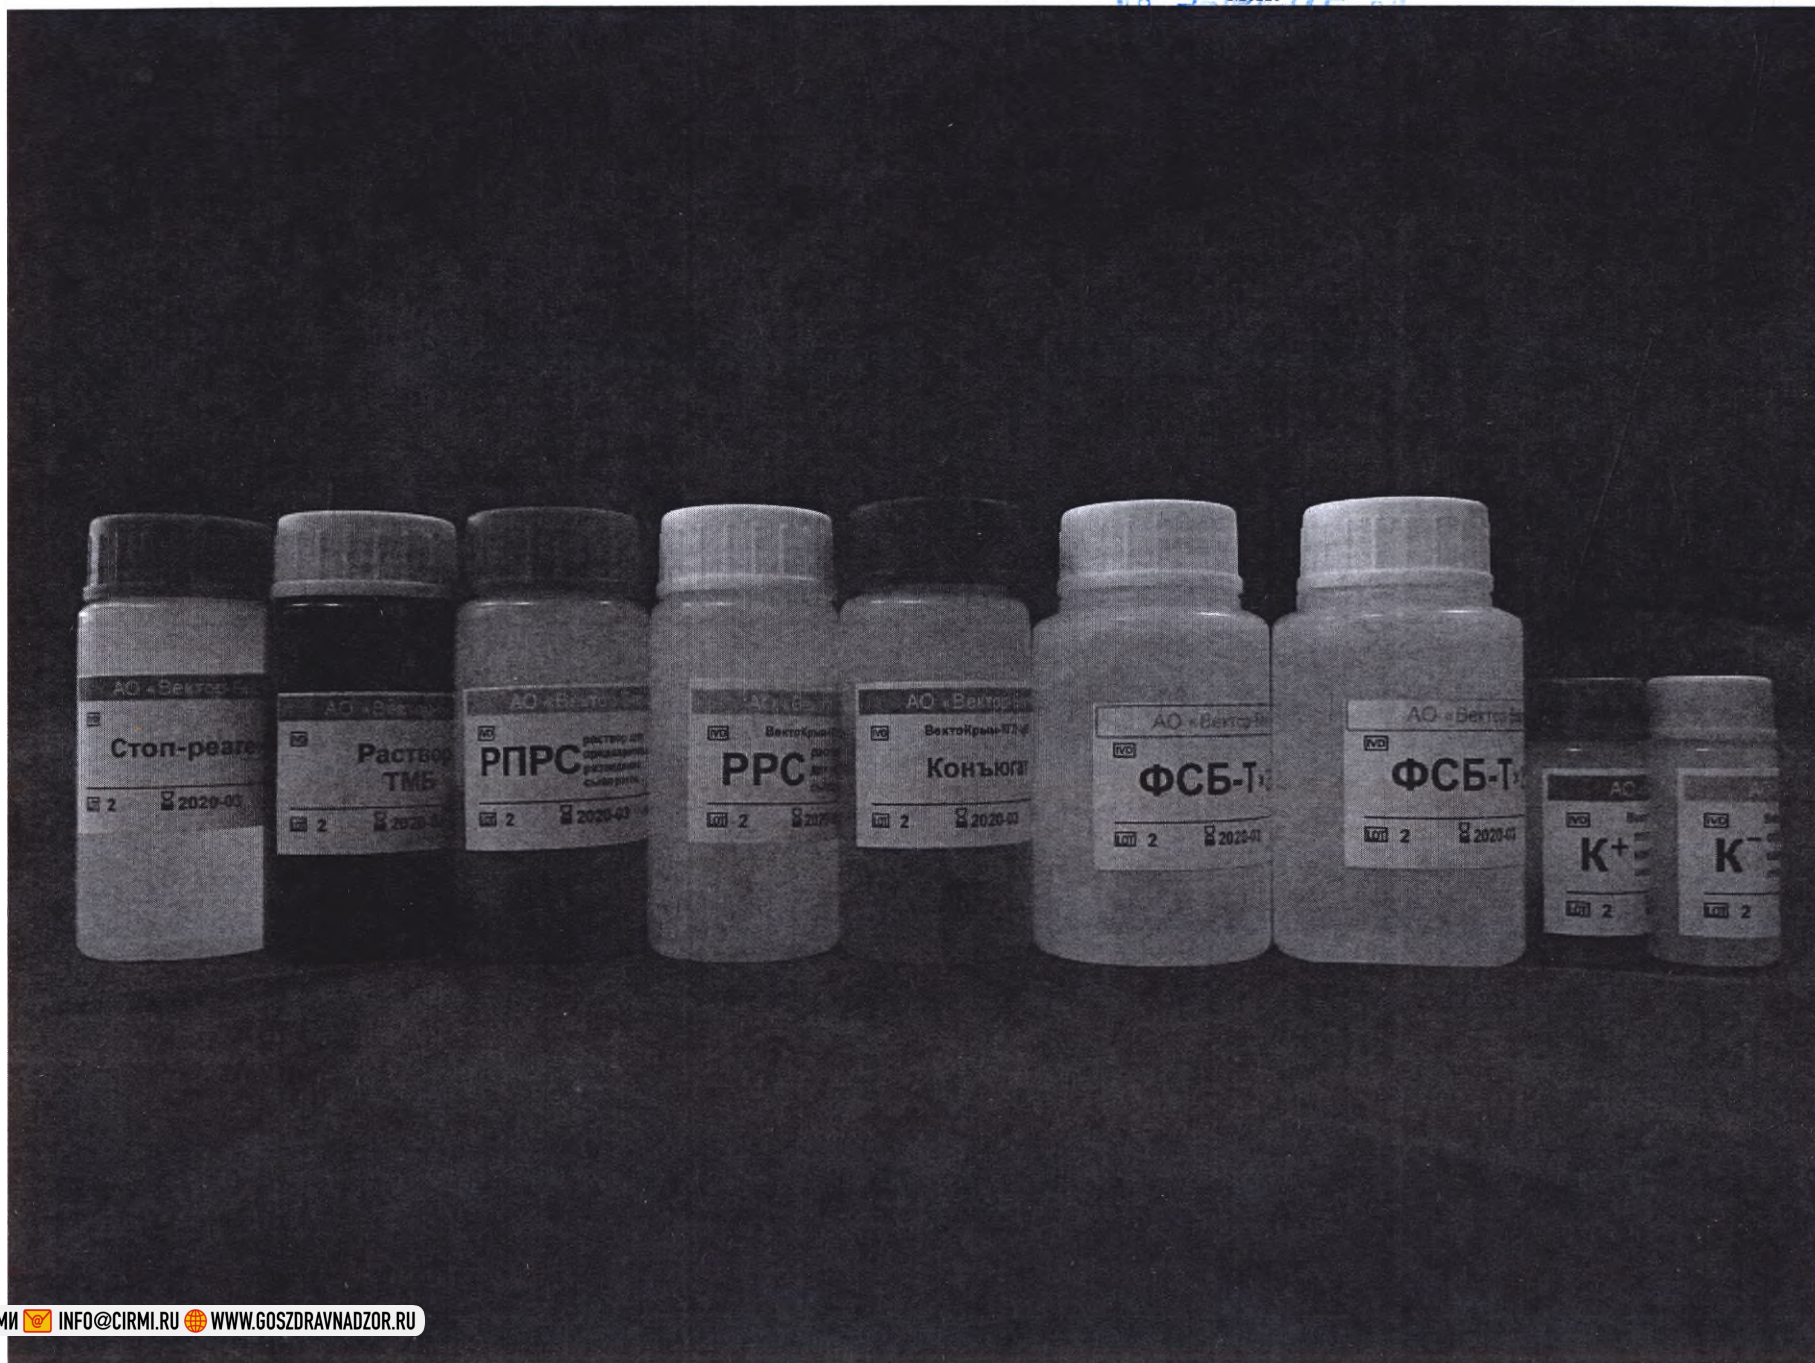


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ ВектоКрым-КГЛ-IgM” № 3
серия 2



Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”


 М.Д. Хусаинов
“14” 08 2019 г.

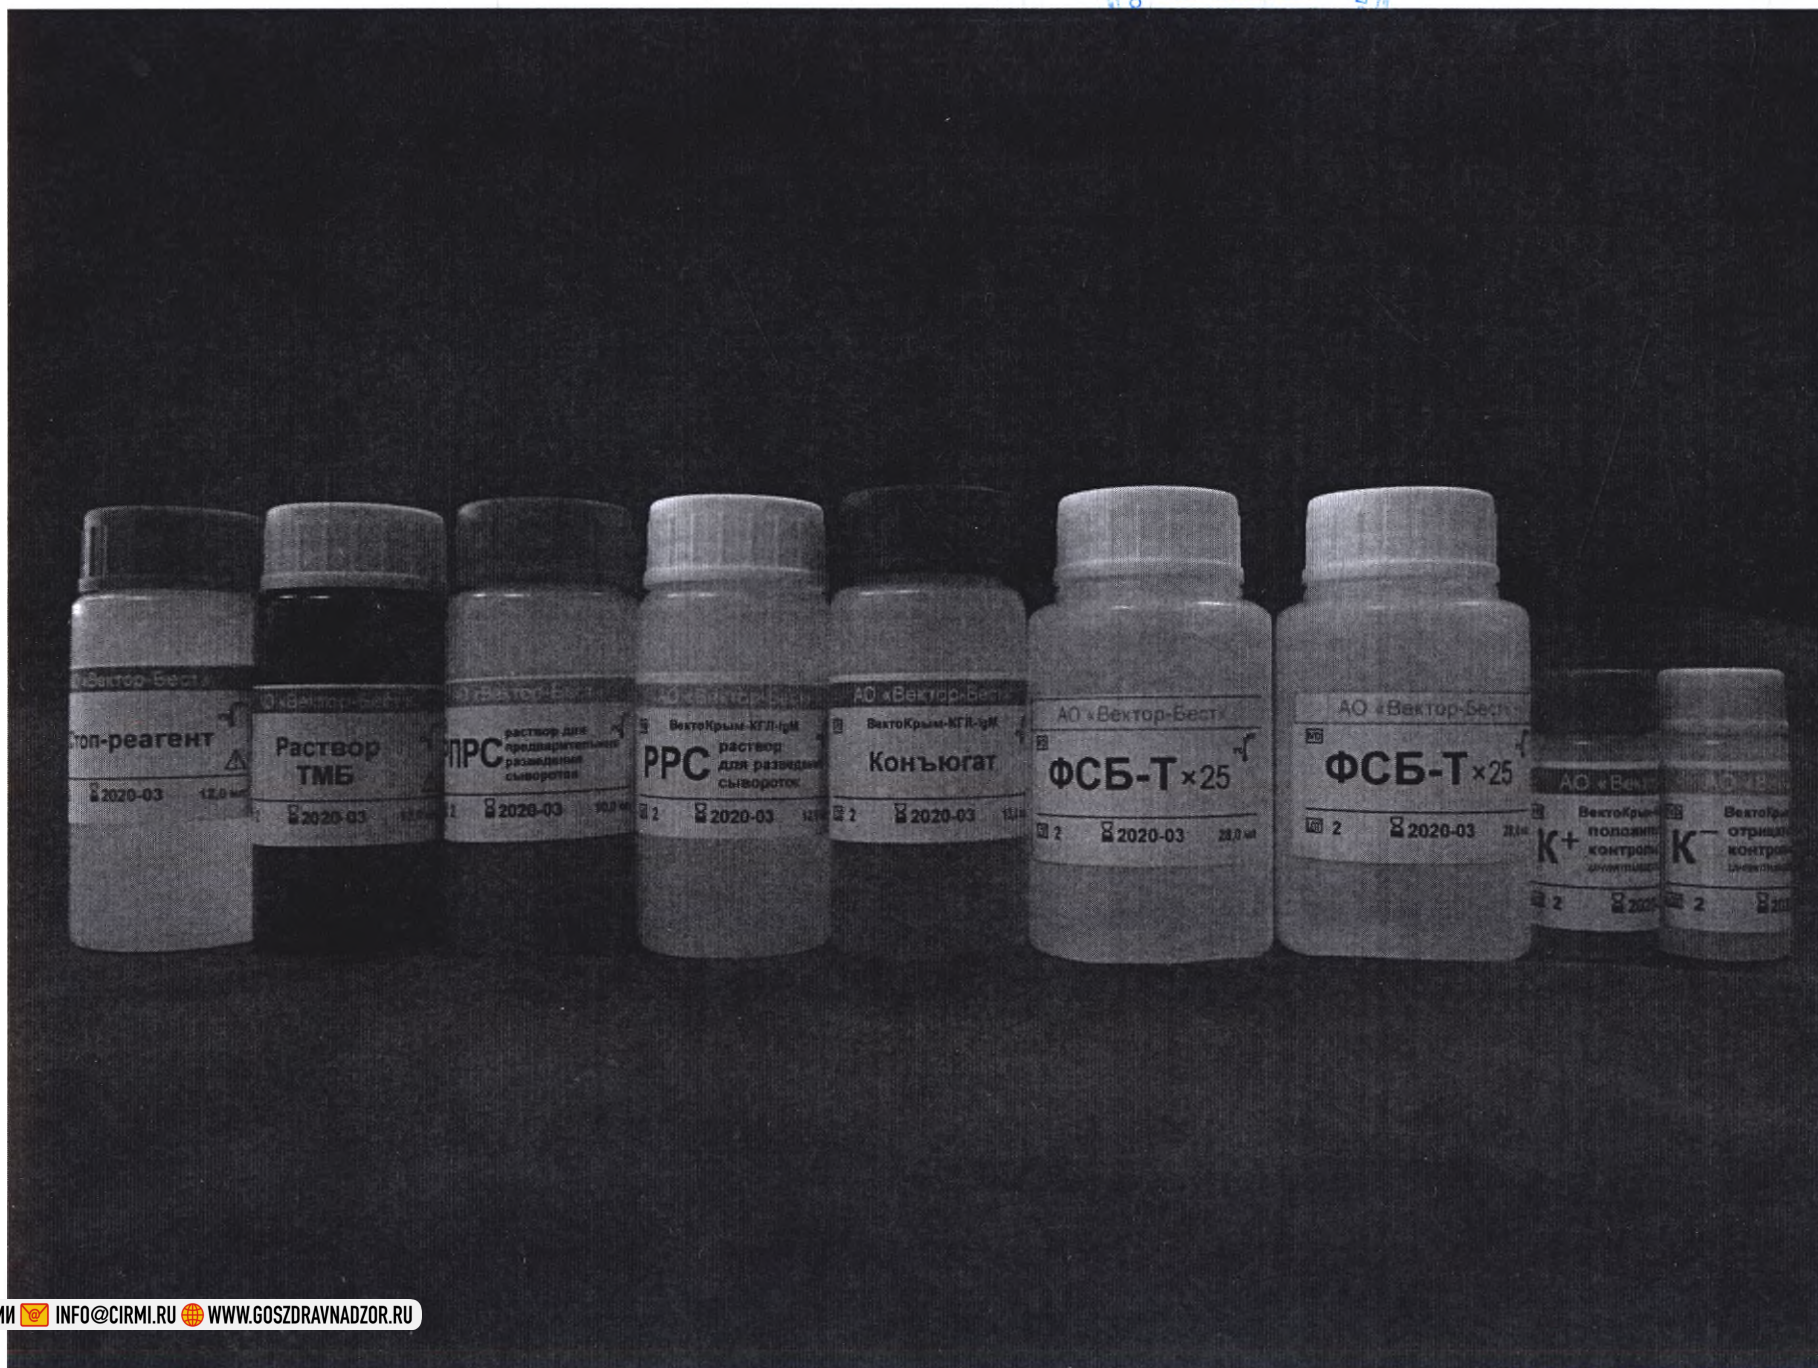


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ВектоКрым-КГЛ-IgM” № 4
серия 2



Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”

 М.Д. Хусаинов
“14” 03 2019 г.

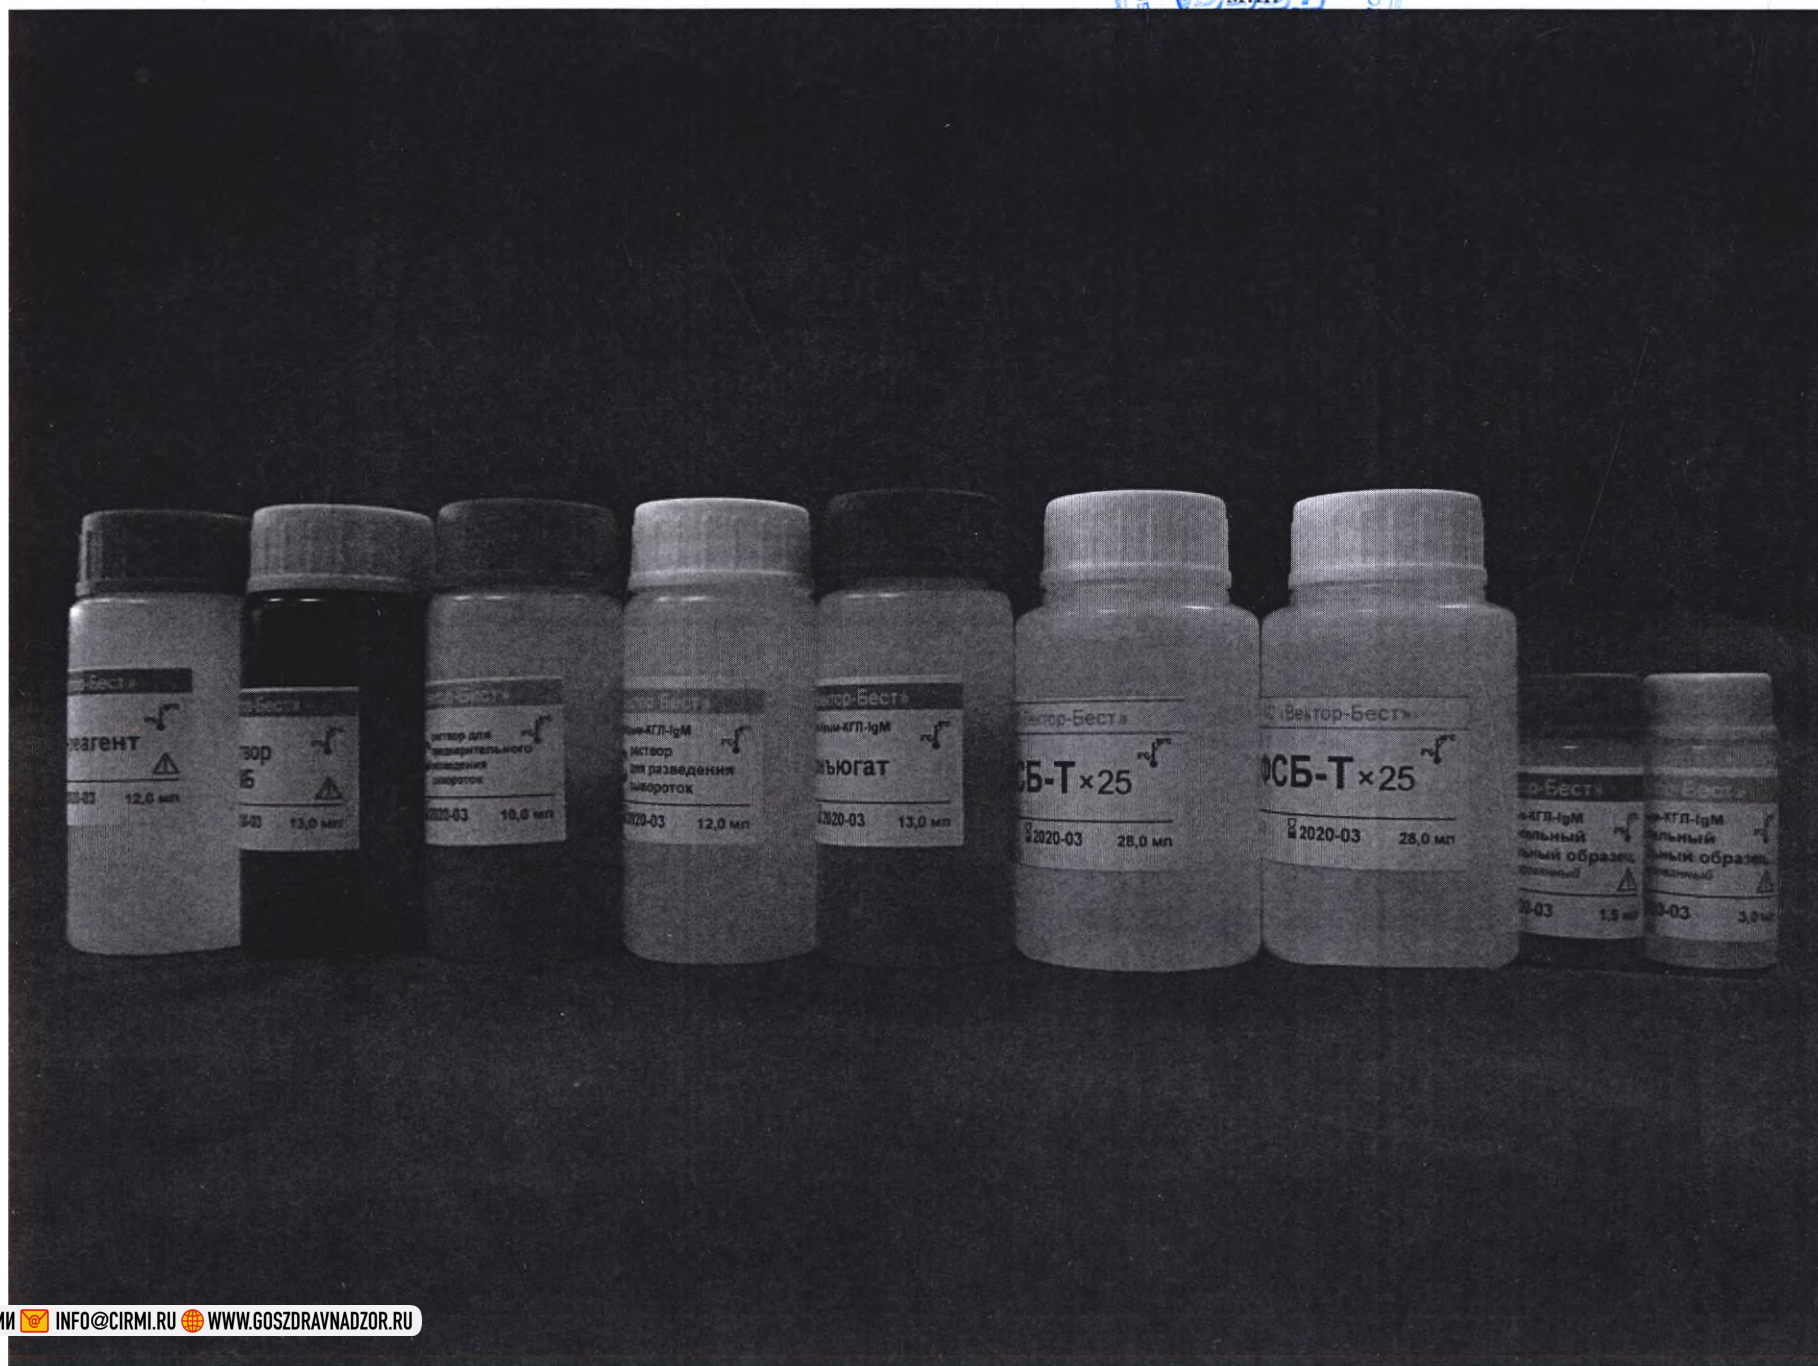


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ВектоКрым-КТЛ-IgM” №5
серия 2



Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»


М.Д. Хусаинов

“14” 03/ 20 19 г.

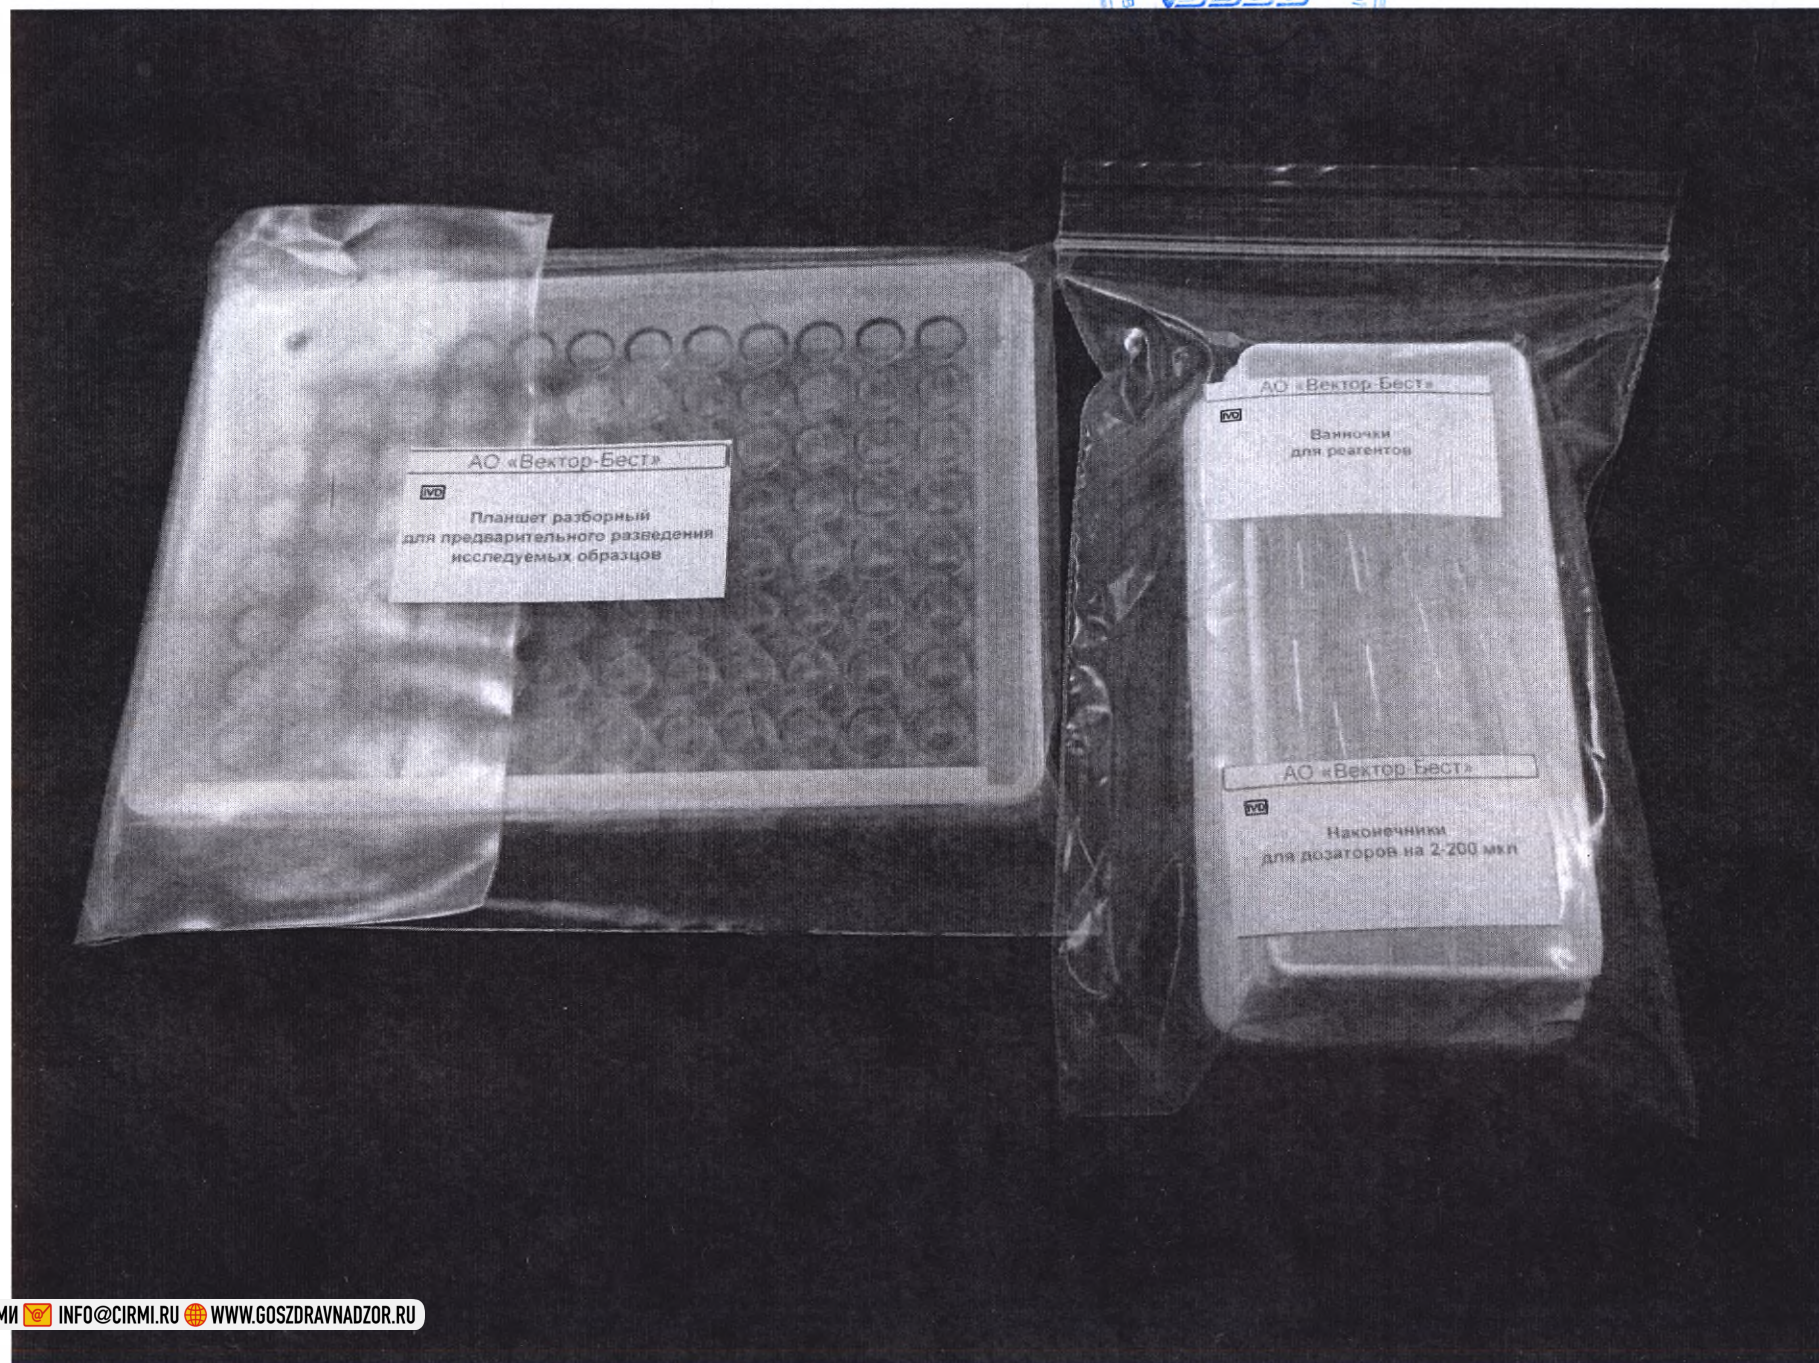



ВЕКТОР
БЕСТ

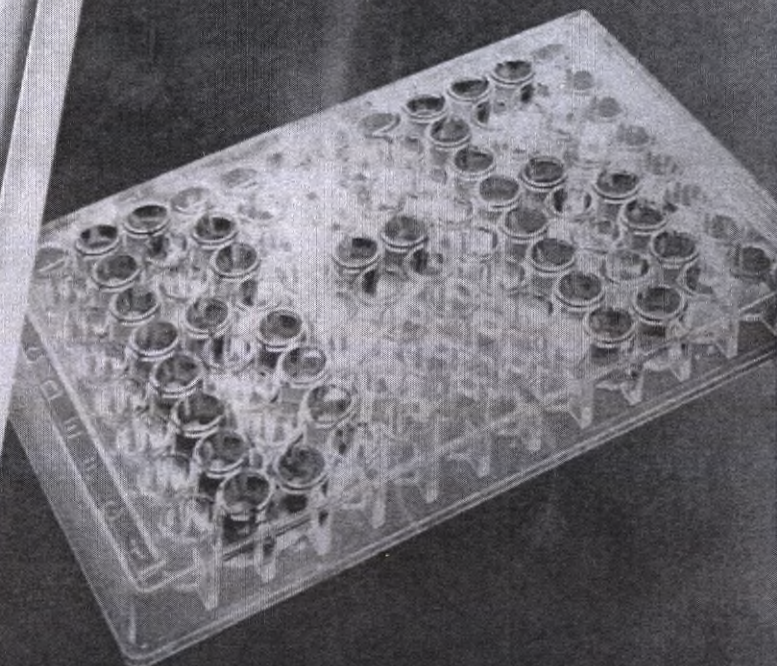

REF

X-XXXX

набор реагентов
 для иммуноферментного определения
 иммуноглобулинов класса IgM вируса
 Крымской-Конго геморрагической
 лихорадки в сыворотке крови

ВектоКрым-КТЛ-IgM

Lot 2

СОСТАВ:

1. Планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к IgM человека	1 шт.	2
2. Положительный контрольный образец	1 фл., 1,0 мл	2
3. Отрицательный контрольный образец	1 фл., 3,0 мл	2
4. Конъюгат	1 фл., 13,0 мл	2
5. Раствор для разведения сывороток	1 фл., 12,0 мл	2
6. Раствор для предварительного разведения сывороток	1 фл., 10,0 мл	2
7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	2 фл. по 28,0 мл	2
8. Раствор тетраметилбензидина	1 фл., 13,0 мл	2
9. Стоп-реагент	1 фл., 12,0 мл	2
10. Планшет разборный для предварительного разведения исследуемых образцов	1 шт.	
11. Пленки для заклеивания планшета	2 шт.	
12. Наконечники для дозаторов на 2-200 мкл	16 шт.	
13. Ванночки для реагентов	2 шт.	


Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“ ВектоКрым-КГЛ-IgM” № 2
серия 2



Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”

“14” 03


М.Д. Хусаинов
20 19 г.

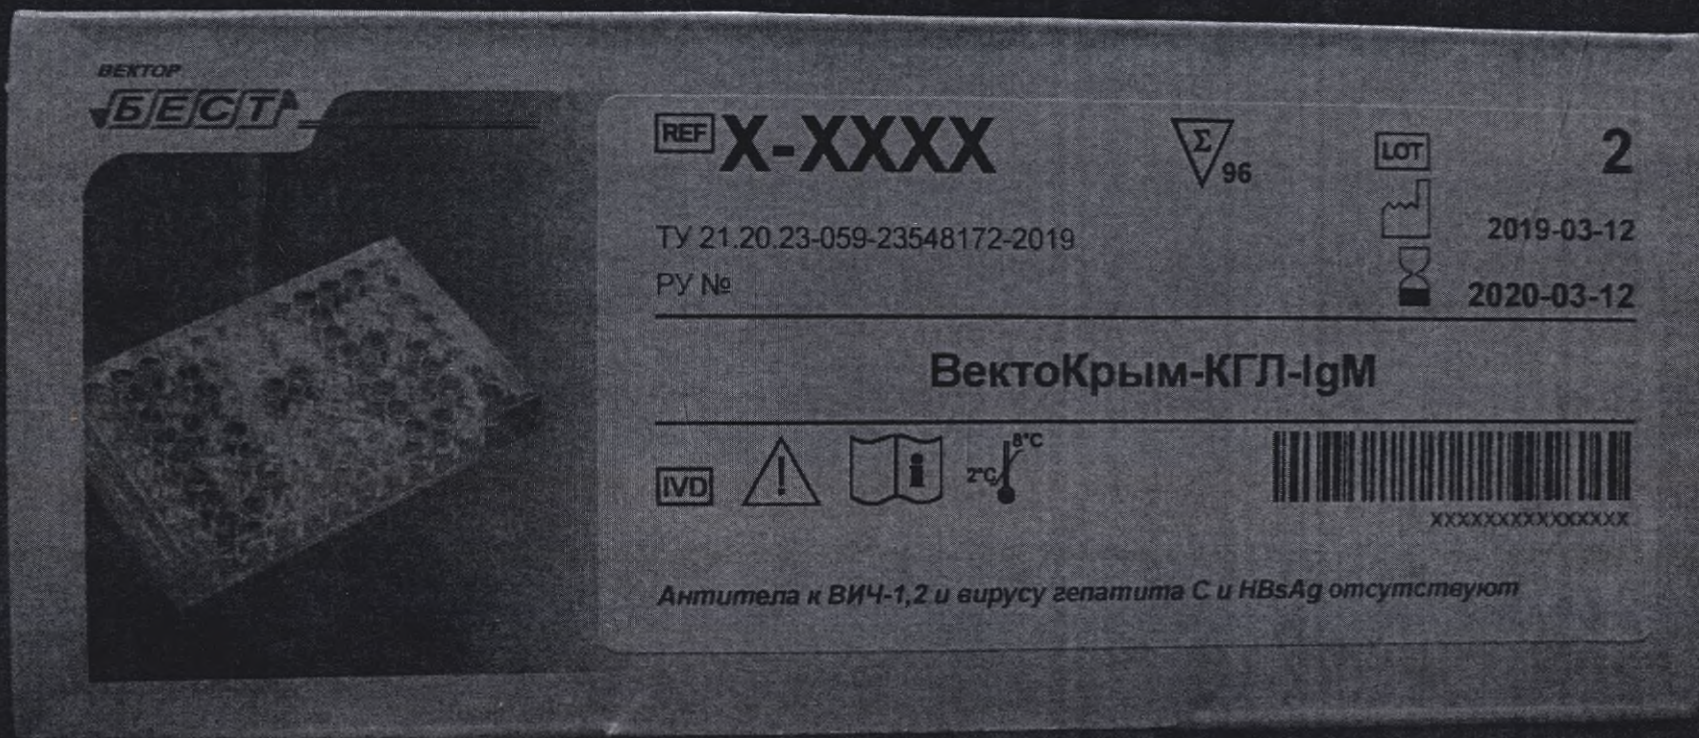

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“ВектоКрым-КГЛ-IgM” № 3
серия 2



Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”


“14” 03/

М.Д. Хусаинов
20 14 г.



АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52

E-mail: vbmarket@vector-best.ru

www.vector-best.ru