


Фотографические изображения


Реагенты в кассете для обнаружения РНК SARS-CoV-2 методом real-time PCR в мазках из носа, носоглотки и ротоглотки на системе автоматизированной cobas® 6800 (cobas® SARS-CoV-2)



Реагенты в кассете для обнаружения РНК SARS-CoV-2 методом real-time PCR в мазках из носа, носоглотки и ротоглотки
на системе автоматизированной cobas® 6800 (cobas® SARS-CoV-2)

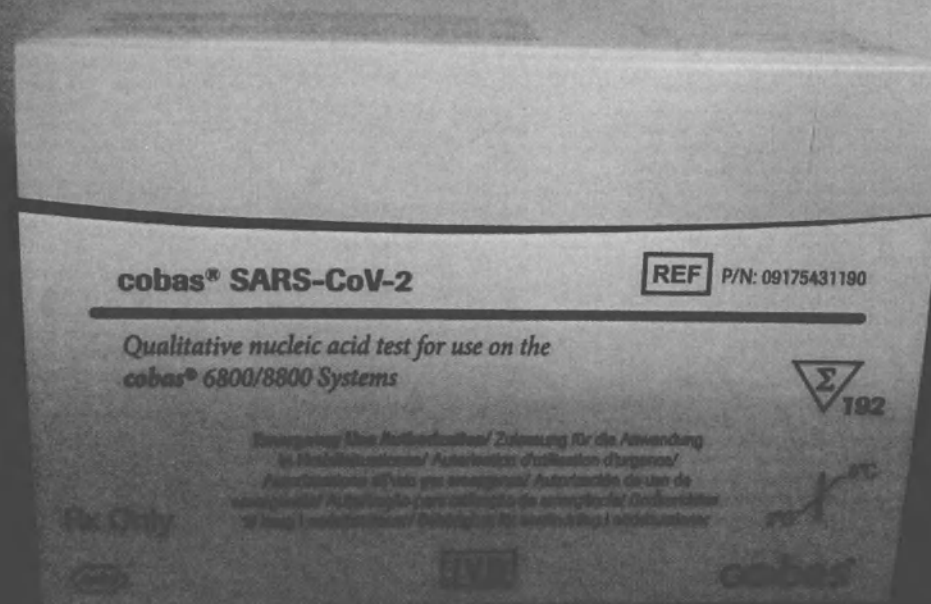

Реагенты в кассете для обнаружения SARS-CoV-2
системе автоматизированной cobas® 6800 (cobas® SARS-CoV-2)

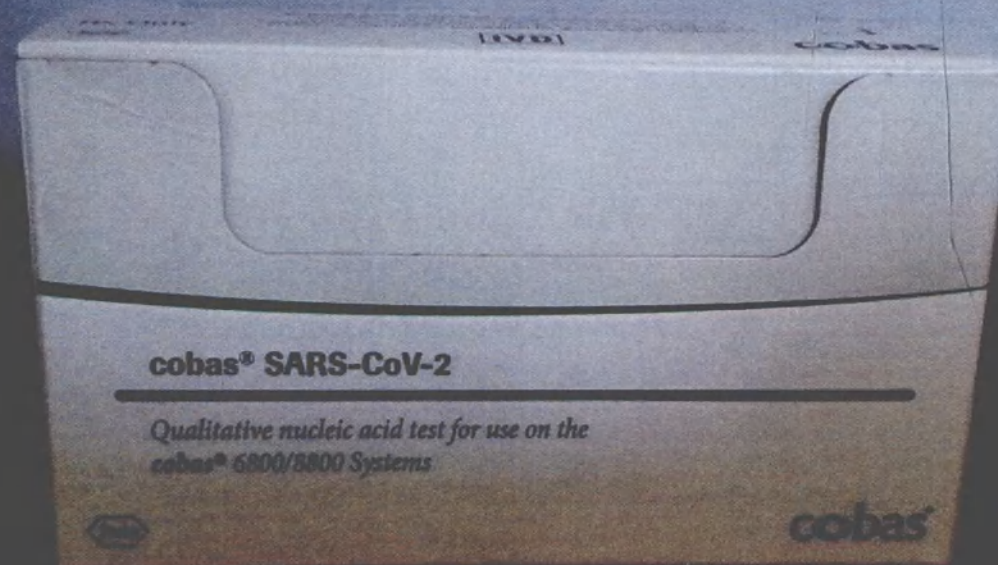




Cont.

SARS-CoV-2 Cassette	x 1
MMX-R1	7.5 mL
SARS-CoV-2 MMX-R2	9.7 mL
PASE	22.3 mL
EB	21.2 mL
RNA IC	21.2 mL

EUM210 Safety data sheet available on request./ Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich./ Fiche de données de sécurité disponible sur demande./ Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta./ Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad./ Ficha de segurança fornecida a pedido./ Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres./ Säkerhetsdatablad finns att rekvireras.

EUM208 Contains Subtilisin. May produce an allergic reaction./ Enthält Subtilisin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen./ Contient de la subtilisine. Peut produire une réaction allergique./ Contiene Subtilisina. Può provocare una reazione allergica./ Contiene subtilisina. Puede provocar una reacción alérgica./ Contém subtilisina. Pode provocar uma reação alérgica./ Innehåller subtilisin. Kan utlösa allergisk reaktion./ Innehåller subtilisin. Kan orsaka en allergisk reaktion.

реагенты в кассете для обнаружения
системе автоматизированной cobas® 6800 (cobas® SARS-CoV-2)

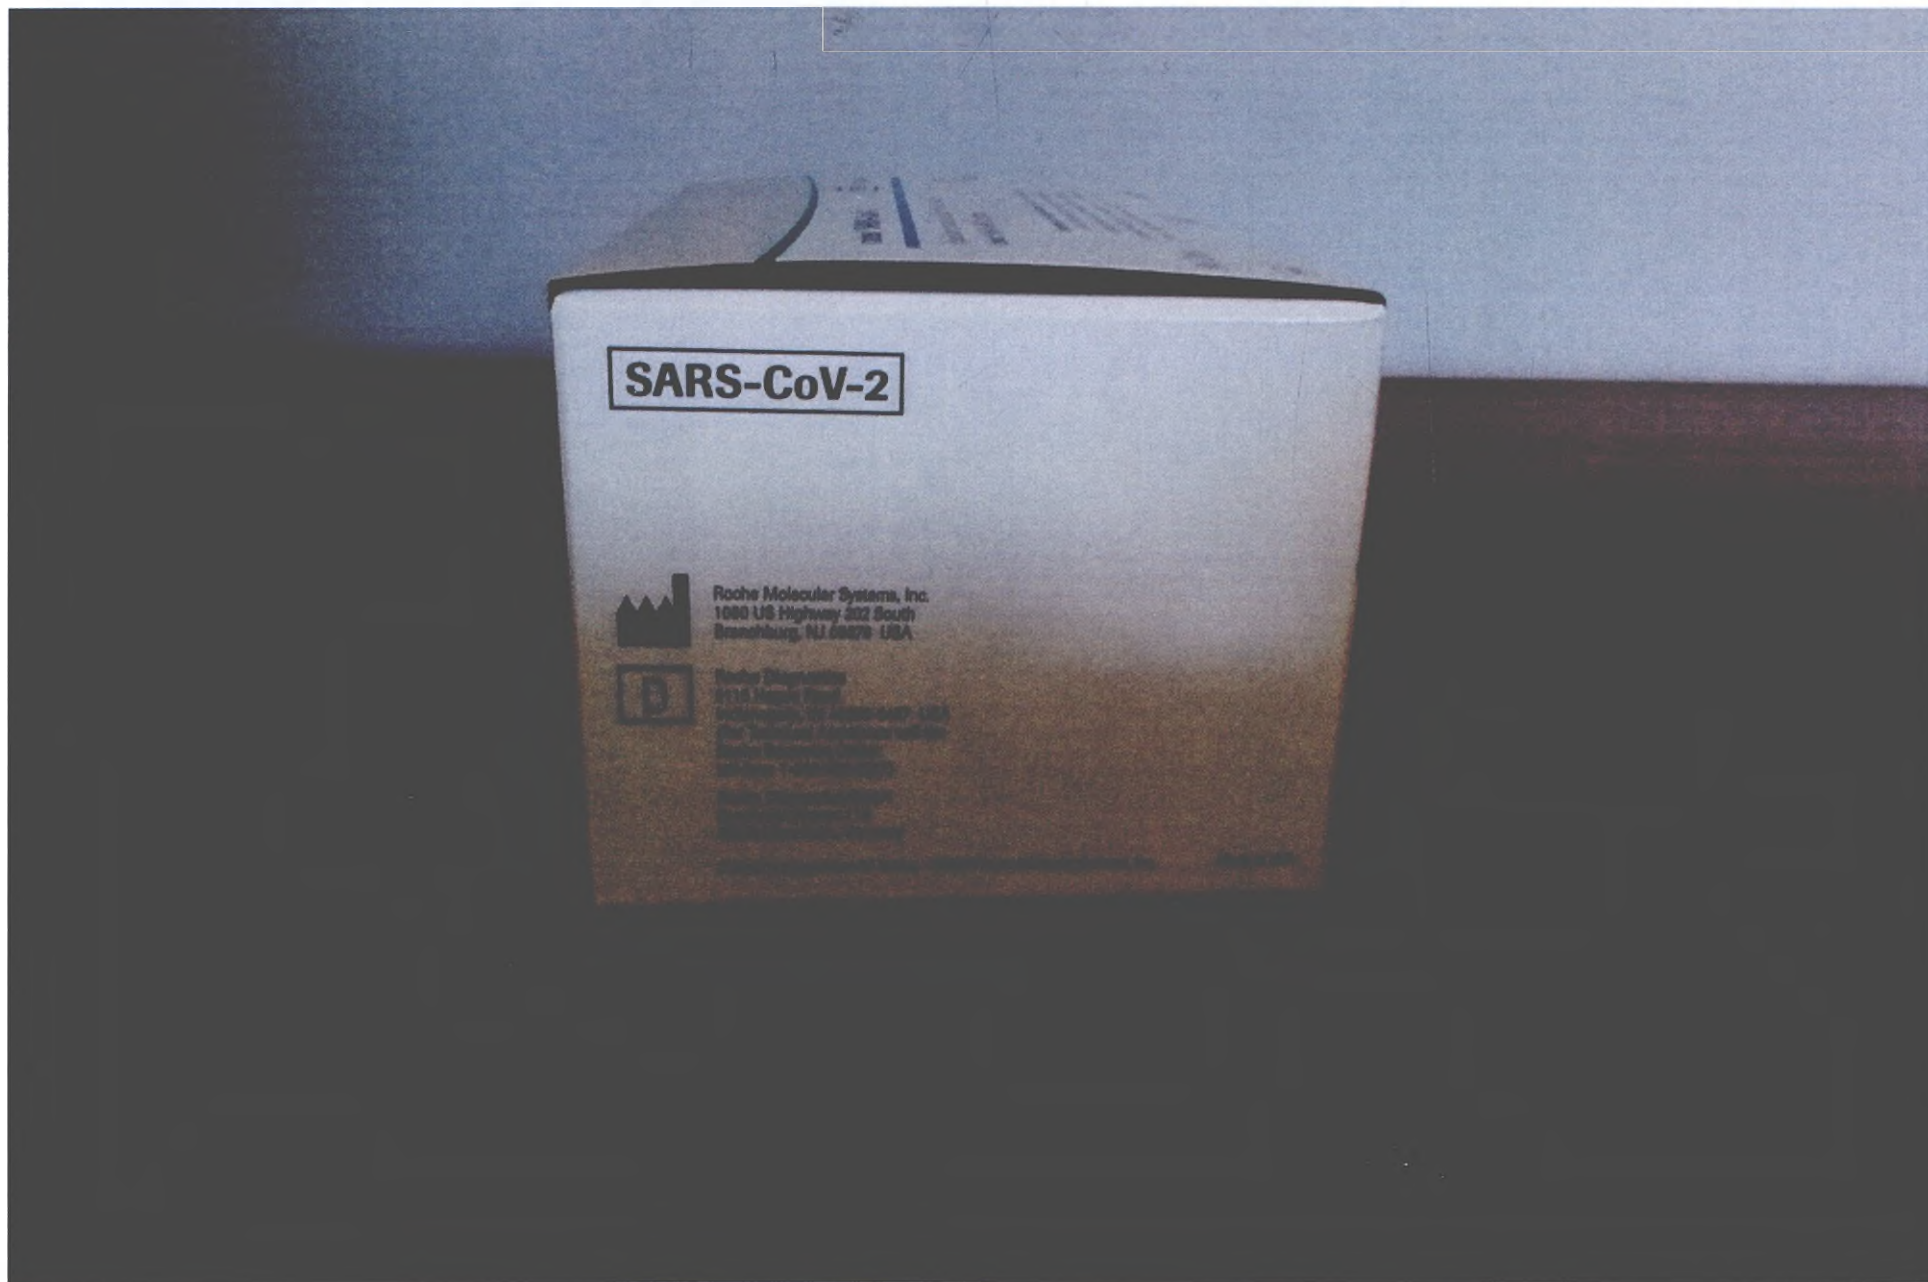

системе автоматизированной cobas® 6800 (cobas® SARS-CoV-2)

09168524001-01



H334, H360, H410

Реагенты в кассете для обнаружения РНК SARS-CoV-2 методом real-time PCR в мазках из носа, носоглотки и ротоглотки на системе автоматизированной cobas® 6800 (cobas® SARS-CoV-2)

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Срок годности см. на упаковке.

Срок годности изделия не подтвержден в режиме реального времени.

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Molecular Systems, Inc», 1000 US Highway 202 South, Branchburg, NJ, 08876, United States

Изделие предназначено для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории

РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-89-99, факс: +7 495 229-82-84. E-mail: moscow.reception_dia@roche.com

Кат. номер 09175431190

Всего пронумеровано,
проиндексировано и
скреплено печатью
8 листа (ов)



Лучина И. А.
Руководитель отдела Логистики
и качества по доверенности от:

02 ИЮЛ 2018