

**Фотографическое изображение
общего вида медицинского изделия:**

**Реагент VITROS Инсулин в кассете (VITROS Insulin Reagent Pack)
для иммунодиагностического определения инсулина
методом усиленной хемилюминесценции на анализаторах серии VITROS.**

необходимое для применения медицинского изделия по назначению

Наименование: Реагент VITROS Инсулин в кассете (VITROS Insulin Reagent Pack) для иммунодиагностического определения инсулина методом усиленной хемилюминесценции на анализаторах серии VITROS



Назначение: для количественного определения инсулина в сыворотке и плазме человека (с литий-гепарином) с помощью анализаторов серии VITROS (VITROS ECi/ECiQ, VITROS 3600, VITROS 5600, VITROS XT7600).

Регистрационное удостоверение в РФ:

Уполномоченная организация на территории РФ: ООО «Орто-Клиникал Диагностика»,
Россия, 143026, Московская область,
Одинцовский район, дер. Сколково, ул. Новая,
дом. 100, лит. А,А



VITROS Insulin Reagent Pack): картонная упаковка, фольгированная упаковка, кассета, информационный вкладыш

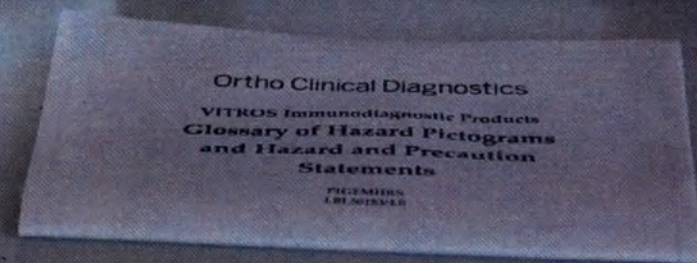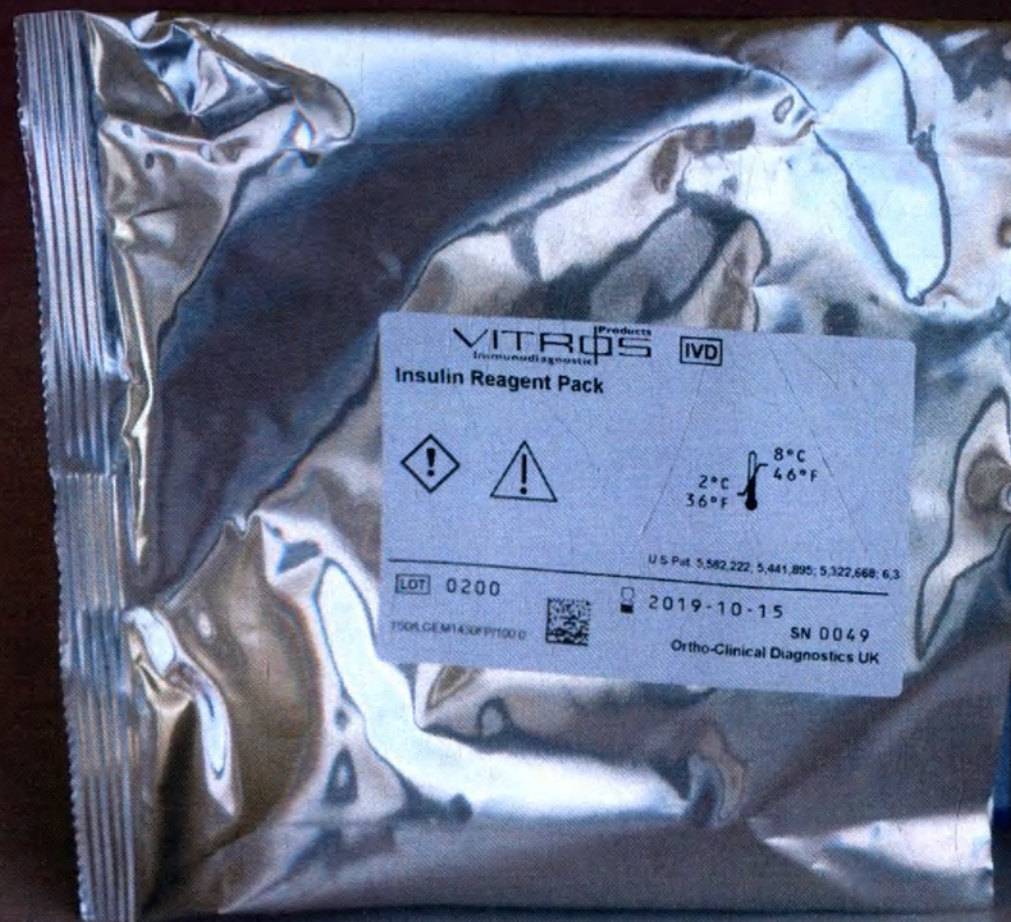

VITROS
Immunodiagnostic
Insulin Reagent Pack

LOT

0200


2°C
36°F
8°C
46°F

2019-10-15

SN 0044



IVD



10702000044



Ortho-Clinical Diagnostics UK
T50/LGEM1430RP/100.0

ВСЕГО 4 листа

«06» 05 2020 г.

Генеральный Директор

ООО «Орто-Клиникал Диагностикс»

Сергеенко В.К.

