

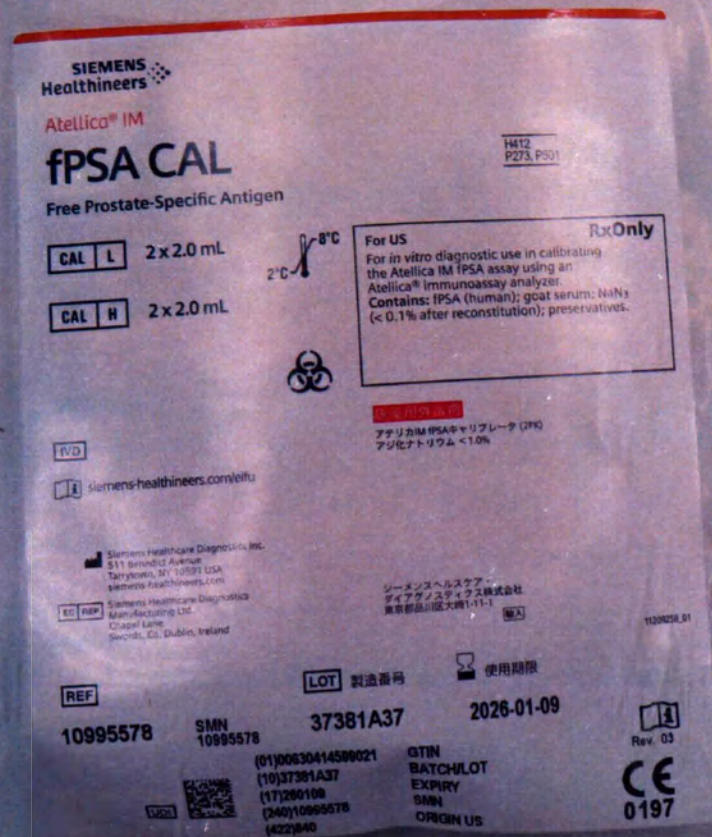


Рисунок 1. Набор калибраторов для определения свободного простат-специфического антигена для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Free



Рисунок 2. Набор калибраторов для определения свободного простат-специфического антигена для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Free



Рисунок 3. Калибратор с низкой концентрацией Atellica IM fPSA CAL L, 2,0 мл и Калибратор с высокой концентрацией Atellica IM fPSA CAL H, 2,0 мл



Рисунок 4. Калибратор с низкой концентрацией Atellica IM fPSA CAL L, 2,0 мл и Калибратор с высокой концентрацией Atellica IM fPSA CAL H, 2,0 мл



Рисунок 5. Калибратор с низкой концентрацией Atellica IM fPSA CAL L, 2,0 мл и Калибратор с высокой концентрацией Atellica IM fPSA CAL H, 2,0 мл

SIEMENS
Healthineers

Atellica® IM

CAL

f PSA

CAL LOT VAL

LOT

C2526

製造番号



2022-05-12

使用期限



[siemens.com/document-library](https://www.siemens.com/document-library)



b2d71cc6

CHECKSUM

CAL L

CAL H

UNITS C

UNITS SI

UNITS C

UNITS SI

f PSA



0 HG/ML

0 UG/L

14.4 HG/ML

14.4 UG/L

10997640 Rev. 02

Рисунок 6. Лист значений параметров лота калибратора

10995578

Набор калибраторов для определения свободного простат-специфического антигена для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Free Prostate-Specific Antigen Calibrator (Atellica IM fPSA CAL))

Информация о производителе и стране производства:
см. на упаковке

Регистрационное удостоверение:

№ PЗН 2020/12591 от 18.11.2020

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на оригинальной упаковке

Инструкция по применению на русском языке Rev. 02

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению

Авторизованный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96

Всего прошито и пронумеровано
4 листа (ов).

ООО «Сиенс Здоровоохранение»

