

Руководитель группы регистрации
ООО «Сименс Здравоохранение»



Горшкова Н.А.

2020 г.

Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики in vitro

Набор реагентов для определения магния на анализаторах биохимических серии
Atellica (Atellica CH Magnesium (Atellica CH Mg))

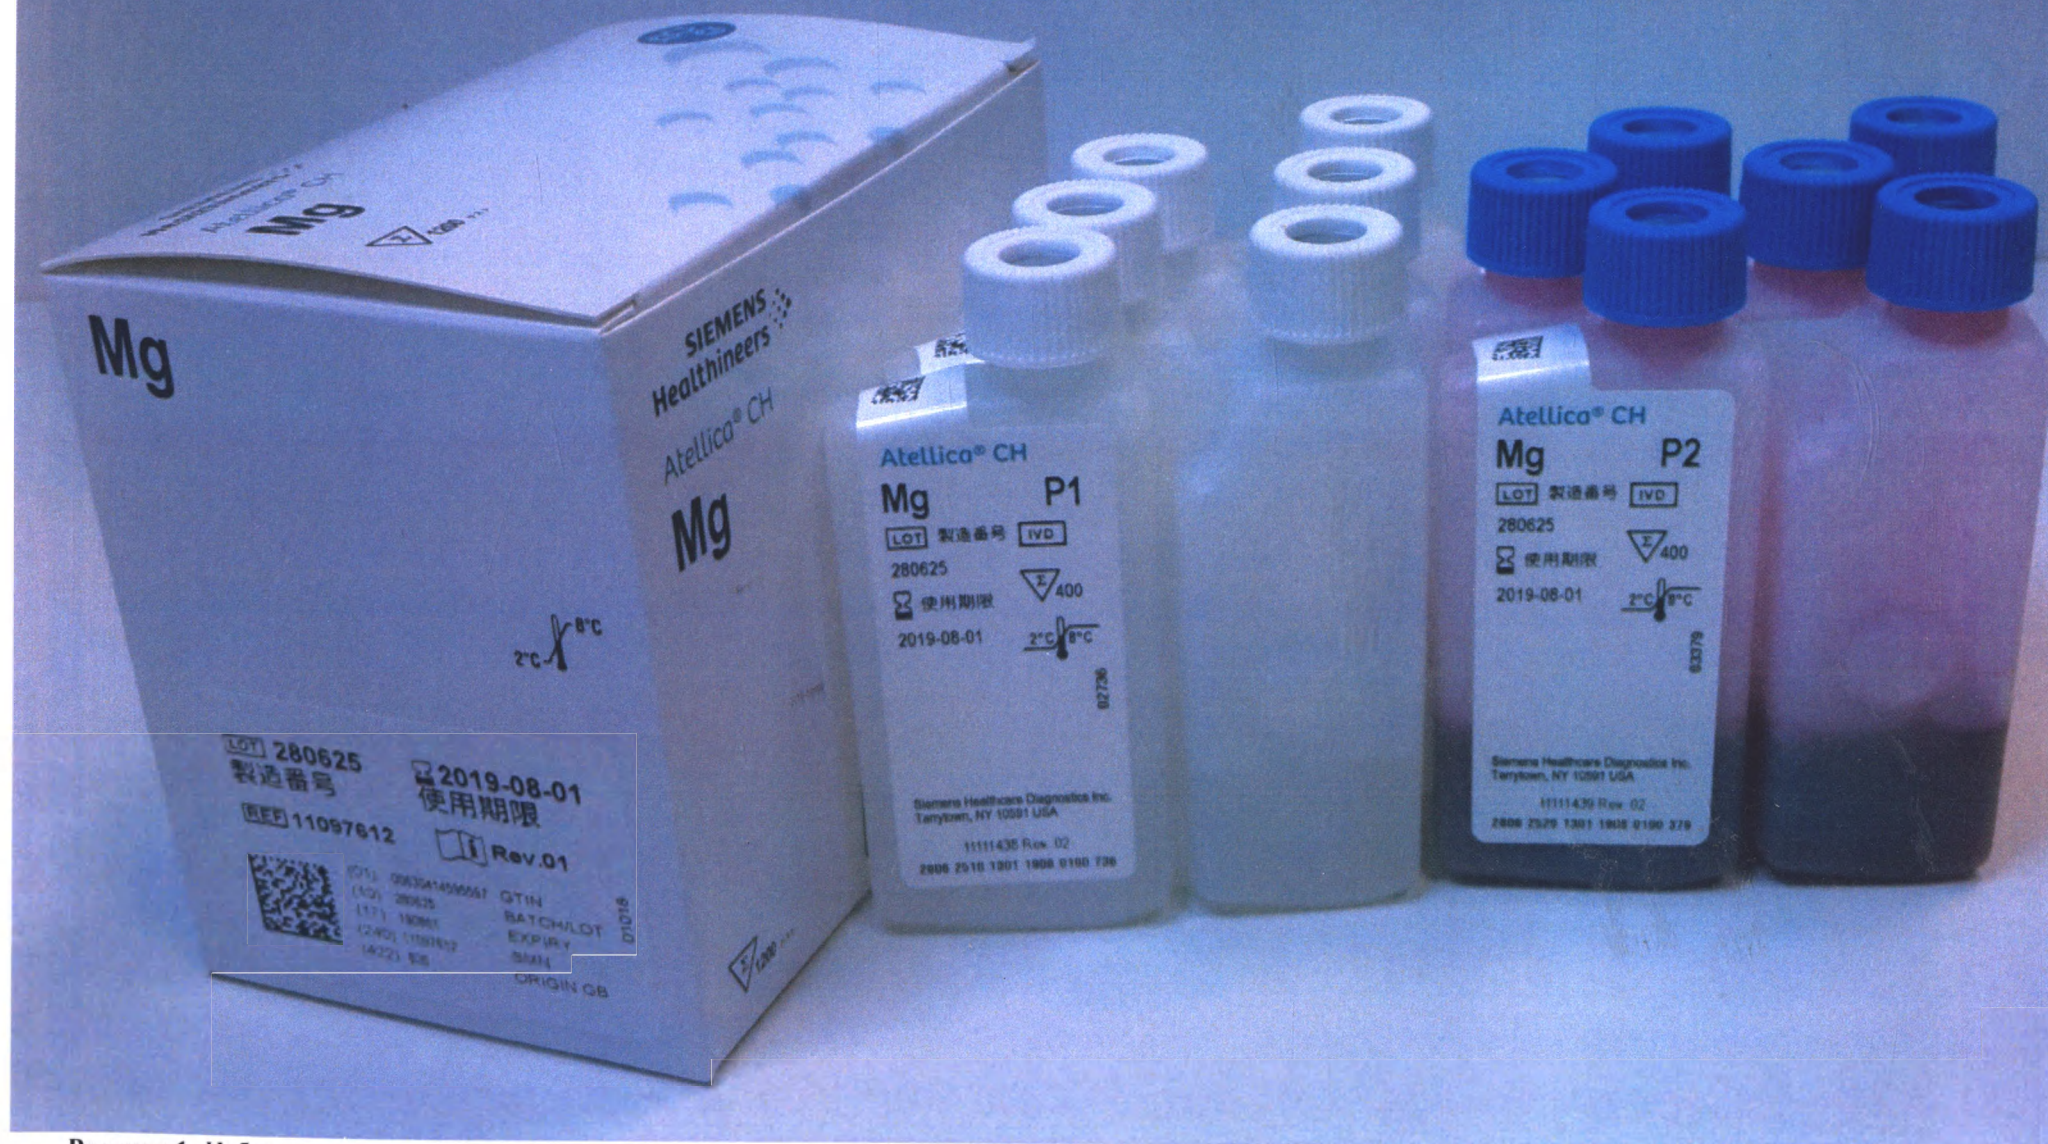


Рисунок 1 Набор реагентов для определения магния на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica CH Magnesium (Atellica CH Mg)): общий вид изделия

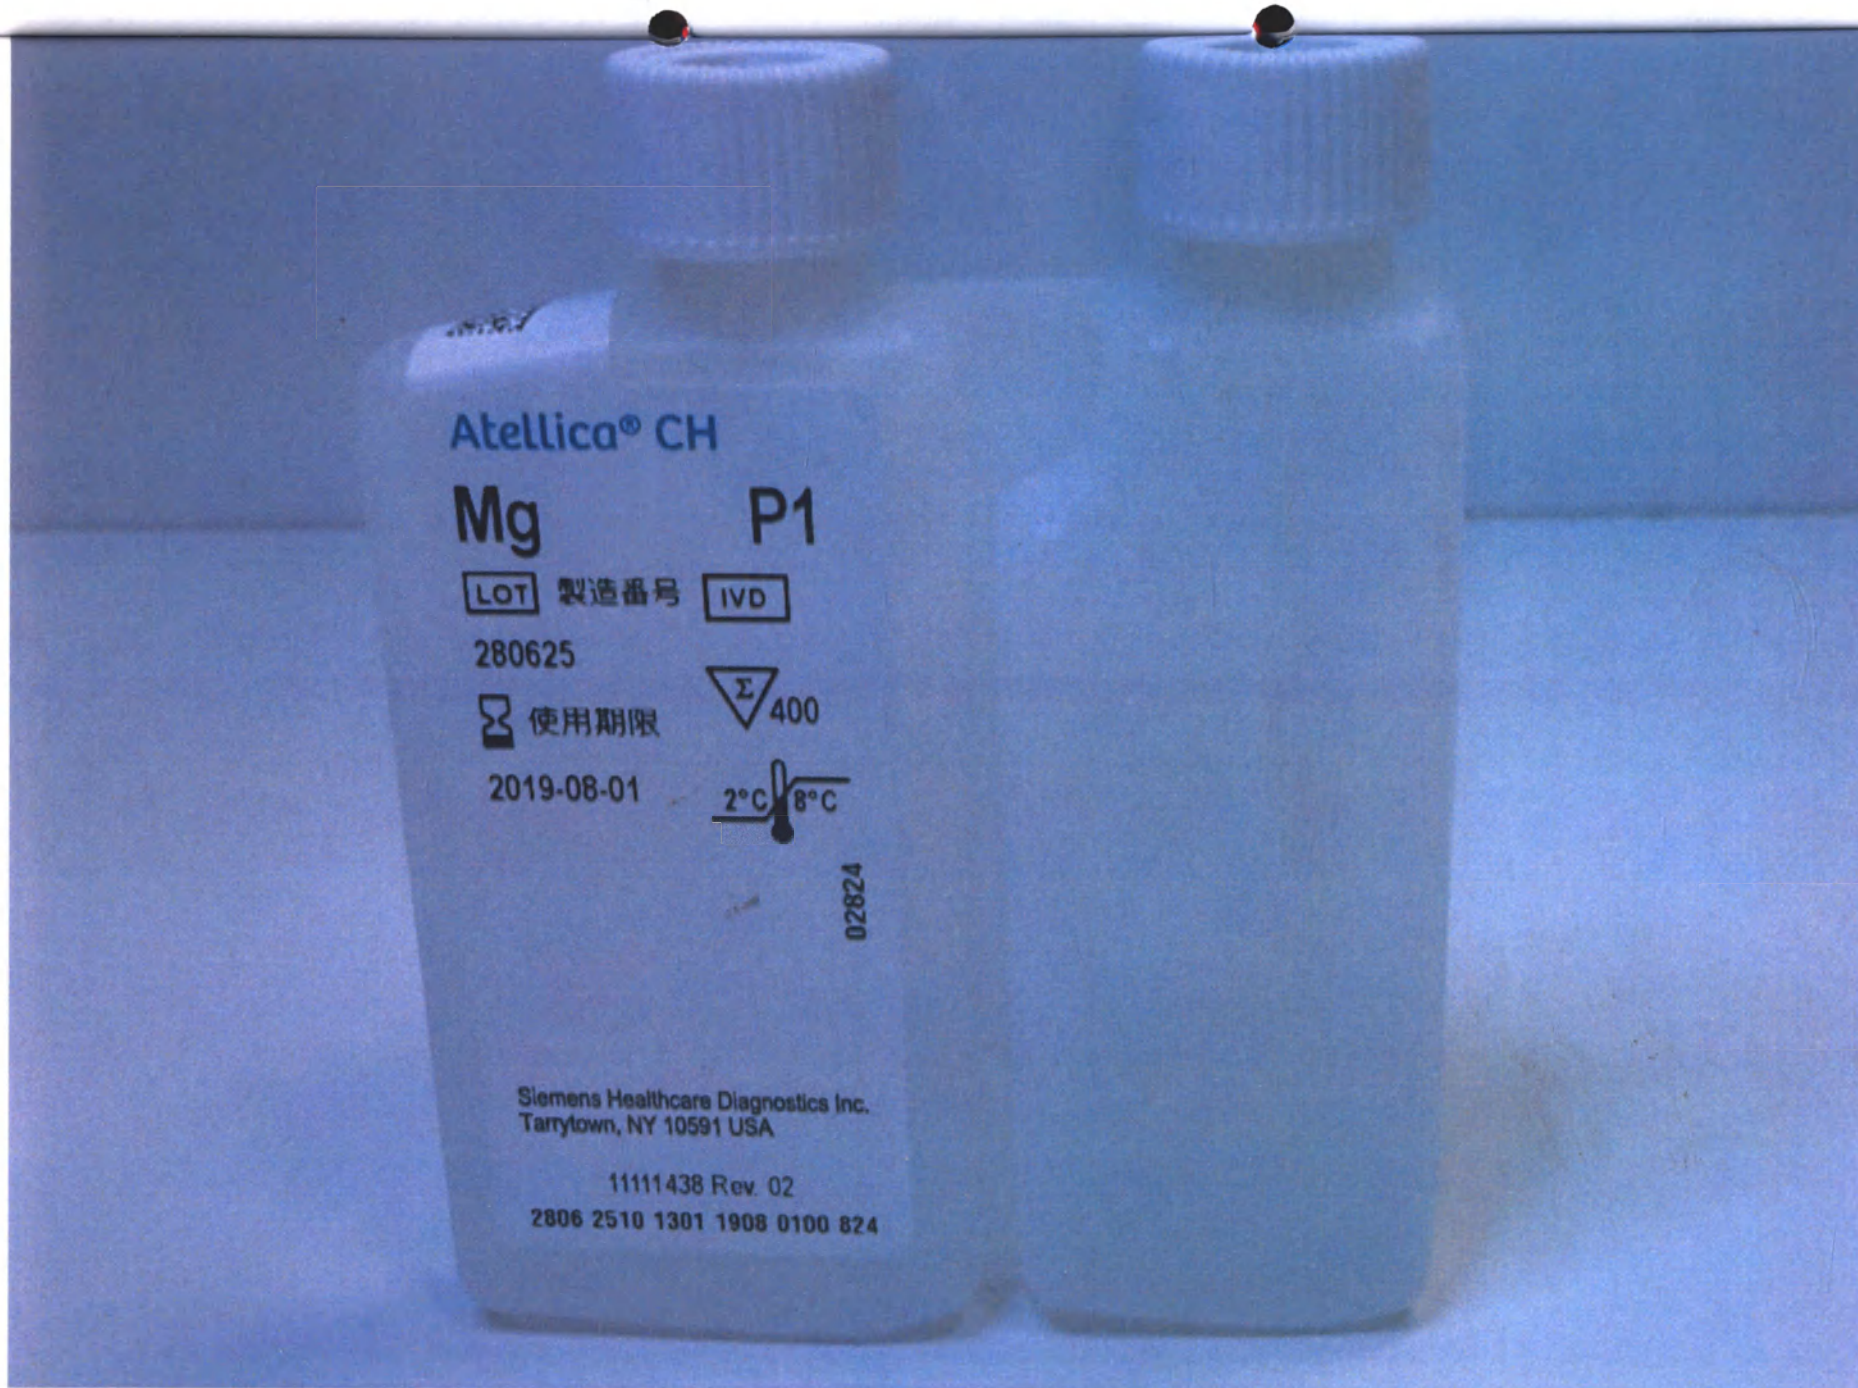


Рисунок 2 Набор реагентов для определения магния на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica CH Magnesium (Atellica CH Mg)): флаконы с реагентами, общий вид, упаковка 1

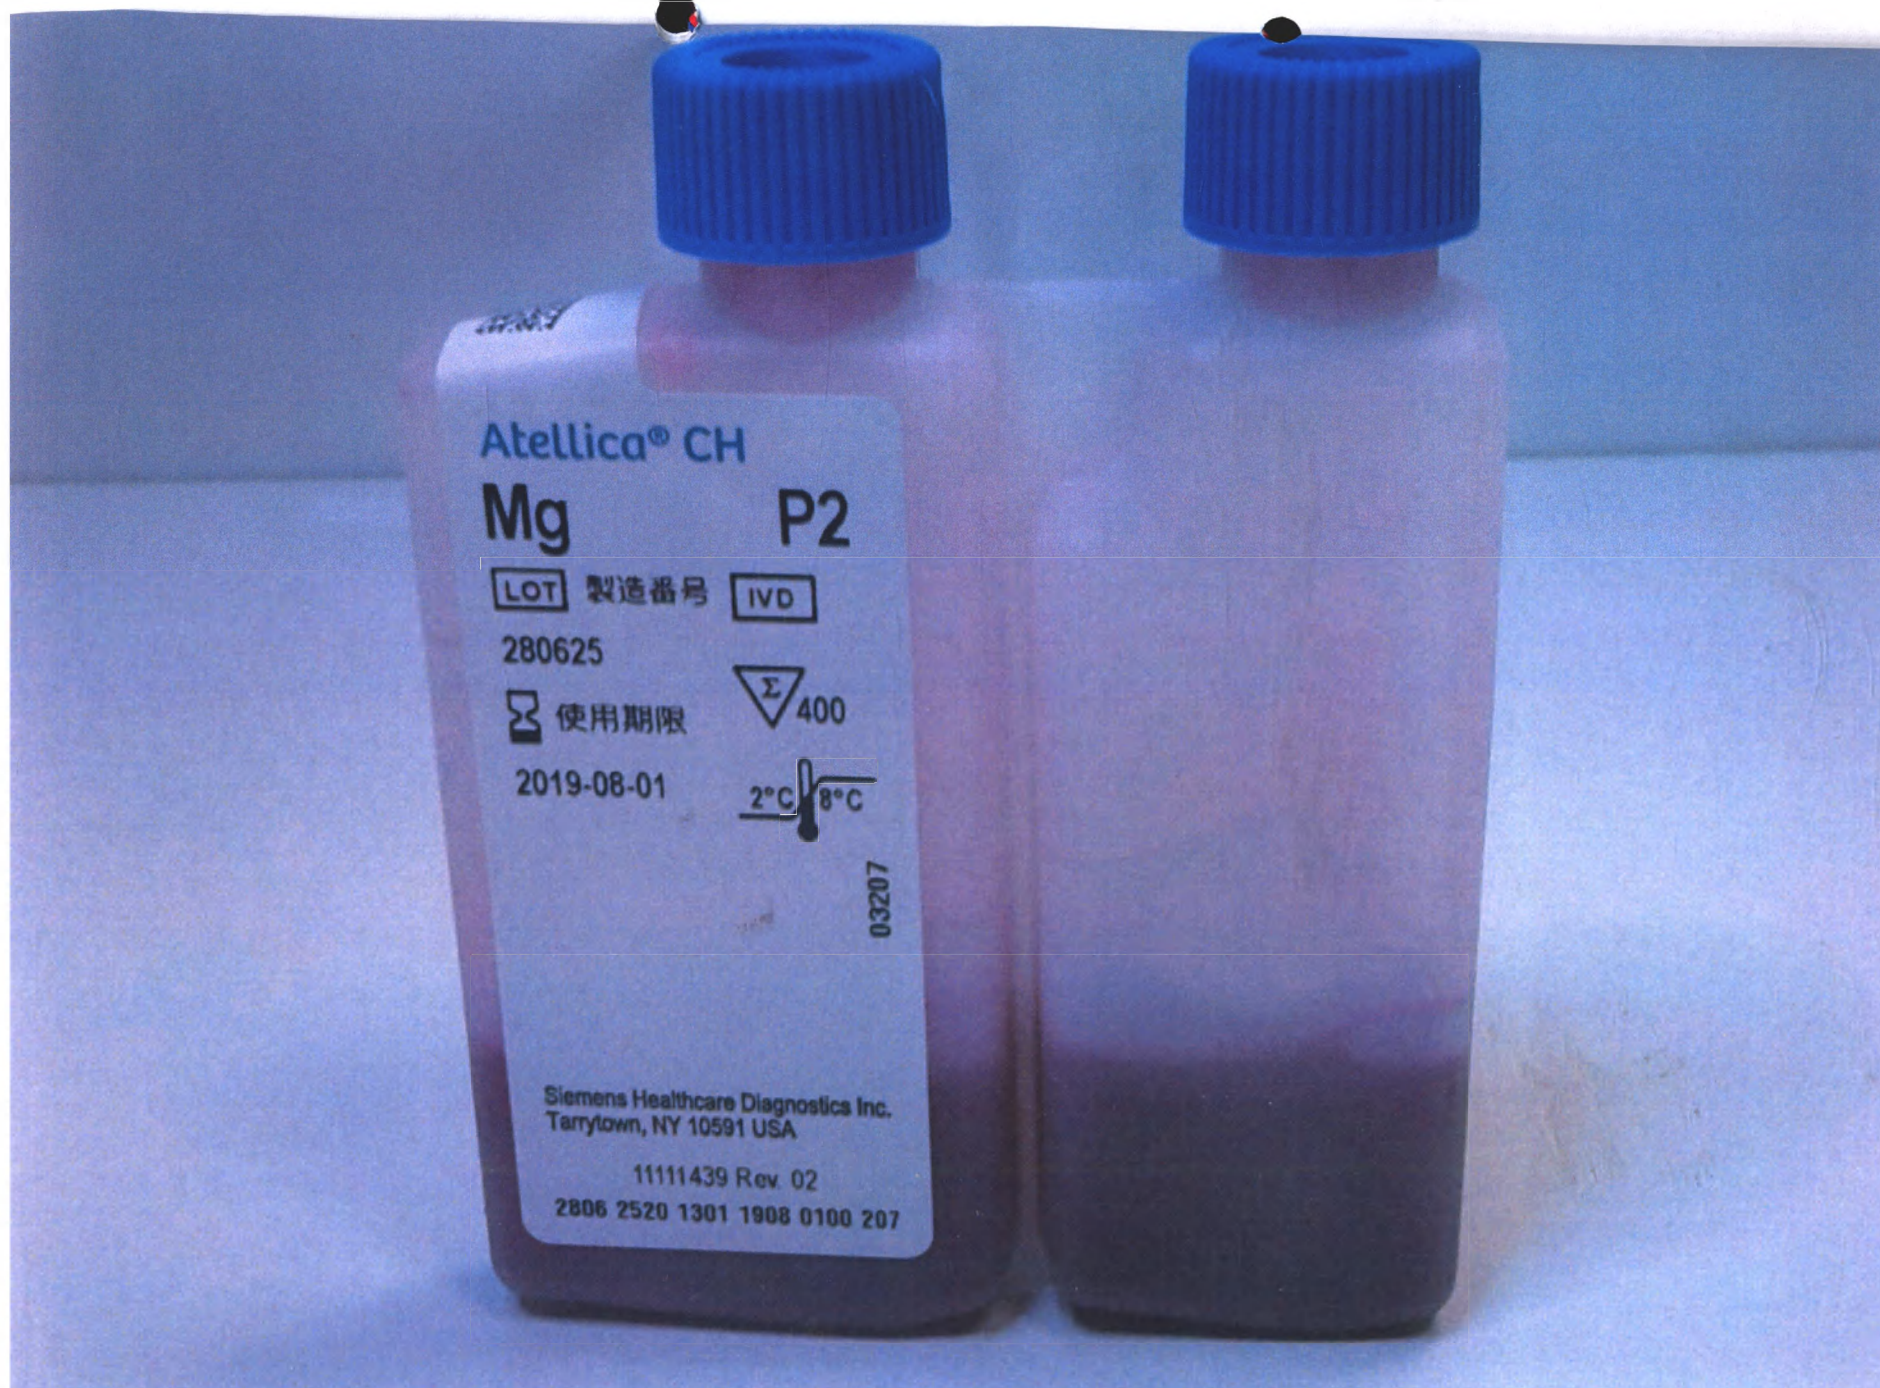


Рисунок 3 Набор реагентов для определения магния на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica CH Magnesium (Atellica CH Mg)): флаконы с реагентами, общий вид, упаковка 2.



Всего прошито и пронумеровано 4 листа (ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»