



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
“SARS-CoV-2-IgM-ИФА-БЕСТ”
 серия 1

Генеральный директор
 АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
 “26” 03 2020 г.
 М.П.

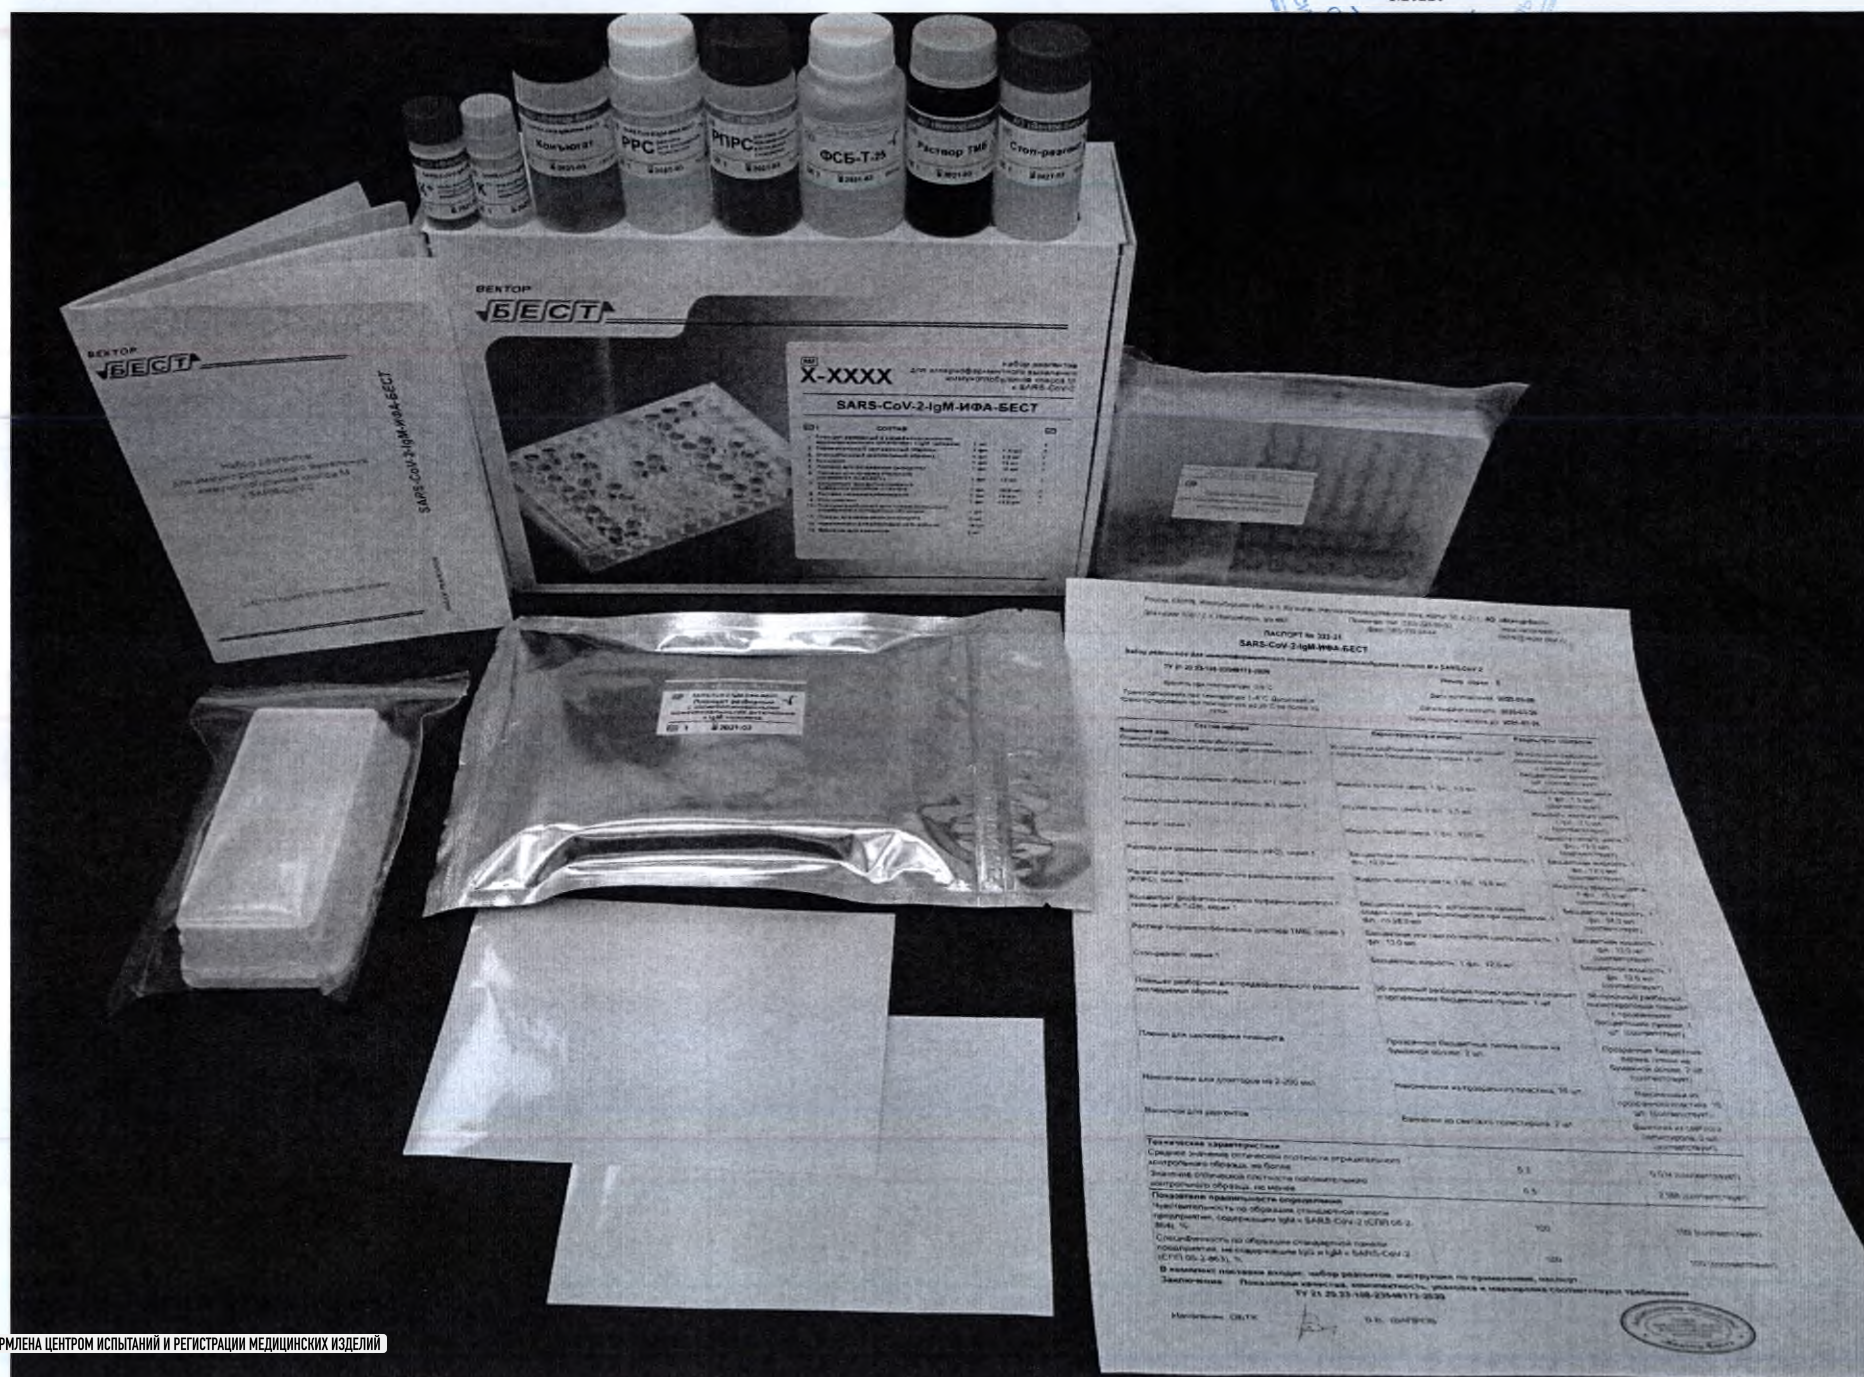


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“SARS-CoV-2-IgM-ИФА-БЕСТ” № 1
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“26” 03 2020 г.
М.П.

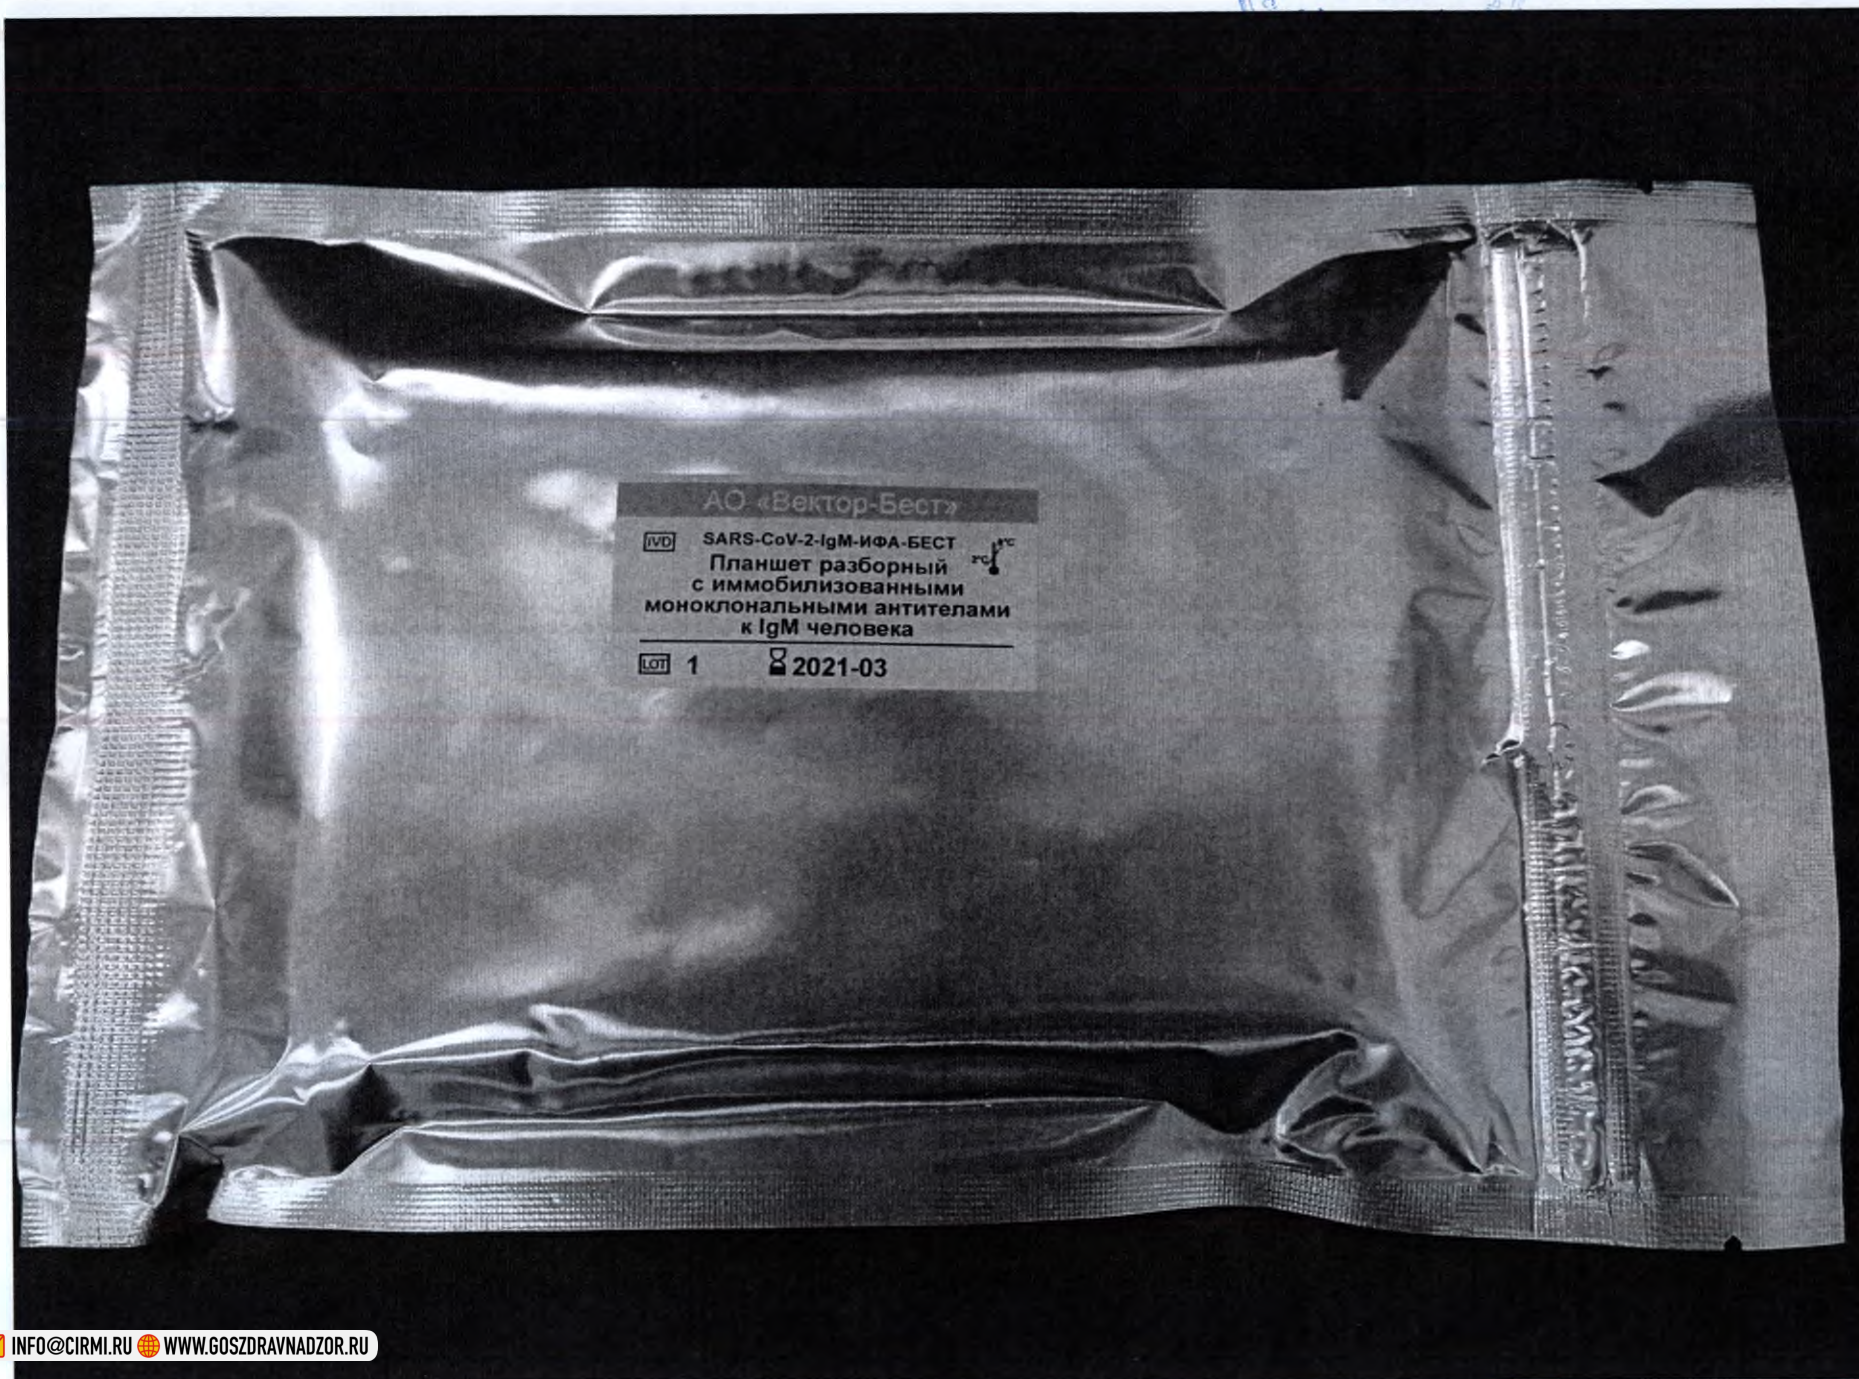



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“SARS-CoV-2-IgM-ИФА-БЕСТ” № 2
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“26” 03 2020 г.
М.П.

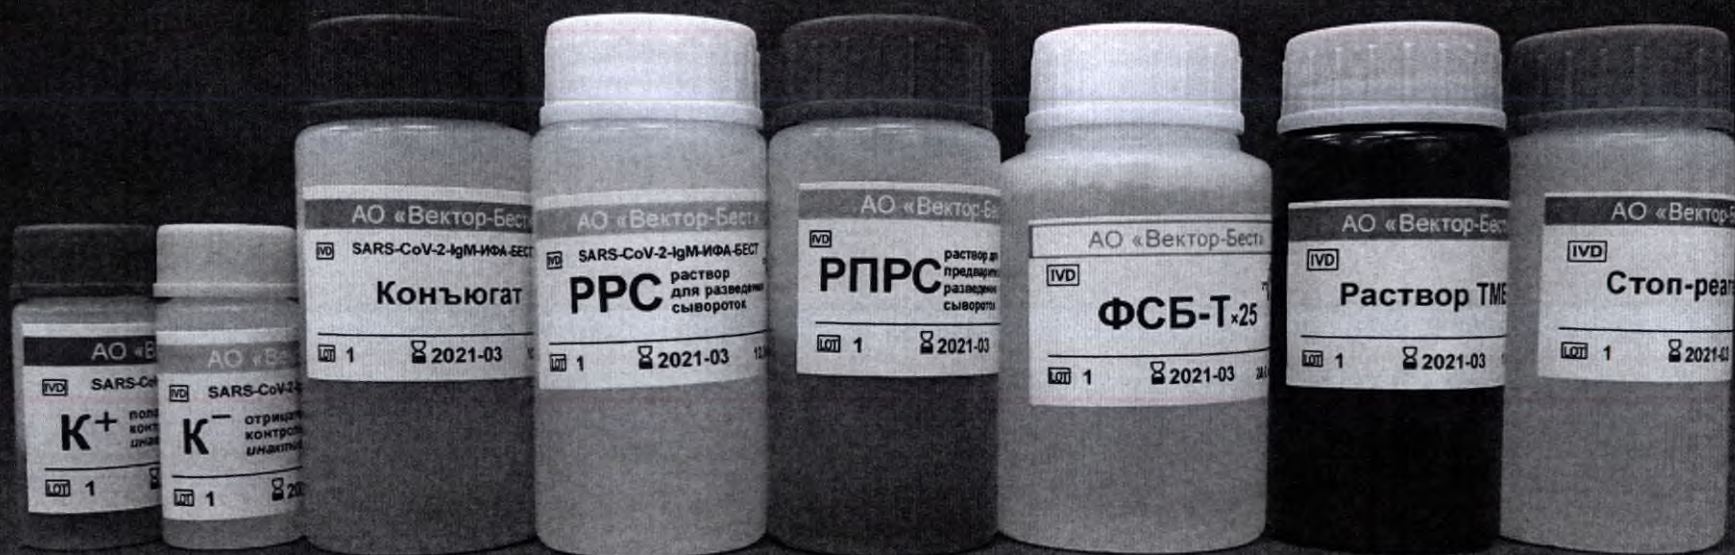



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“SARS-CoV-2-IgM-ИФА-БЕСТ” № 3
серия 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»  М.Д. Хусаинов
“26” 03 / 2020 г.
М.П. 

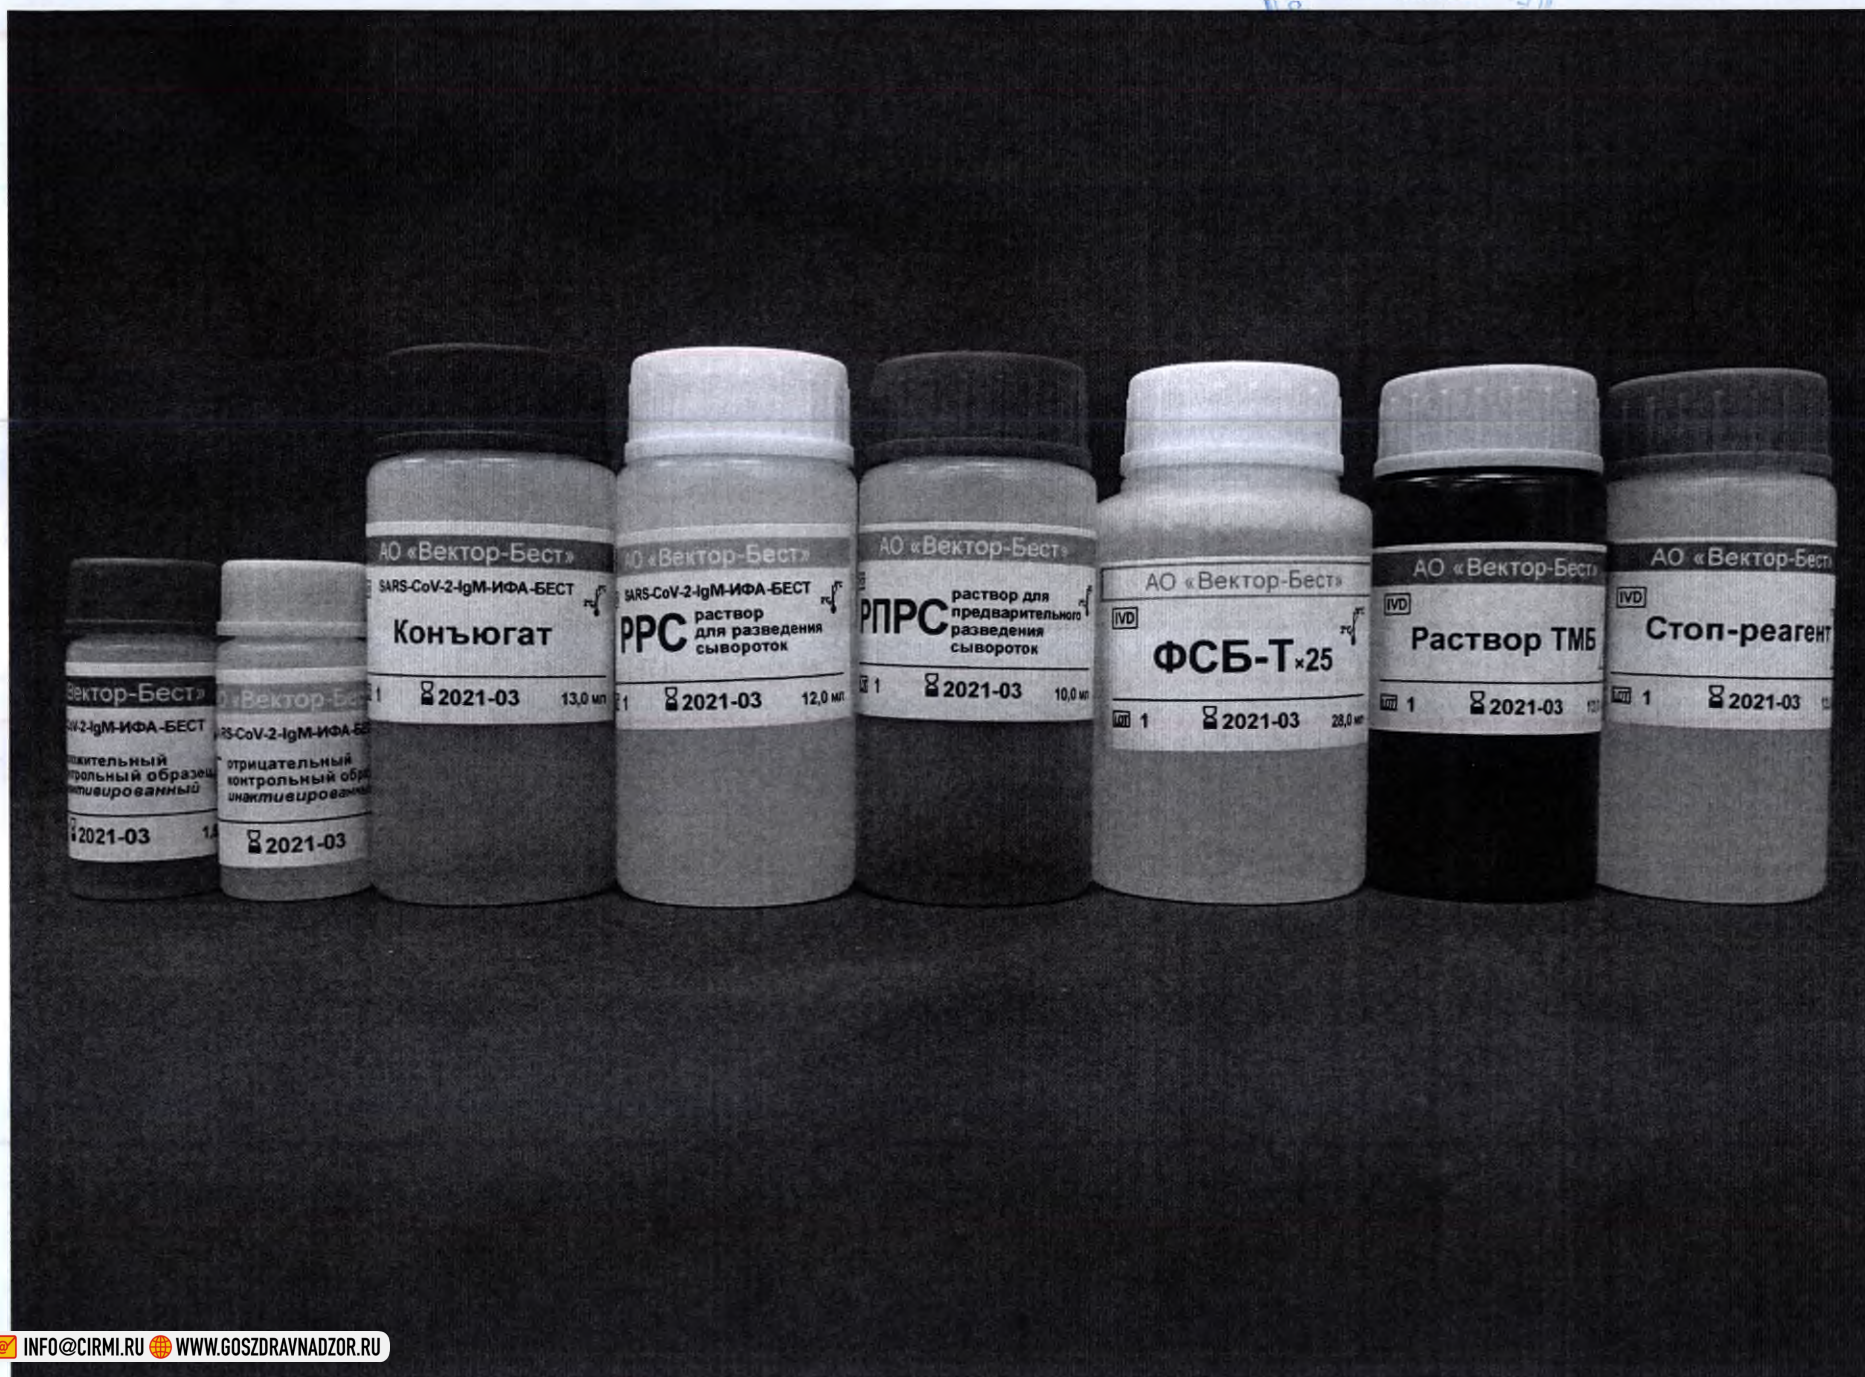


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"SARS-CoV-2-IgM-ИФА-БЕСТ" № 4
серия 1

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест"  М.Д. Хусаинов
"26" 03 2020 г.
 М.П.

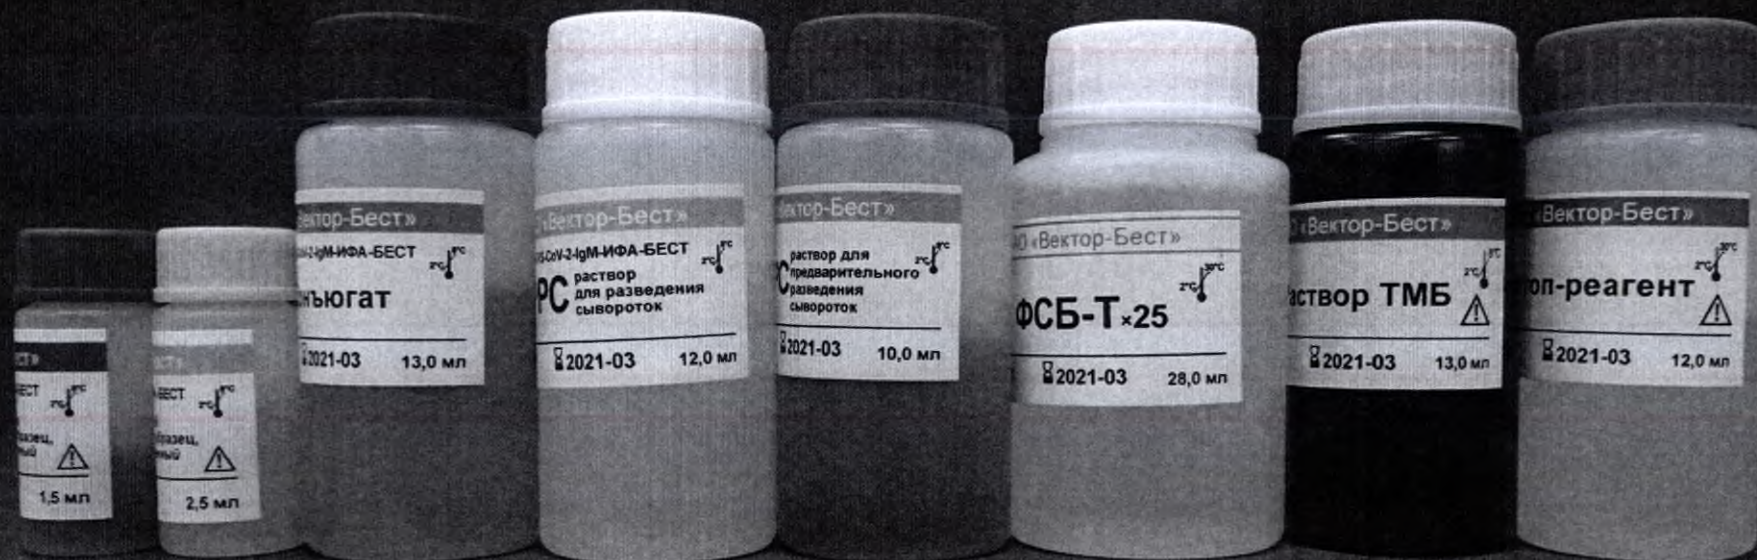


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"SARS-CoV-2-IgM-ИФА-БЕСТ" № 5
серия 1

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
"26" 03 2020 г.

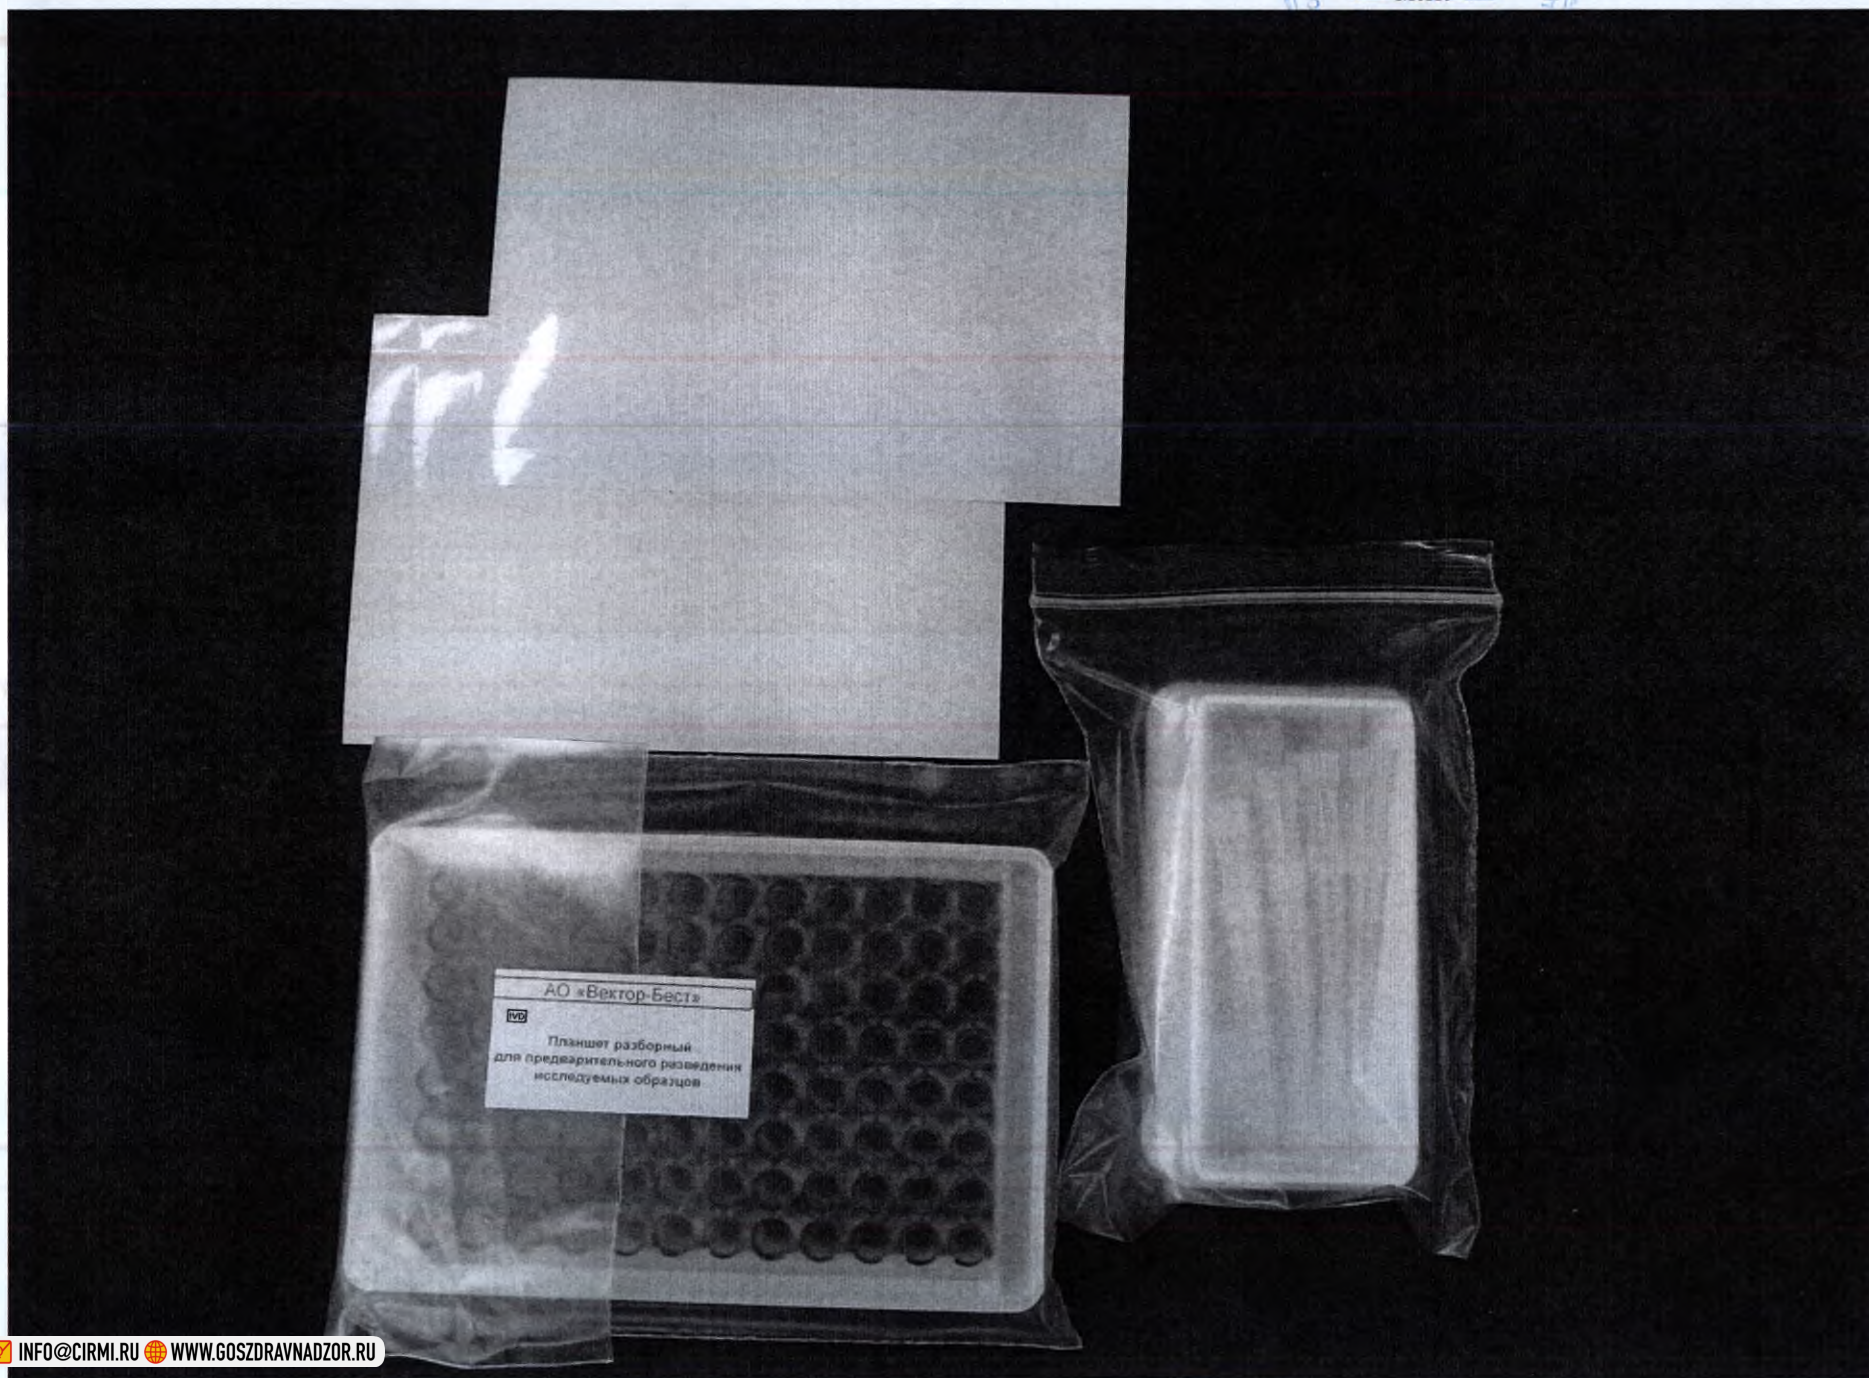

ВЕКТОР

БЕСТ

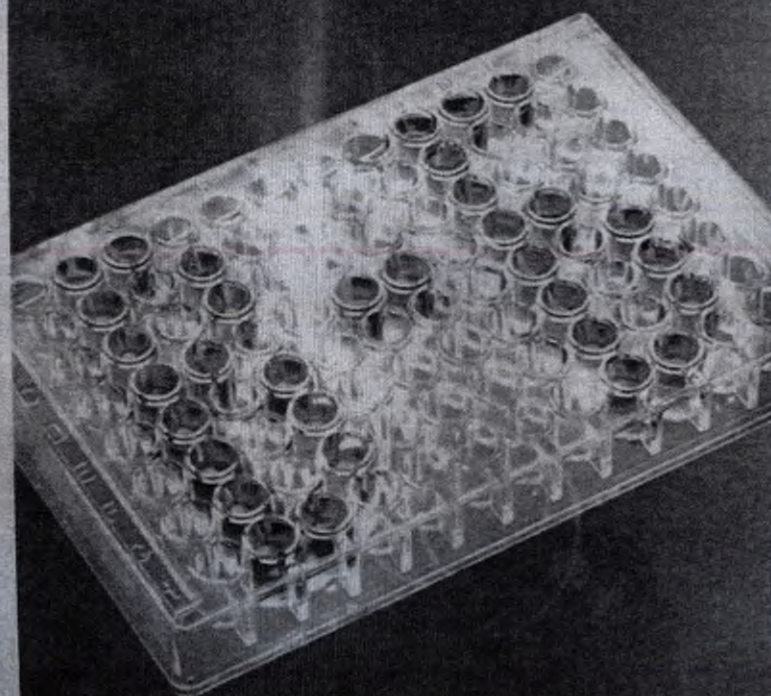

REF

X-XXXX

набор реагентов
для иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов класса М
к SARS-CoV-2

SARS-CoV-2-IgM-ИФА-БЕСТ

LOT 1

СОСТАВ:

LOT

1. Планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к IgM человека	1 шт.		1
2. Положительный контрольный образец,	1 фл.	1,5 мл	1
3. Отрицательный контрольный образец,	1 фл.	2,5 мл	1
4. Конъюгат	1 фл.	13 мл	1
5. Раствор для разведения сывороток	1 фл.	12 мл	1
6. Раствор для предварительного разведения сывороток	1 фл.	10 мл	1
7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	1 фл.	20,0 мл	1
8. Раствор тетраметилбензидина	1 фл.	13 мл	1
9. Стоп-реагент	1 фл.	12,0 мл	1
10. Планшет разборный для предварительного разведения исследуемых образцов	1 шт.		
11. Пленки для заклеивания планшета	2 шт.		
12. Наконечники для дозаторов на 2-200 мкл	16 шт.		
13. Ванночки для реагентов	2 шт.		

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"SARS-CoV-2-IgM-ИФА-БЕСТ" № 2
серия 1




Генеральный директор
АО "Вектор-Бест"

"26"

03

М.Д. Хусаинов
2020 г.

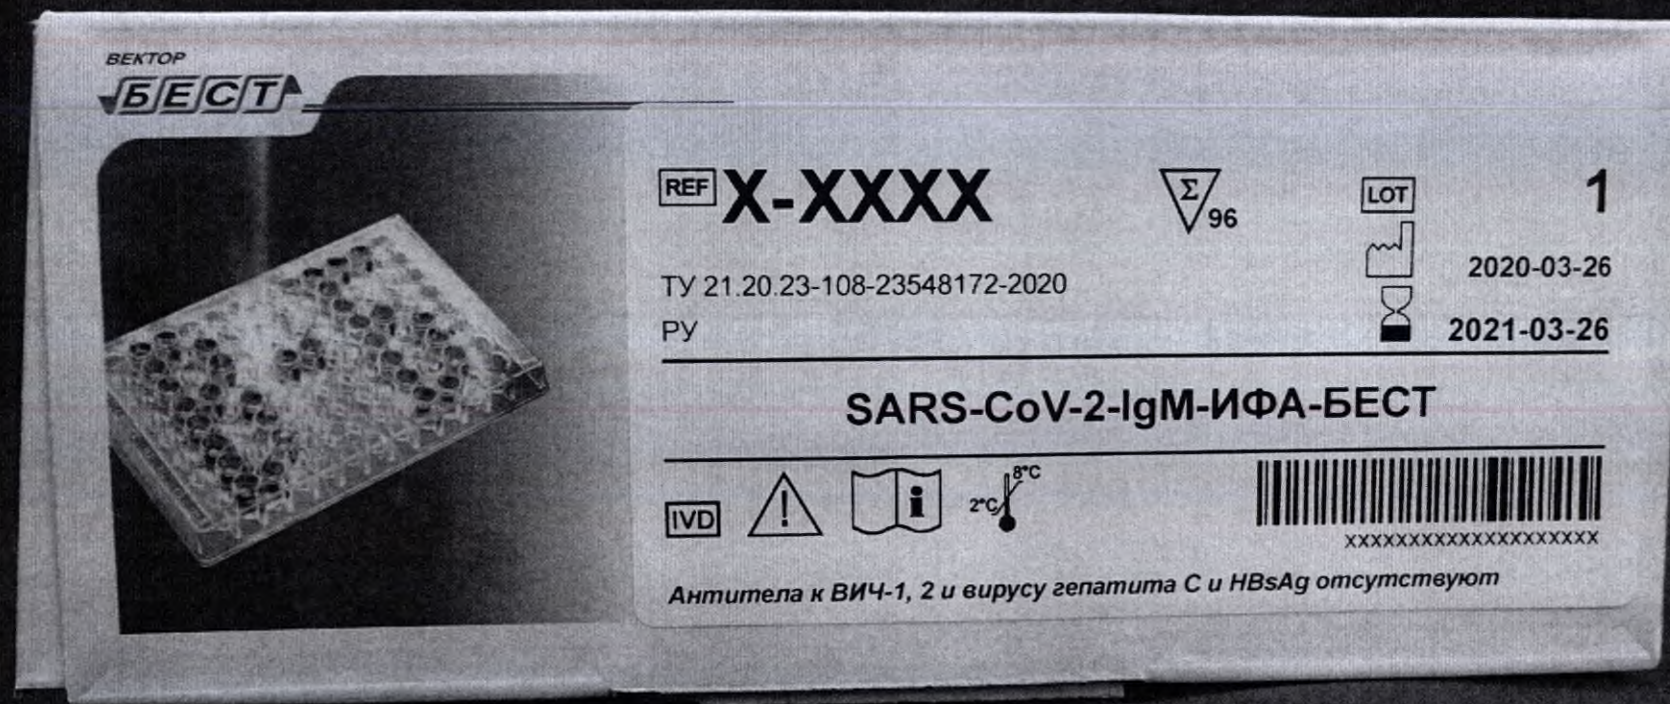

REF **X-XXXX**

Σ 96

LOT

1

TU 21.20.23-108-23548172-2020

PY

2020-03-26

2021-03-26

SARS-CoV-2-IgM-ИФА-БЕСТ


IVD



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Антитела к ВИЧ-1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“SARS-CoV-2-IgM-ИФА-БЕСТ” № 3
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”  М.Д. Хусаинов
“16” 03 2020 г.
 М.П.



АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52


E-mail: vbmarket@vector-best.ru

www.vector-best.ru

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
“SARS-CoV-2-IgM-ИФА-БЕСТ”
серия 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»
М.П.

М.Д. Хусанов
2020 г.

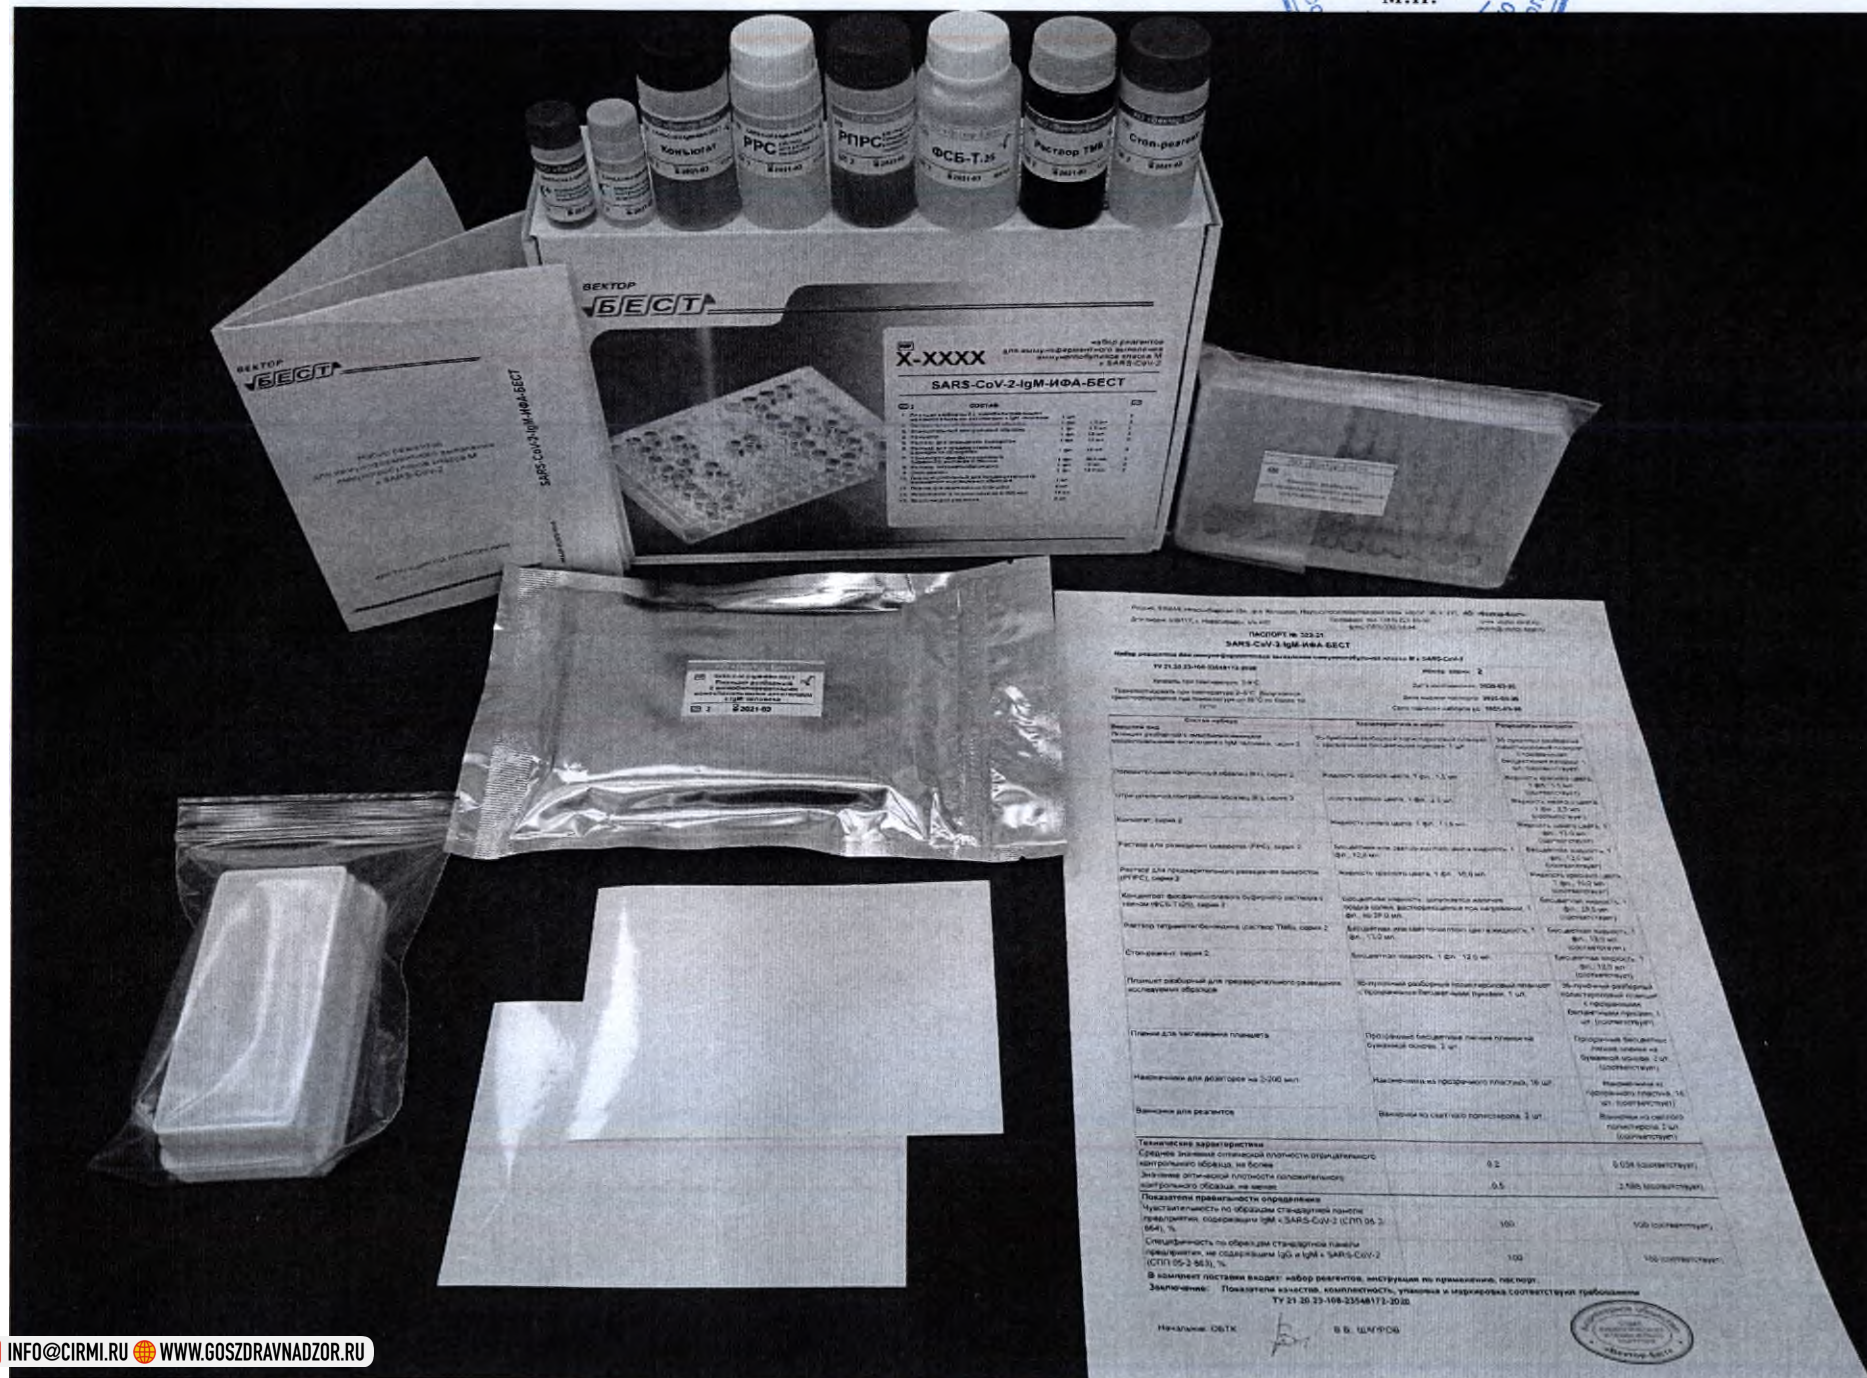


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"SARS-CoV-2-IgM-ИФА-БЕСТ" № 1
серия 2

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест"





М.Д. Хусаинов
2020 г.

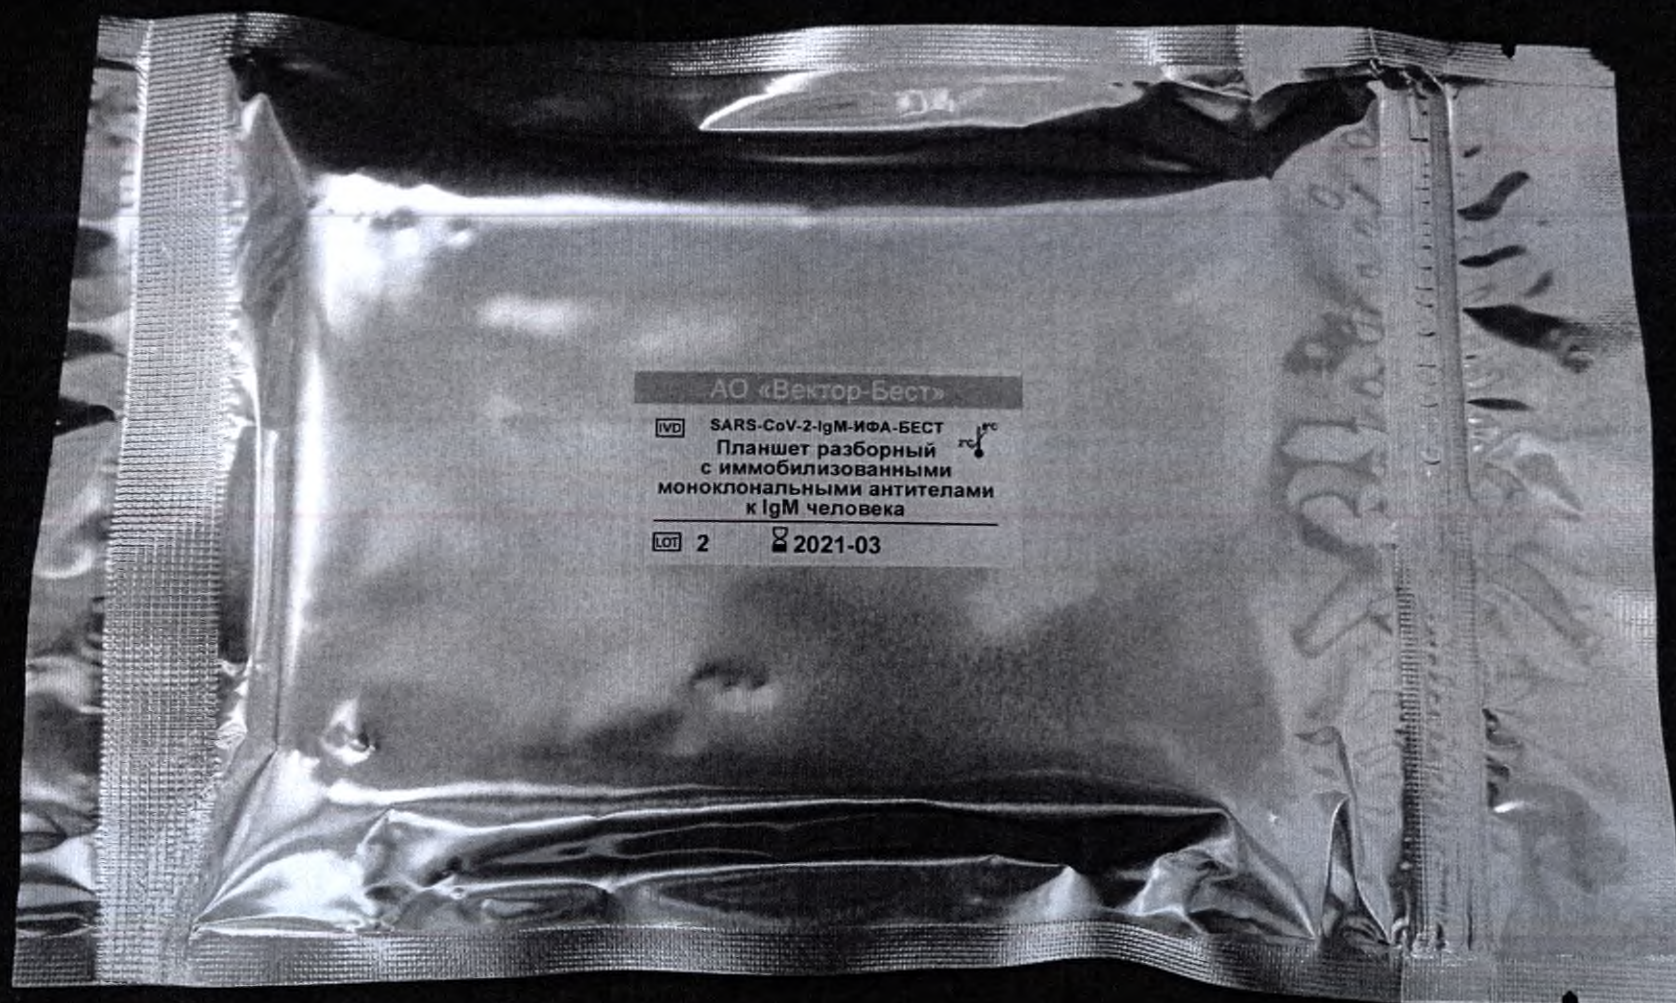

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"SARS-CoV-2-IgM-ИФА-БЕСТ" № 2
серия 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»


М.Д. Хусаинов
2020 г.

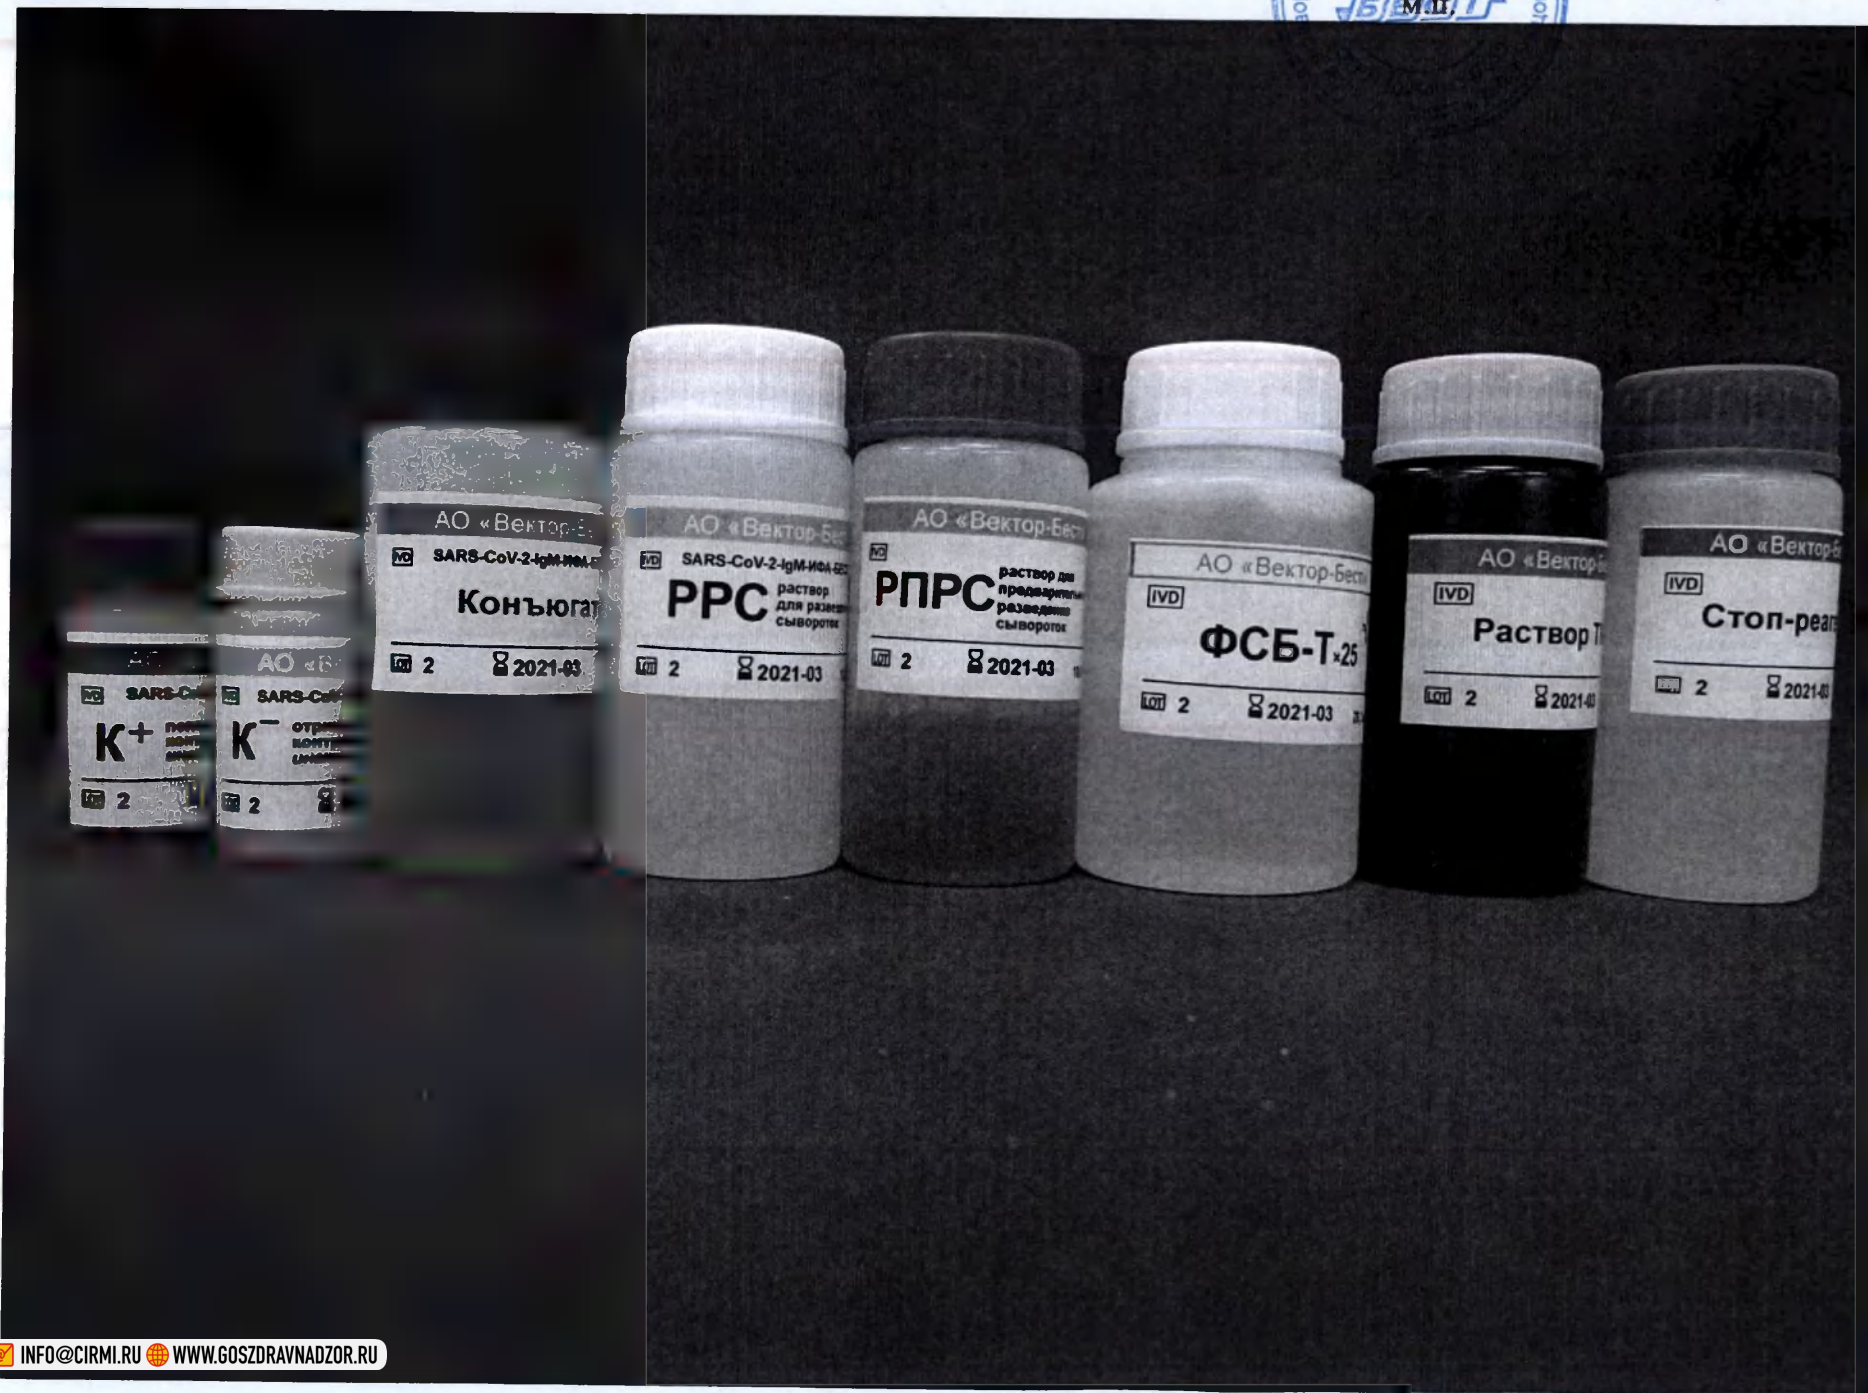

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"SARS-CoV-2-IgM-ИФА-БЕСТ" № 3
серия 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

М.Д. Хусаинов
2020 г.

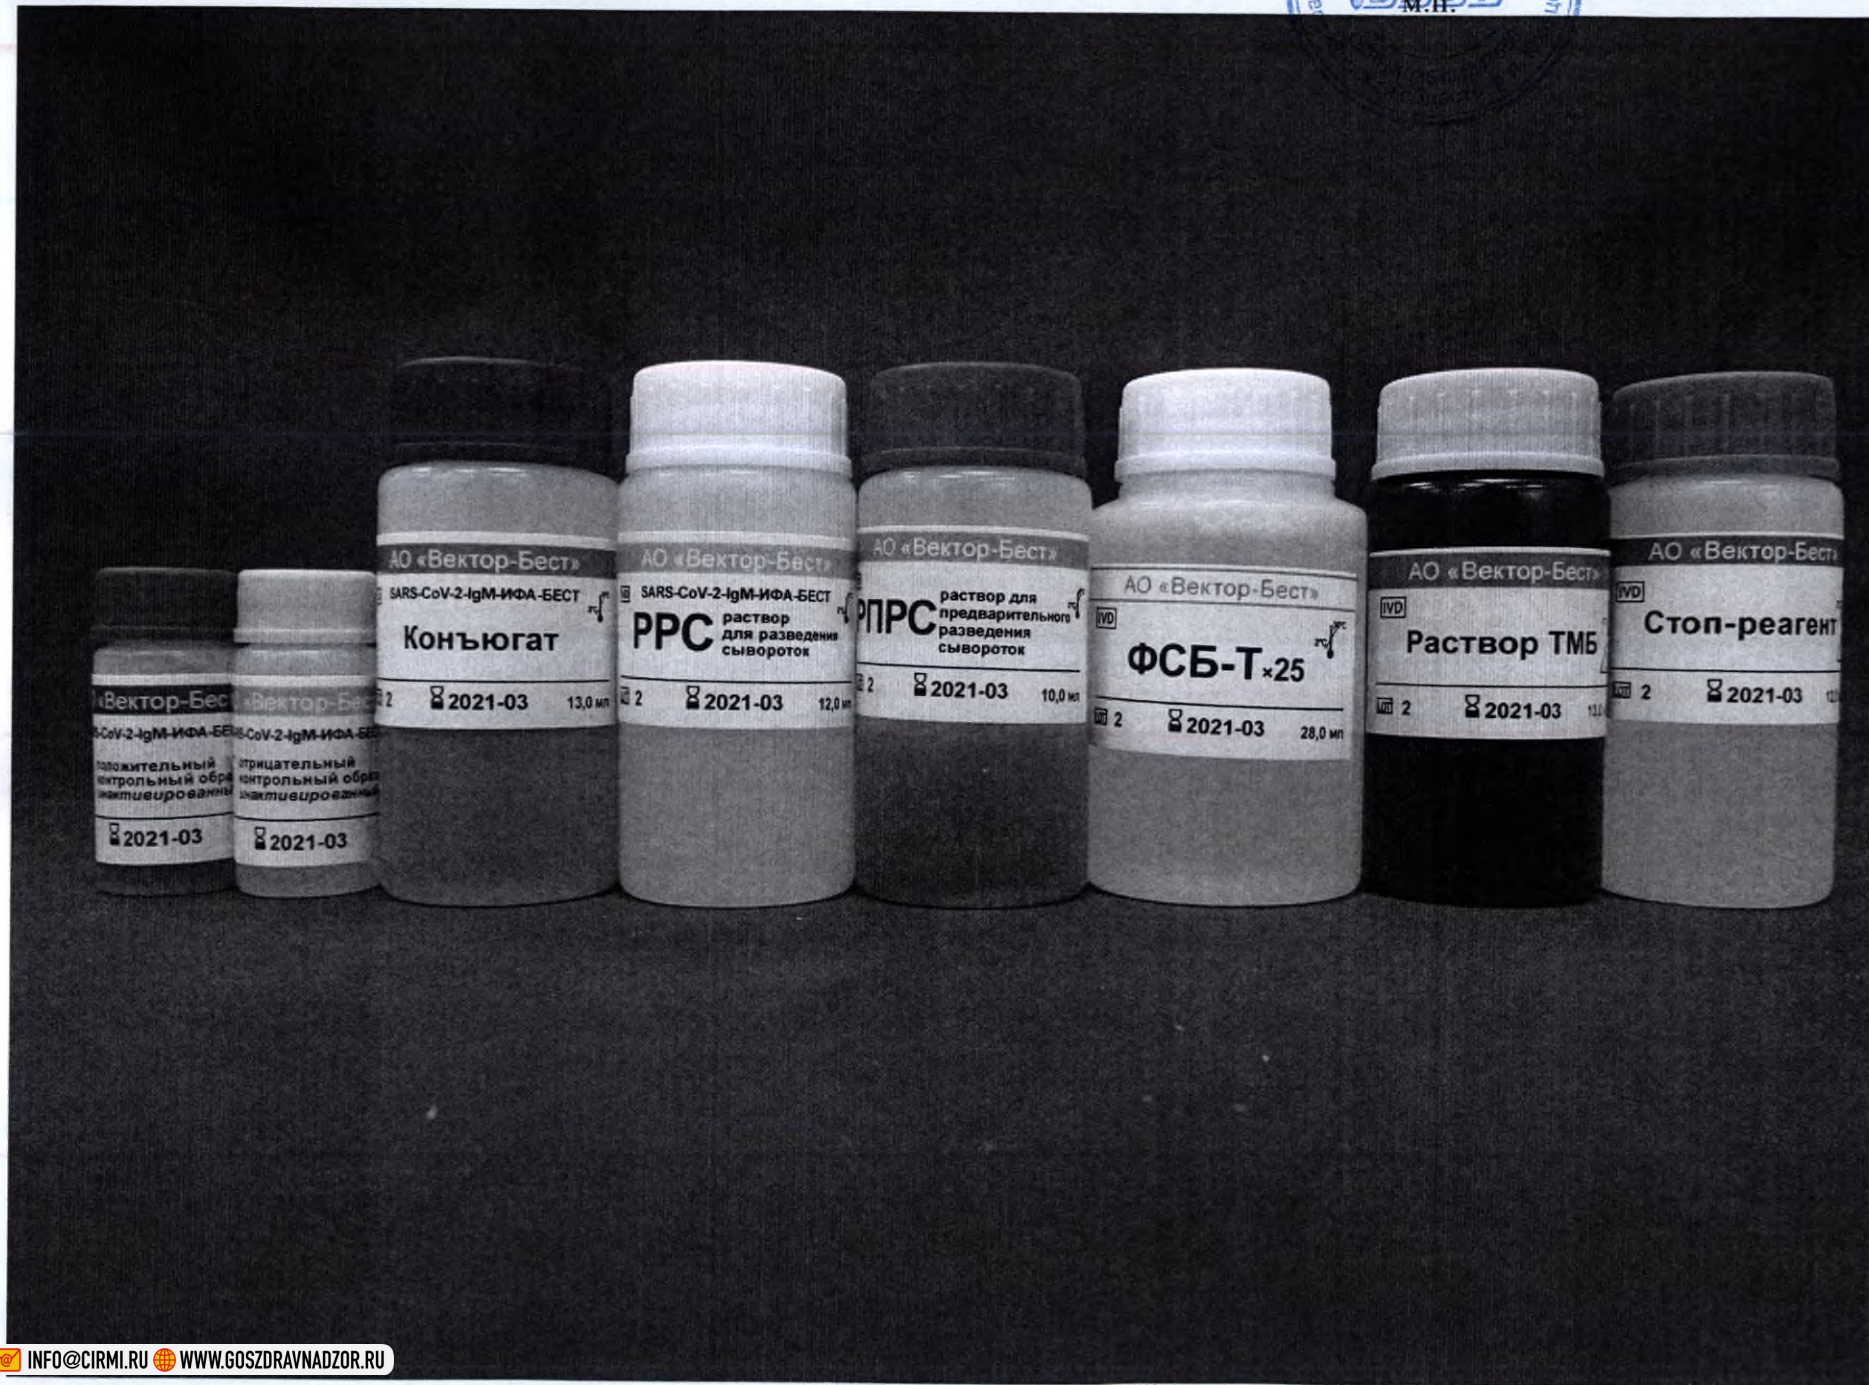


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"SARS-CoV-2-IgM-ИФА-БЕСТ" № 4
серия 2

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест"



26 03

М.Д. Хусаинов
2020 г.

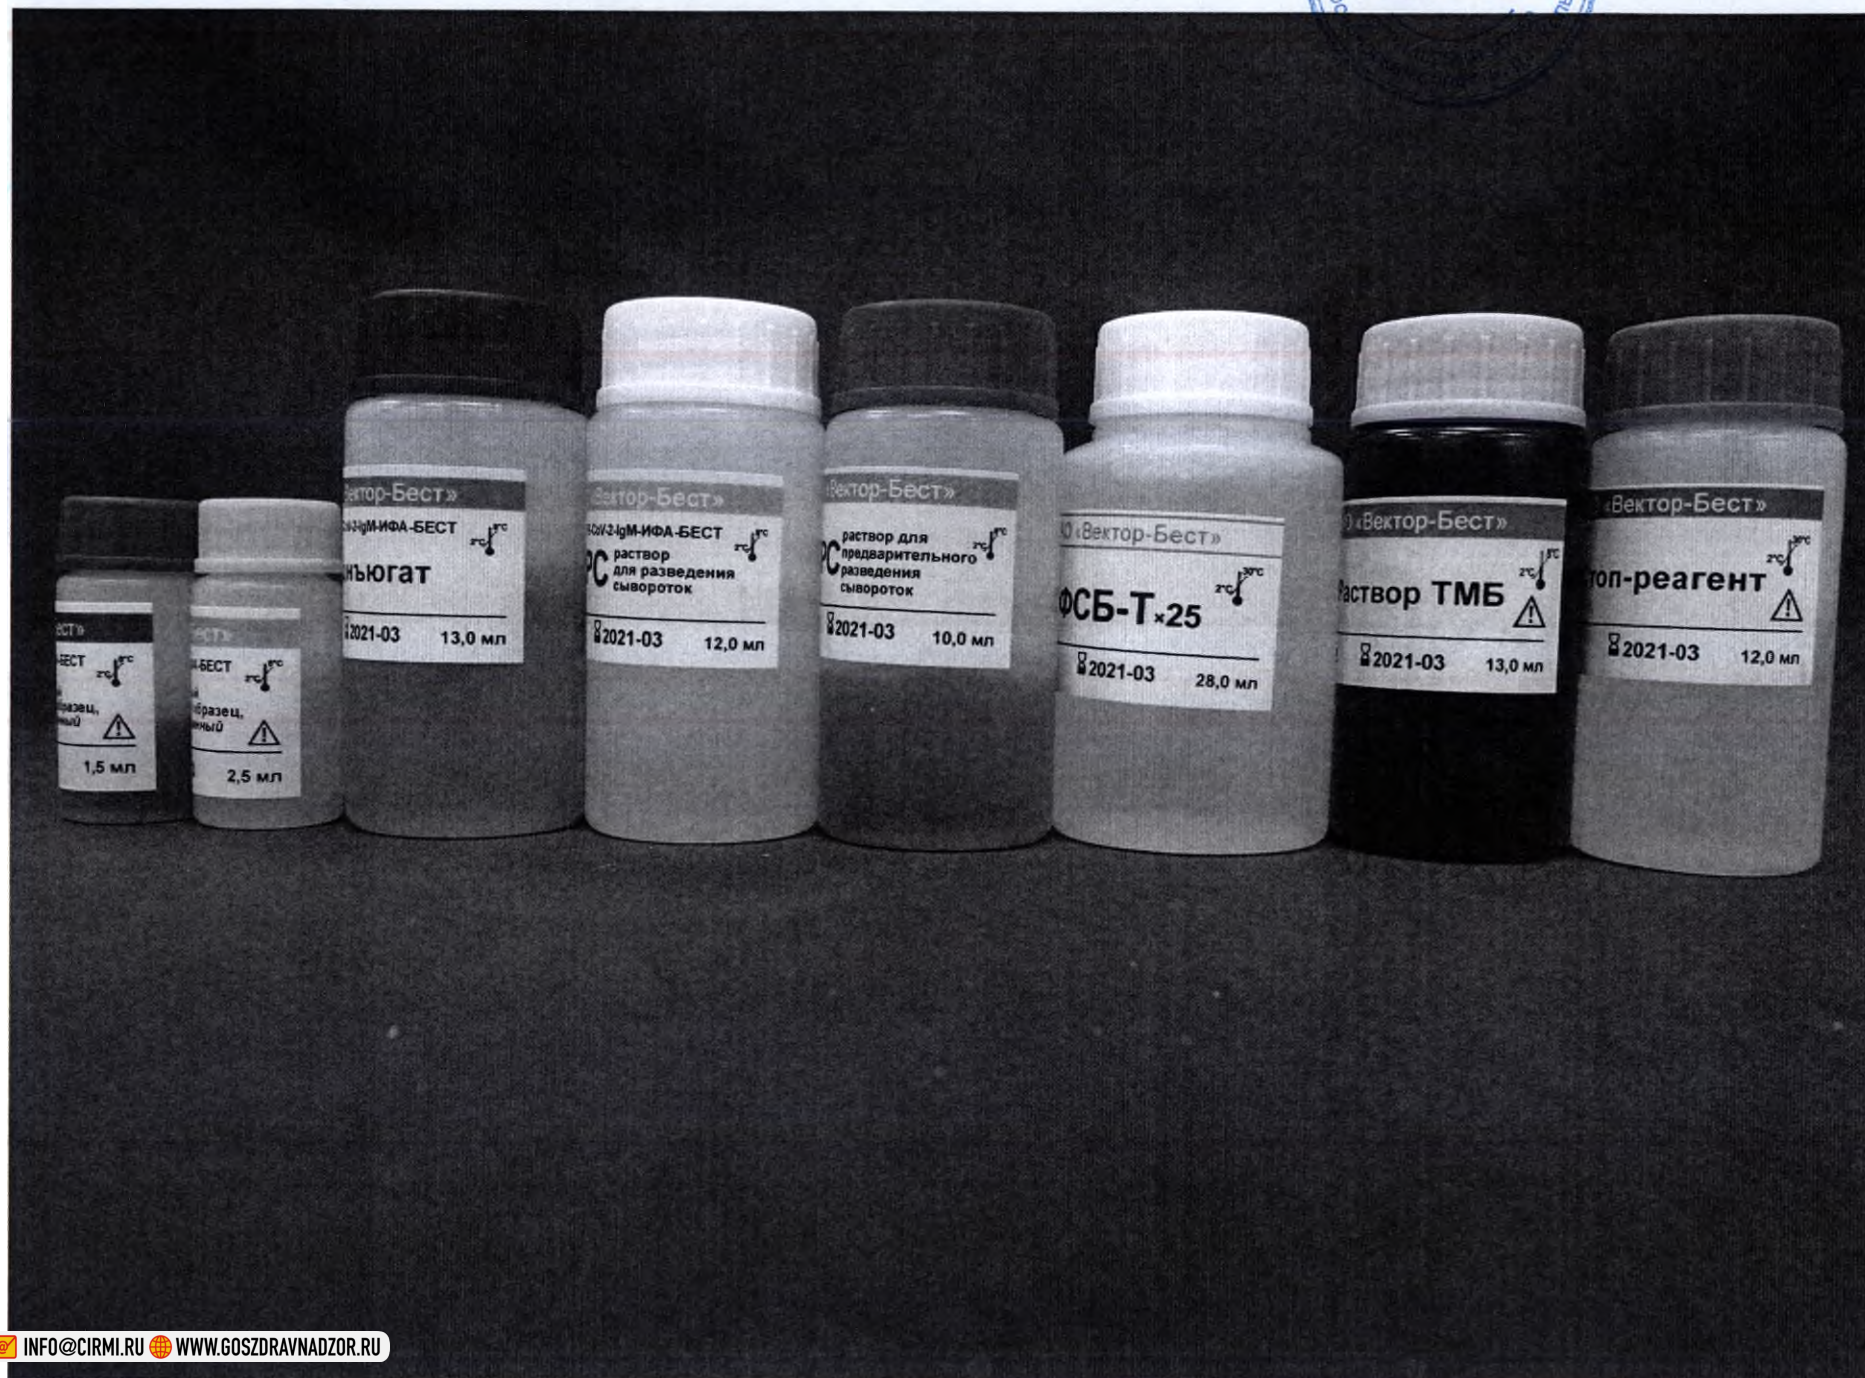

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"SARS-CoV-2-IgM-ИФА-БЕСТ" № 5
серия 2


Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



М.Д. Хусаинов
"26" 03/ 2020 г.



ВЕКТОР
БЕСТ

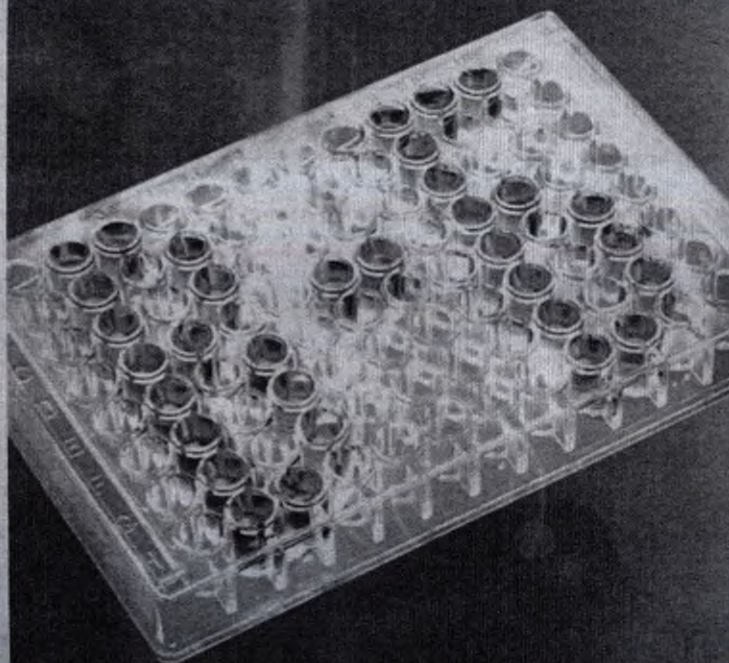

REF
X-XXXX

набор реагентов
 для иммуноферментного выявления
 иммуноглобулинов класса М
 к SARS-CoV-2

SARS-CoV-2-IgM-ИФА-БЕСТ

LOT 2

СОСТАВ:

LOT

1. Планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к IgM человека	1 шт.		2
2. Положительный контрольный образец,	1 фл.	1,5 мл	2
3. Отрицательный контрольный образец,	1 фл.	2,5 мл	2
4. Конъюгат	1 фл.	13 мл	2
5. Раствор для разведения сывороток	1 фл.	12 мл	2
6. Раствор для предварительного разведения сывороток	1 фл.	10 мл	2
7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	1 фл.	28,0 мл	2
8. Раствор тетраметилбензидина	1 фл.	13 мл	2
9. Стоп-реагент	1 фл.	12,0 мл	2
10. Планшет разборный для предварительного разведения исследуемых образцов	1 шт.		
11. Пленки для заклеивания планшета	2 шт.		
12. Наконечники для дозаторов на 2-200 мкл	18 шт.		
13. Ванночки для реагентов	2 шт.		


Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"SARS-CoV-2-IgM-ИФА-БЕСТ" № 2
серия 2

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест"



"26" 03

М.Д. Хусаинов
2020 г.

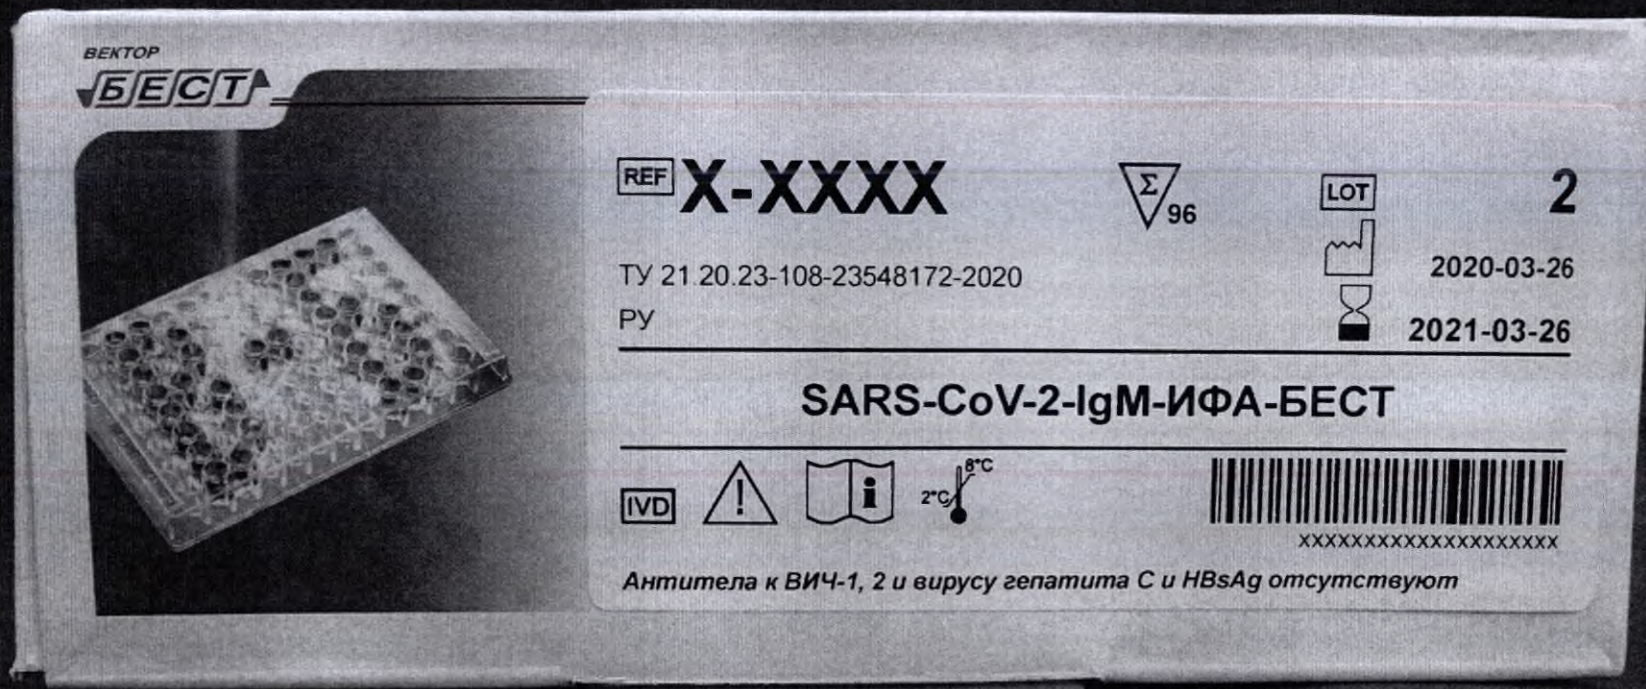

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"SARS-CoV-2-IgM-ИФА-БЕСТ" № 3
серия 2

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»

М.Д. Хусаинов

"26" 03 2020 г.



АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,

Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,

тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52

E-mail: vbmarket@vector-best.ru

www.vector-best.ru



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»

М.Д. Хусаинов

2020 г.

**Образцы маркировки на Набор реагентов
для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к SARS-CoV-2
(SARS-CoV-2-IgM-ИФА-БЕСТ)**

1. Образцы этикеток на компоненты набора “SARS-CoV-2-IgM-ИФА-БЕСТ”

Наименование компонента	Этикетка
Планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к IgM человека	
Положительный контрольный образец (K+)	
Отрицательный контрольный образец (K-)	
Конъюгат	
Раствор для разведения сывороток (PPC)	
Раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС)	
Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25)	

Наименование компонента	Этикетка
Раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ)	
Стоп-реагент	
Планшет разборный для предварительного разведения исследуемых образцов	

2. Образцы этикеток на коробке набора “SARS-CoV-2-IgM-ИФА-БЕСТ”

2.1. Верхняя этикетка.

REF	X-XXXX		набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к SARS-CoV-2	
SARS-CoV-2-IgM-ИФА-БЕСТ				
LOT XXXX	Состав:			LOT
1. Планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к IgM человека 1 шт. xxxx 2. Положительный контрольный образец 1 фл., 1,5 мл xxxx 3. Отрицательный контрольный образец 1 фл., 2,5 мл xxxx 4. Конъюгат 1 фл., 13,0 мл xxxx 5. Раствор для разведения сывороток 1 фл., 12,0 мл xxxx 6. Раствор для предварительного разведения сывороток 1 фл., 10,0 мл xxxx 7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином 1 фл., 28,0 мл xxxx 8. Раствор тетраметилбензидина 1 фл., 13,0 мл xxxx 9. Стоп-реагент 1 фл., 12,0 мл xxxx 10. Планшет разборный для предварительного разведения исследуемых образцов 1 шт. 11. Пленки для заклеивания планшета 2 шт. 12. Наконечники для дозаторов на 2-200 мкл 16 шт. 13. Ванночки для реагентов 2 шт.				

2.2. Боковая этикетка № 1.

REF	X-XXXX	Σ 96	LOT	XXXX
ТУ 21.20.23-108-23548172-2020 ПУ №			XXXX-XX-XX	XXXX-XX-XX
SARS-CoV-2-IgM-ИФА-БЕСТ				
IVD	2°C	XXXXXXXXXXXXXXXX		
<i>Антитела к ВИЧ-1,2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют</i>				

2.3. Боковая этикетка № 2.

АО «Вектор-Бест»
Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211
тел/факс: (383) 332-67-49, 332-67-52
E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru

Примечание. Текст боковой этикетки № 2 может быть нанесен непосредственно на коробку типографским способом.

«СОГЛАСОВАНО»
Директор НИИСД
АО «Вектор-Бест»

М.Ю. Рукавишников
«26» ав 2020 г.

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 3 листов.

Директор по технологии и качеству
АО "Вектор-Бест"



Масяго Масяго А.В.
03 20 20 г.