

**Кресло оториноларингологическое
«Клер» по ТУ 32.50.30-001-03456315-2019, варианты
исполнения КЛЭМ и КЛЭМ-К**

Фотографические изображения



ООО ТПФ "Клер" РУ -

Кресло оториноларингологическое "Клер"

по ТУ 32.50.30-001-03456315-2019

вариант исполнения КЛЭМ

Кл.1, тип В, IP21, 360ВА, 220В~, 50Гц

Заводской номер № 2

Дата изготовления ОКТЯБРЬ 2019 г

 Clear
медицинское оборудование


426006 Удмуртская Республика, г.

Ижевск, ул. Баранова, д. 33А

тел. (3412) 971-325 www.clear18.com



ИМ04

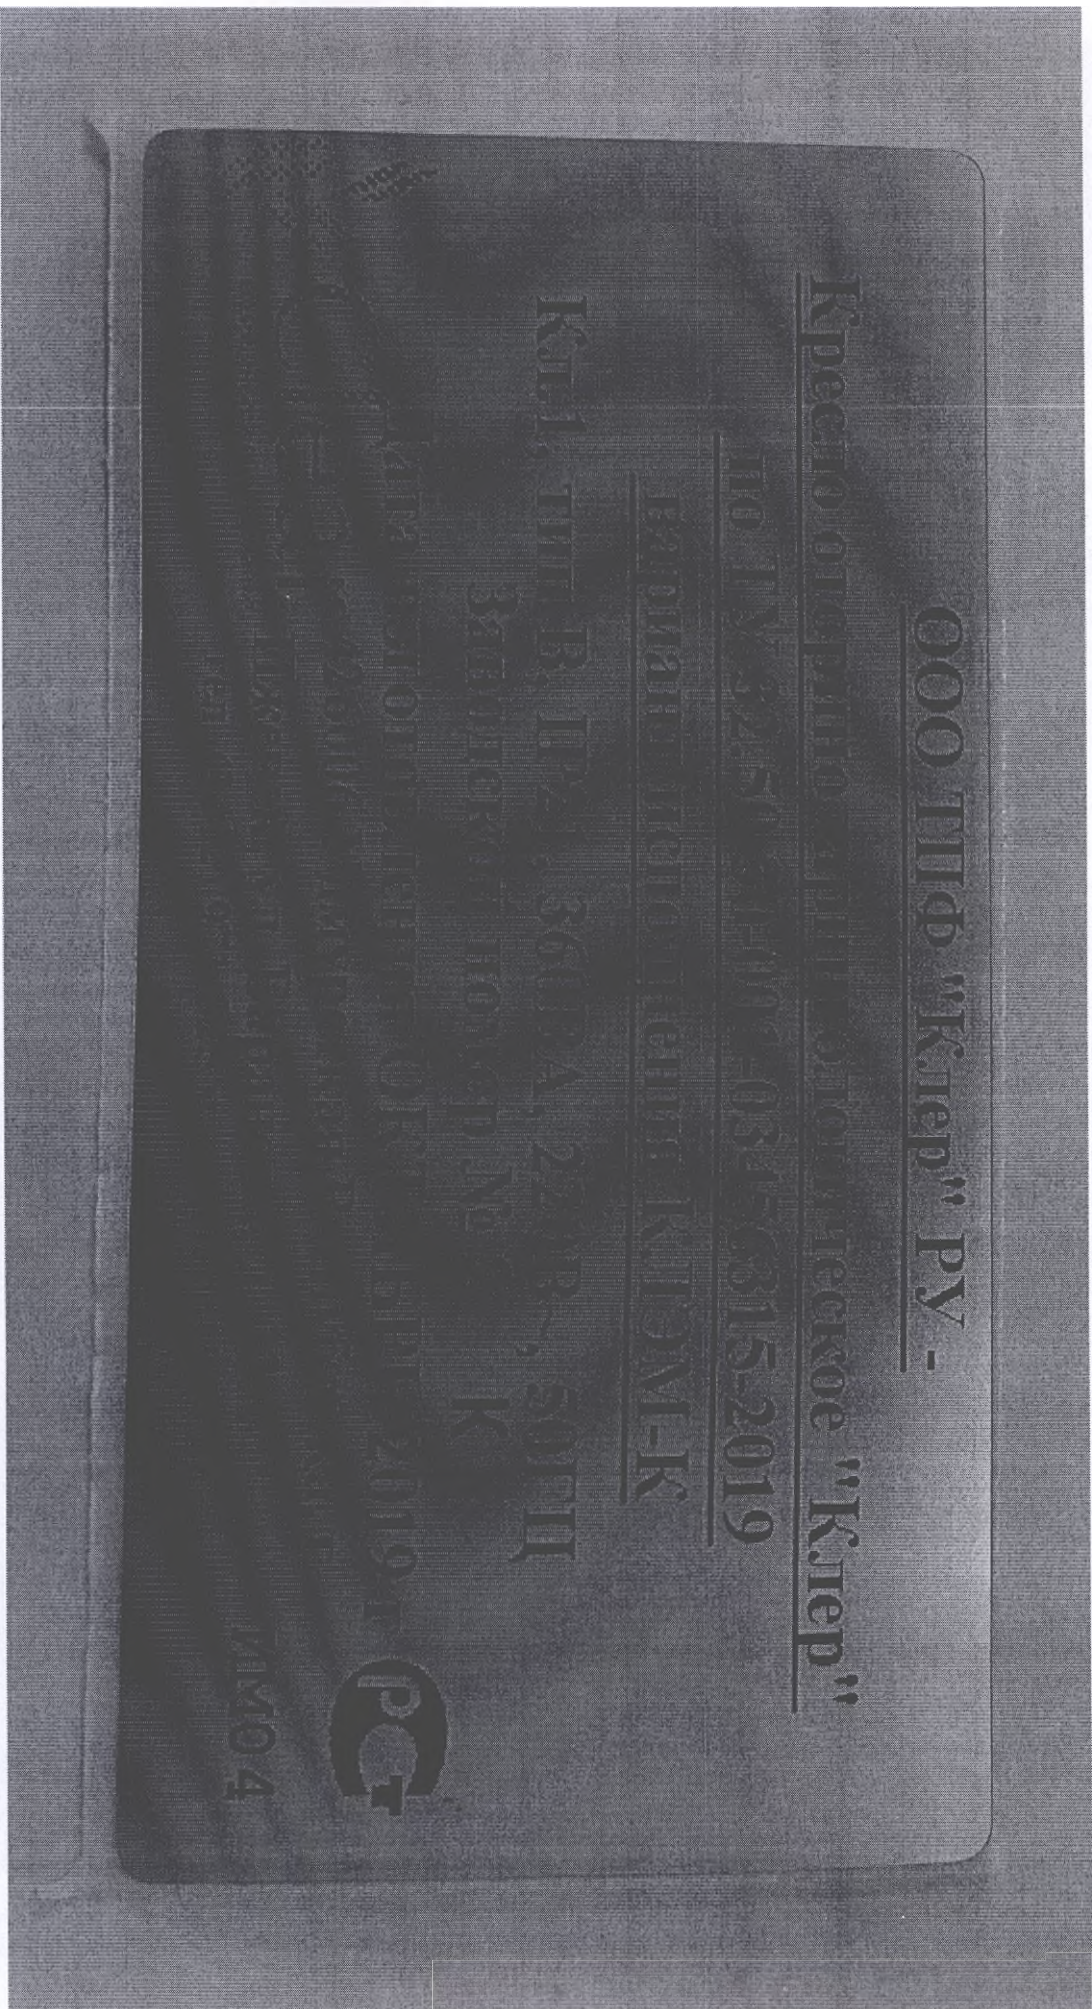

ООО ТШФ "Клер" РУ -

Кресло оториноларингологическое "Клер"

по ТУ 32.50.30-001-03456315-2019

вариант исполнения КЛЭМ-К

Клн, тип В, Пр, 360°РА, 22,0 В., 50Гц


Затворка, по форме К


Материал: пластик, металл, ткань, кожа



УМ04

Рисунок 2 – Маркировка. Кресло оториноларингологическое «Клер» по ТУ 32.50.30-001-03456315-2019,

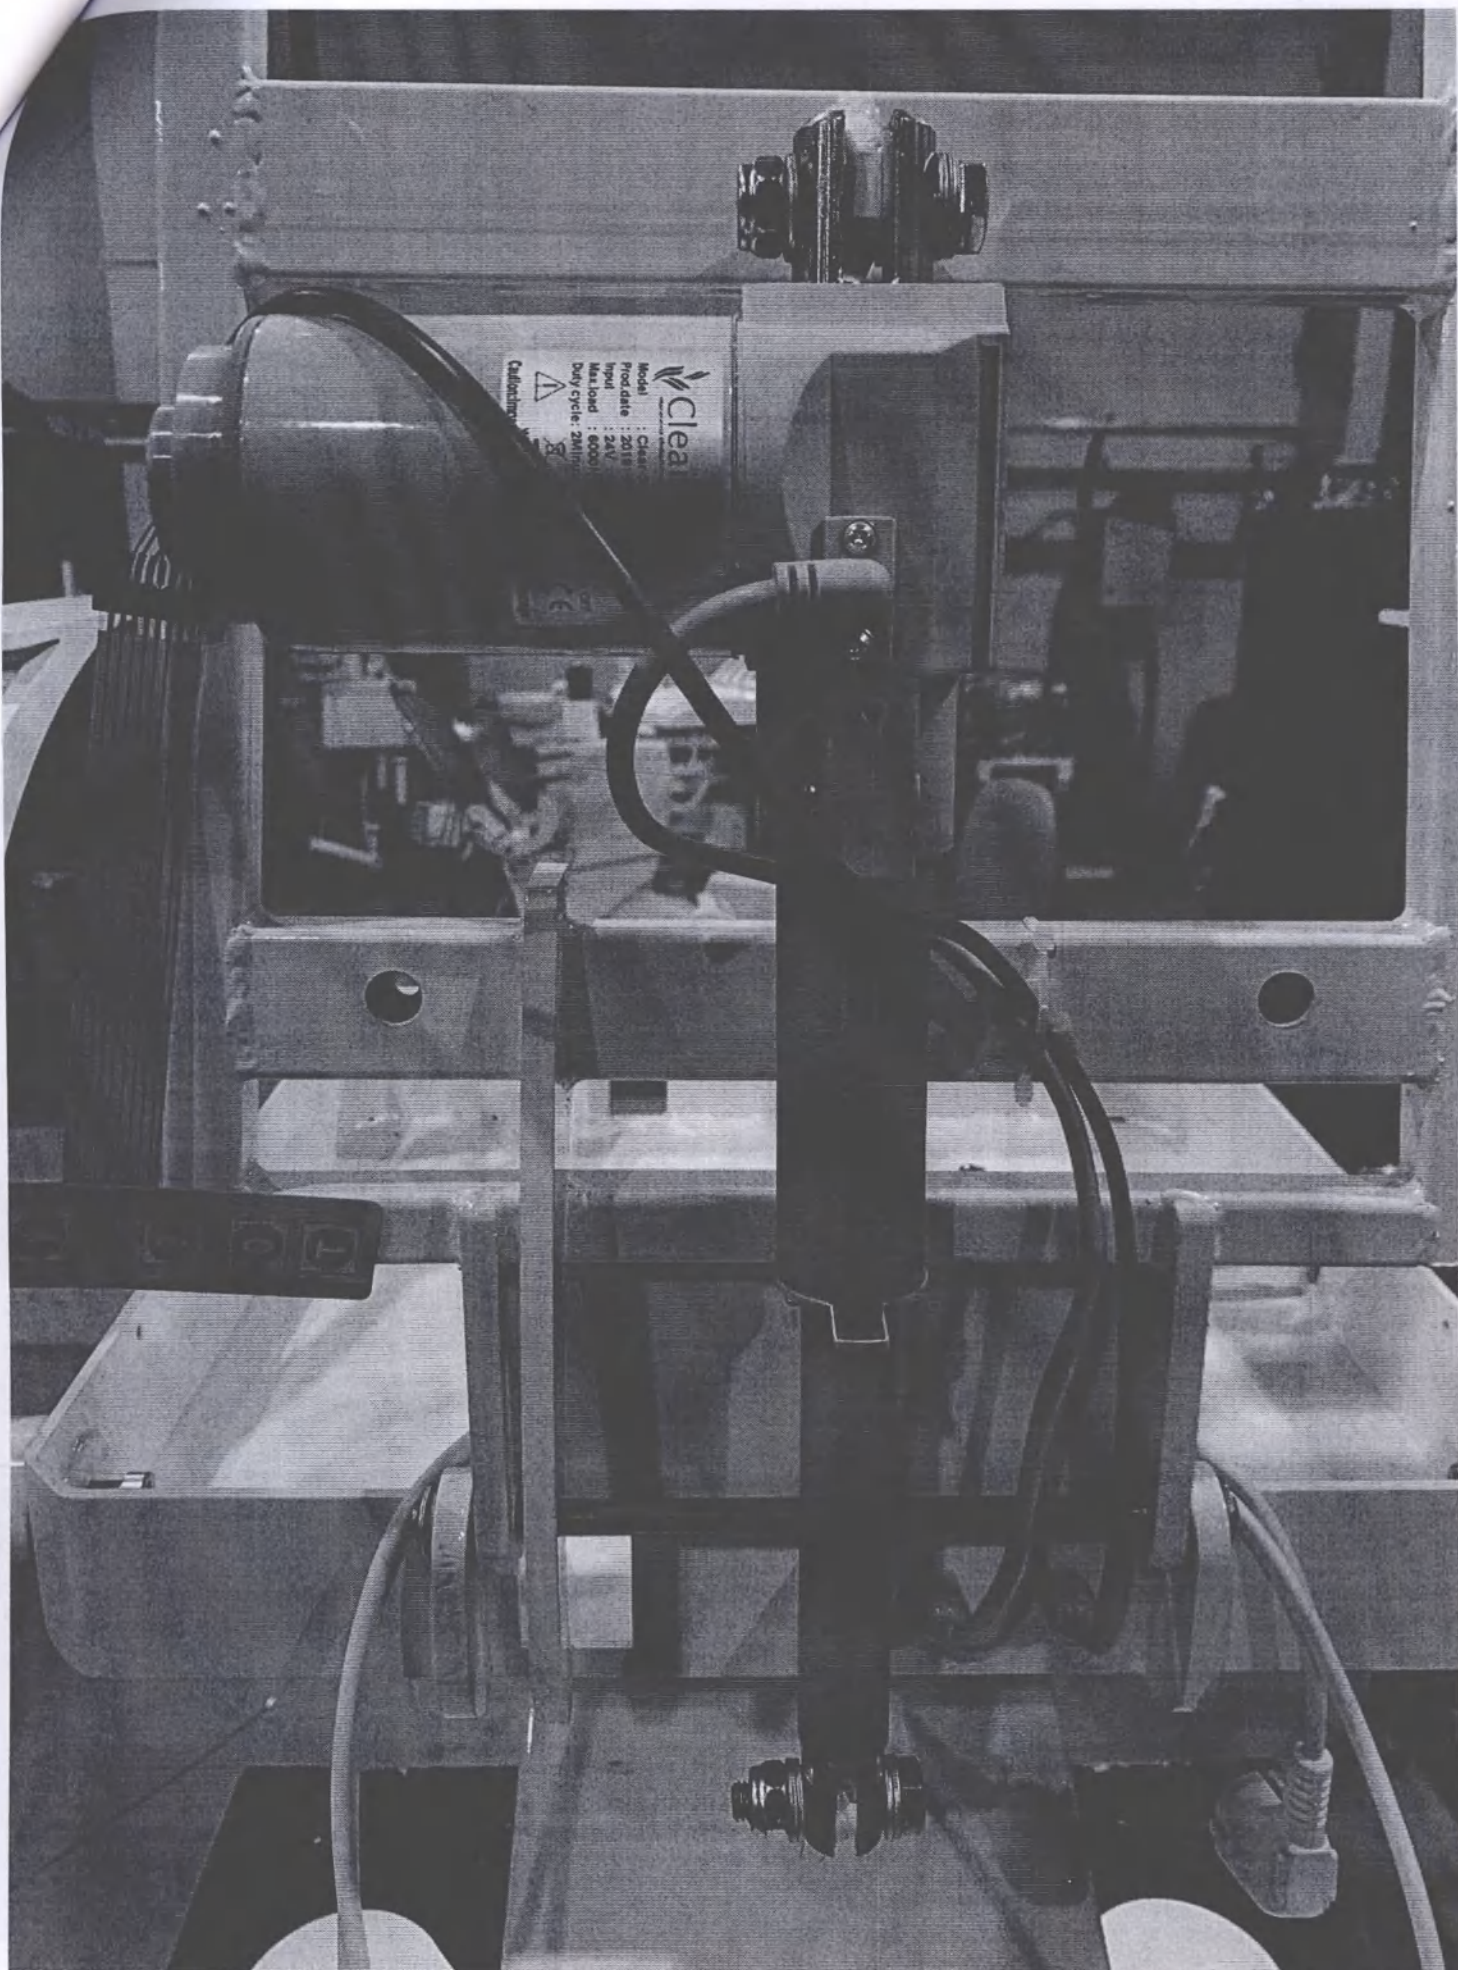

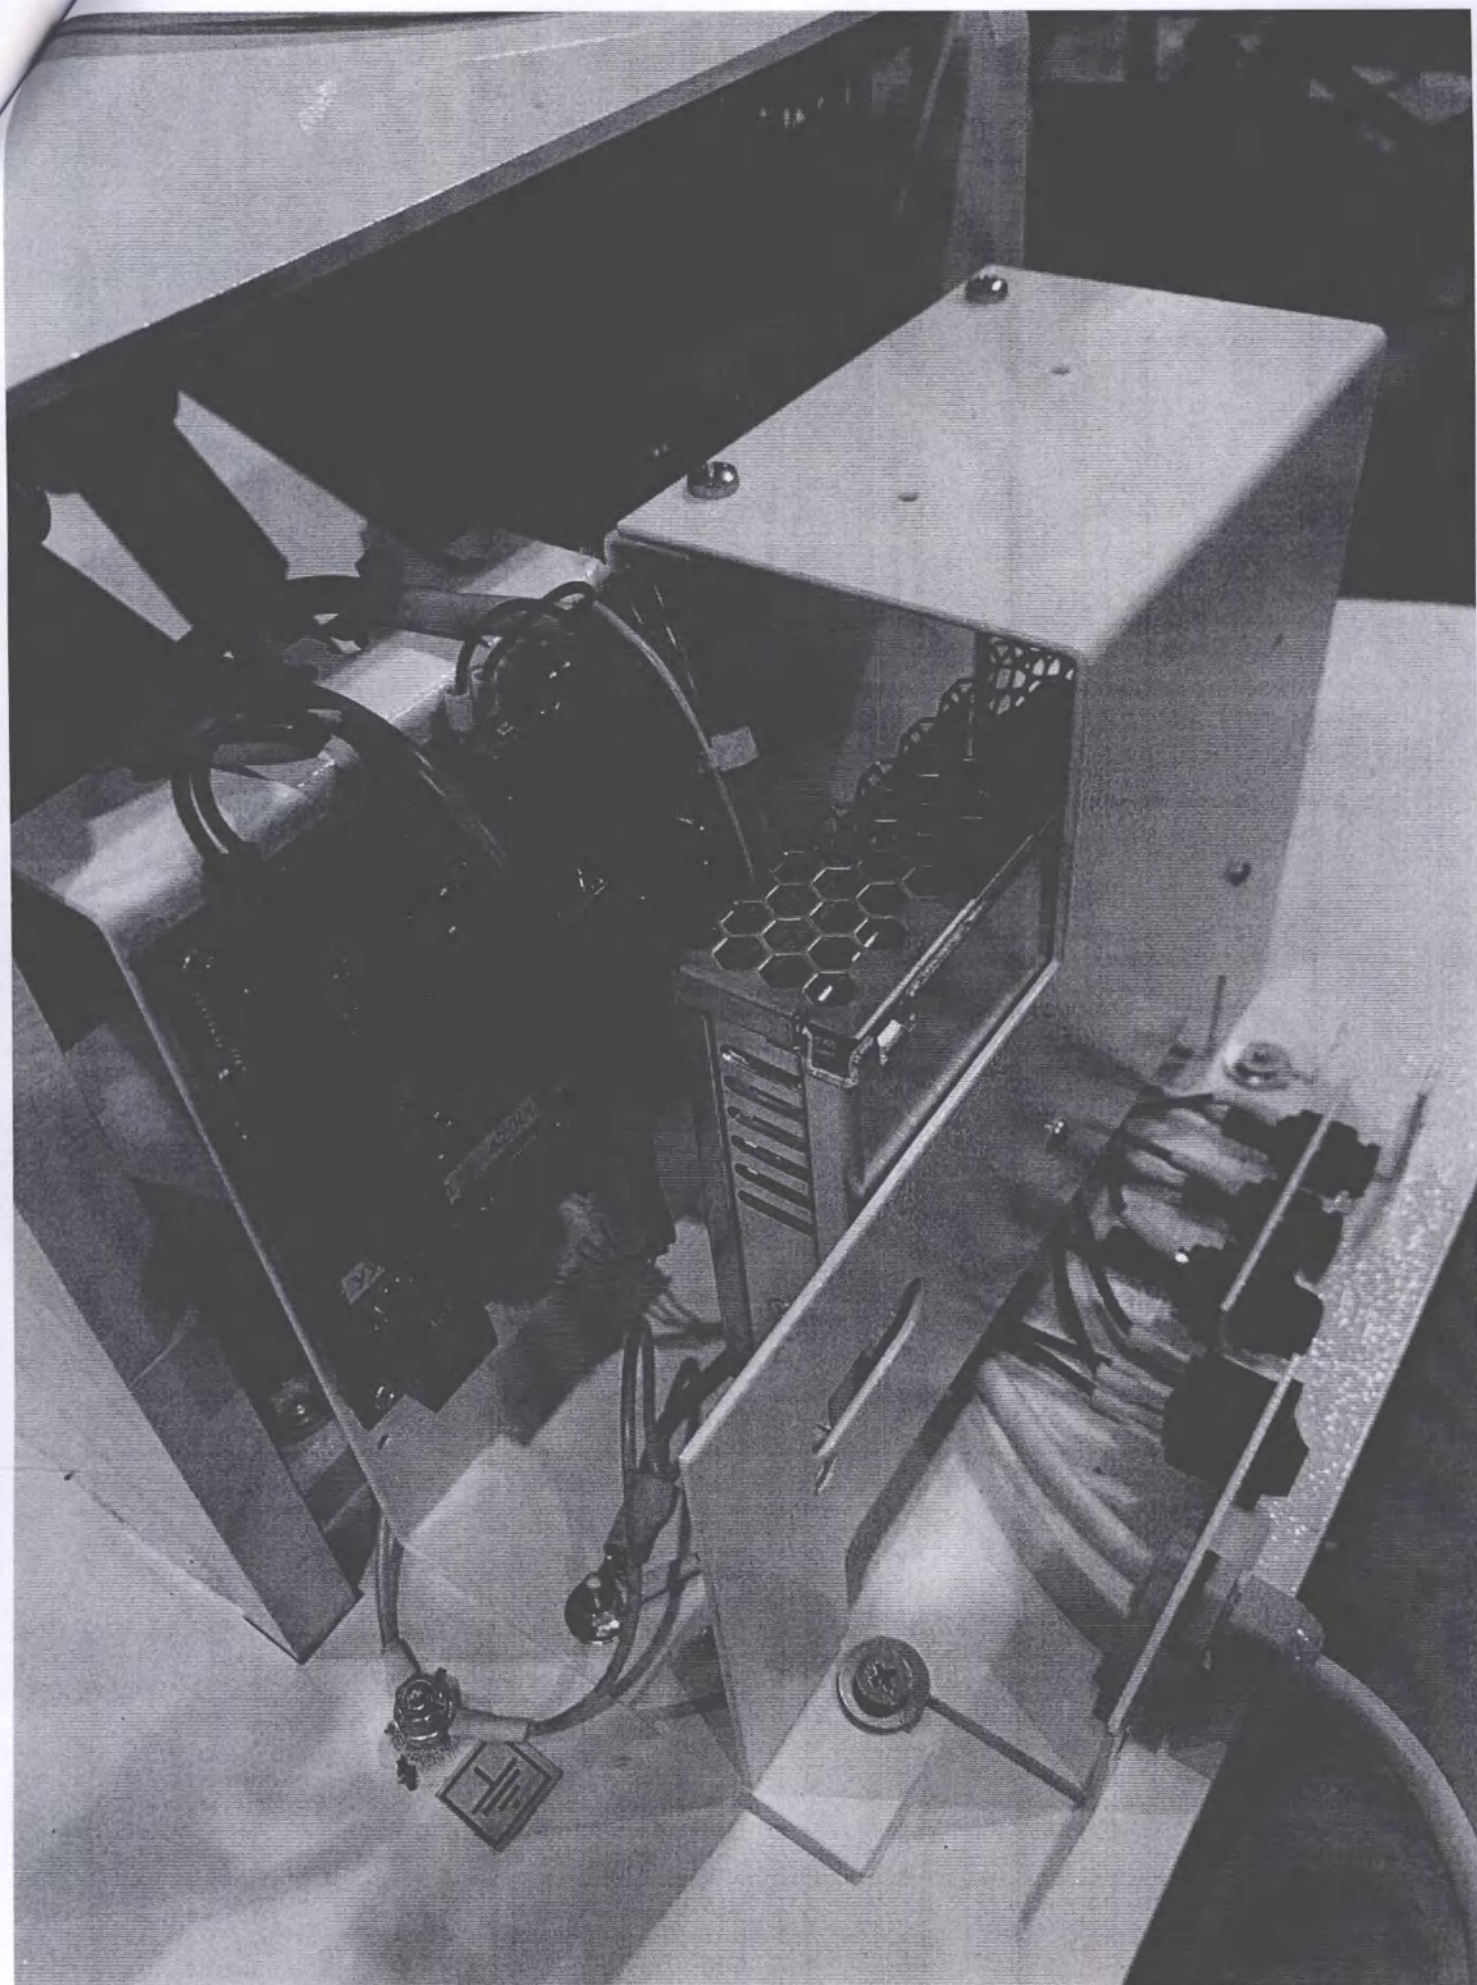

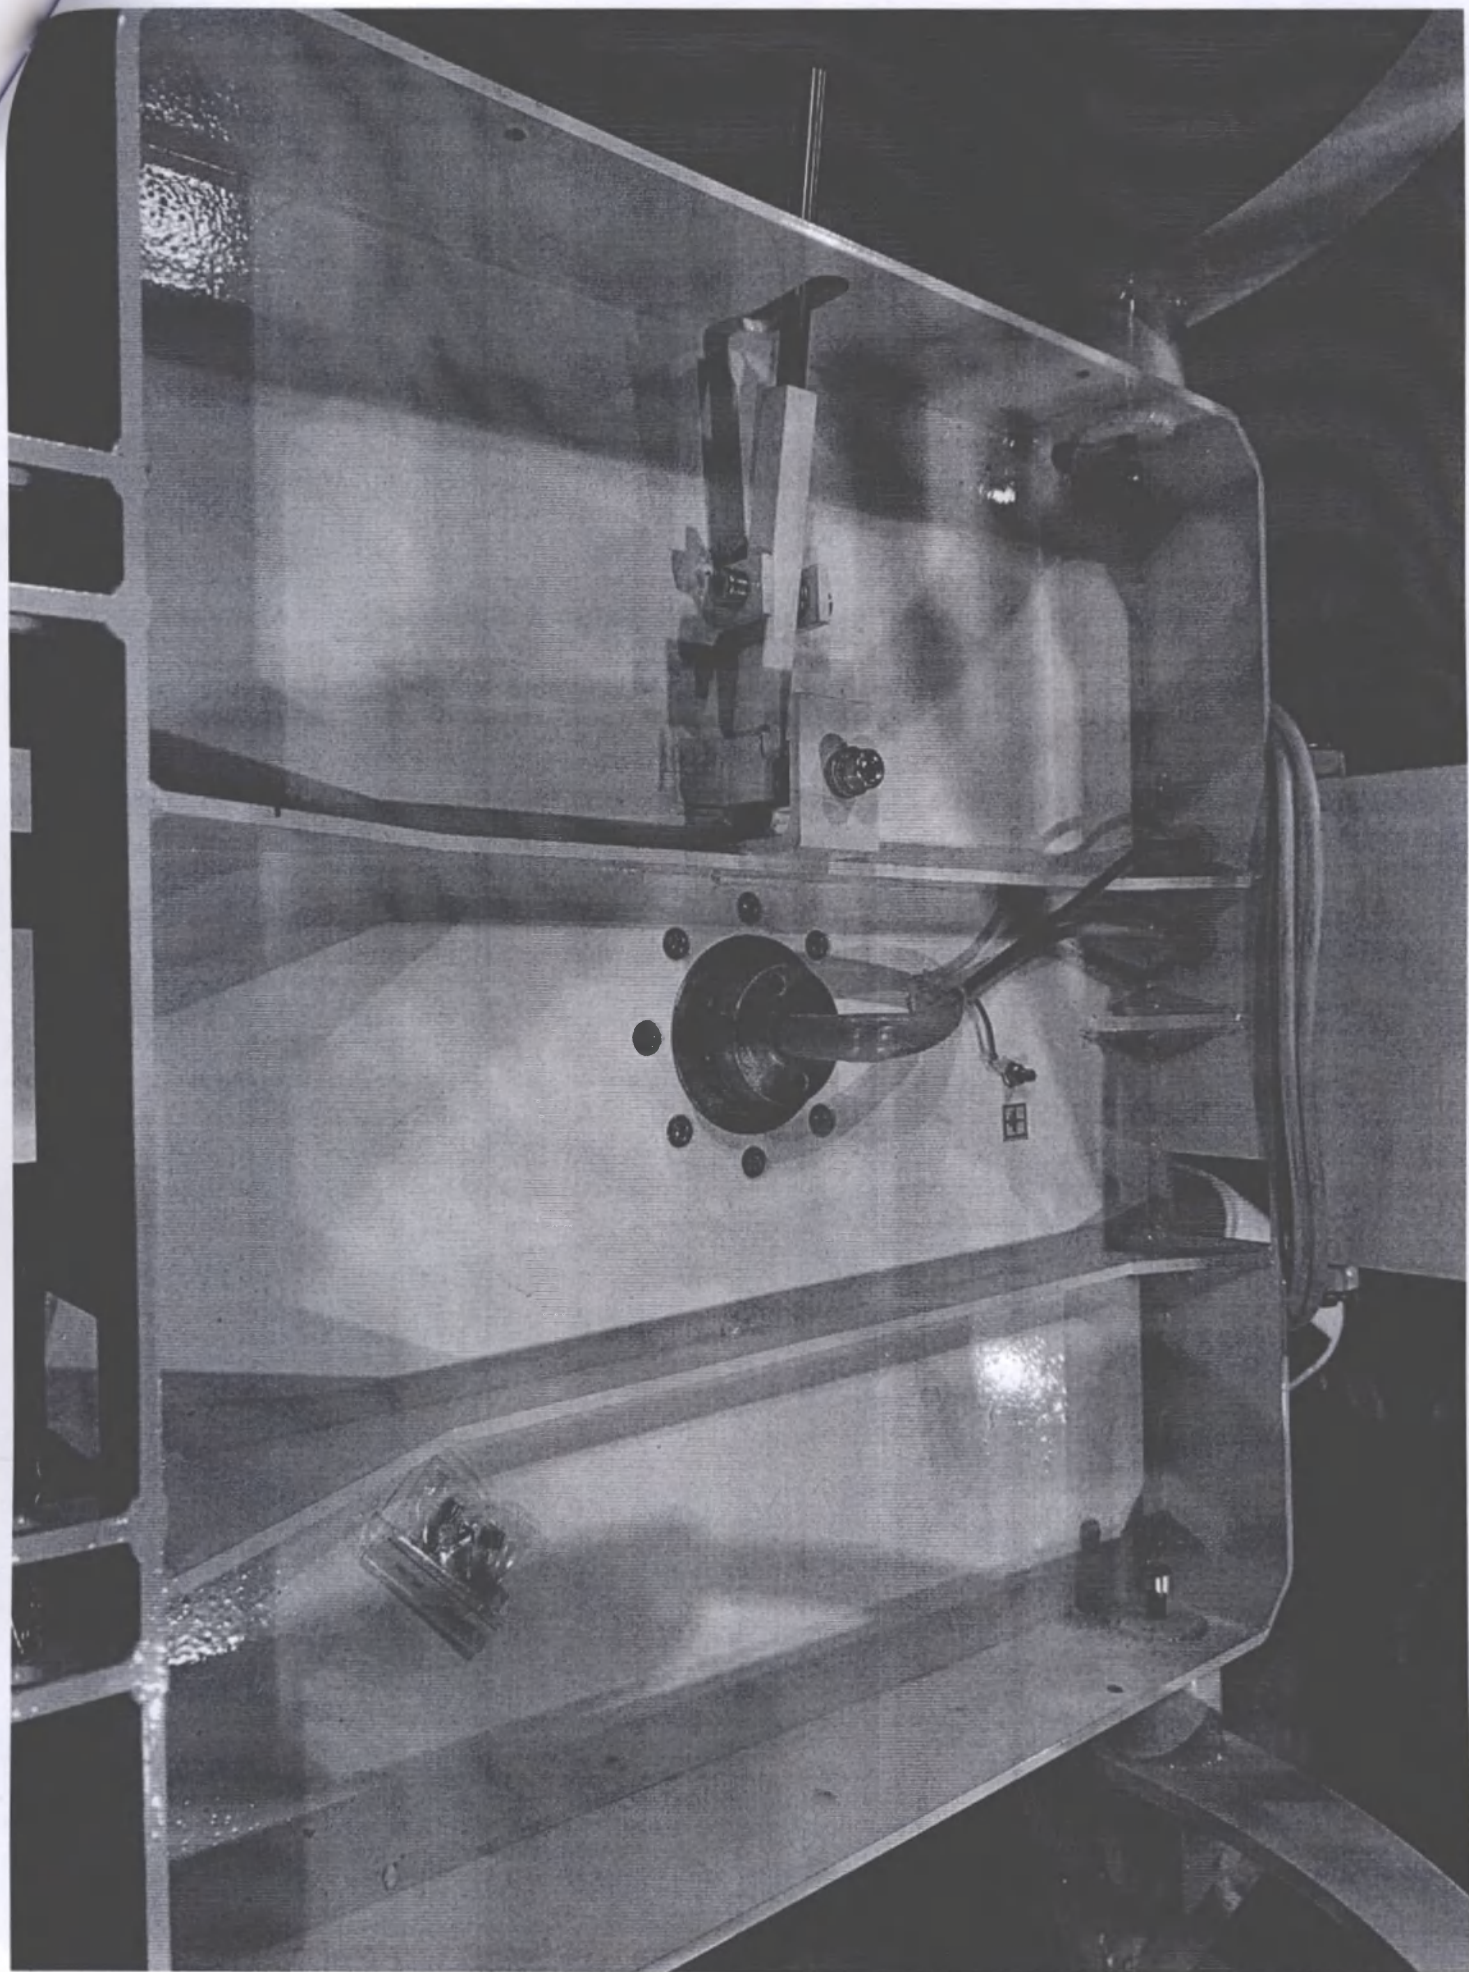


Рисунок 5 – Маркировка заземления

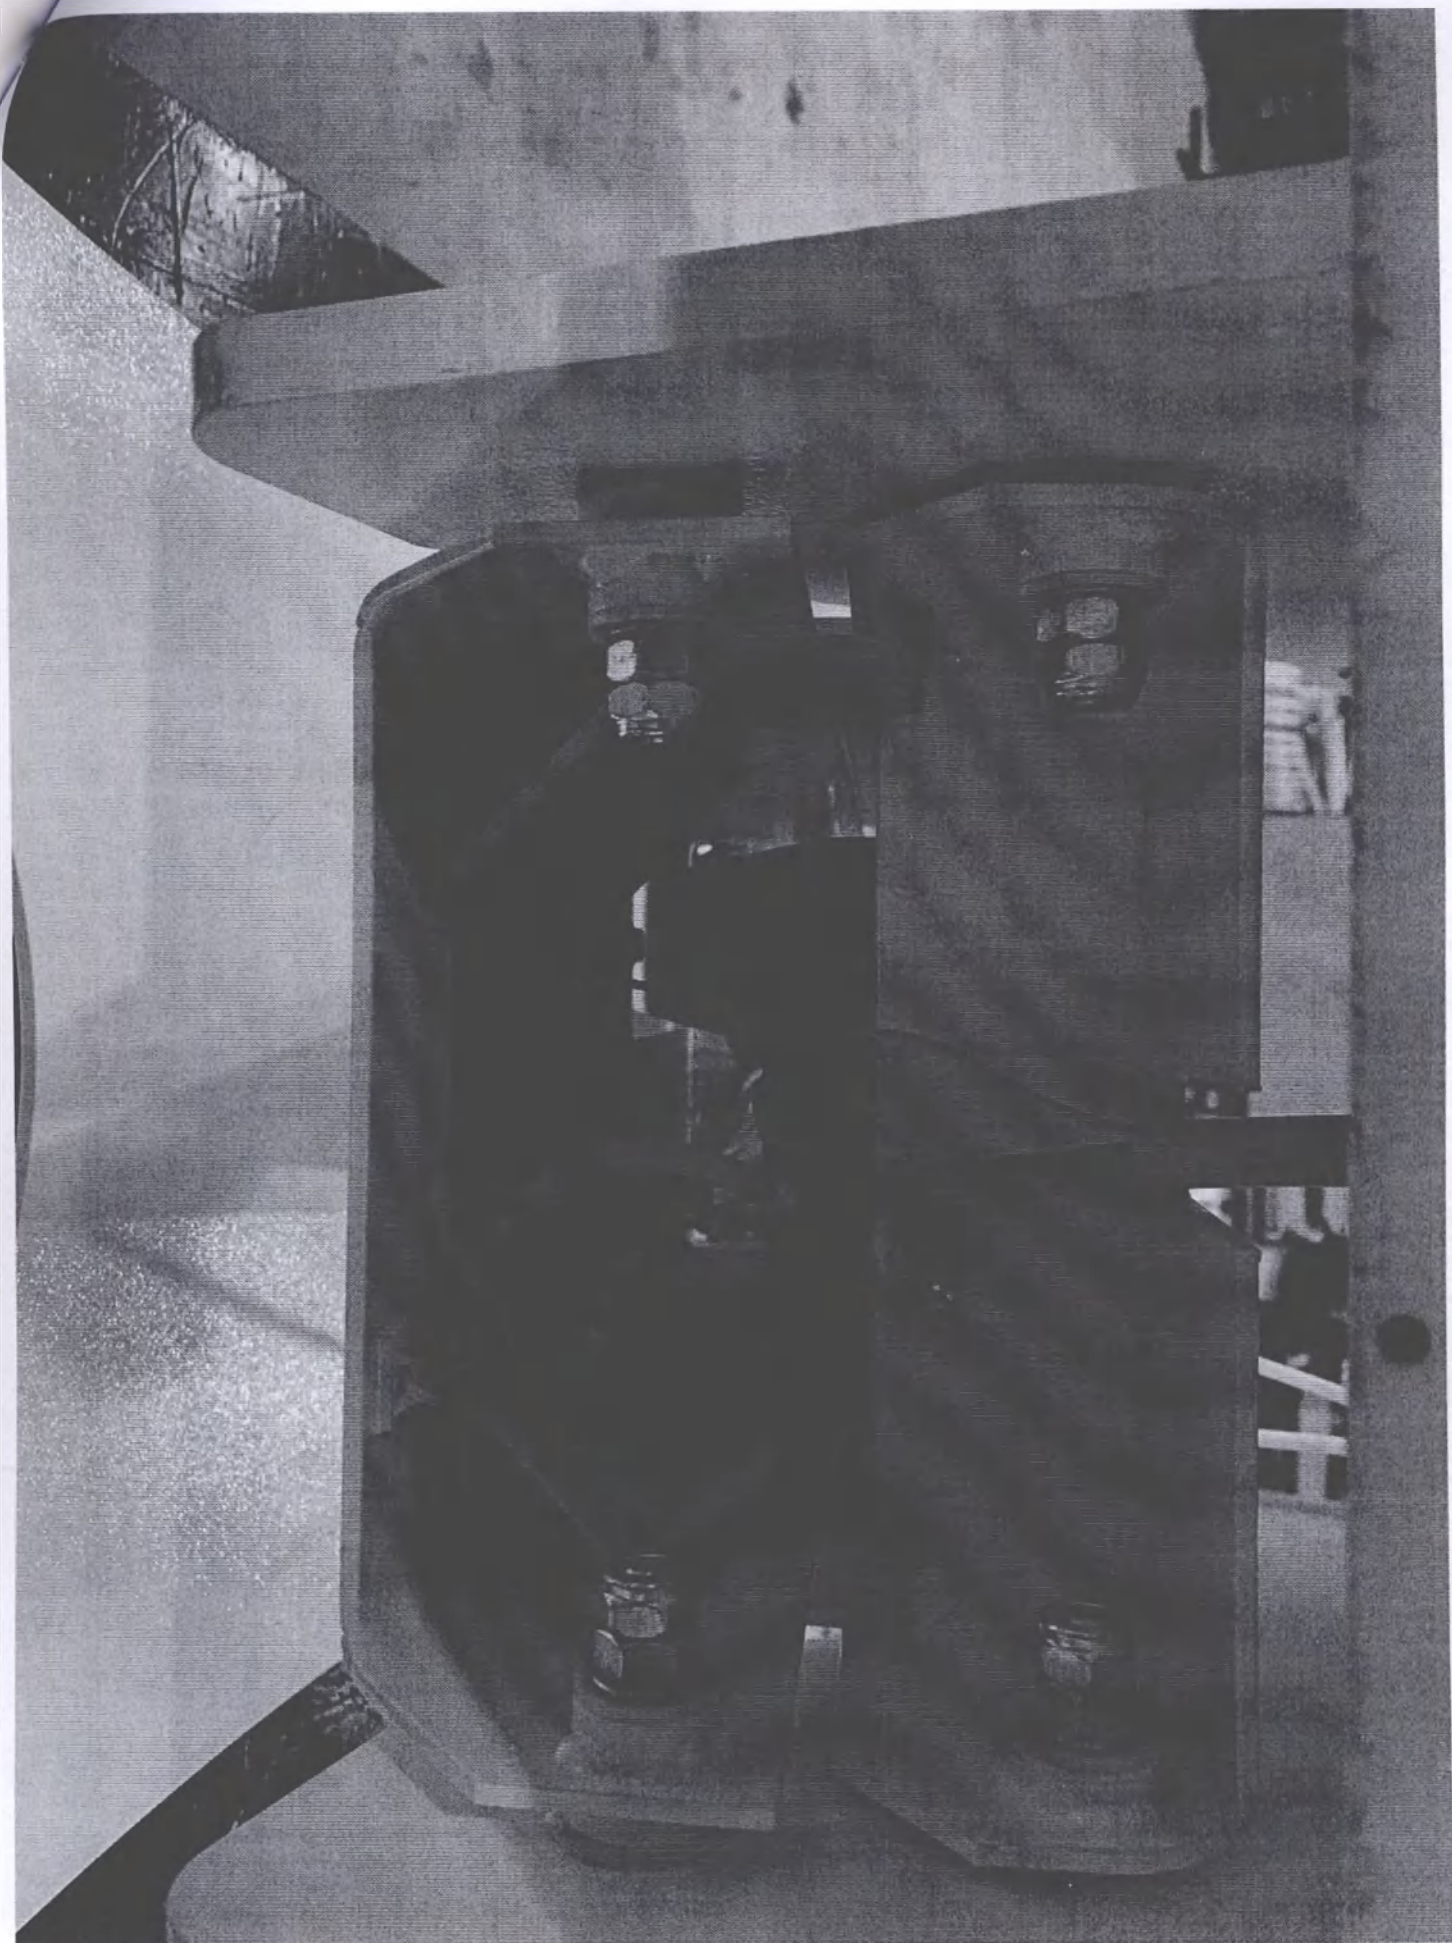


Рисунок 6 – Маркировка заземления

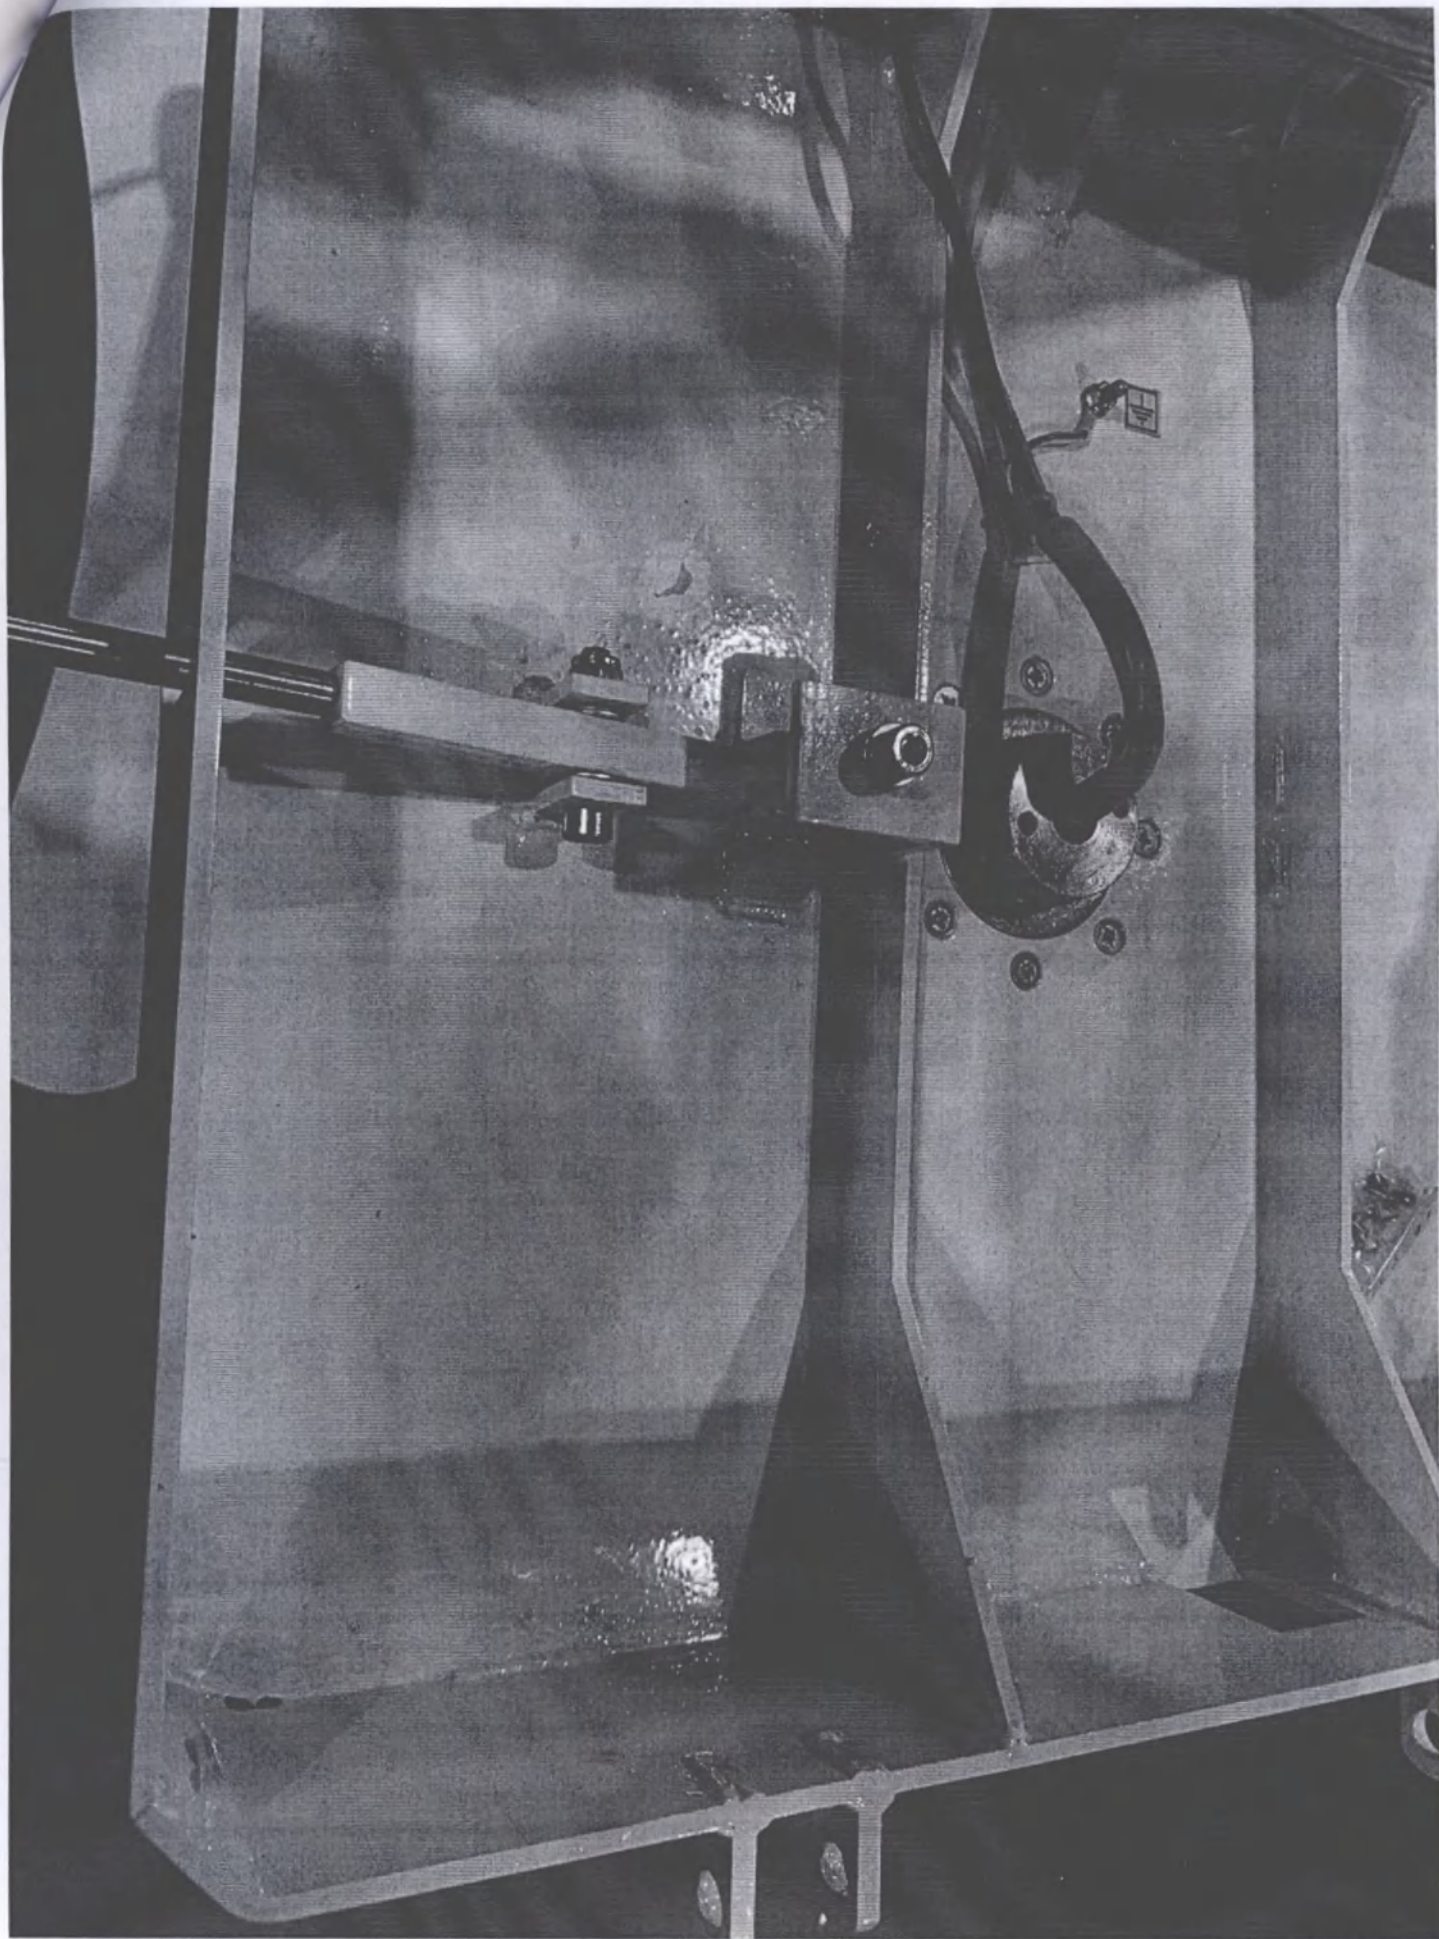


Рисунок 7 – Маркировка заземления



Рисунок 8 – Панель управления

Всего в настоящем документе
прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 9 листов.

Директор

