

Условия хранения и
эксплуатации:
температура от +5°C до +40°C,
относительная влажность до 80%.





**ВЕСЫ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ
С БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ
РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ**



**ИнВМЭ
АСПД.404474.001ТУ**

Модель ВМ-01В-1

РАЗРАБОТАНО:
ООО «ИНМИ», Россия

ИЗГОТОВЛЕНО:
ООО «Альтоника»
119313, г. Москва, Проспект Ленинский, д.95,
эт. Цокольный, пом. X, оф.90

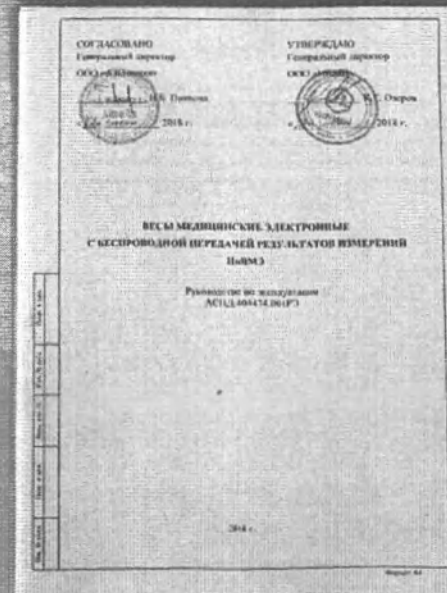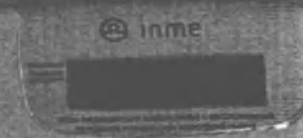

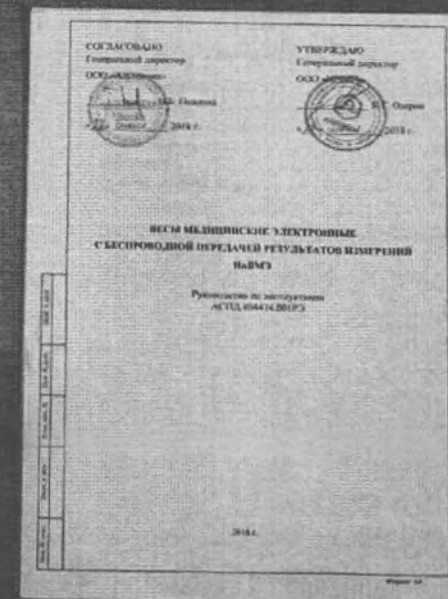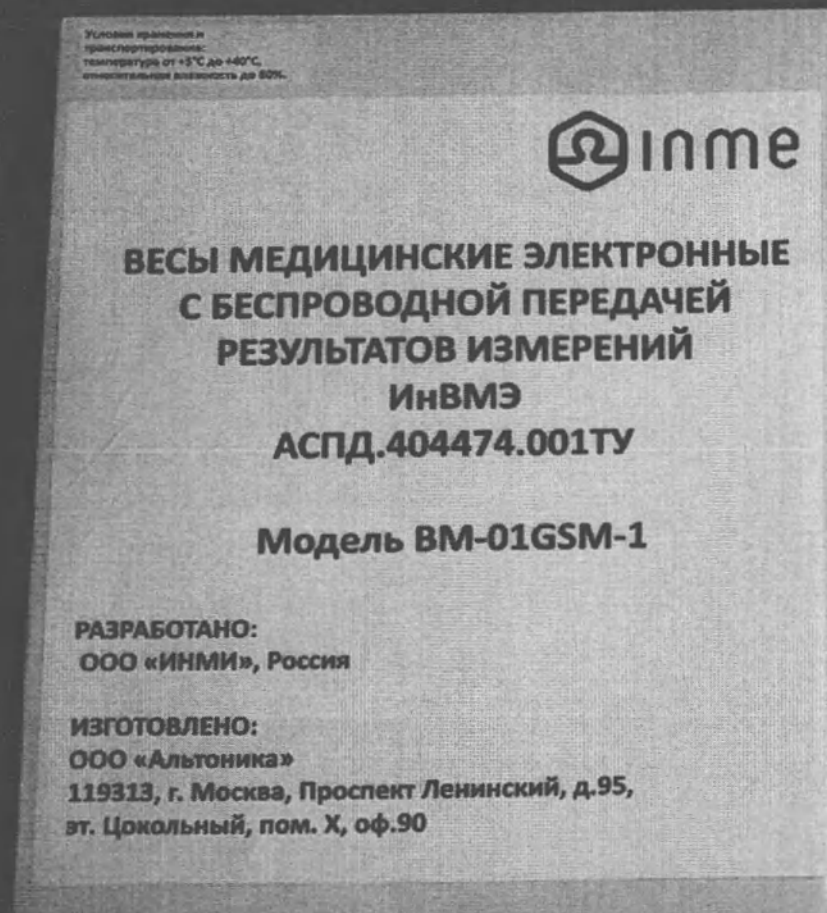

Условия эксплуатации:
температура от +5°C до +40°C,
влажность воздуха до 80%.



**ВЕСЫ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ
С БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ
РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ**

ИнВМЭ

АСПД.404474.001ТУ

Модель ВМ-01GSM-1

РАЗРАБОТАНО:

ООО «ИНМИ», Россия

ИЗГОТОВЛЕНО:

ООО «Альтонака»

**119313, г. Москва, Проспект Ленинский, д.95,
Б-у. Цокольный, пом. X, оф.90**

СОГЛАСОВАНО Технический директор ООО «ИНМИ» [Подпись] 2018 г.	УТВЕРЖДЕНО Генеральный директор ООО «Альтонака» [Подпись] 2018 г.
ВЕСЫ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ С БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ ИнВМЭ	
Регистрационный номер: АИ ТУ.404474.001ТУ	
2018 г.	

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия

«Весы медицинские электронные с беспроводной передачей результатов измерений ИнВМЭ» по АСПД.404474.001ТУ, Модель ВМ-01В-1

Условия хранения и
температурный диапазон
температуры от 10°C до 40°C,
влажность воздуха до 80%.



**ВЕСЫ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ
С БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ
РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ**

ИнВМЭ

АСПД.404474.001ТУ

Модель ВМ-01В-1

РАЗРАБОТАНО:
ООО «ИНМИ», Россия

ИЗГОТОВЛЕНО:
ООО «Альтоника»
119313, г. Москва, Проспект Ленинский, д.95,
эт. Цокольный, пом. X, оф.90

СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ	
Генеральный директор		Генеральный директор	
С.И. Сидоров		С.И. Сидоров	
2018 г.		2018 г.	
ВЕСЫ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ С БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ			
ИнВМЭ			
Разработанное в соответствии с АСПД.404474.001ТУ			
2018 г.			