

ФОТО

Комплекс аппаратно-программный для клинико-диагностических исследований реологических свойств крови (тромбоэластограф) НПТЭГ «МЕДНОРД» по ТУ 26.60.12-010-67002267-2017

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«МЕДНОРД-ТЕХНИКА»

(ООО «Меднорд-Т»)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Меднорд-Т»



« 01 » 2020 г.

Л.М. Жуков



ФОТО

**Комплекс аппаратно-программный
для клинико-диагностических исследований
реологических свойств крови (тромбоэластограф)
НПТЭГ «МЕДНОРД» по
ТУ 26.60.12-010-67002267-2017**

Томск 2020

ФОТО

Комплекс аппаратно-программный для клинико-диагностических исследований реологических свойств крови (тромбоэластограф) НПТЭГ "МЕДНОРД" по ТУ 26.60.12-010-67002267-2017

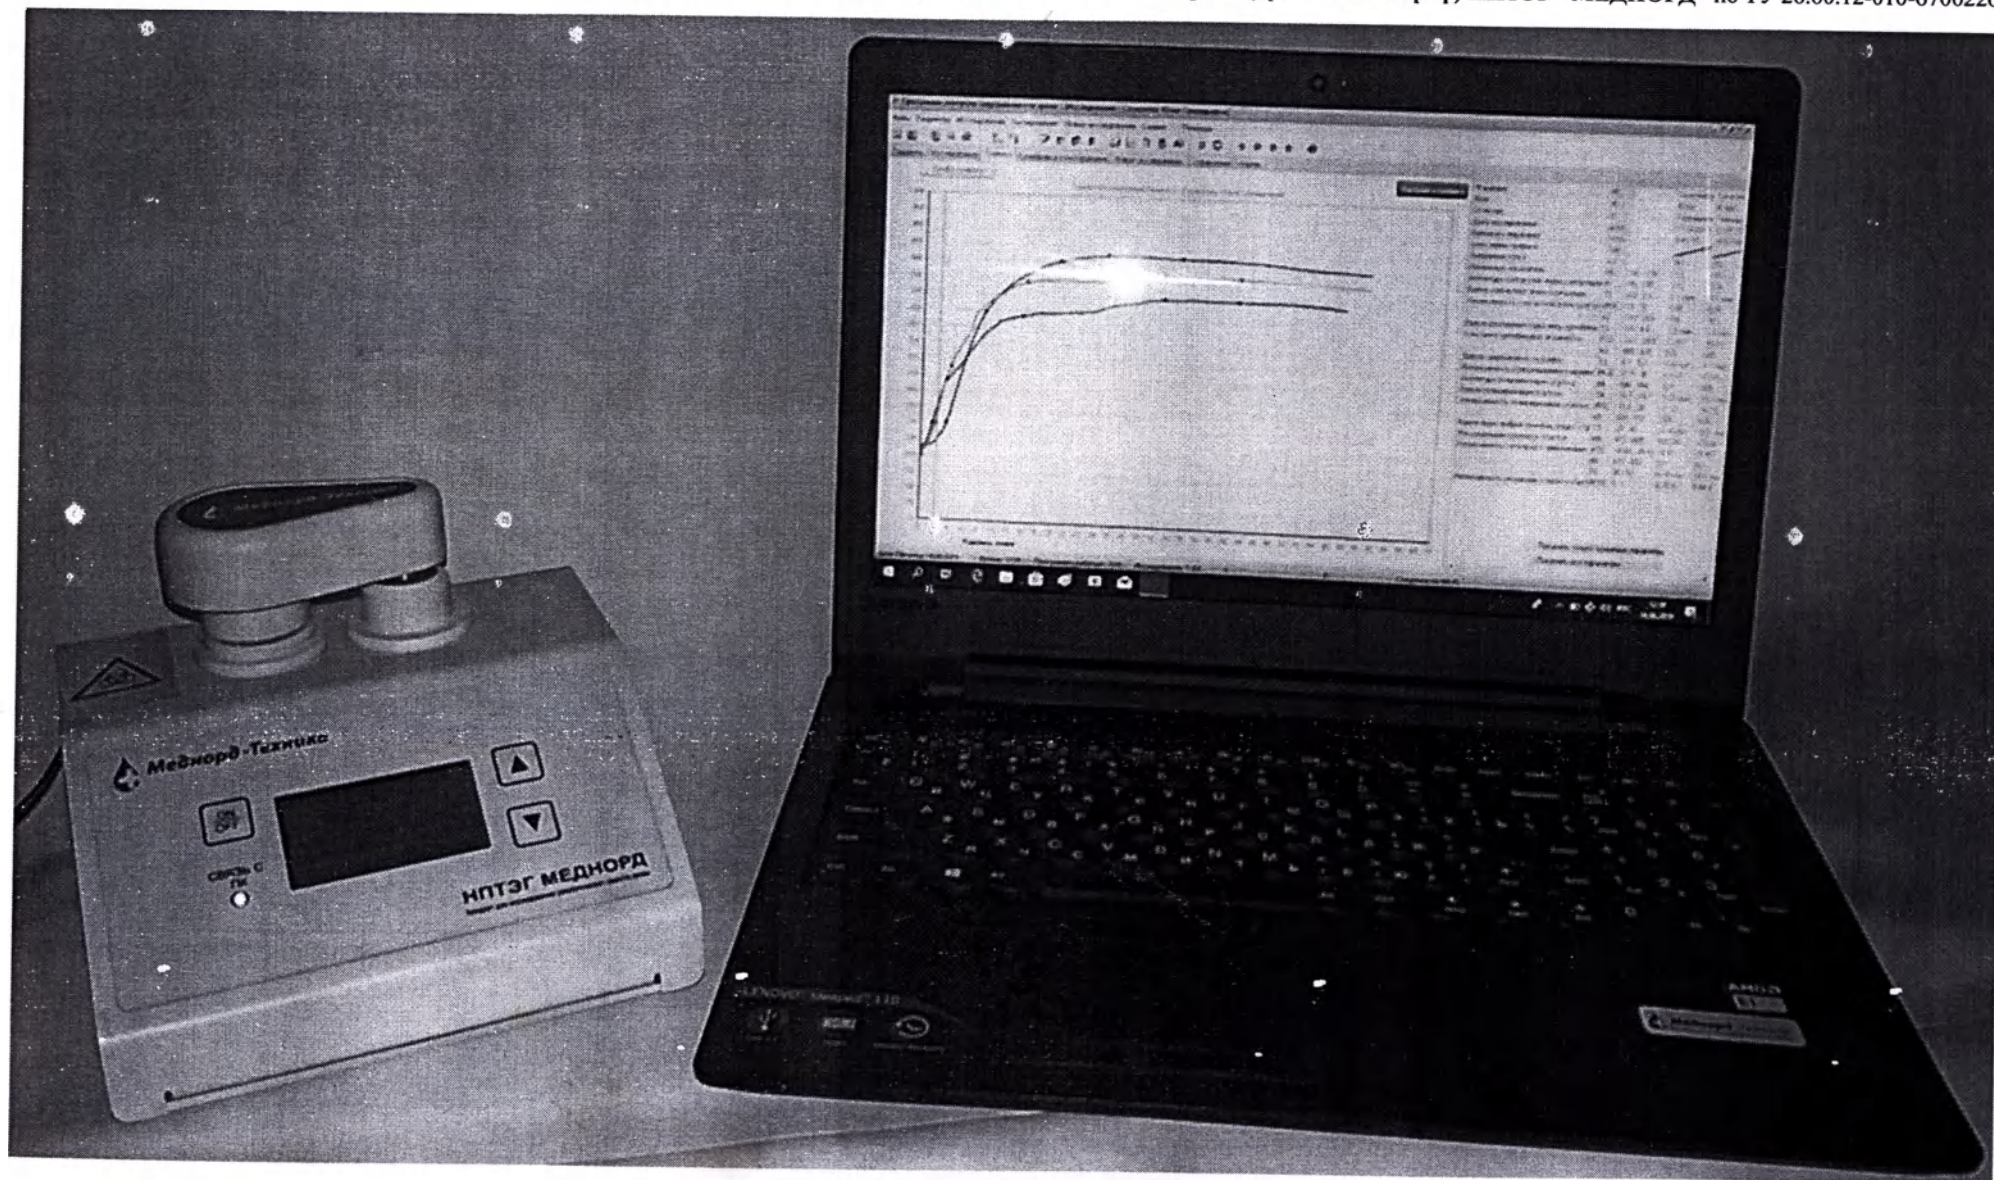


Фото 1 Внешний вид комплекса аппаратно-программного для клинико-диагностических исследований реологических свойств крови (тромбоэластограф) НПТЭГ "МЕДНОРД"

ФОТО

Комплекс аппаратно-программный для клинико-диагностических исследований реологических свойств крови (тромбозластограф) НПТЭГ "МЕДНОРД" по ТУ 26.60.12-010-67002267-2017



Фото 2 Маркировка и пломбировка аппарата

ФОТО

Комплекс аппаратно-программный для клинко-диагностических исследований реологических свойств крови (тромбоэластограф) НПТЭГ "МЕДНОРД" по ТУ 26.60.12-010-67002267-2017

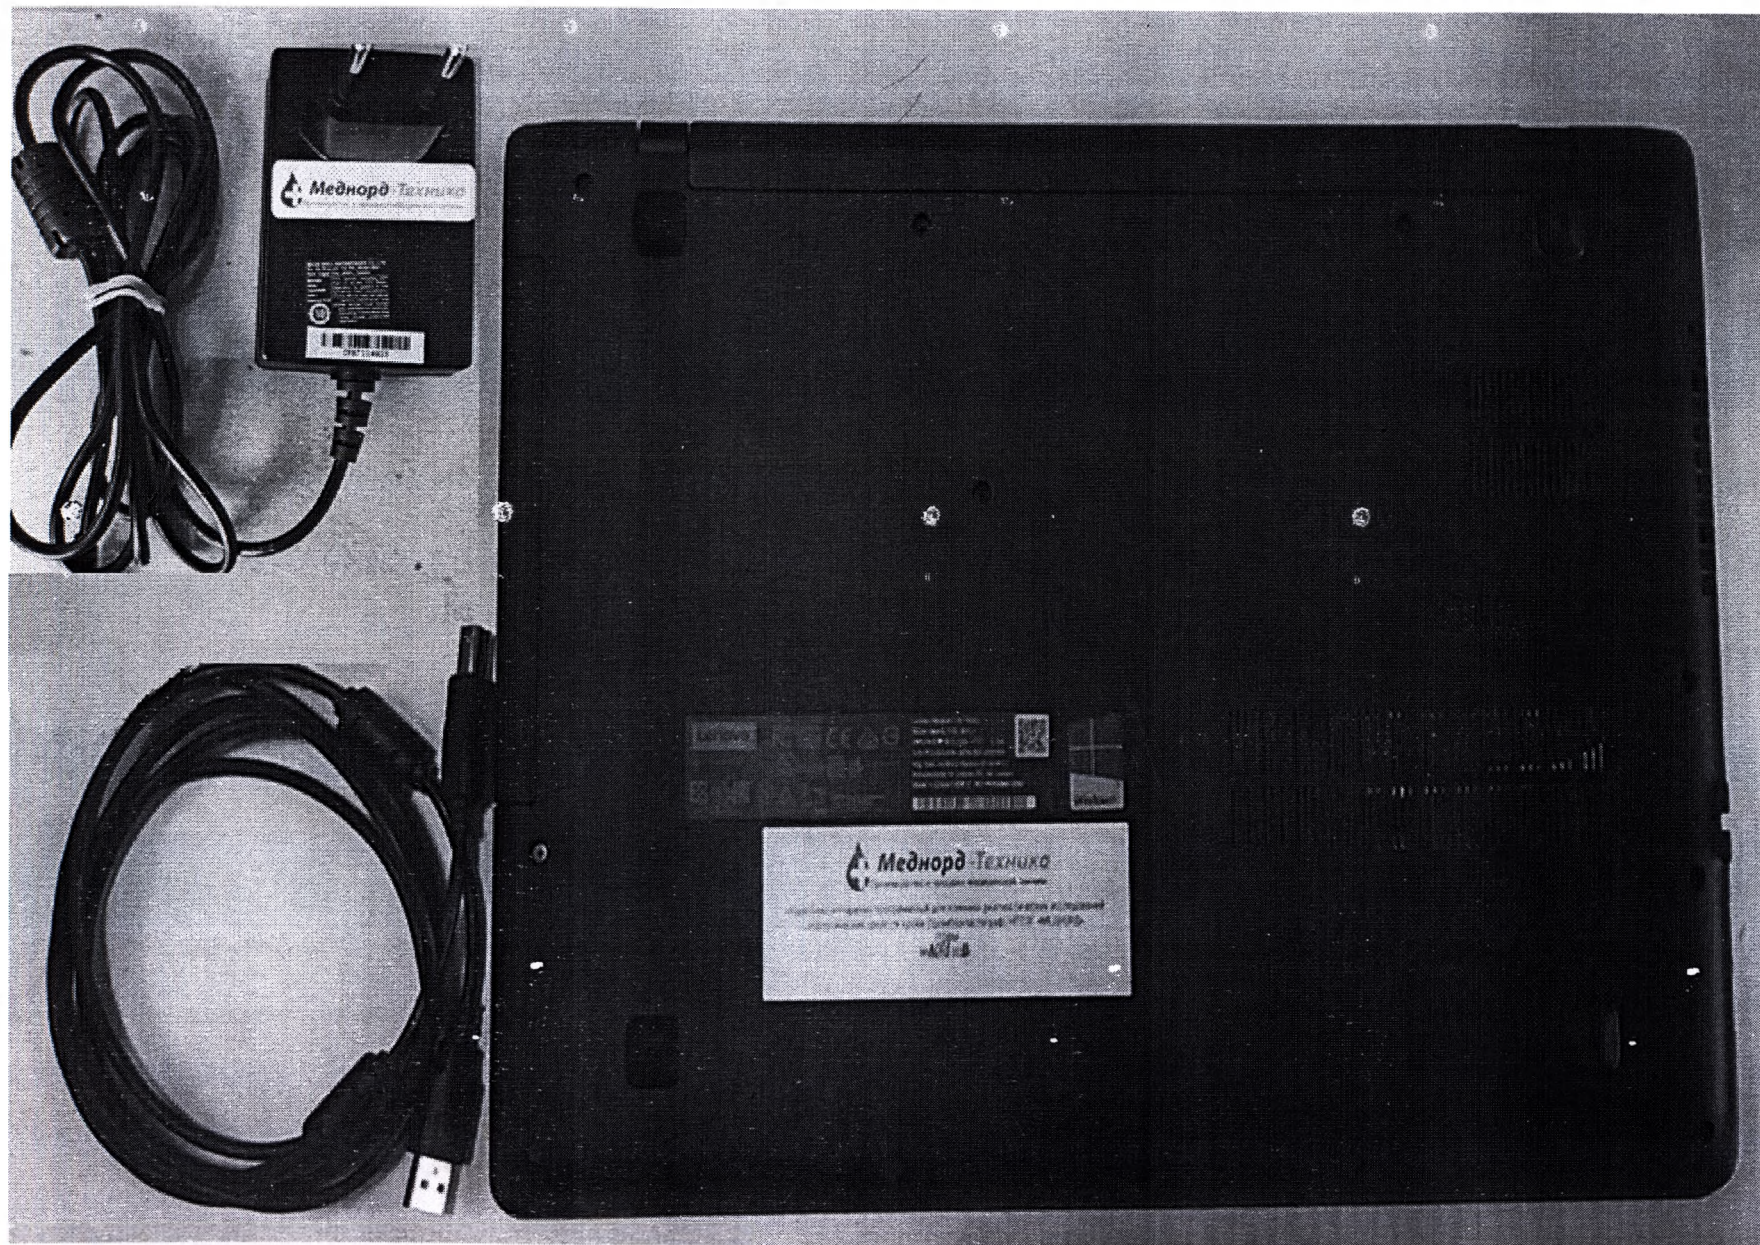


Фото 3 ПЭВМ с принадлежностями

ФОТО

Комплекс аппаратно-программный для клинико-диагностических исследований реологических свойств крови (тромбоэластограф) НПТЭГ "МЕДНОРД" по ТУ 26.60.12-010-67002267-2017

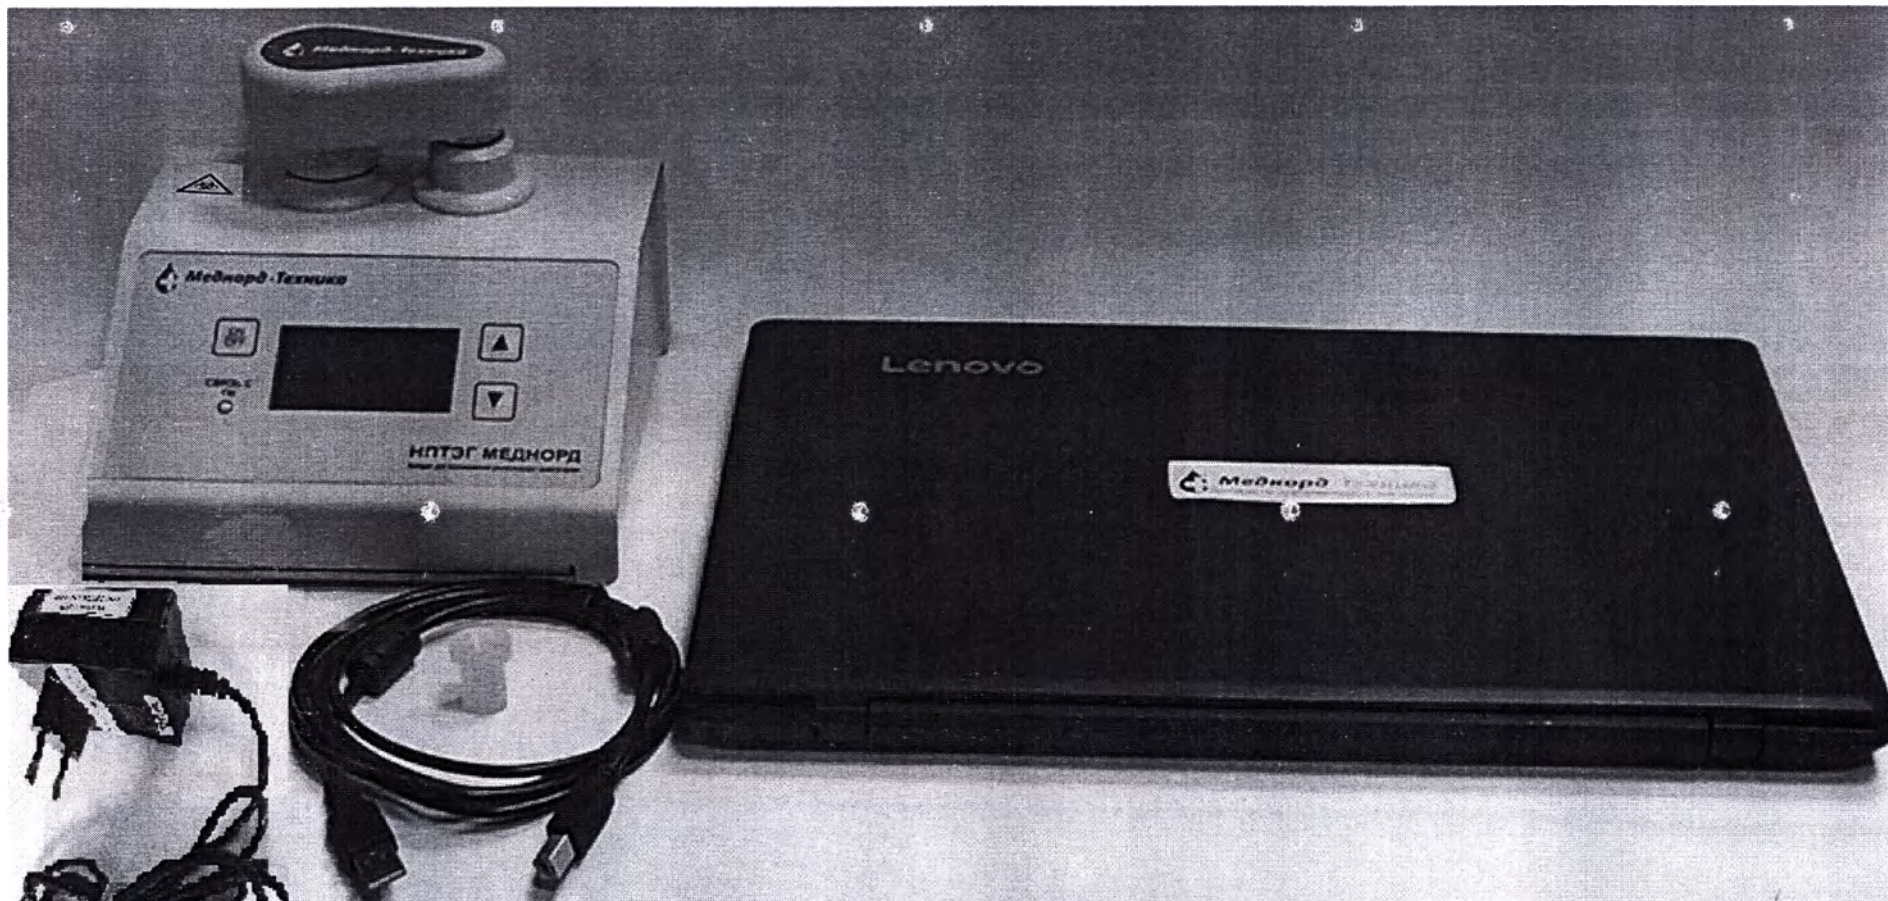


Фото 4 Комплектация «Комплекс аппаратно-программный для клинико-диагностических исследований реологических свойств крови (тромбоэластограф) НПТЭГ "МЕДНОРД"»

ФОТО

Комплекс аппаратно-программный для клинико-диагностических исследований реологических свойств крови (тромбоэластограф) НПТЭГ "МЕДНОРД" по ТУ 26.60.12-010-67002267-2017

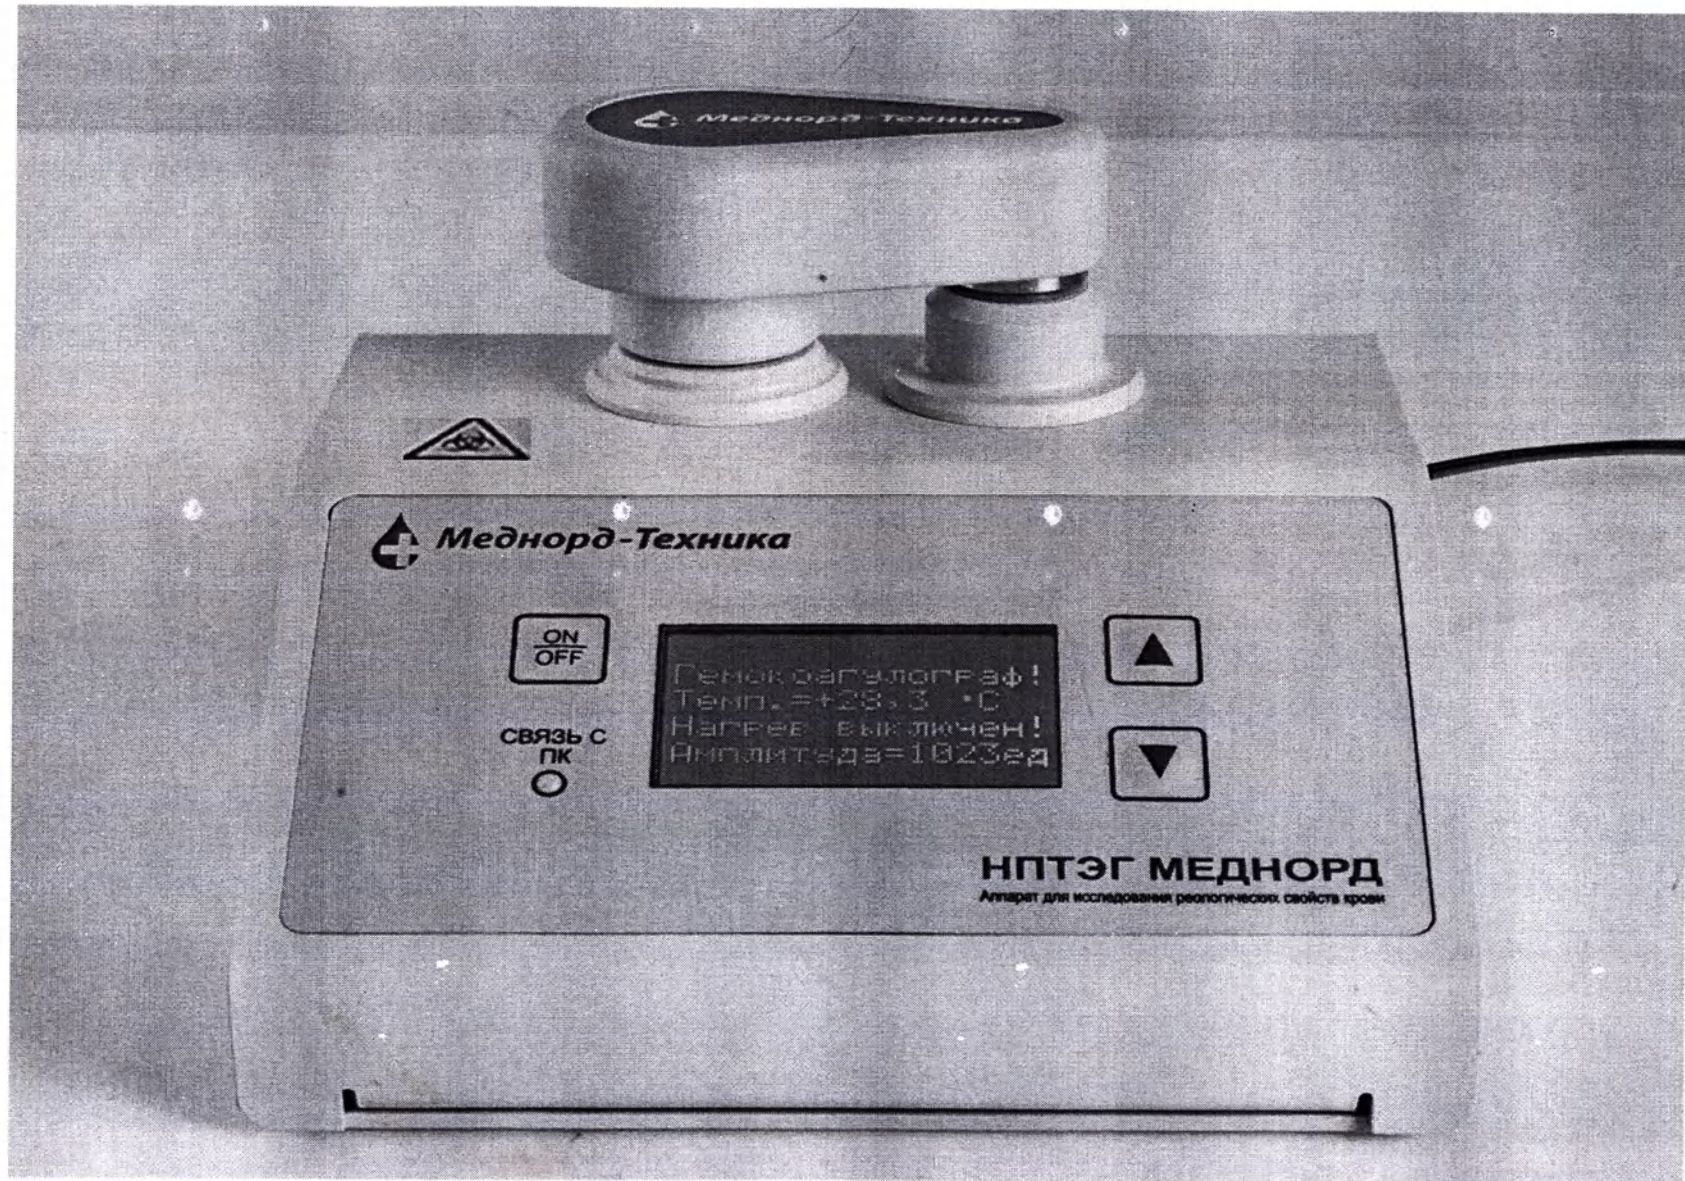


Фото 5 Внешний вид аппарата

ФОТО

Комплекс аппаратно-программный для клинико-диагностических исследований реологических свойств крови (тромбоэластограф) НПТЭГ "МЕДНОРД" по ТУ 26.60.12-010-67002267-2017

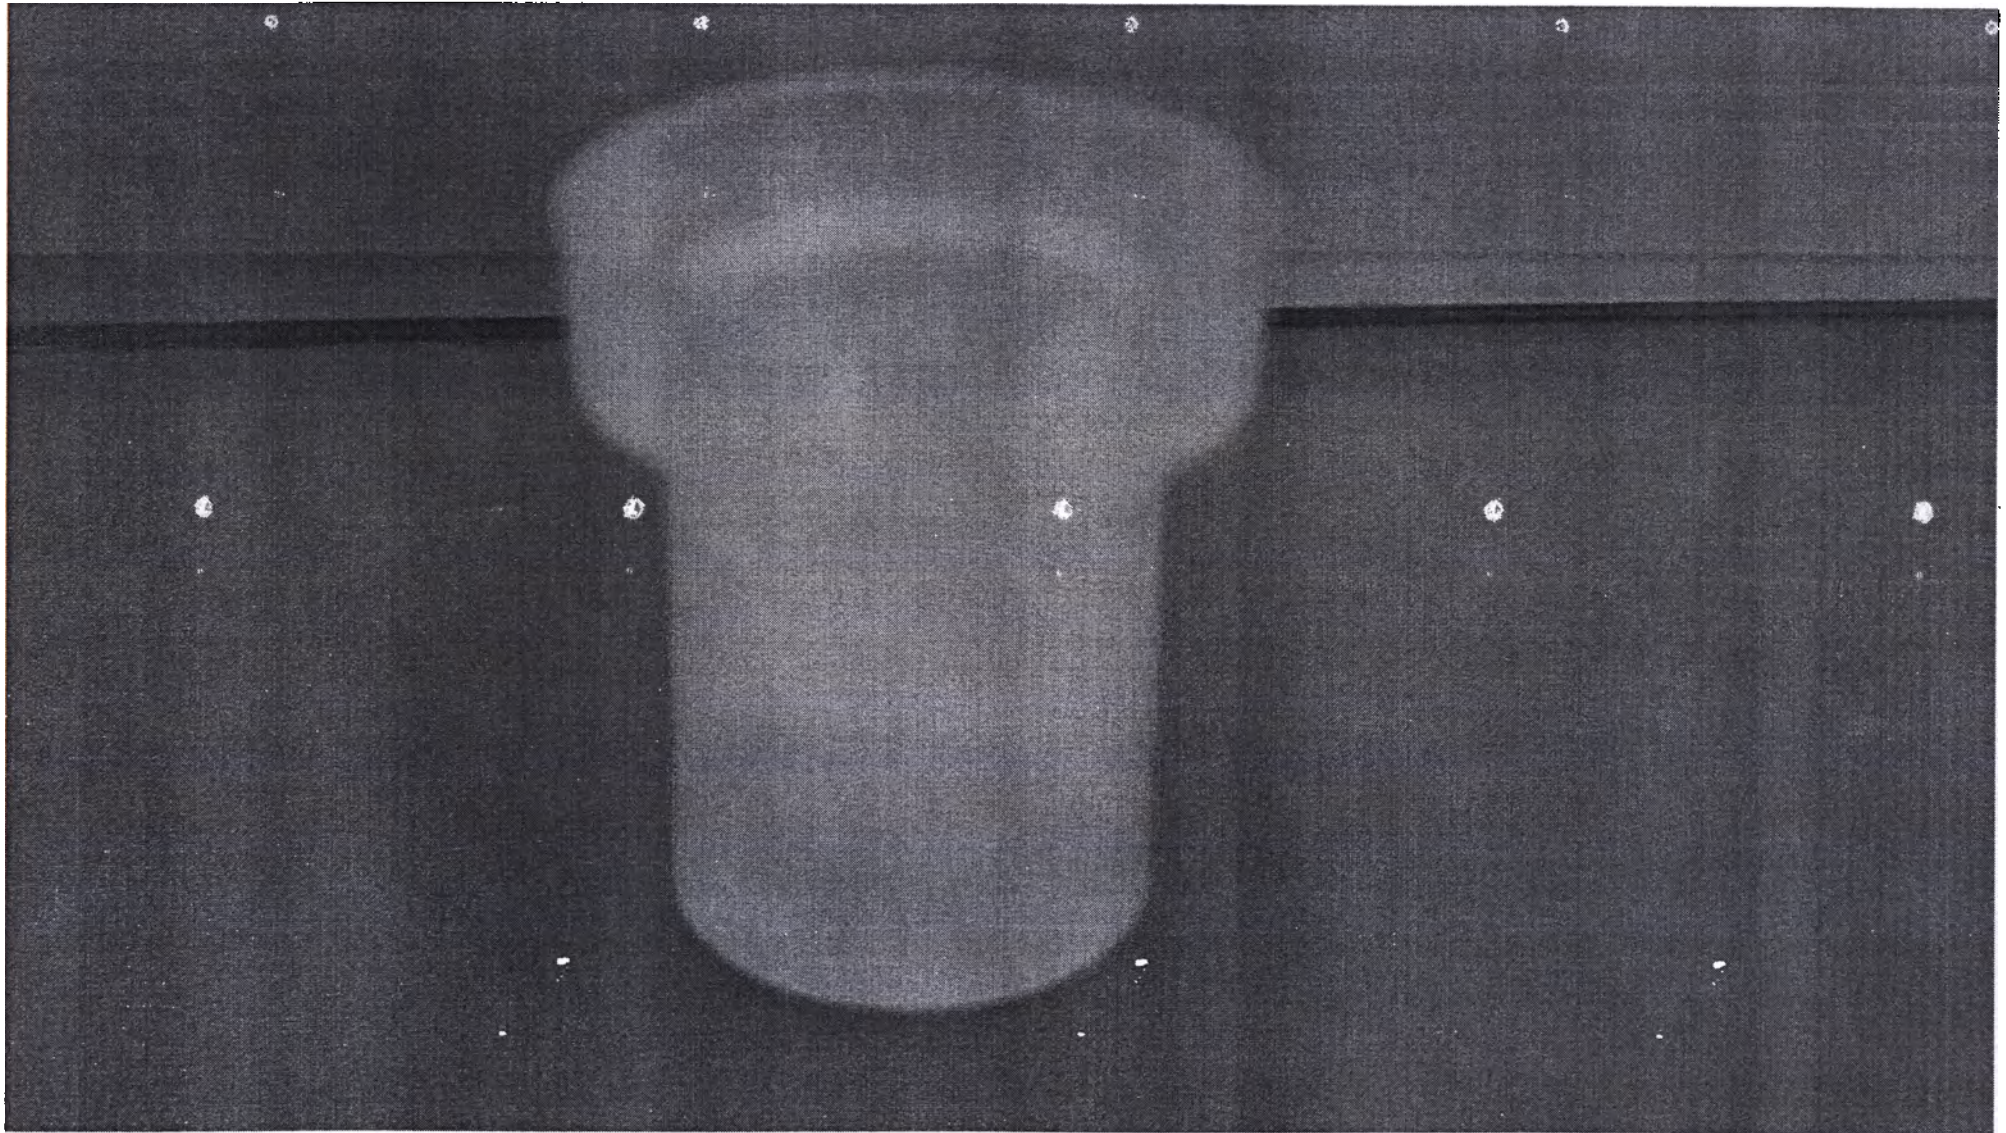




Фото 6 Кювета

Маркировка

	Запрет на повторное применение		Обратитесь к инструкции по применению
	Хрупкое. Обращаться осторожно		Беречь от солнечных лучей
	Беречь от влаги		Верх
	Постоянный ток		Переменный ток
	Медицинское изделие для диагностики in vitro		Неионизирующее излучение
	Биологическая опасность		Оборудование, защищенное двойной изоляцией или усиленной изоляцией
	Символ соответствия требованиям директив ЕС		Эксплуатировать только в помещениях
	Символ полярности разъемов		Символ особой утилизации

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 8

листах



Восемь
интерактивный директор
И. М. Мухомов