

Руководитель группы регистрации
ООО «Сименс Здравоохранение»

Н.А. Горшкова

2021 г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO**

**«Дилуент для тироксина для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Total Thyroxine
Diluent (Atellica IM T4 DIL))»**

производства «Сименс Хелскеа Диагностикс Инк.», Siemens Healthcare Diagnostics Inc., США



Рисунок 1. Дилуент для тироксина для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Total Thyroxine Diluent (Atellica IM T4 DIL)). Общий вид

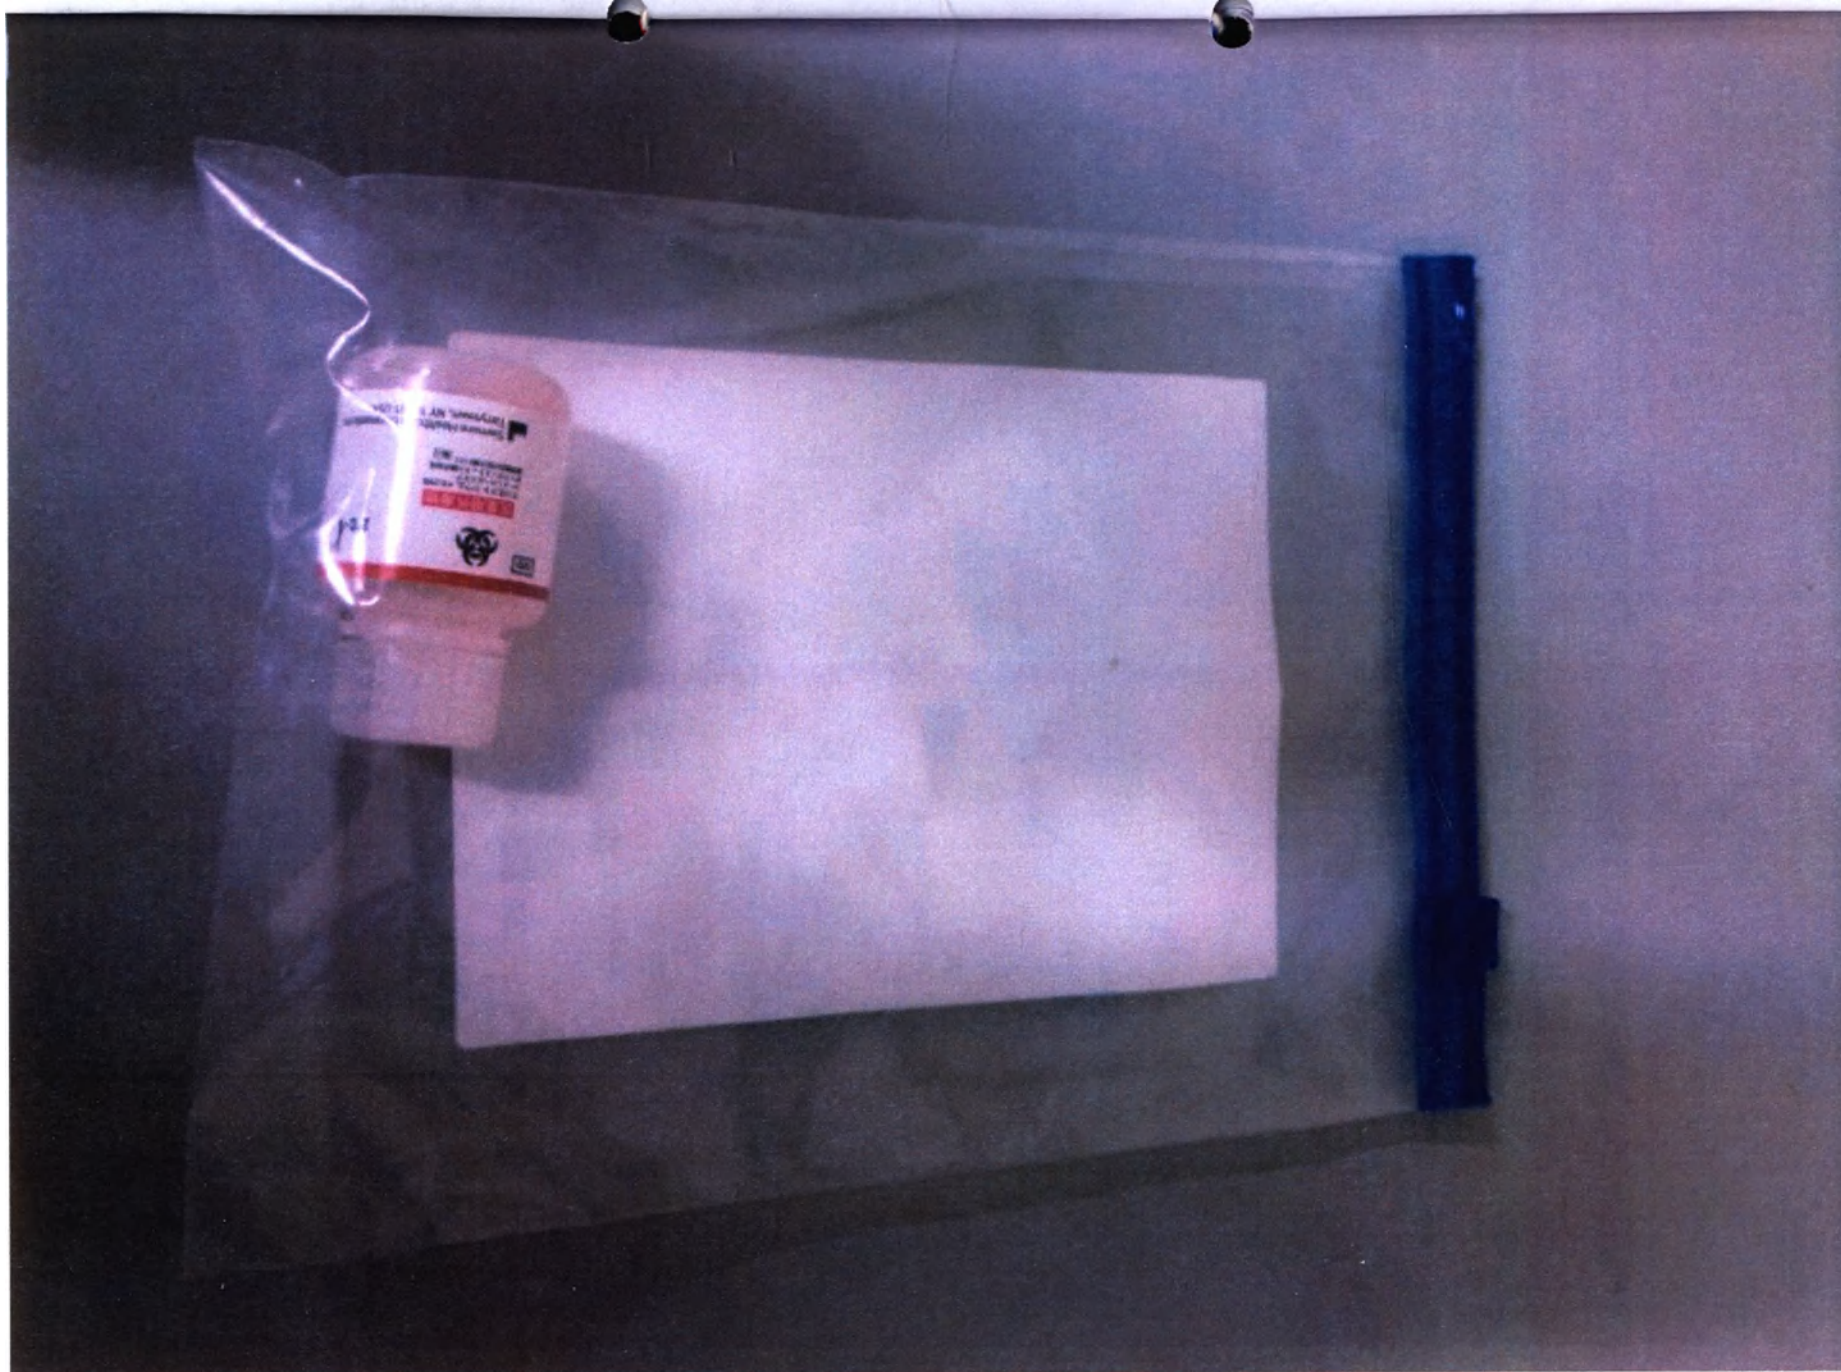


Рисунок 2. Дилуент для тироксина для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Total Thyroxine Diluent (Atellica IM T4 DIL)). Общий вид 2

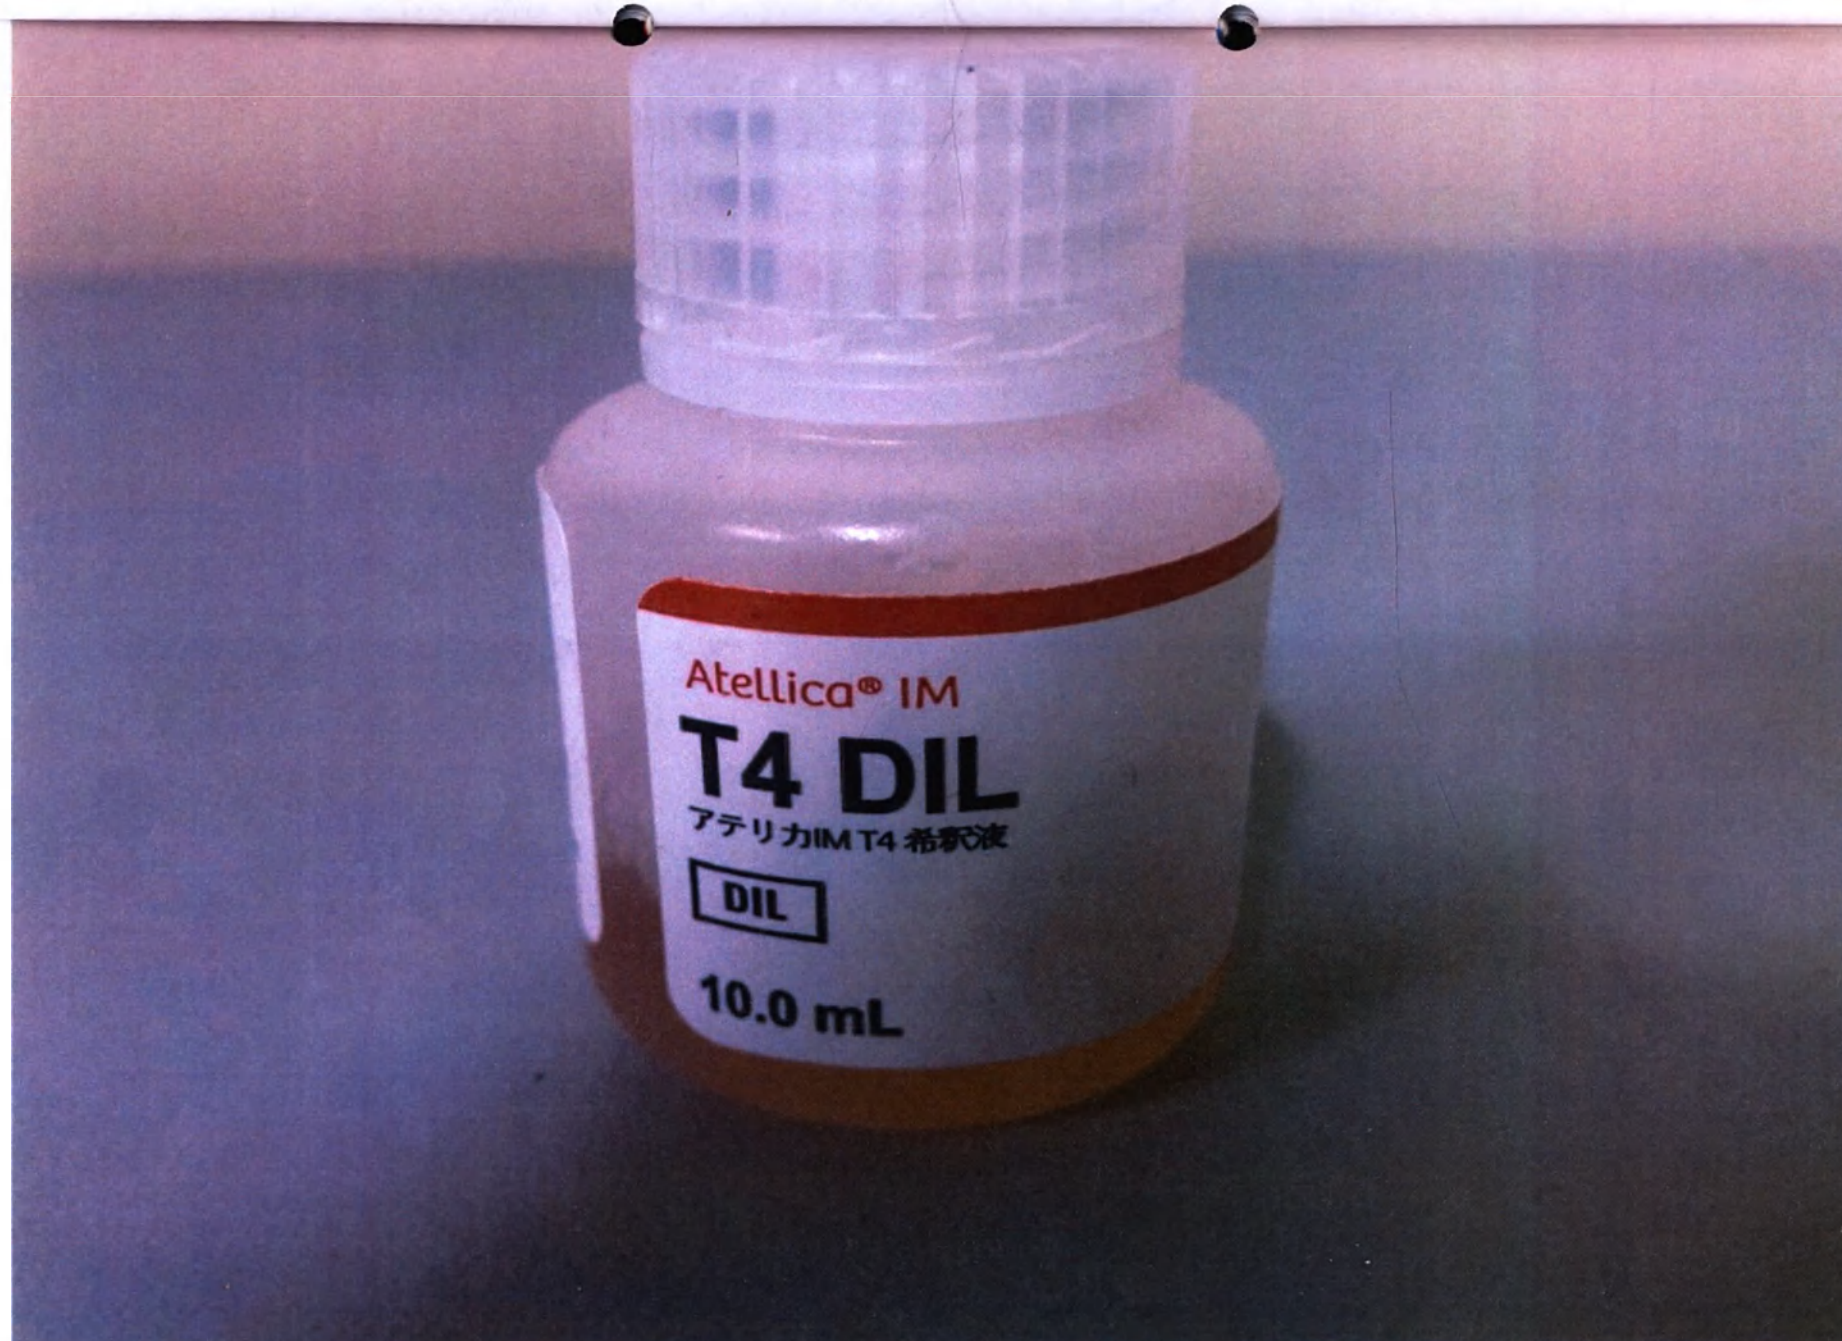


Рисунок 3. Дилуент для тироксина для анализаторов иммунохимической серии Atellica (Atellica IM Total Thyroxine Diluent (Atellica IM T4 DIL)): Дилуент для трийодтиронина (Atellica IM Total Thyroxine Diluent (Atellica IM T4 DIL)) - 10,0 мл/флакон.

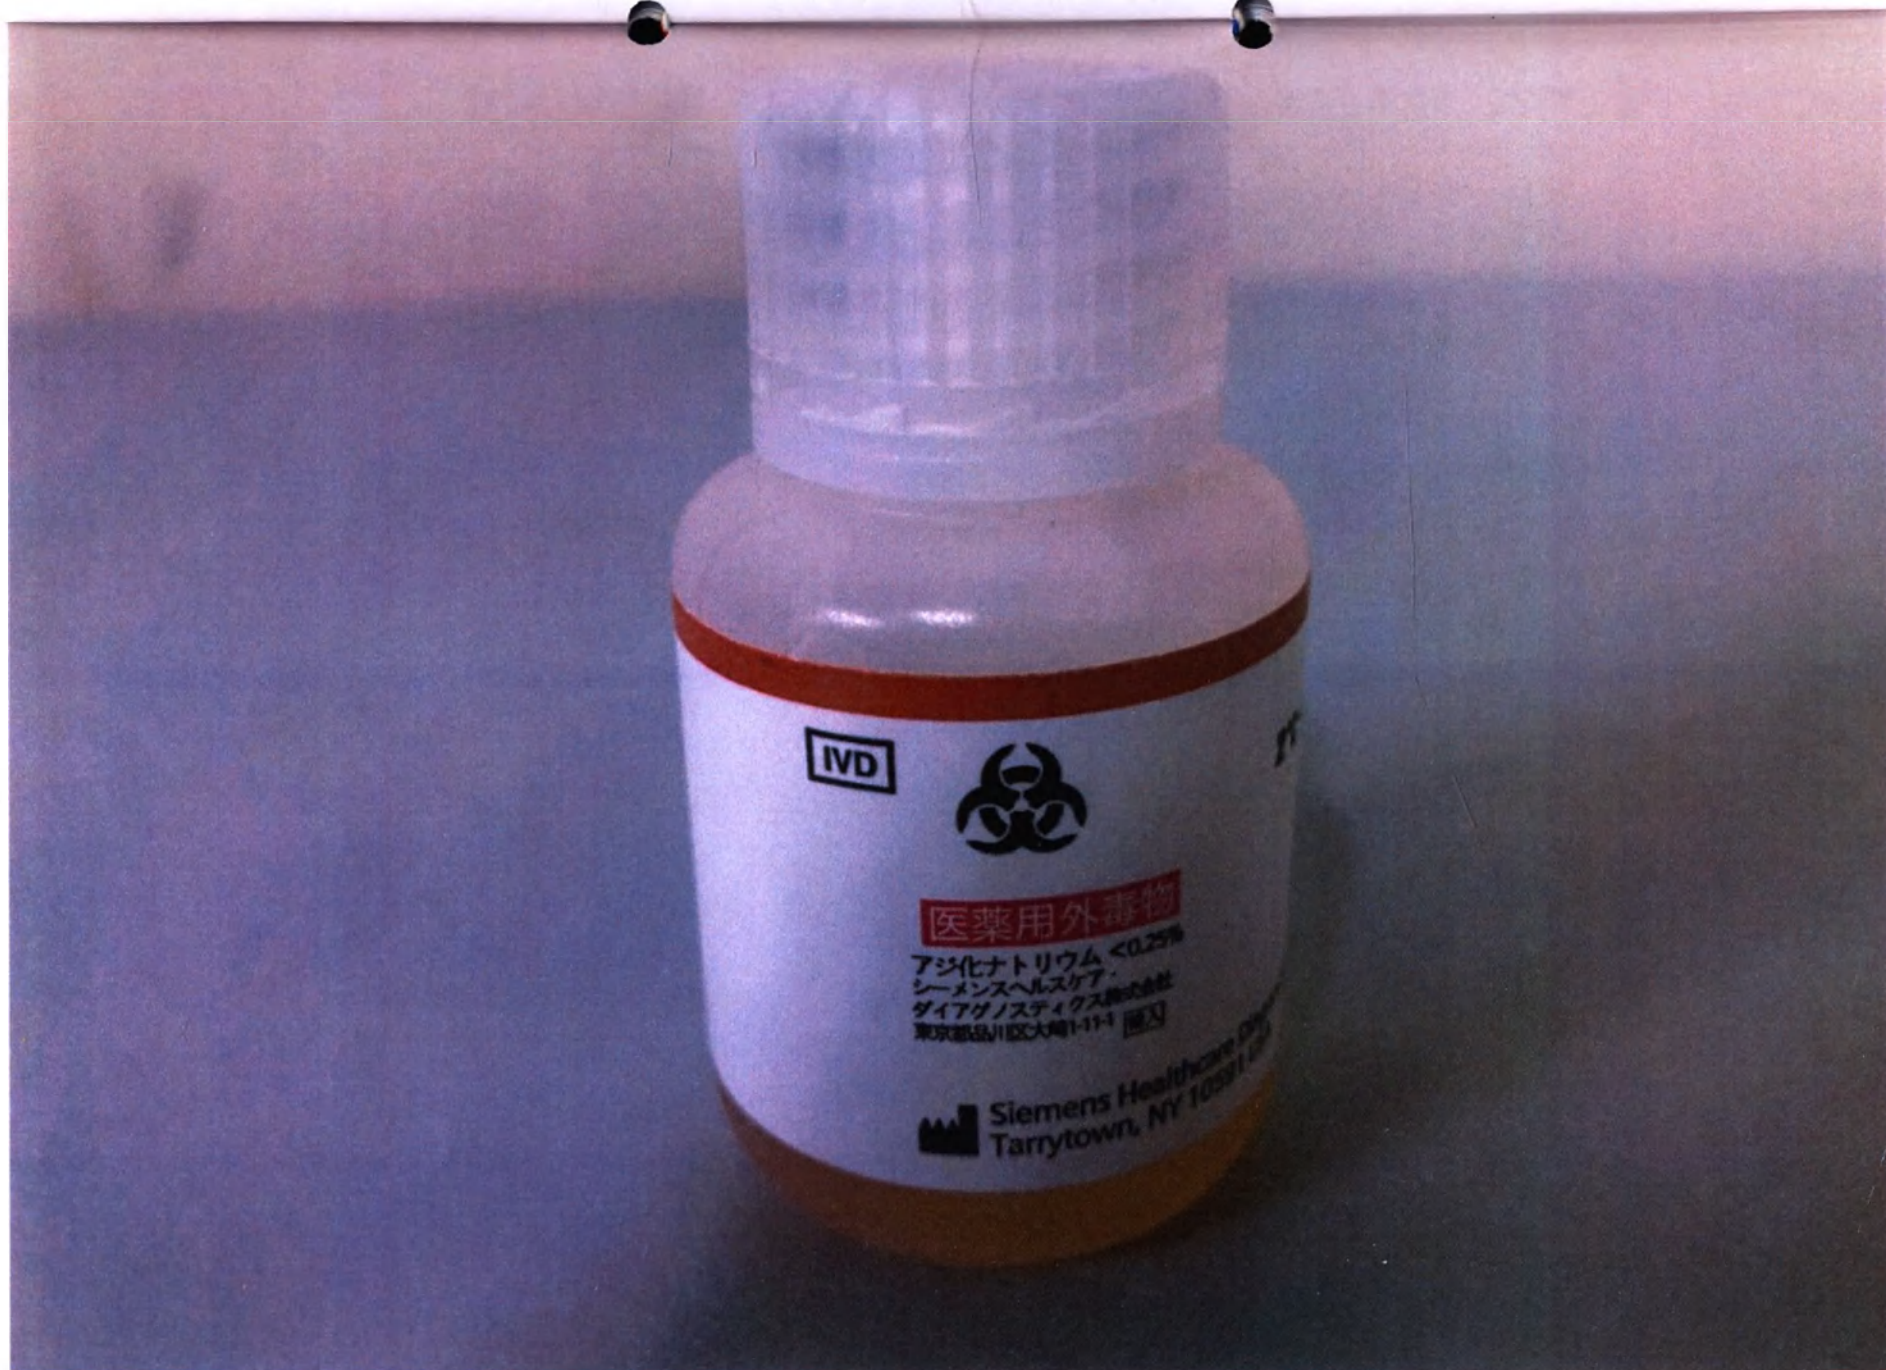


Рисунок 4. Дилуэнт для тироксина для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Total Thyroxine Diluent (Atellica IM T4 DIL)): Дилуэнт для трийодтиронина

Рисунок 5. Дилуент для тироксина для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Total Thyroxine Diluent (Atellica IM T4 DIL)), с русскоязычным стикером

10995686 Дилуэнт для тироксина для анализаторов иммунохимических серии
Atellica (Atellica IM Total Thyroxine Diluent (Atellica IM T4 DIL))

Информация о производителе и стране происхождения
см. на упаковке

Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2020/11663 от 11.08.2020

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на
оригинальной упаковке

Инструкция по применению на русском языке Rev. 01

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению

Авторизованный представитель изготовителя на территории Российской Федерации

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96

Рисунок 6. Русскоязычный стикер дилуэнта для тироксина для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Total Thyroxine Diluent (Atellica IM T4 DIL))

Всего прошито и пронумеровано
4 листа (ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»

