

Руководитель отдела качества
и корпоративных технологий
ООО «Сименс Здравоохранение»

«*И.Б. Медведева*» 2021 г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO**

**«Набор реагентов для определения свободного тироксина на анализаторах
иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Free Thyroxine (Atellica IM FT4))»**

производства «Сименс Хелскеа Diagnostiks Инк.», Siemens Healthcare Diagnostics Inc., США

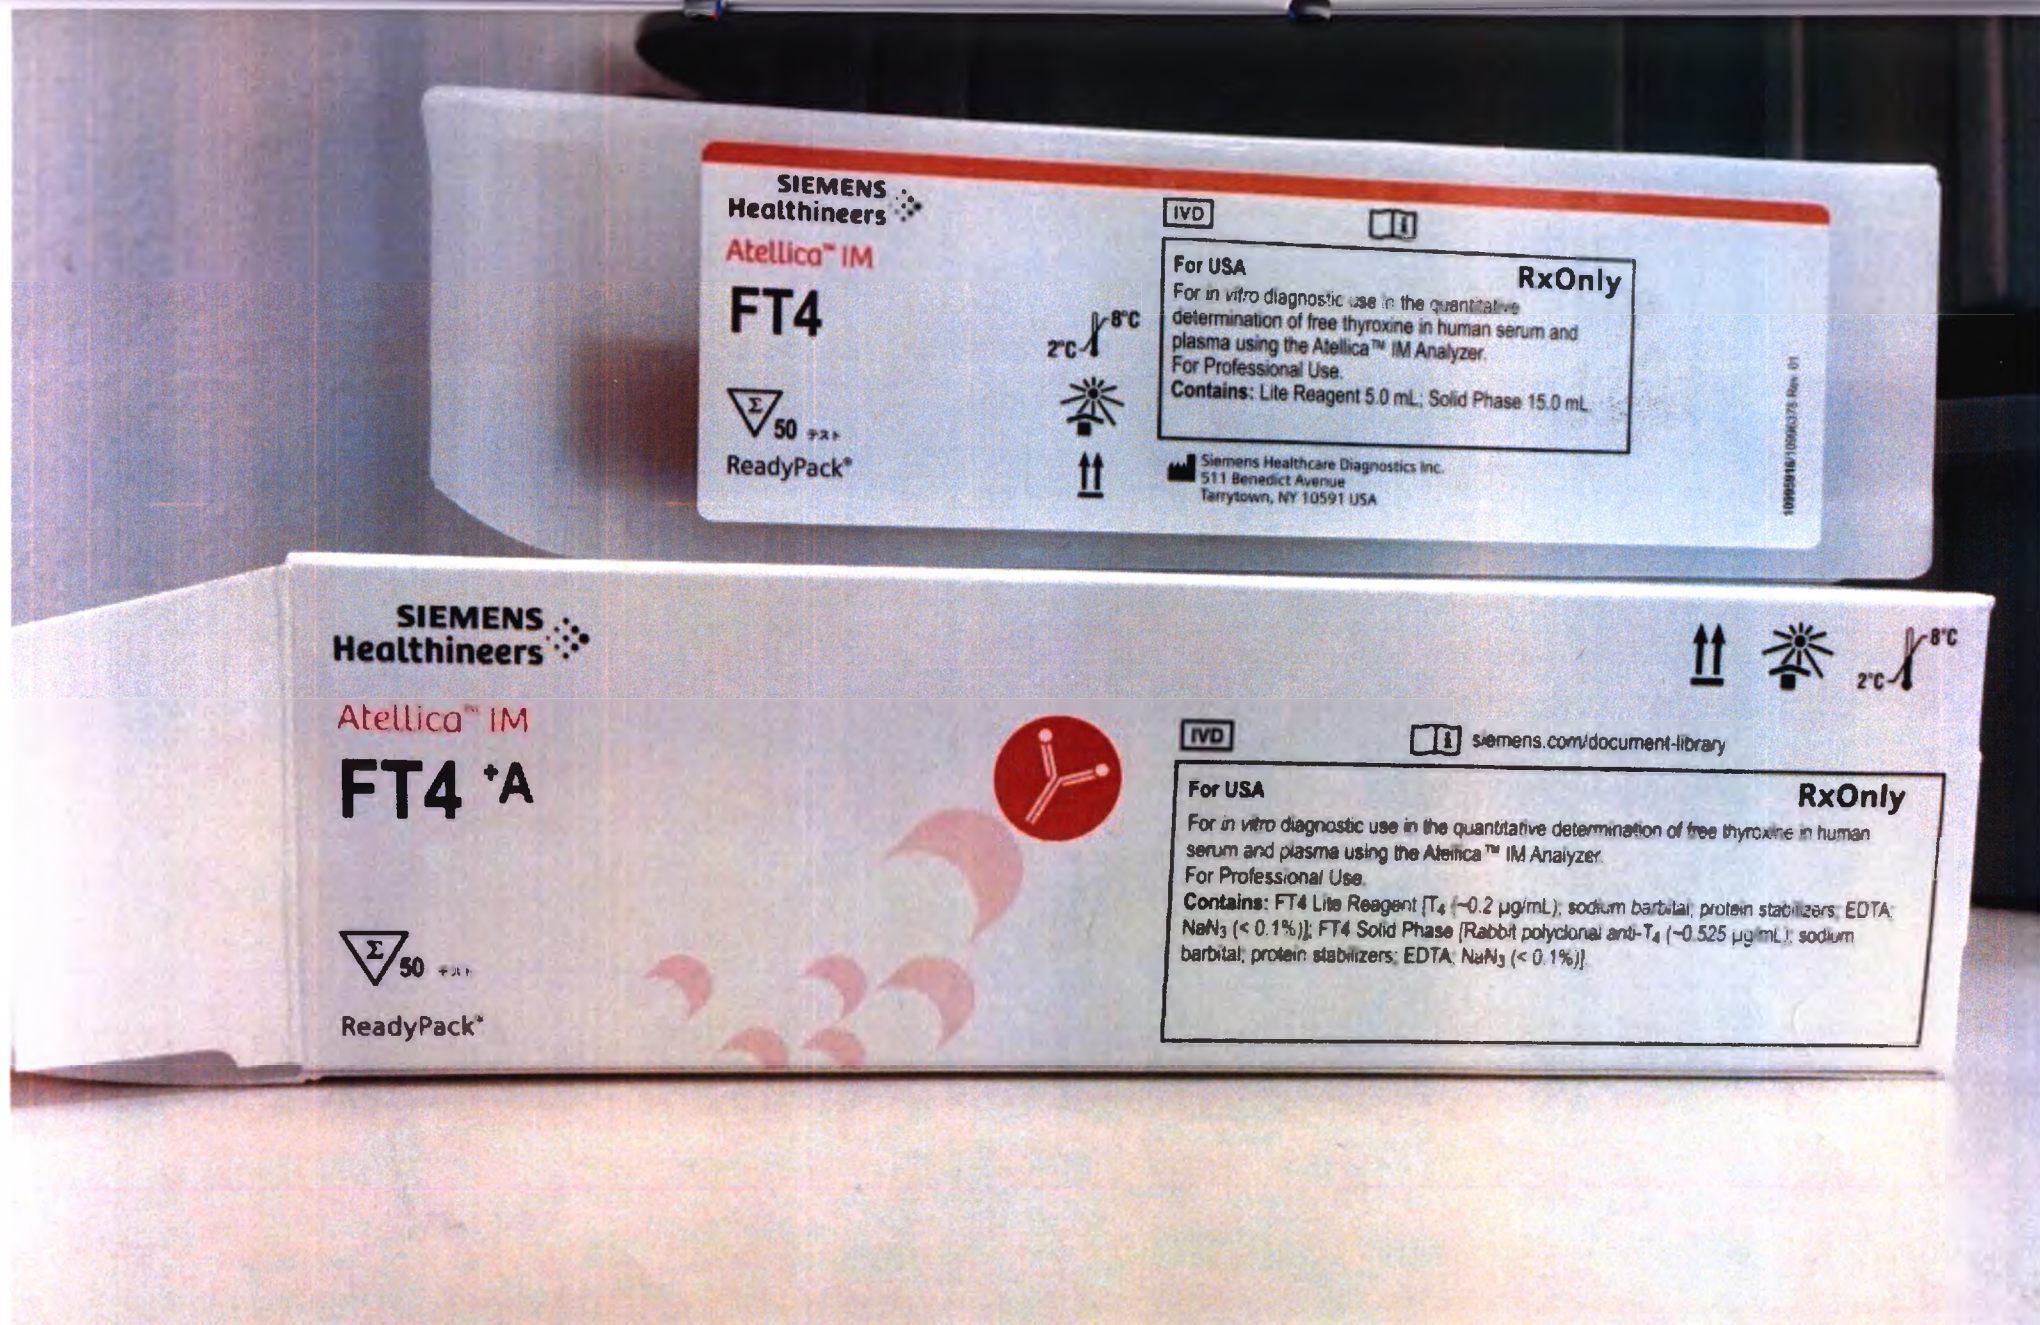


Рисунок 1. Набор реагентов для определения свободного тироксина на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Free Thyroxine (Atellica IM FT4)), Фасовка 50 тестов. Общий вид



Рисунок 2. Набор реагентов для определения свободного тироксина на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Free Thyroxine (Atellica IM FT4)), Фасовка 250 тестов. Общий вид



Рисунок 3. Набор реагентов для определения свободного тироксина на анализаторах иммунохимической серии Atellica (Atellica IM Free Thyroxine (Atellica IM FT4)), Фасовка 250 тестов. Общий вид с маркировкой для Российской Федерации

10995568 Набор реагентов для определения свободного тироксина на анализаторах иммунохимической серии Atellica (Atellica IM Free Thyroxine (Atellica IM FT4))

Информация о применении и сроке годности
см. на упаковке

Регистрационный номер
№ РЗН 2020/03602 от 27.11.2020

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Код платим, одна единица, условия хранения и др. символы указаны на оригинальной упаковке

Инструкция по применению на русском языке Rev. 03

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению.
Ассигнованный производителем материал не по территории Российской Федерации.
ООО «Сильвер-Здравозащитный», 115093, Москва, ул. Дубининская, 98

Рисунок 4. Набор реагентов для определения свободного тироксина на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Free Thyroxine (Atellica IM FT4)), Фасовка 250 тестов. Маркировка для Российской Федерации

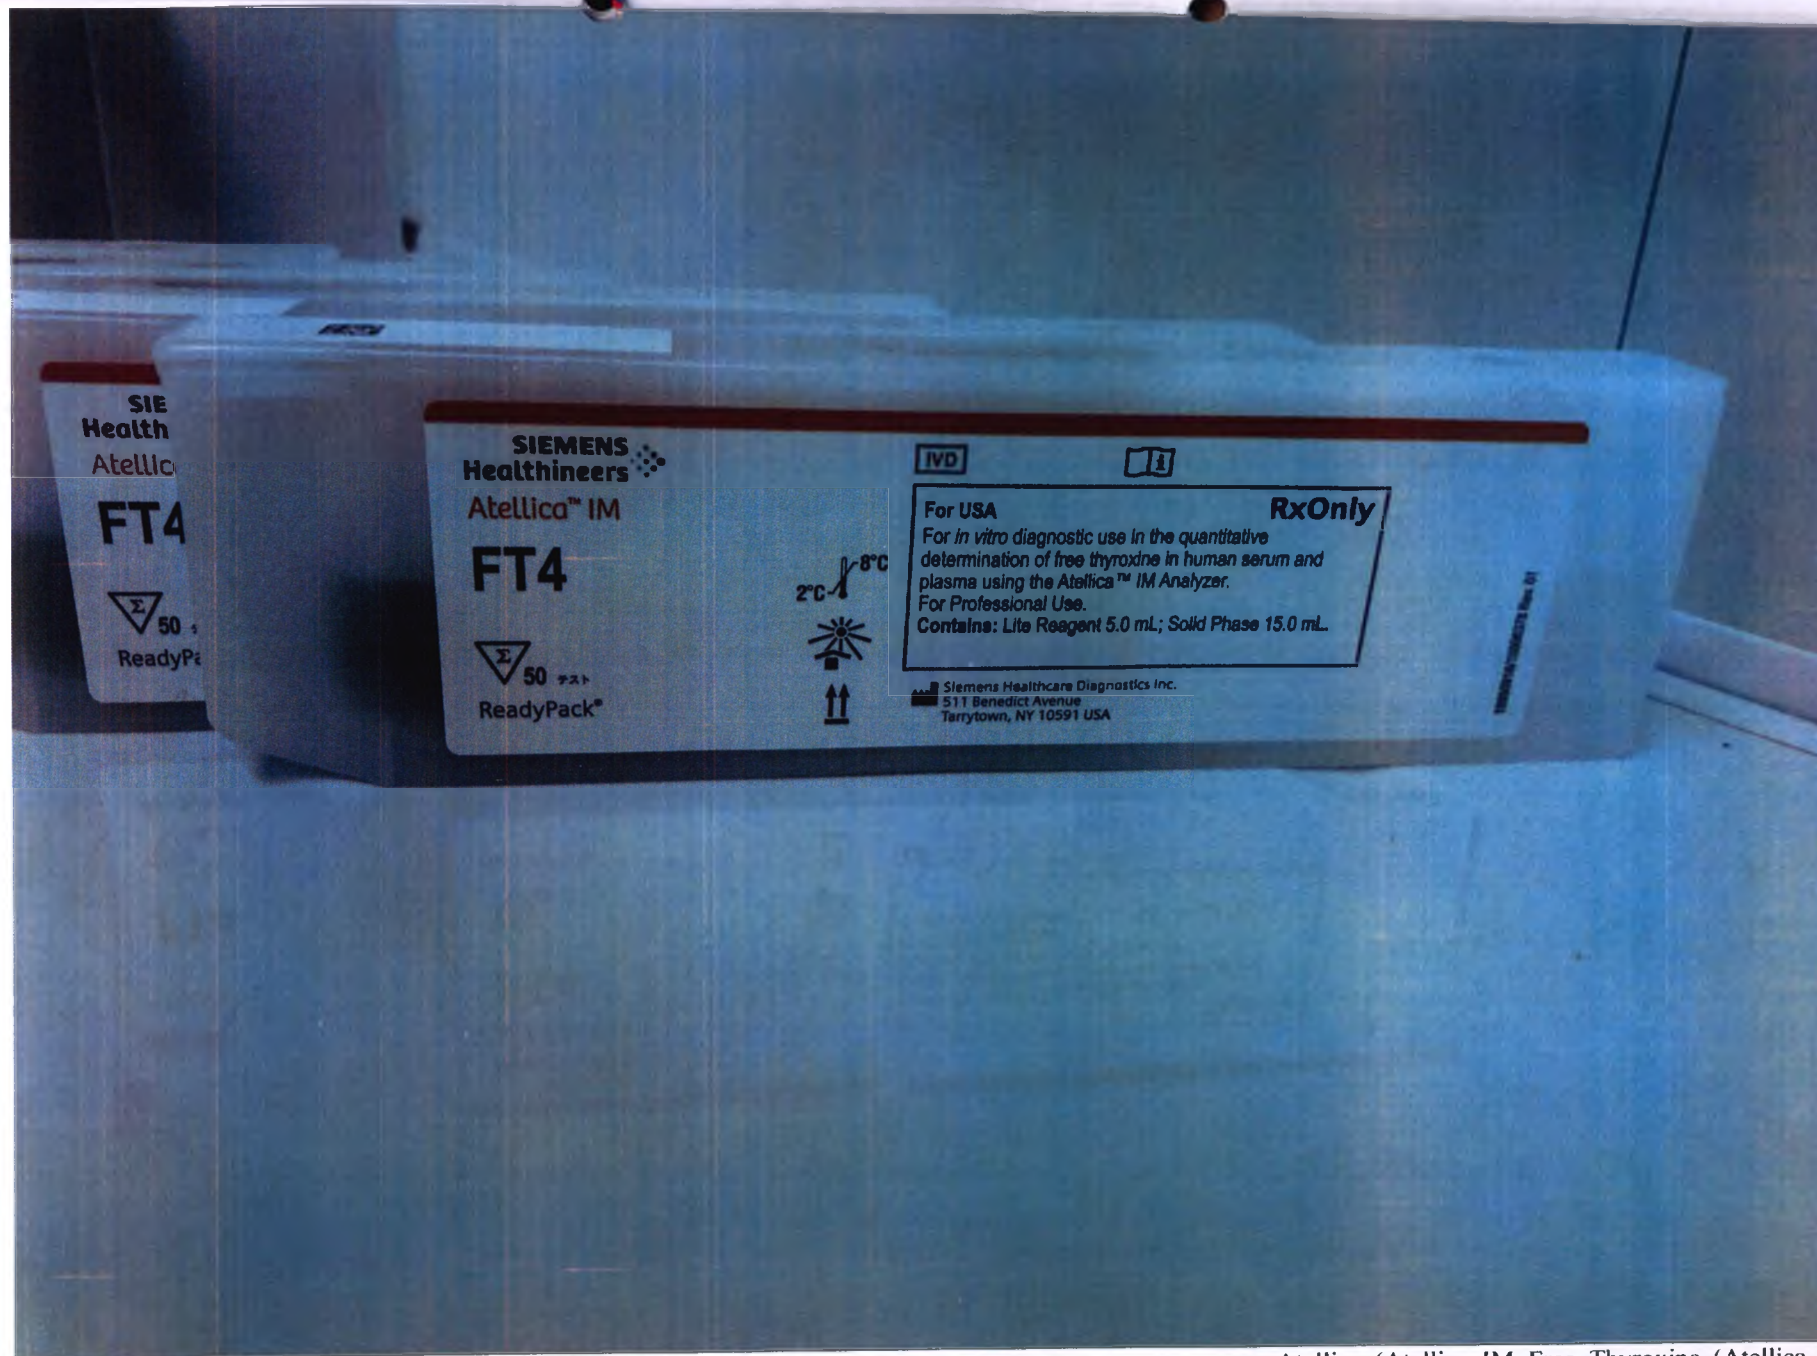


Рисунок 5. Набор реагентов для определения свободного тироксина на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Free Thyroxine (Atellica IM FT4)): Первичный реагент Atellica IM FT4

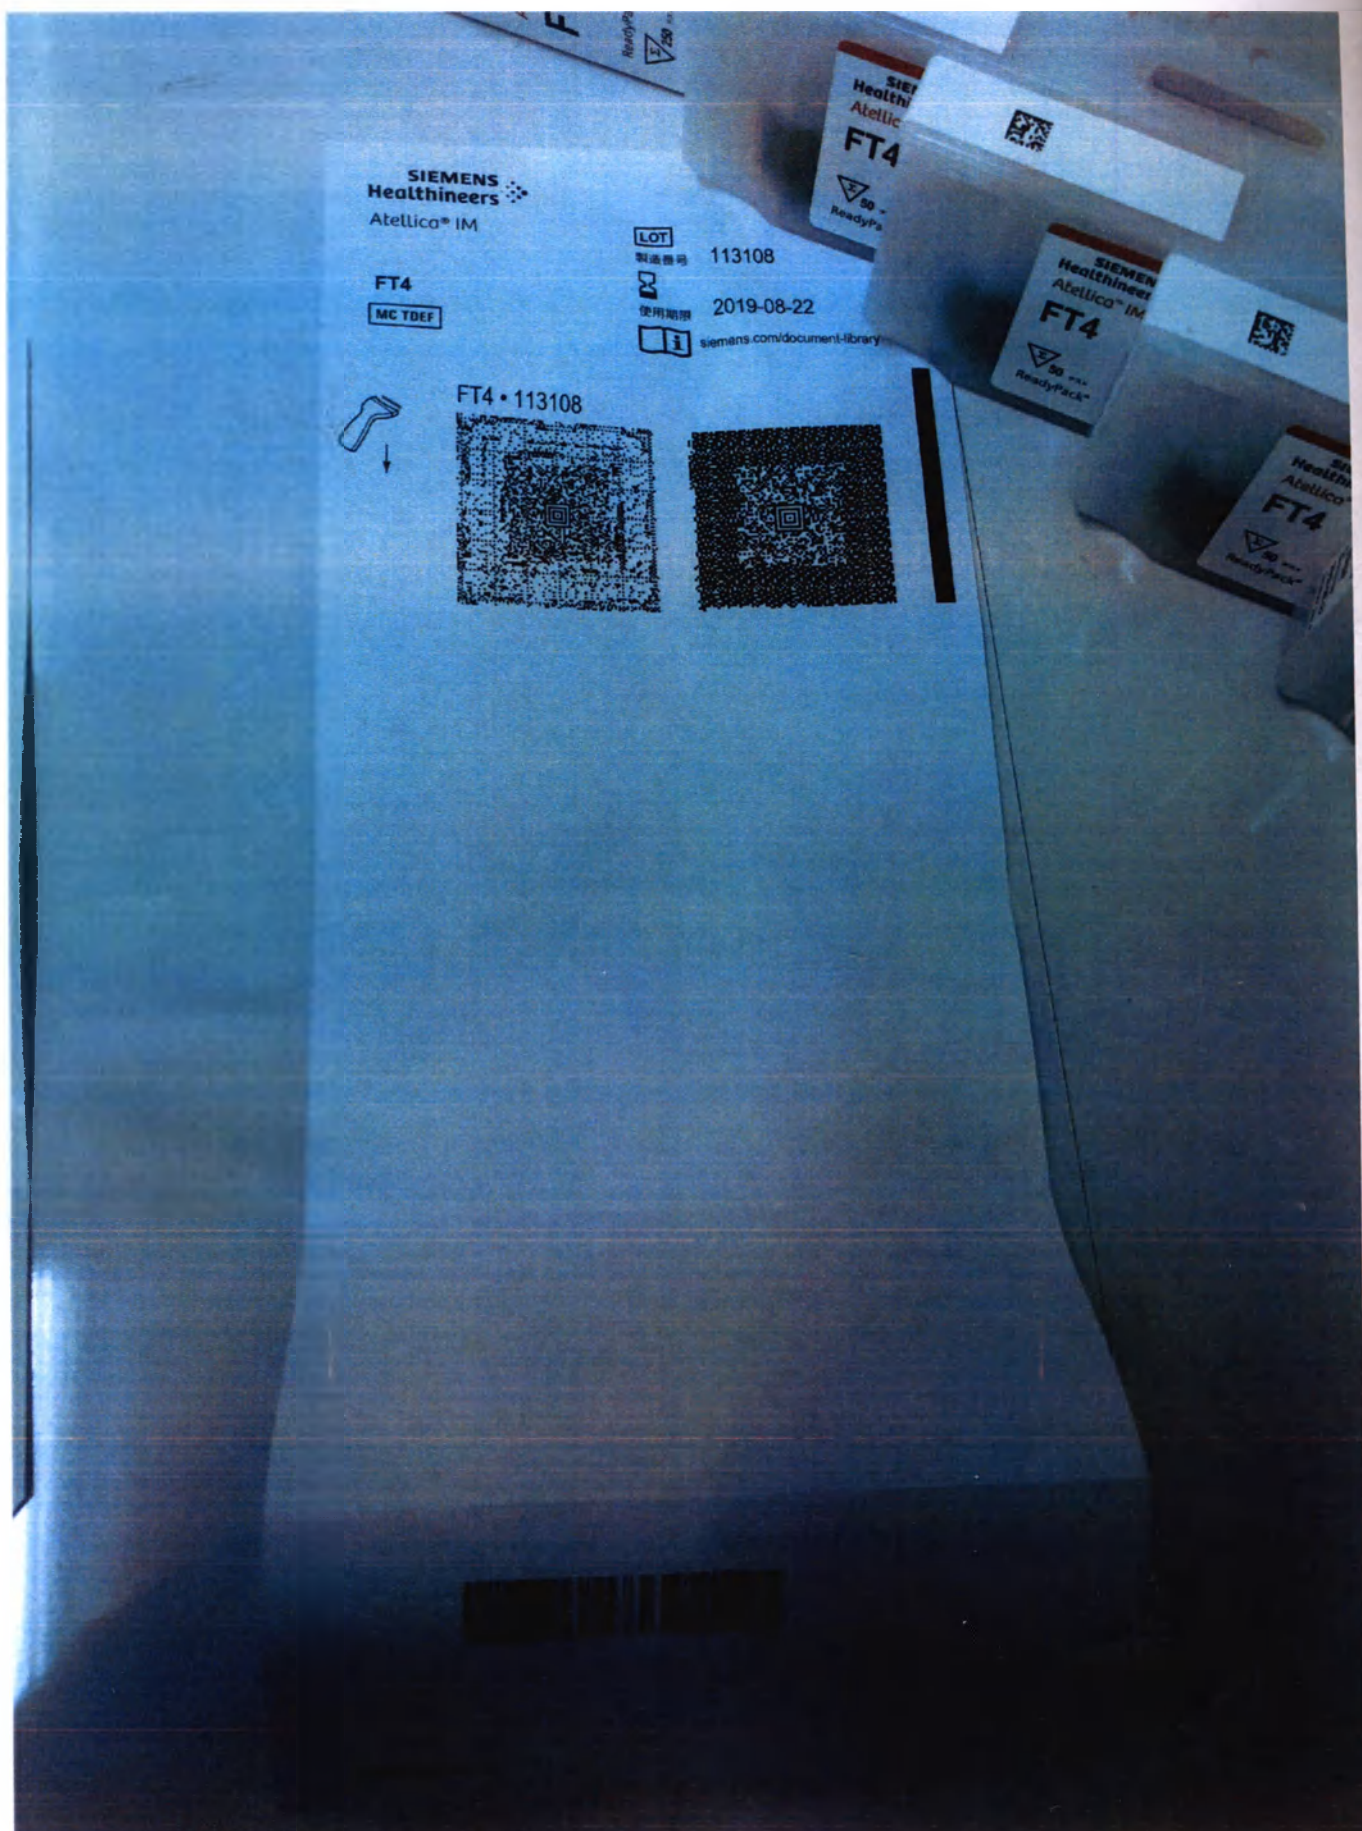


Рисунок 6. Набор реагентов для определения свободного тироксина на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Free Thyroxine (Atellica IM FT4)): Вкладыш со штрих-кодом MC TDEF для Atellica IM FT4

Всего прошито и пронумеровано
7 листа (ов).

ООО «Сименс Здоровоохранение»

