


Руководитель группы регистрации
ООО «Сименс Здравоохранение»

«  Н.А. Горшкова
2021 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO**

**«Дилуент для трийодтиронина для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica
IM Total Triiodothyronine Diluent (Atellica IM T3 DIL))»**

производства «Сименс Хелскеа Диагностикс Инк.», Siemens Healthcare Diagnostics Inc., США

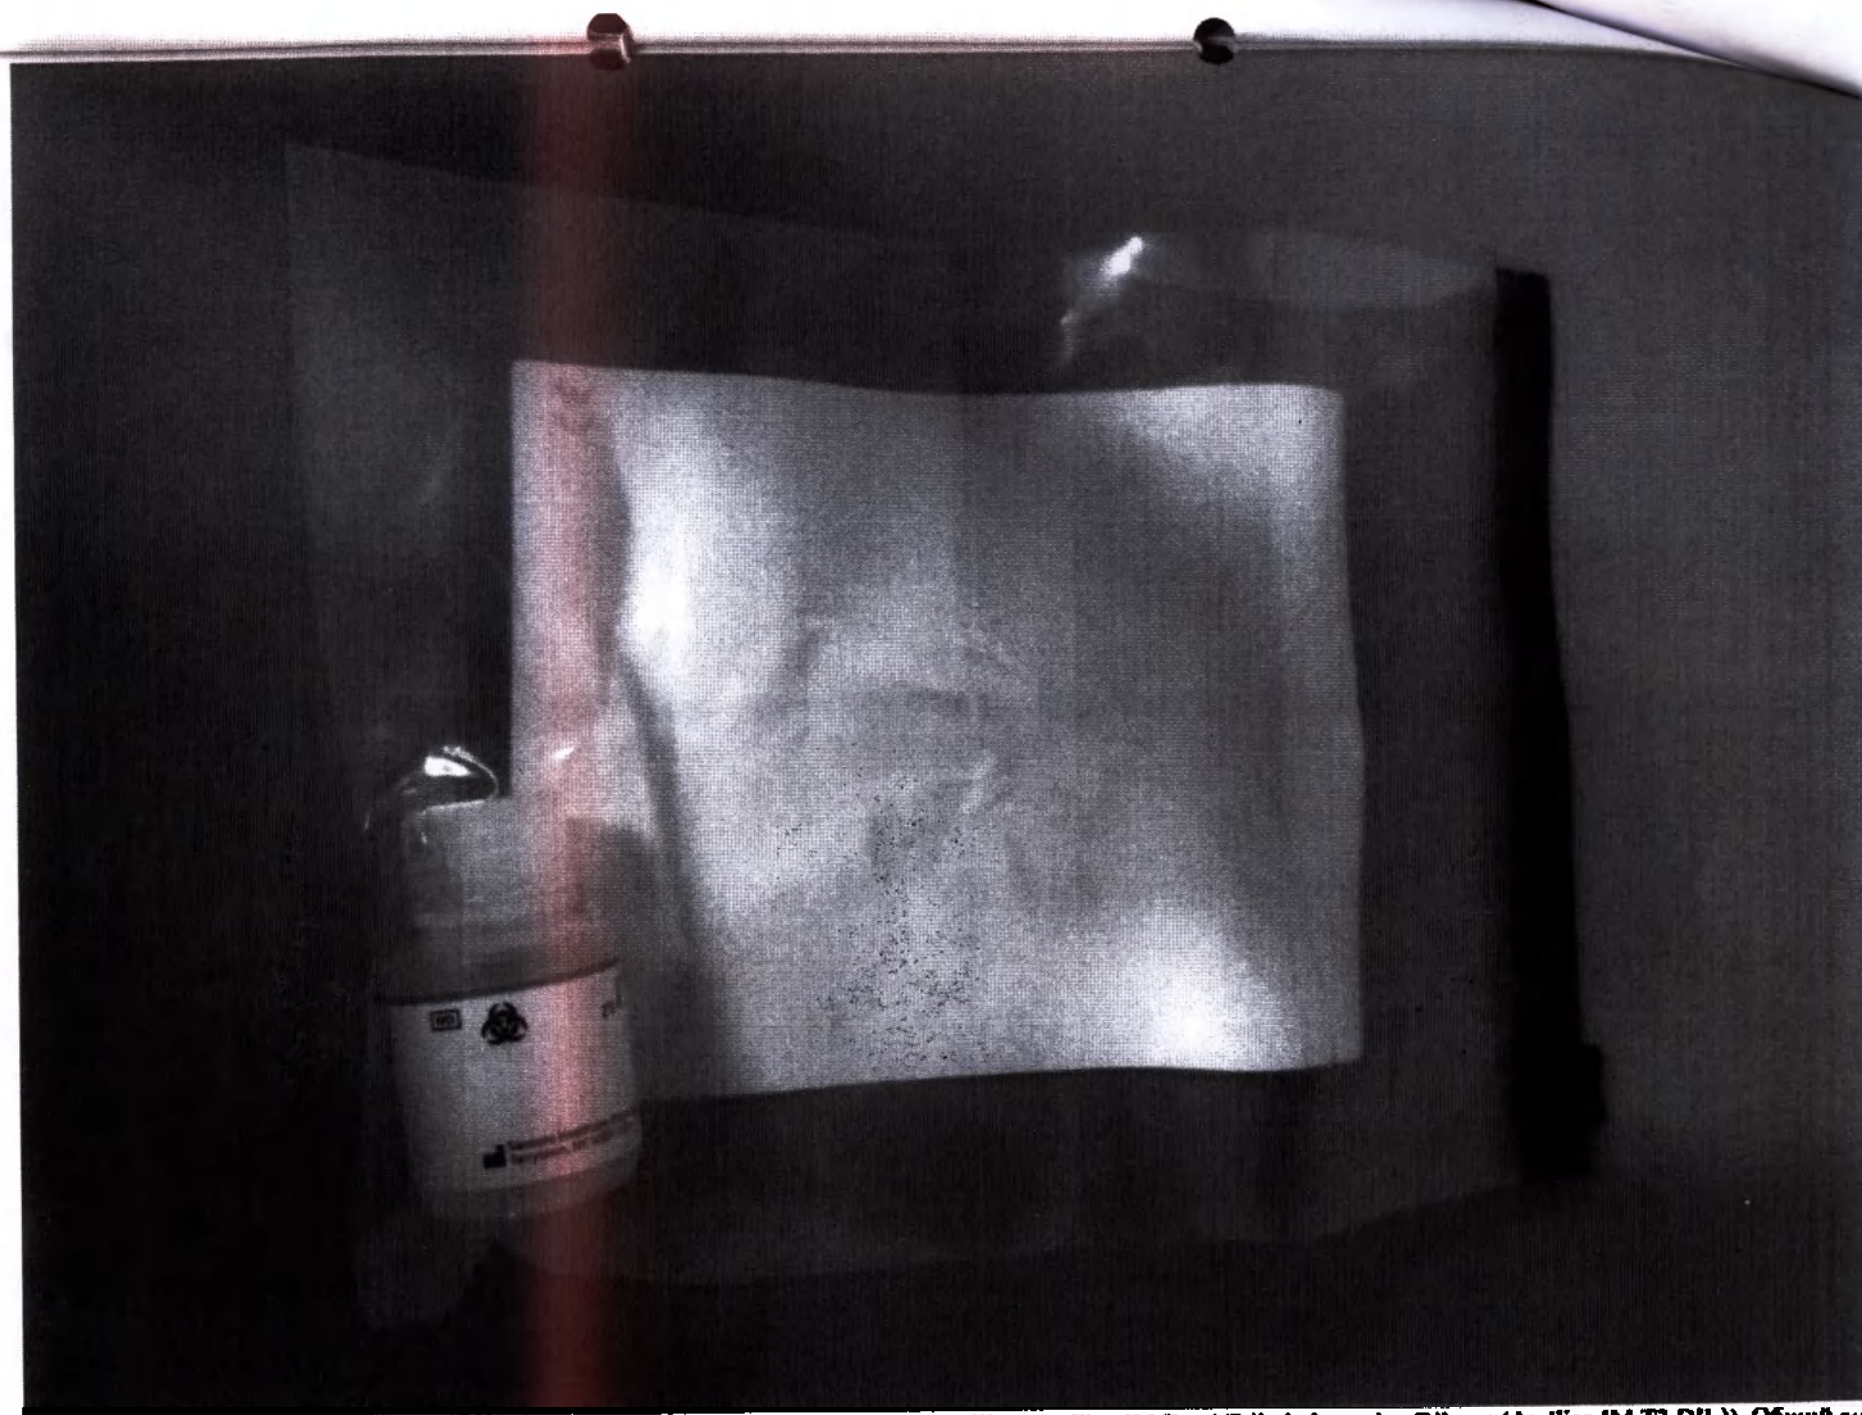




Рисунок 3. Дилуент для трийодтиронина для анализаторов иммунохимических серий Atellica (Atellica IM Total Triiodothyronine Diluent (Atellica IM T3 DIL)): Дилуент для трийодтиронина (Atellica IM Total Triiodothyronine Diluent (Atellica IM T3 DIL)) - 10,0 мл/флакон.

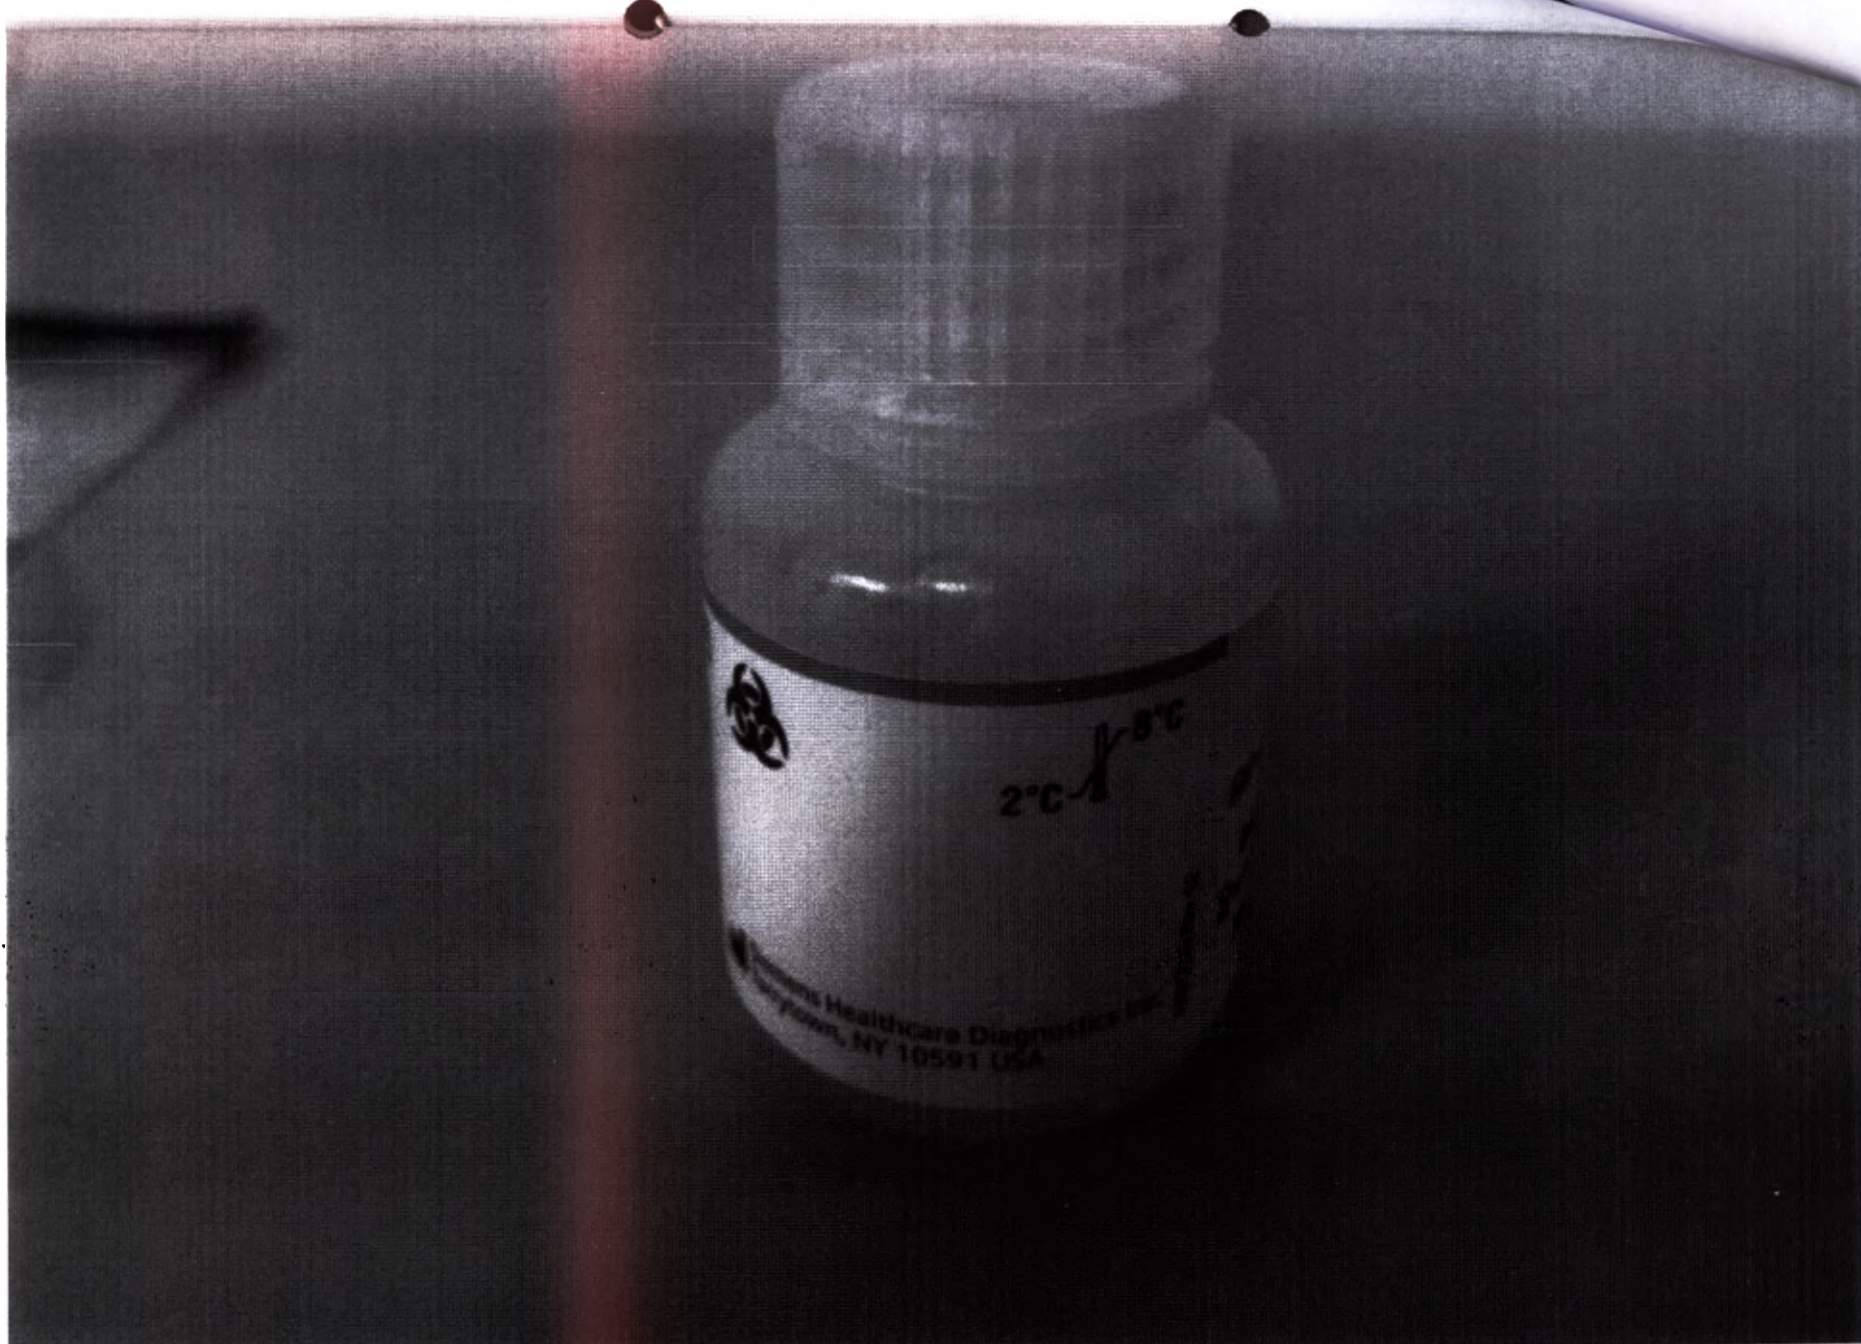


Рисунок 4. Дилуэнт для трийодтиронина для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Total Triiodothyronine Diluent (Atellica IM T3 DIL)): Дилуэнт для трийодтиронина (Atellica IM Total Triiodothyronine Diluent (Atellica IM T3 DIL)) - 10,0 мл/флакон.

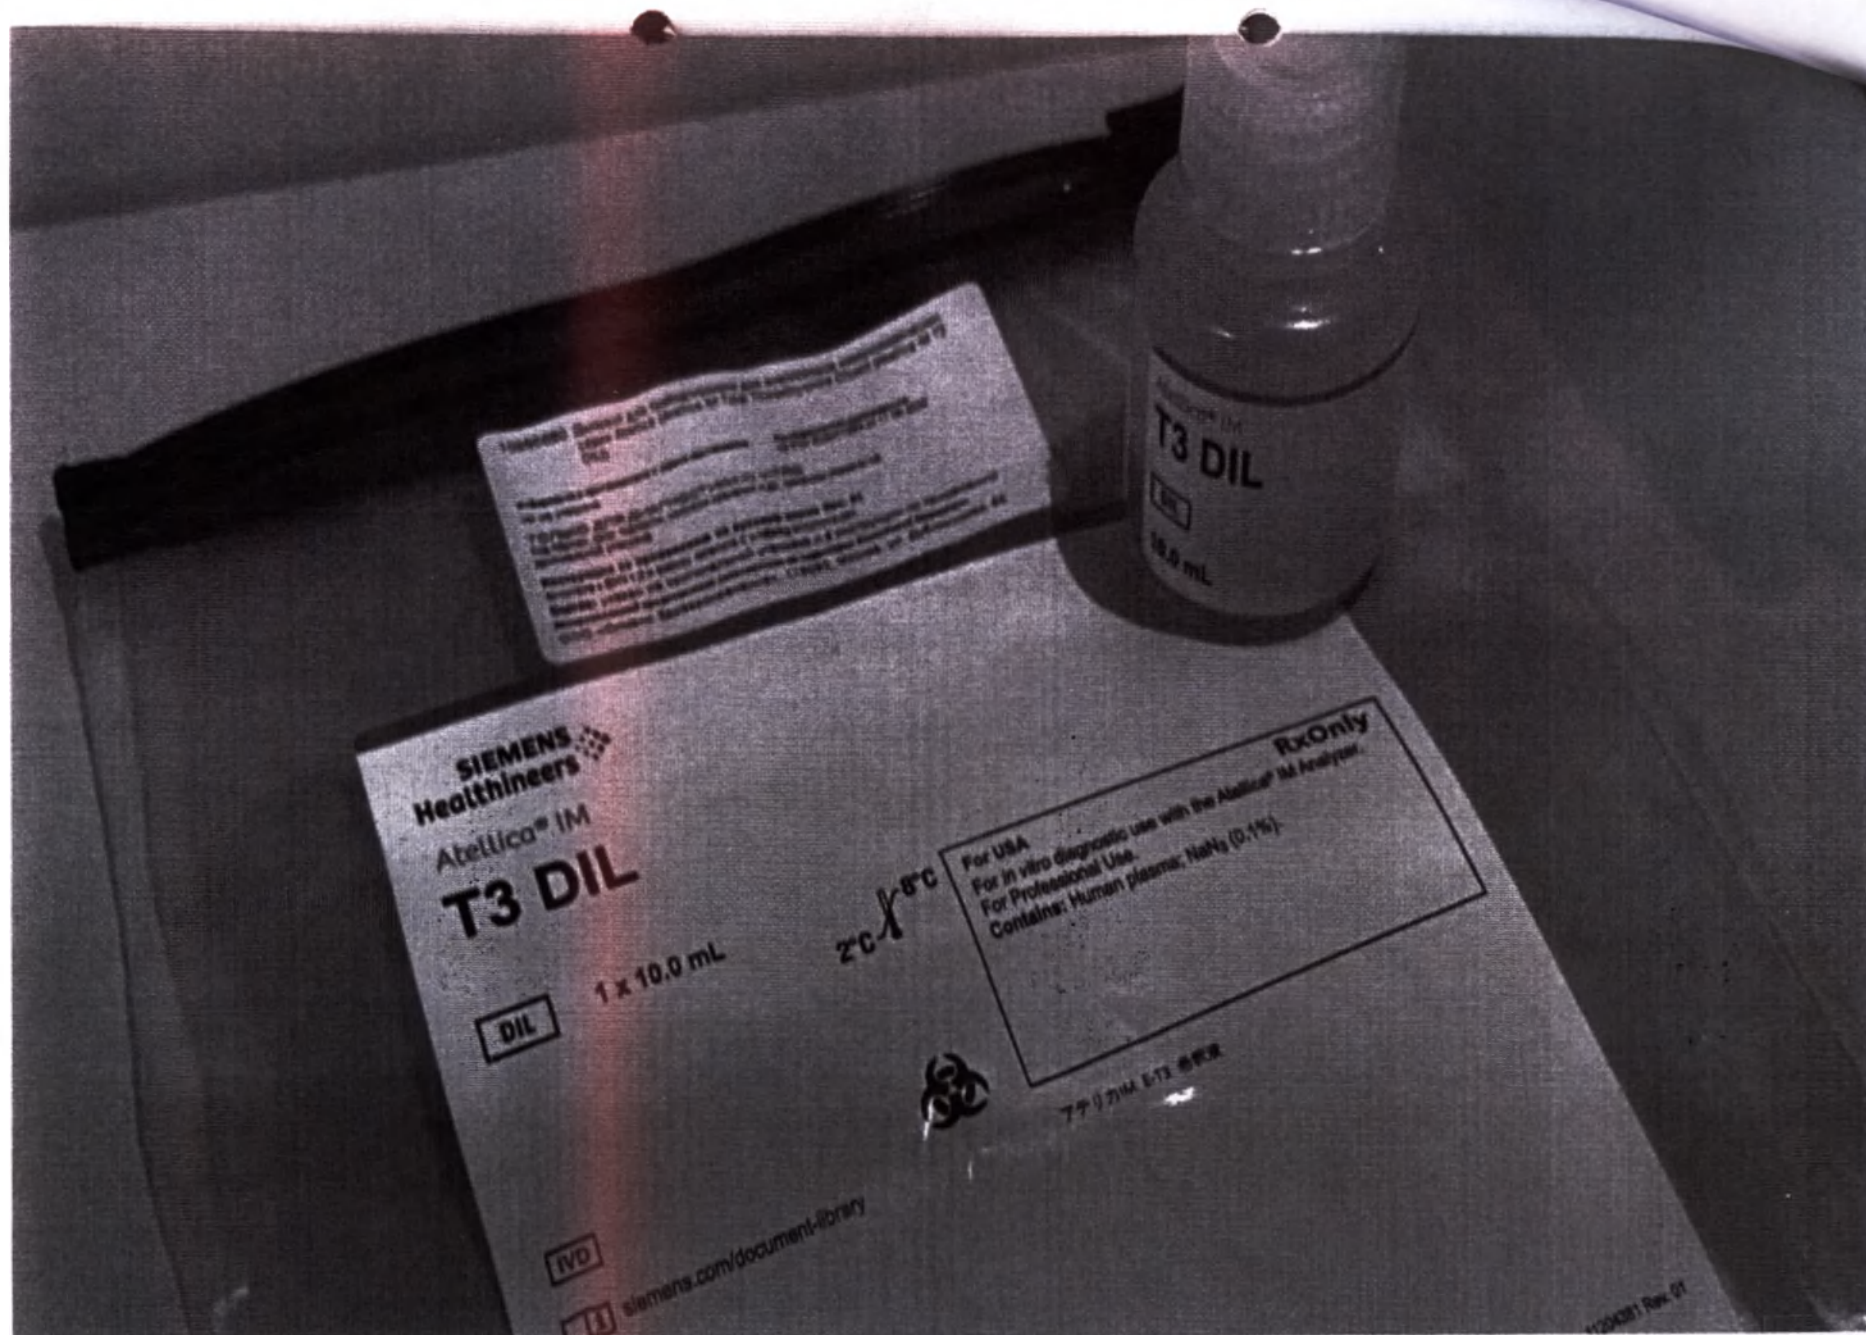


Рисунок 5. Дилуэнт для трийодтиронина для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Total Triiodothyronine Diluent (Atellica IM T3 DIL)), с русскоязычным тикером



Всего прошито и пронумеровано
6 листа (ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»